

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Оссис Медикал Групп»

А.А. Нестеренко

« 08 » 2020 г.




Макет маркировки медицинского изделия

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019**


2020 г

Макет маркировки потребительской упаковки. Вариант исполнения: OMME 1.0 ml

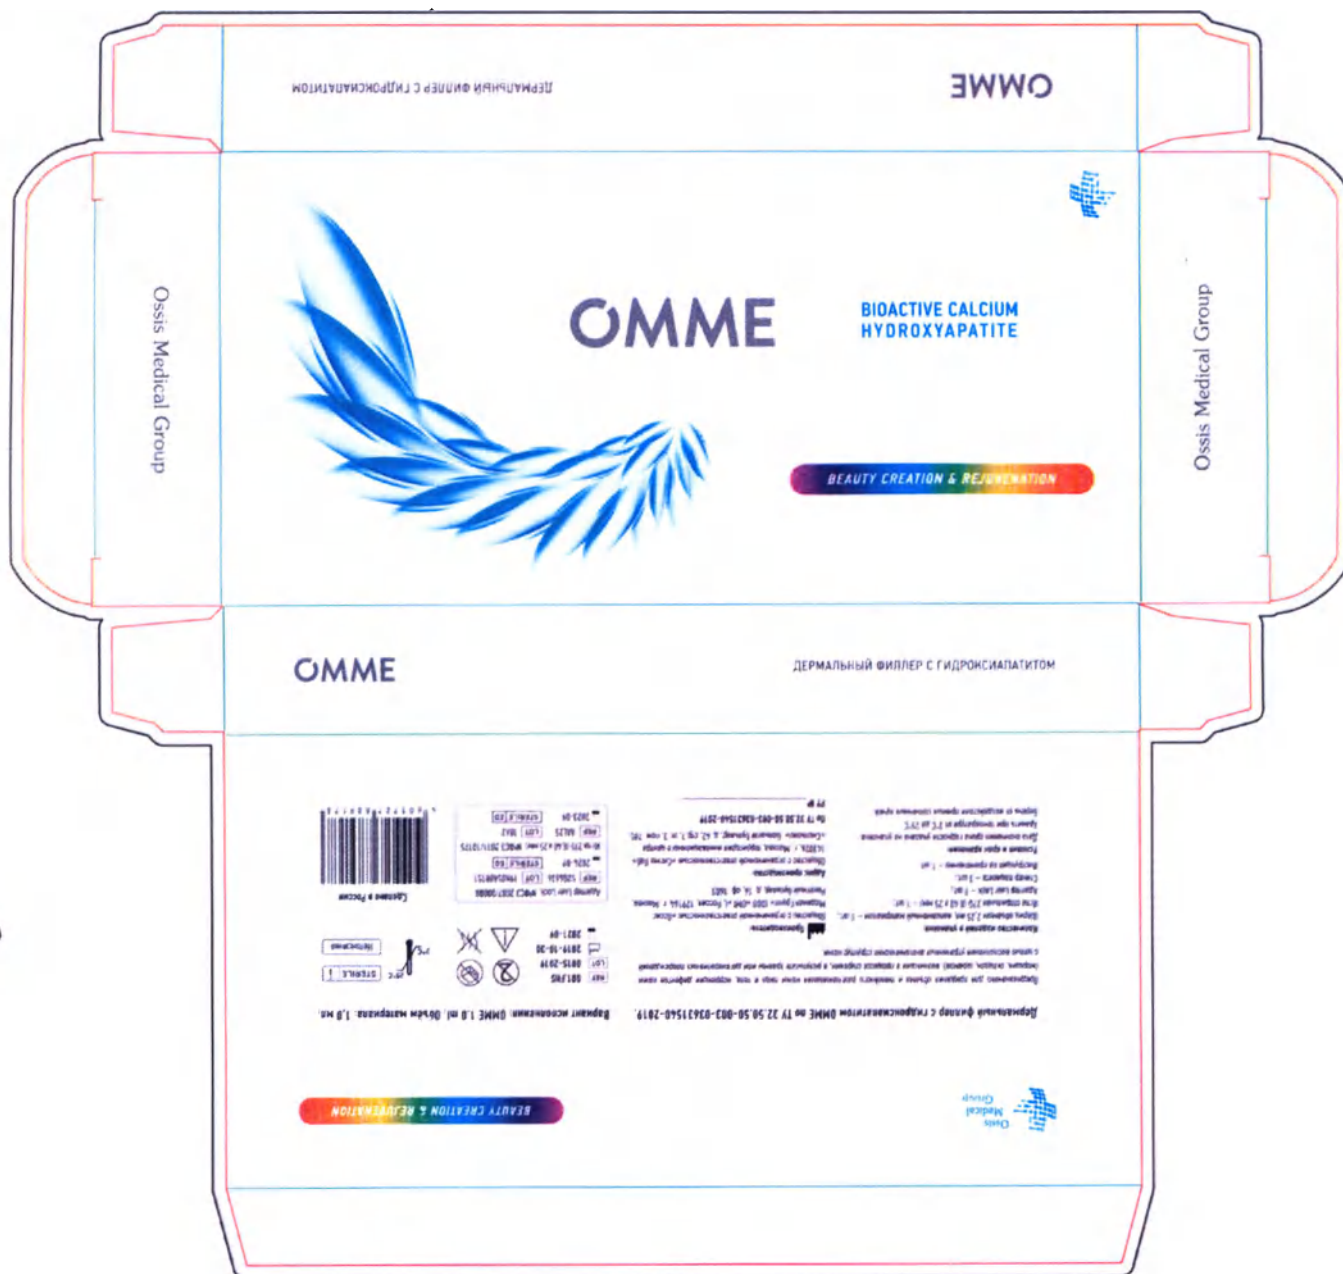





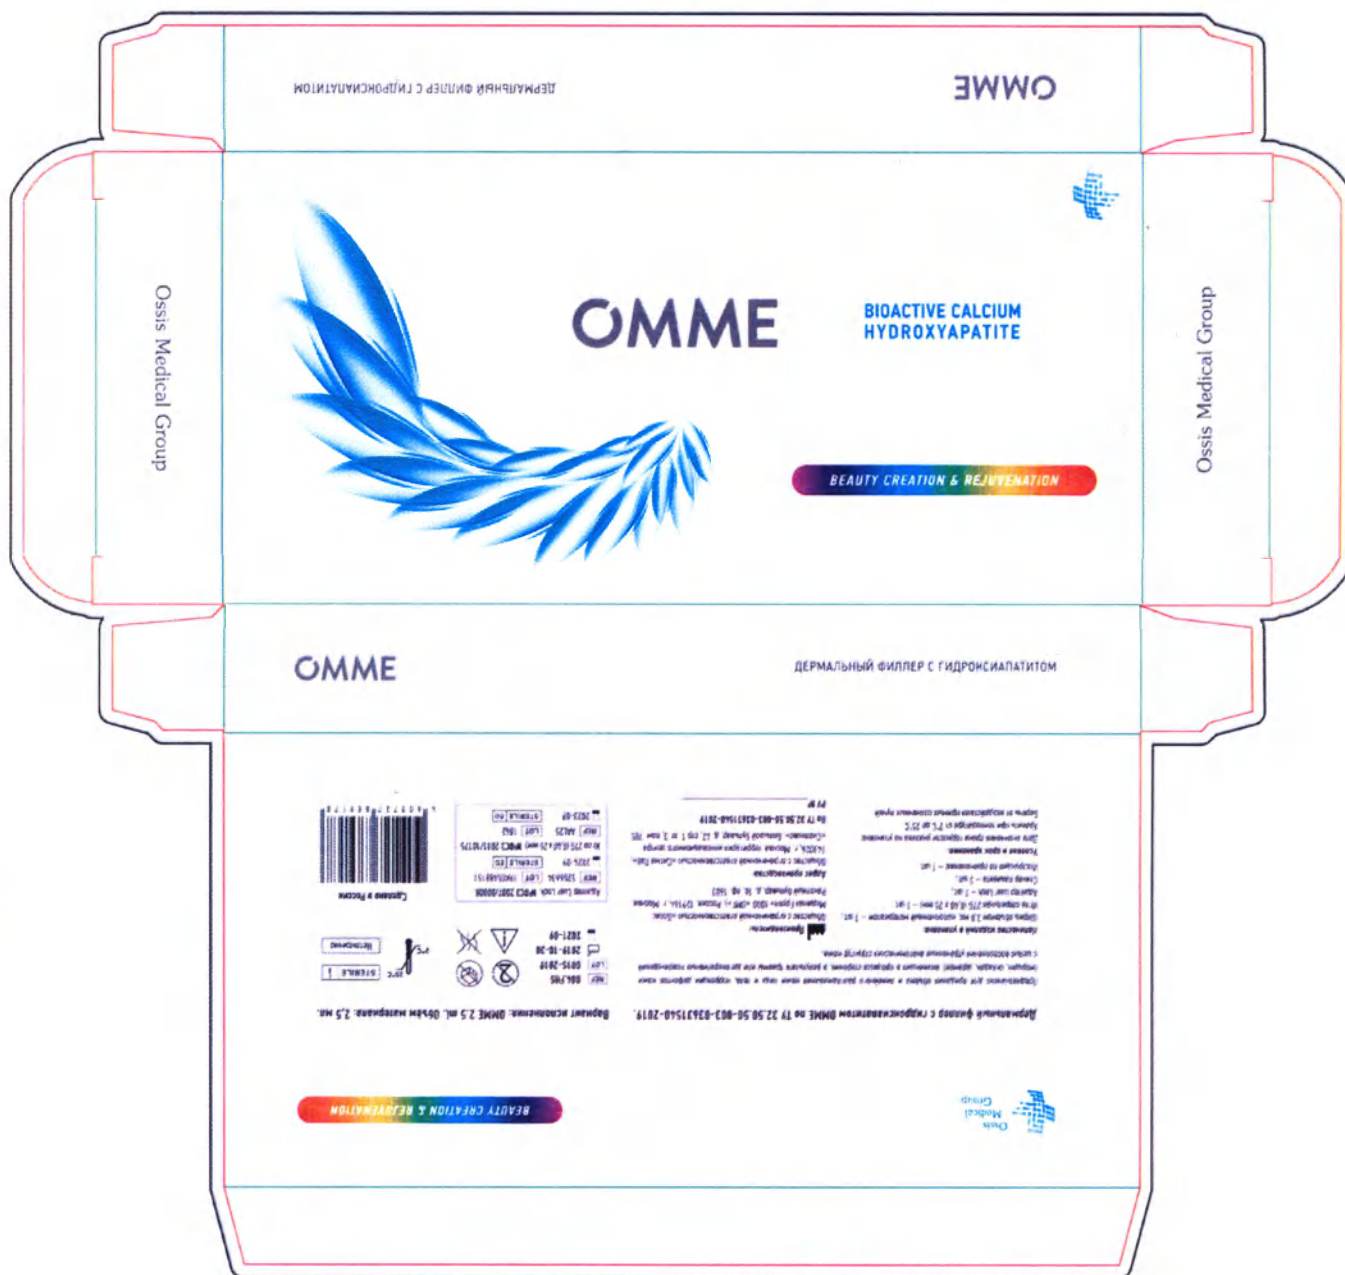

Дермальный филлер с гидроксиапатитом ОММЕ по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019.

Предназначено для придания объема и линейного разглаживания кожи лица и тела, коррекции дефектов кожи (морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений с целью восполнения утраченных анатомических структур кожи.

Количество изделий в упаковке:

Шприц объемом 2,25 мл, наполненный материалом — 1 шт.;
 Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) — 1 шт.;
 Адаптер Luer Lock — 1 шт.;
 Стикер пациента — 3 шт.;
 Инструкция по применению — 1 шт.

Условия и срок хранения:

Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре от 2°C до 25°C.
 Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

РУ № _____

Вариант исполнения: ОММЕ 1.0 мл. Объем материала: 1,0 мл.

REF 001.FHS
 LOT 001S-2019
 2019-10-30
 2021-09



Адаптер Luer Lock. №ФСЗ 2007/00008.

REF 5206634 LOT 19K05A88151

2024-09 STERILE EO

Игла 27G (0,40 x 25 мм). №ФСЗ 2011/10175

REF AAL25 LOT 1842

2023-09 STERILE EO

Сделано в России



Дермальный филлер с гидроксиапатитом ОММЕ по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019.

Предназначено для придания объема и линейного разглаживания кожи лица и тела, коррекции дефектов кожи (морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений с целью восполнения утраченных анатомических структур кожи.

Количество изделий в упаковке:

Шприц объемом 2,25 мл, наполненный материалом — 1 шт.;
 Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) — 1 шт.;
 Адаптер Luer Lock — 1 шт.;
 Стикер пациента — 3 шт.;
 Инструкция по применению — 1 шт.

Условия и срок хранения:

Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре от 2°C до 25°C.
 Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

РУ № _____

Вариант исполнения: ОММЕ 1.5 мл. Объем материала: 1,5 мл.

REF 002.FHS
 LOT 001S-2019
 2019-10-30
 2021-09



Адаптер Luer Lock. №ФСЗ 2007/00008.

REF 5206634 LOT 19K05A88151

2024-09 STERILE EO

Игла 27G (0,40 x 25 мм). №ФСЗ 2011/10175

REF AAL25 LOT 1842

2023-09 STERILE EO

Сделано в России



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019.

Предназначено для придания объёма и линейного разглаживания кожи лица и тела, коррекции дефектов кожи (морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений с целью восполнения утраченных анатомических структур кожи.

Количество изделий в упаковке:

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом — 1 шт.;
 Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) — 1 шт.;
 Адаптер Luer Lock — 1 шт.;
 Стикер пациента — 3 шт.;
 Инструкция по применению — 1 шт.

Условия и срок хранения:

Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре от 2°C до 25°C.
 Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

РУ № _____

Вариант исполнения: OMME 2.0 ml. Объём материала: 2,0 мл.

REF 003.FHS
 LOT 001S-2019
 2019-10-30
 2021-09



Адаптер Luer Lock. №ФСЗ 2007/00008.

REF 5206634 LOT 19K05A88151

2024-09 STERILE EO

Игла 27G (0,40 x 25 мм). №ФСЗ 2011/10175

REF AAL25 LOT 1842

2023-09 STERILE EO

Сделано в России



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019.

Предназначено для придания объёма и линейного разглаживания кожи лица и тела, коррекции дефектов кожи (морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений с целью восполнения утраченных анатомических структур кожи.

Количество изделий в упаковке:

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом — 1 шт.;
 Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) — 1 шт.;
 Адаптер Luer Lock — 1 шт.;
 Стикер пациента — 3 шт.;
 Инструкция по применению — 1 шт.

Условия и срок хранения:

Дата окончания срока годности указана на упаковке.
 Хранить при температуре от 2°C до 25°C.
 Беречь от воздействия прямых солнечных лучей.



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»), Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства:


Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Лаб», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой Бульвар, д. 42, стр.1, эт. 3, пом. 785.

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

РУ № _____

Вариант исполнения: OMME 2.5 ml. Объём материала: 2,5 мл.

REF 004.FHS
 LOT 001S-2019
 2019-10-30
 2021-09



Адаптер Luer Lock. №ФСЗ 2007/00008.

REF 5206634 LOT 19K05A88151

2024-09 STERILE EO

Игла 27G (0,40 x 25 мм). №ФСЗ 2011/10175

REF AAL25 LOT 1842

2023-09 STERILE EO

Сделано в России





Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 1.0 ml. Объем материала: 1,0 мл.

REF 001.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 1.0 ml. Объем материала: 1,0 мл.

REF 001.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 1.0 ml. Объем материала: 1,0 мл.

REF 001.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: OMME 1.0 ml



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 1.5 ml. Объем материала: 1,5 мл.

REF 002.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 1.5 ml. Объем материала: 1,5 мл.

REF 002.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 1.5 ml. Объем материала: 1,5 мл.

REF 002.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: OMME 1.5 ml



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.0 ml. Объем материала: 2,0 мл.

REF 003.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.0 ml. Объем материала: 2,0 мл.

REF 003.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.0 ml. Объем материала: 2,0 мл.

REF 003.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: OMME 2.0 ml



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.5 ml. Объем материала: 2,5 мл.

REF 004.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.5 ml. Объем материала: 2,5 мл.

REF 004.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №



Ossis
Medical
Group

Сделано в России

STERILE |



Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения: OMME 2.5 ml. Объем материала: 2,5 мл.

REF 004.FHS
LOT 001S-2019
2019-10-30
2021-09

Игла 27G (0,40 x 25 мм) REF AAL25 LOT 1842
№ФСЗ 2011/10175 2023-09 STERILE EO
Адаптер Luer Lock REF 5206634 LOT 19K05A88151
№ФСЗ 2007/00008 2024-09 STERILE EO

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019. РУ №

ФИО

Дата рождения Пол

Аллергические реакции

Процедура №

Макет маркировки стикера пациента. Вариант исполнения: OMME 2.5 ml



Ossis
Medical
Group

Объём материала: 1,0 мл.

REF 001.FHS 2019-10-30

LOT 001S-2019 2021-09

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 1.0 ml

Шприц объёмом 2,25 мл, наполненный материалом – 1 шт.

 Производитель: "Шаньдун Вэйгао Груп Медикал Полимер Компани Лимитэд", Китай / Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., No. 18 Xingshan Road, High-tech Industrial Development Zone, 264210 Weihai City, Shandong Province.
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA.
РУ № РЗН 2013/764

WEGO 威高



Нетоксично

STERILE !



Ossis
Medical
Group

Объём материала: 1,5 мл.

REF 002.FHS 2019-10-30

LOT 001S-2019 2021-09

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 1.5 ml

Шприц объёмом 2,25 мл, наполненный материалом – 1 шт.

 Производитель: "Шаньдун Вэйгао Груп Медикал Полимер Компани Лимитэд", Китай / Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., No. 18 Xingshan Road, High-tech Industrial Development Zone, 264210 Weihai City, Shandong Province.
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA.
РУ № РЗН 2013/764

WEGO 威高



Нетоксично

STERILE !

Макет маркировки индивидуальной упаковки шприца объёмом 2,25 мл, наполненного материалом. Вариант исполнения (слева направо): OMME 1.0 ml, OMME 1.5 ml



Ossis
Medical
Group

Объём материала: 2,0 мл.

REF 003.FHS 2019-10-30

LOT 001S-2019 2021-09

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 2.0 ml

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом – 1 шт.

 Производитель: "Шаньдун Вэйгао Груп Медикал Полимер Компани Лимитэд", Китай / Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., No. 18 Xingshan Road, High-tech Industrial Development Zone, 264210 Weihai City, Shandong Province.
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA.
РУ № РЗН 2013/764

WEGO 威高



Нетоксично

STERILE |



Ossis
Medical
Group

Объём материала: 2,5 мл.

REF 004.FHS 2019-10-30

LOT 001S-2019 2021-09

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения: OMME 2.5 ml

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом – 1 шт.

 Производитель: "Шаньдун Вэйгао Груп Медикал Полимер Компани Лимитэд", Китай / Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., No. 18 Xingshan Road, High-tech Industrial Development Zone, 264210 Weihai City, Shandong Province.
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA.
РУ № РЗН 2013/764

WEGO 威高



Нетоксично

STERILE |

Макет маркировки индивидуальной упаковки шприца объёмом 3,0 мл, наполненного материалом. Вариант исполнения (слева направо): OMME 2.0 ml, OMME 2.5 ml

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки иглы стерильной 27G (0,40 x 25 мм).
Вариант исполнения: **OMME 1.0 ml**

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения:

OMME 1.0 ml



«БИОТЕКНЕ С.Р.Л.», Италия. /
BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via
Della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX




XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2011/10175

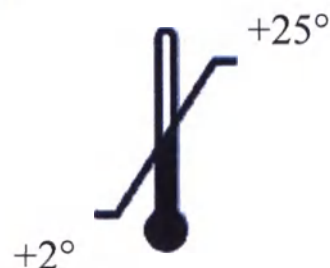

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки иглы стерильной 27G (0,40 x 25 мм).
Вариант исполнения: OMME 1.5 ml

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

**Вариант исполнения:
OMME 1.5 ml**



«БИОТЕКНЕ С.Р.Л.», Италия. /
BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via
Della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX




XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2011/10175

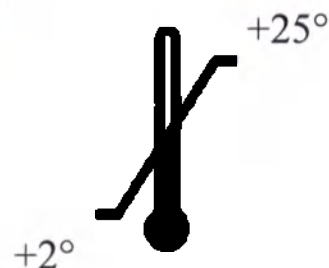

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки иглы стерильной 27G (0,40 x 25 мм).
Вариант исполнения: OMME 2.0 ml

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

**Вариант исполнения:
OMME 2.0 ml**



«БИОТЕКНЕ С.Р.Л.», Италия. /

BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via
Della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2011/10175



Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки иглы стерильной 27G (0,40 x 25 мм).
Вариант исполнения: **OMME 2.5 ml**

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения:

OMME 2.5 ml



«БИОТЕКНЕ С.Р.Л.», Италия. /
BIOTEKNE S.R.L., Casalecchio di Reno (BO), Via
Della Bastia, 9, CAP 40033, Italy

Игла стерильная 27G (0,40 x 25 мм) – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX




XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2011/10175

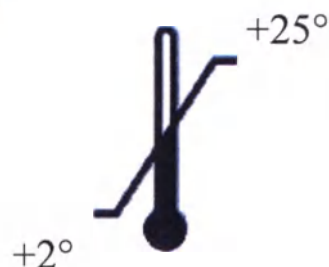

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки адаптера Luer Lock.

Вариант исполнения: OMME 1.0 ml

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения:

OMME 1.0 ml



«Б. Браун Мельзунген АГ», Германия. / B.Braun
Melsungen AG, Carl-Braun-Str, 34212
Melsungen, Germany

Адаптер Luer Lock – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF

XXXXXX

LOT

XXXXXX

STERILE EO



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2007/00008



Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки адаптера Luer Lock.
Вариант исполнения: **OMME 1.5 ml**

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

**Вариант исполнения:
OMME 1.5 ml**



«Б. Браун Мельзунген АГ», Германия. / B.Braun
Melsungen AG, Carl-Braun-Str, 34212
Melsungen, Germany

Адаптер Luer Lock – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX




XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2007/00008

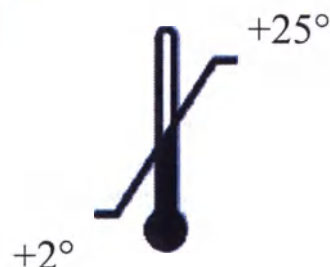

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки адаптера Luer Lock.

Вариант исполнения: OMME 2.0 ml

**Дермальный филлер с гидроксиапатитом
OMME**

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения:

OMME 2.0 ml



«Б. Браун Мельзунген АГ», Германия. / B.Braun
Melsungen AG, Carl-Braun-Str, 34212
Melsungen, Germany

Адаптер Luer Lock – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX




XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2007/00008

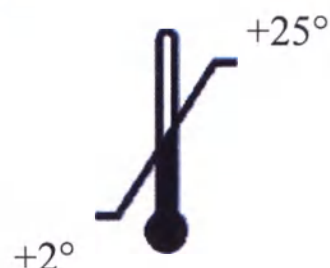

Макет маркировки индивидуальной стерильной упаковки адаптера Luer Lock.

Вариант исполнения: OMME 2.5 ml

Дермальный филлер с гидроксиапатитом

OMME

по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Вариант исполнения:

OMME 2.5 ml



«Б. Браун Мельзунген АГ», Германия. / B.Braun
Melsungen AG, Carl-Braun-Str, 34212
Melsungen, Germany

Адаптер Luer Lock – 1 шт.



XX.XX.XXXX



XX.XXXX



XXXXXX



XXXXXX



По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Нетоксично

РУ № ФСЗ 2007/00008



Макет маркировки транспортной упаковки материала. Вариант исполнения: OMME 1.0 ml

Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения:
OMME 1.0 ml

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

REF XXXXXXX

+25°C

+2°C

LOT XXXXXXX

STERILE 

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Нетоксично

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 2°C до + 25°C и влажности не более 80%

Макет маркировки транспортной упаковки материала. Вариант исполнения: OMME 1.5 ml

Дермальный филлер с гидроксипатитом OMME
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения:
OMME 1.5 ml

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

+25°C

+2°C

REF XXXXXX

LOT XXXXXX

STERILE 

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Нетоксично

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:
хранить и транспортировать при температуре от + 2°C до + 25°C и влажности не более 80%

Макет маркировки транспортной упаковки материала. Вариант исполнения: OMME 2.0 ml

Дермальный филлер с гидроксипатитом OMME
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения:
OMME 2.0 ml

 Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.

 XX.XX.XXXX

 XX.XXXX

+25°C

+2°C

REP XXXXXXX

LOT XXXXXXX



Масса нетто _____

Масса брутто _____

Нетоксично

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 2°C до + 25°C и влажности не более 80%

Макет маркировки транспортной упаковки материала. Вариант исполнения: **ОММЕ 2.5 ml**

Дермальный филлер с гидроксиапатитом ОММЕ
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019
Вариант исполнения:
ОММЕ 2.5 ml



Общество с ограниченной ответственностью «Оссис Медикал Групп» (ООО «ОМГ»),
Россия, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, оф. 1603

Адрес производства: ООО «Сигма Лаб», Россия, 143026, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 42, стр. 1, эт. 3, пом. 785

Количество изделий: XX шт.




XX.XX.XXXX



XX.XXXX

REF XXXXXX



LOT XXXXXX



Масса нетто _____

Масса брутто _____

Нетоксично

По ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

Сделано в России

РУ _____

Условия хранения и транспортирования:

хранить и транспортировать при температуре от + 2°C до + 25°C и влажности не более 80%

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 25 лист 06

ООО «ОМГ»

Генеральный директор

А.А. Нестеренко



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Оссис Медикал Групп»

_____ А.А. Нестеренко

« 02 » _____ 2020 г.



Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

Дермальный филлер с гидроксиапатитом ОММЕ
по ТУ 32.50.50-003-03631540-2019

2020 г

Вариант исполнения **ОММЕ 1.0 ml**. Общий вид.

Сверху вниз:

Потребительская упаковка – 1 шт.;

Шприц объёмом 2,25 мл, наполненный материалом в блистере – 1 шт.;


Инструкция по применению – 1 шт.;

Под инструкцией по применению, слева направо:

Стикер пациента – 3 шт.;

Адаптер Luer Lock в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.;

Игла 27G 0,40 x 25 мм в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.

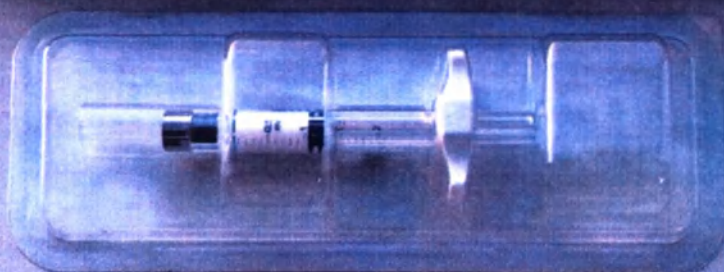

 Cross Medical Group Сделано в России STERILE	Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME на 19 32 58 00 485 6267540-2019 Объем упаковки OMME 1,9 мл. Шкала измерения 1,9 мм. Срок годности: 24 мес. Дата изготовления: 2019-09-08 Номер партии: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: 275.40.0 x 25 мм Артикул: 2019-09-08 Код: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: _____ Дата рождения: _____ Контактная информация: _____ Подпись: _____
 Cross Medical Group Сделано в России STERILE	Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME на 19 32 58 00 485 6267540-2019 Объем упаковки OMME 1,9 мл. Шкала измерения 1,9 мм. Срок годности: 24 мес. Дата изготовления: 2019-09-08 Номер партии: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: 275.40.0 x 25 мм Артикул: 2019-09-08 Код: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: _____ Дата рождения: _____ Контактная информация: _____ Подпись: _____
 Cross Medical Group Сделано в России STERILE	Дермальный филлер с гидроксиапатитом OMME на 19 32 58 00 485 6267540-2019 Объем упаковки OMME 1,9 мл. Шкала измерения 1,9 мм. Срок годности: 24 мес. Дата изготовления: 2019-09-08 Номер партии: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: 275.40.0 x 25 мм Артикул: 2019-09-08 Код: 2019-09-08 Код: 2019-09-08	Имя: _____ Дата рождения: _____ Контактная информация: _____ Подпись: _____



Вариант исполнения **ОММЕ 1.5 ml**. Общий вид.

Сверху вниз:

Потребительская упаковка – 1 шт.;

Шприц объёмом 2,25 мл, наполненный материалом в блистере – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Под инструкцией по применению, слева направо:

Стикер пациента – 3 шт.;

Адаптер Luer Lock в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.;

Игла 27G 0,40 x 25 мм в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.

Вариант исполнения **OMME 2.0 ml**. Общий вид.

Сверху вниз:

Потребительская упаковка – 1 шт.;

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом в блистере – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.;

Под инструкцией по применению, слева направо:

Стикер пациента – 3 шт.;

Адаптер Luer Lock в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.;

Игла 27G 0,40 x 25 мм в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.

Вариант исполнения **ОММЕ 2.5 ml**. Общий вид.

Сверху вниз:

Потребительская упаковка – 1 шт.;

Шприц объёмом 3,0 мл, наполненный материалом в блистере – 1 шт.;


Инструкция по применению – 1 шт.;

Под инструкцией по применению, слева направо:

Стикер пациента – 3 шт.;

Адаптер Luer Lock в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.;

Игла 27G 0,40 x 25 мм в заводской индивидуальной упаковке – 1 шт.

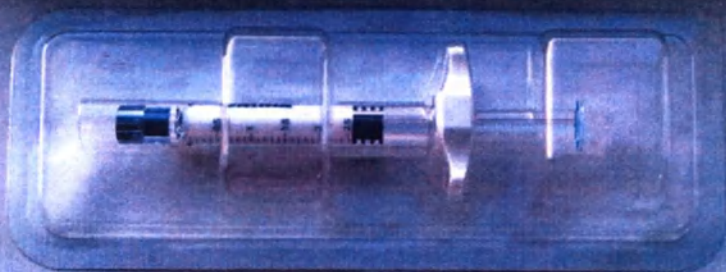[illegible]

Прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 9 лист *об*

ООО «ОМГ»

Генеральный директор
А.А. Нестеренко

