


Фотографические изображения

Сканер предметных стекол цифровой VENTANA DP 200 для in vitro диагностики, производства FFEI Ltd. ("Эф-Эф-И-Ай Лтд"), Великобритания

Сканер предметных стекол цифровой VENTANA DP 200 для in vitro диагностики (общий вид)

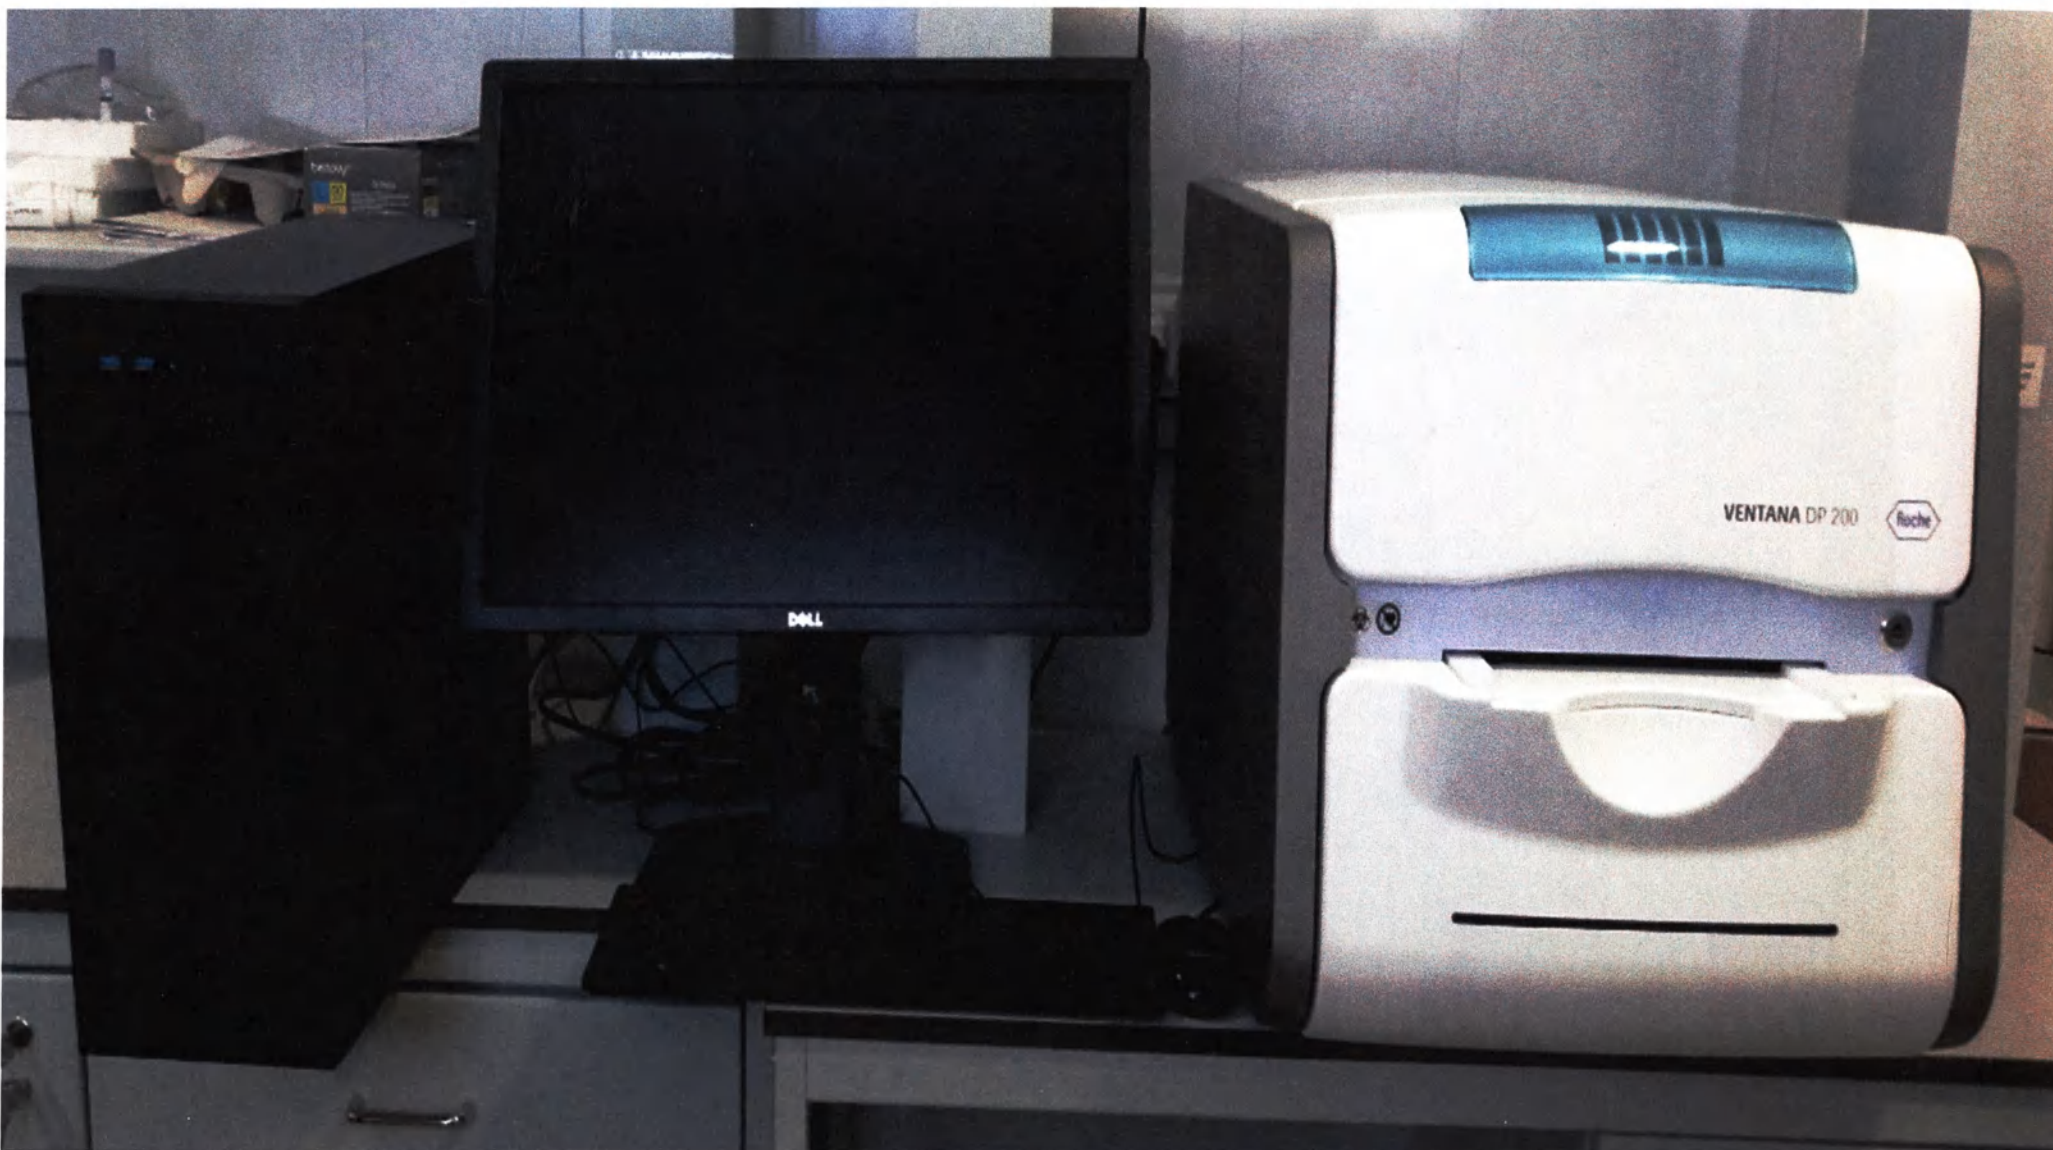

Сканер VENTANA DP 200 – 1 шт.



Сканер VENTANA DP 200 – 1 шт.



Рабочая станция VENTANA DP 200 – 1 шт.




Рабочая станция VENTANA DP 200 – 1 шт.






Монитор – 1 шт.

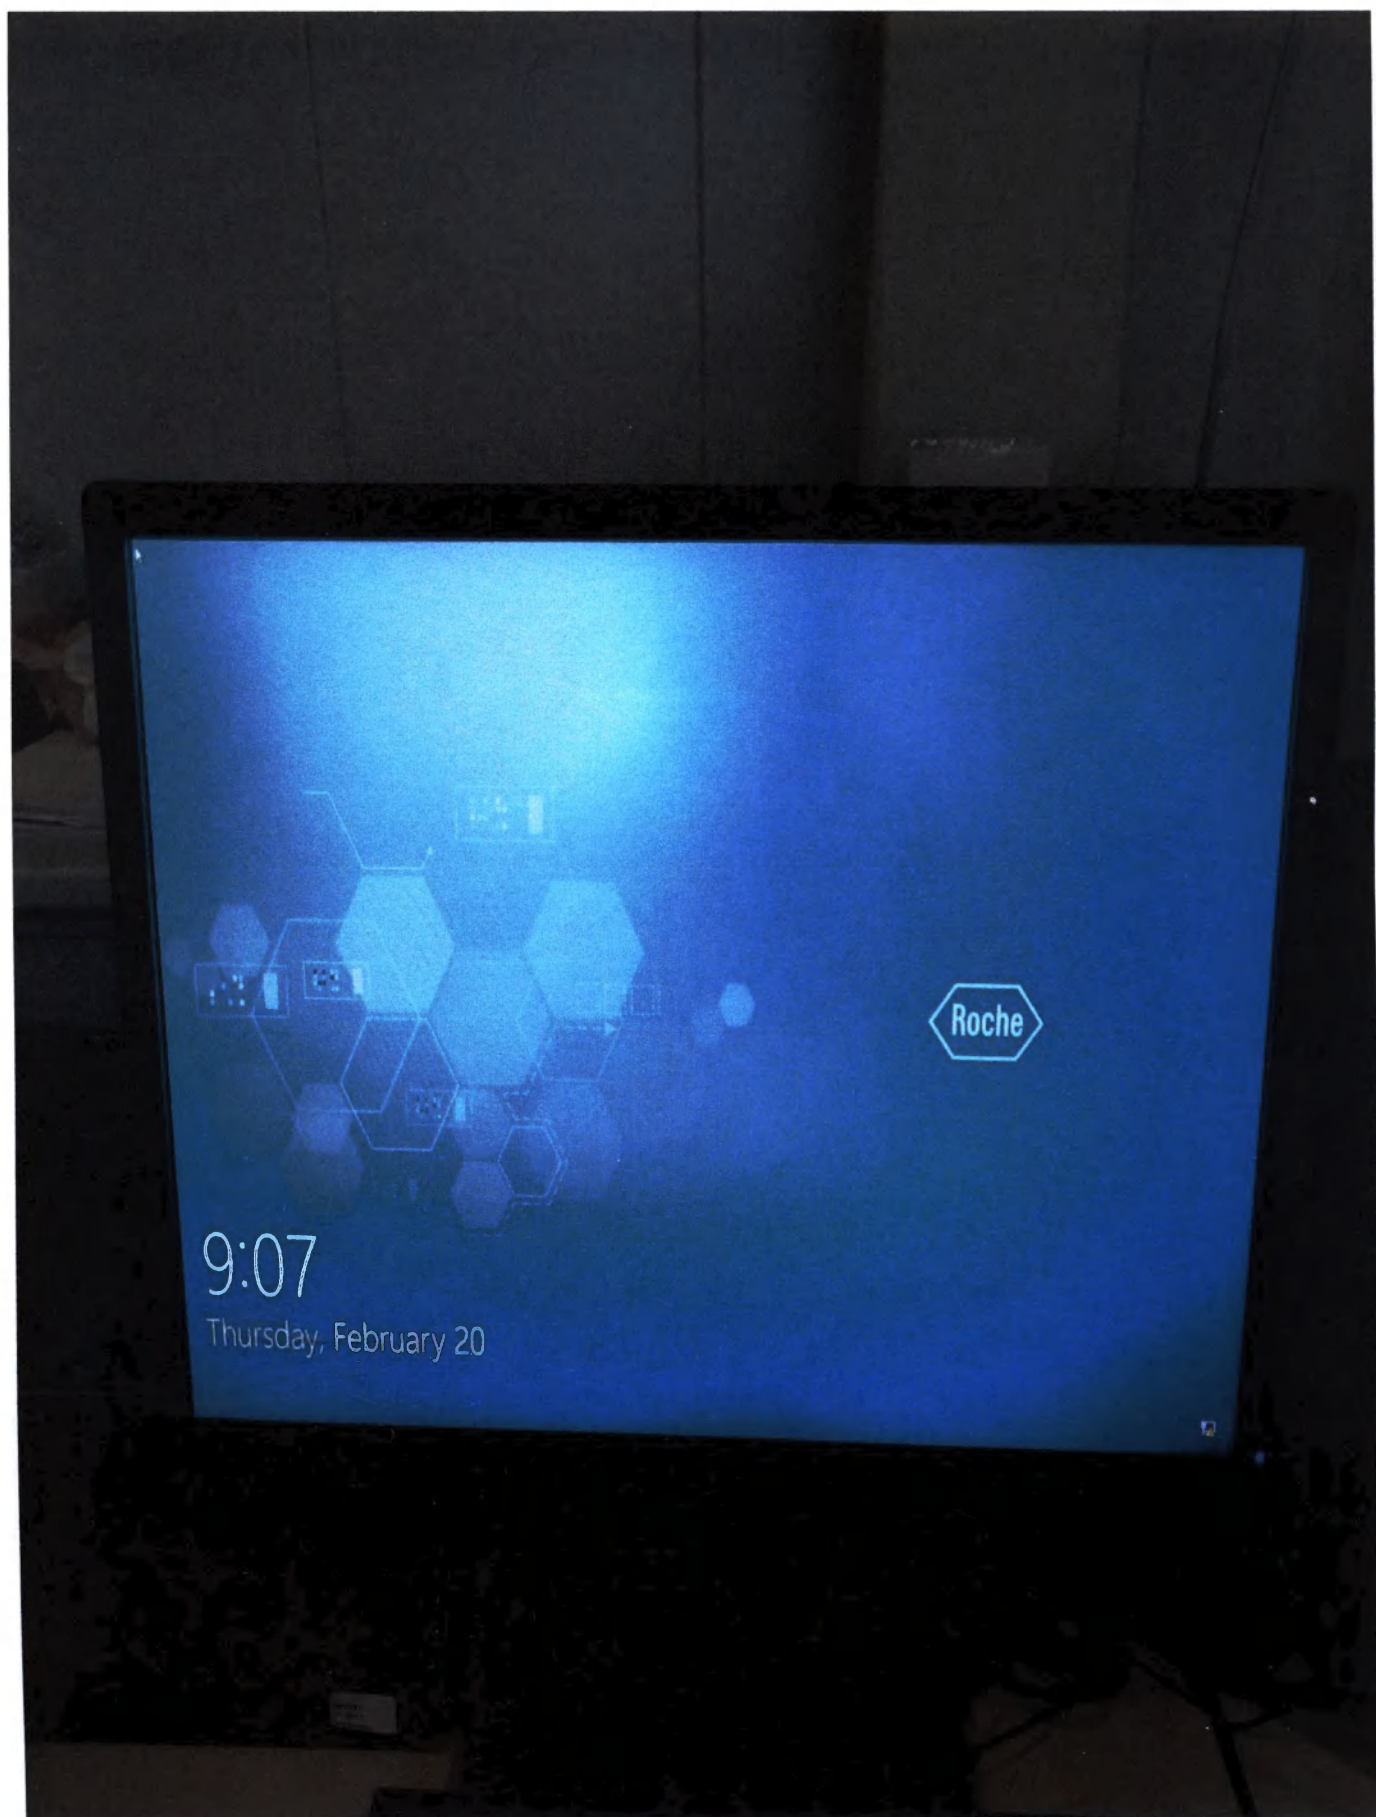

Монитор – 1 шт.




Клавиатура – 1 шт.

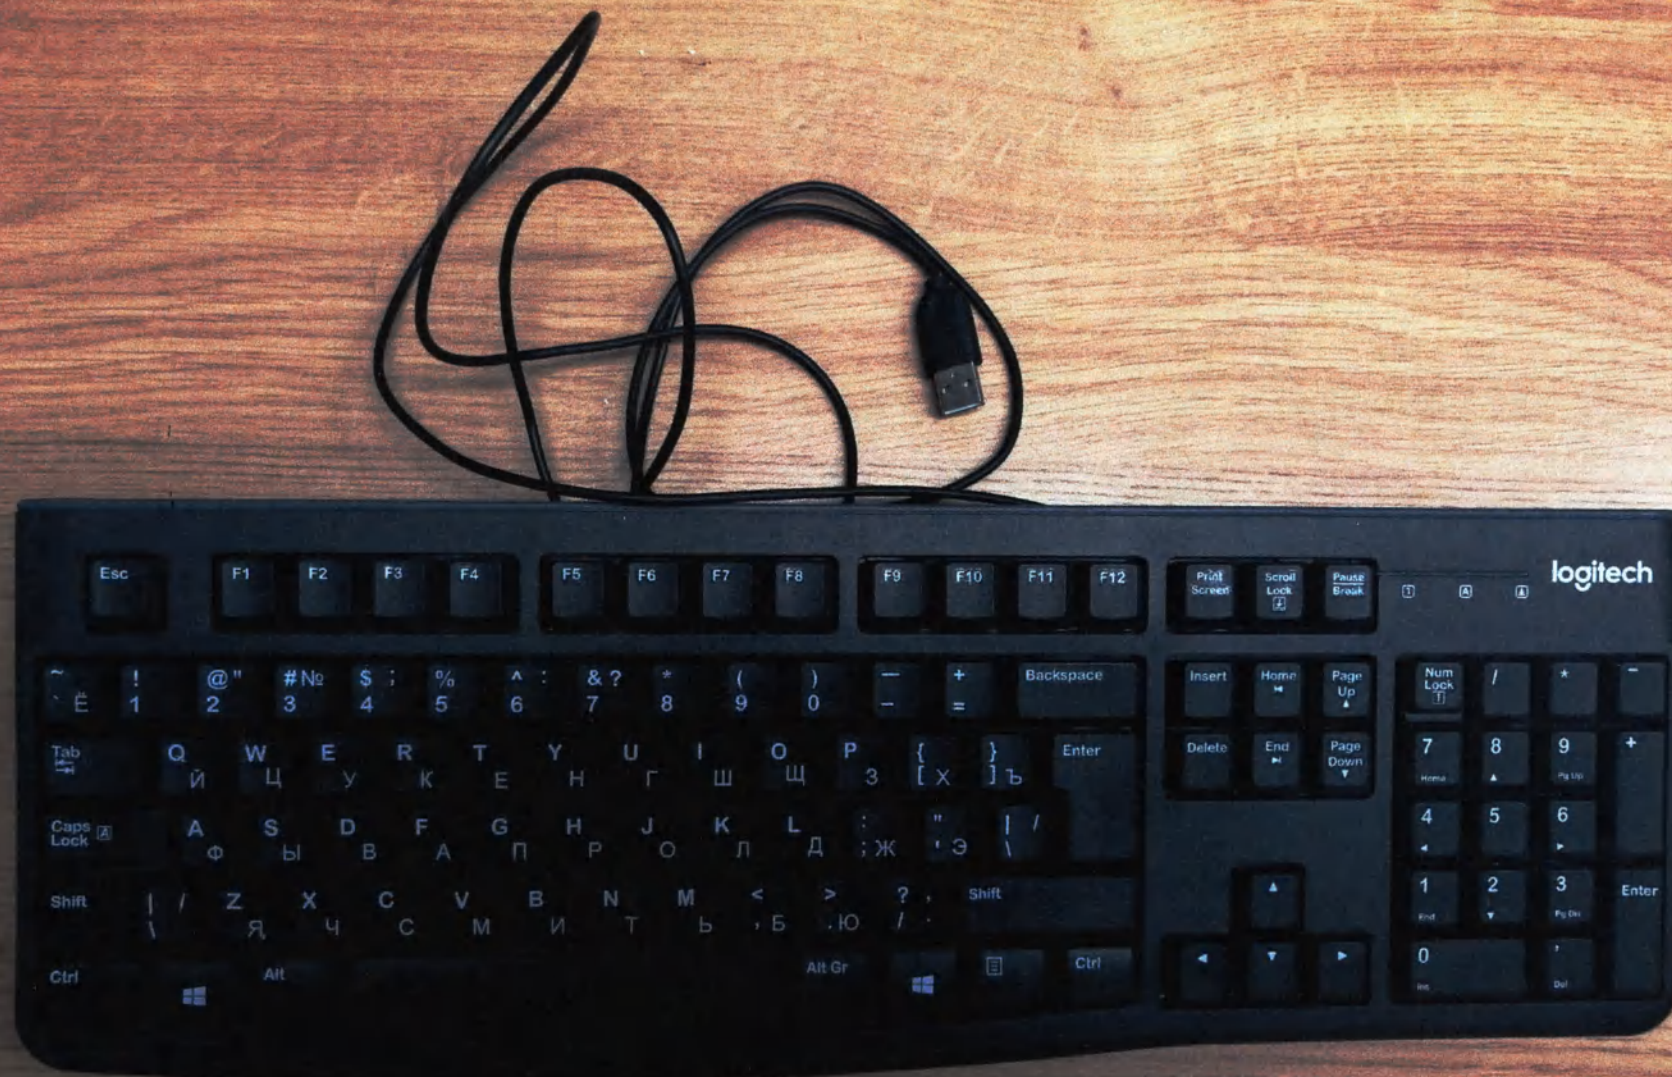

Мышь – 1 шт.


Кабель данных – 1 шт.

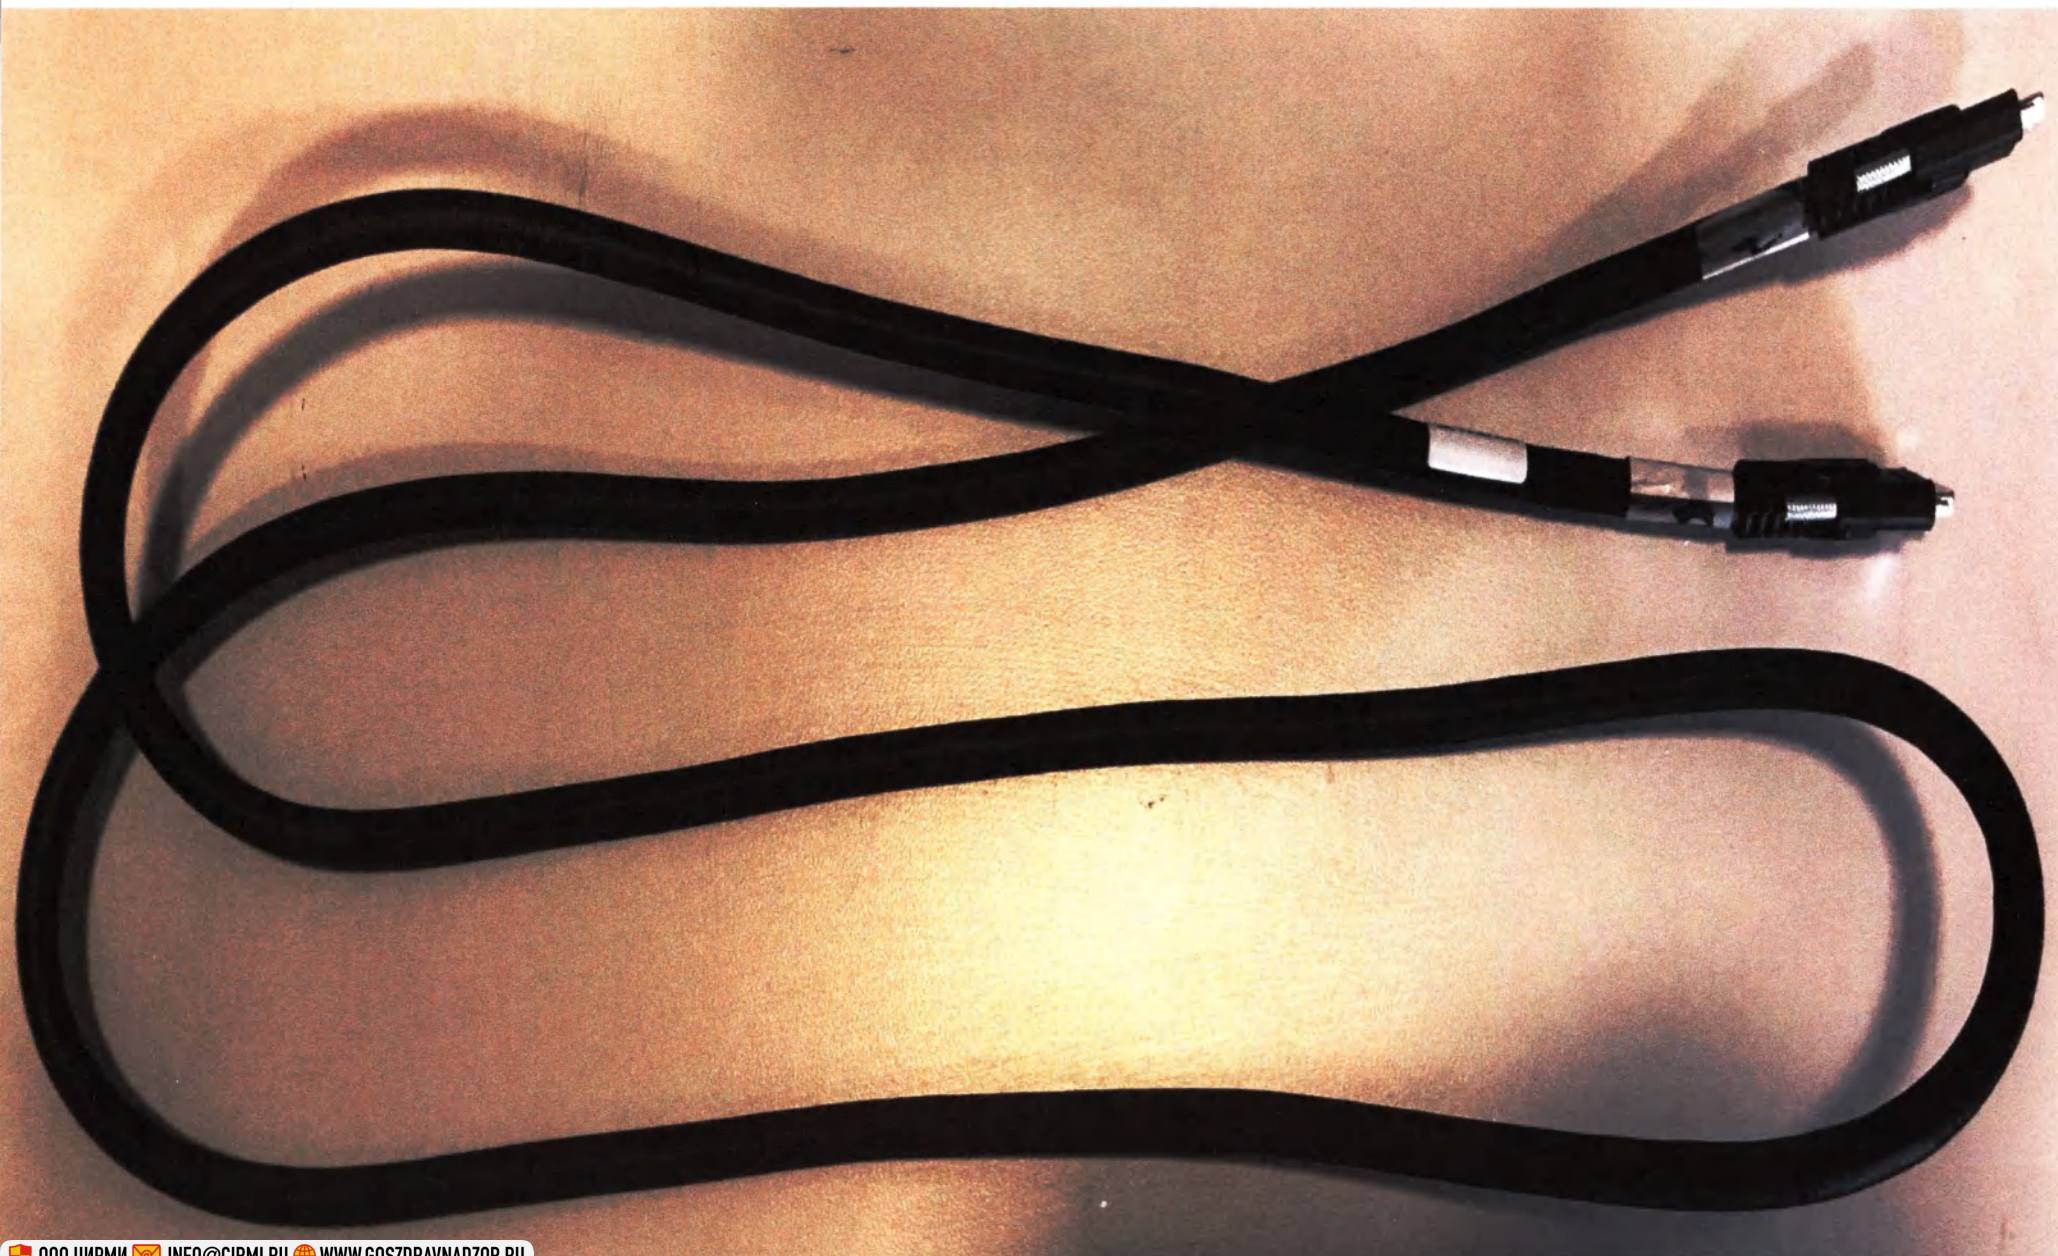


Кабель Ethernet – 1 шт.




Кабель питания DP 200 – 1 шт.

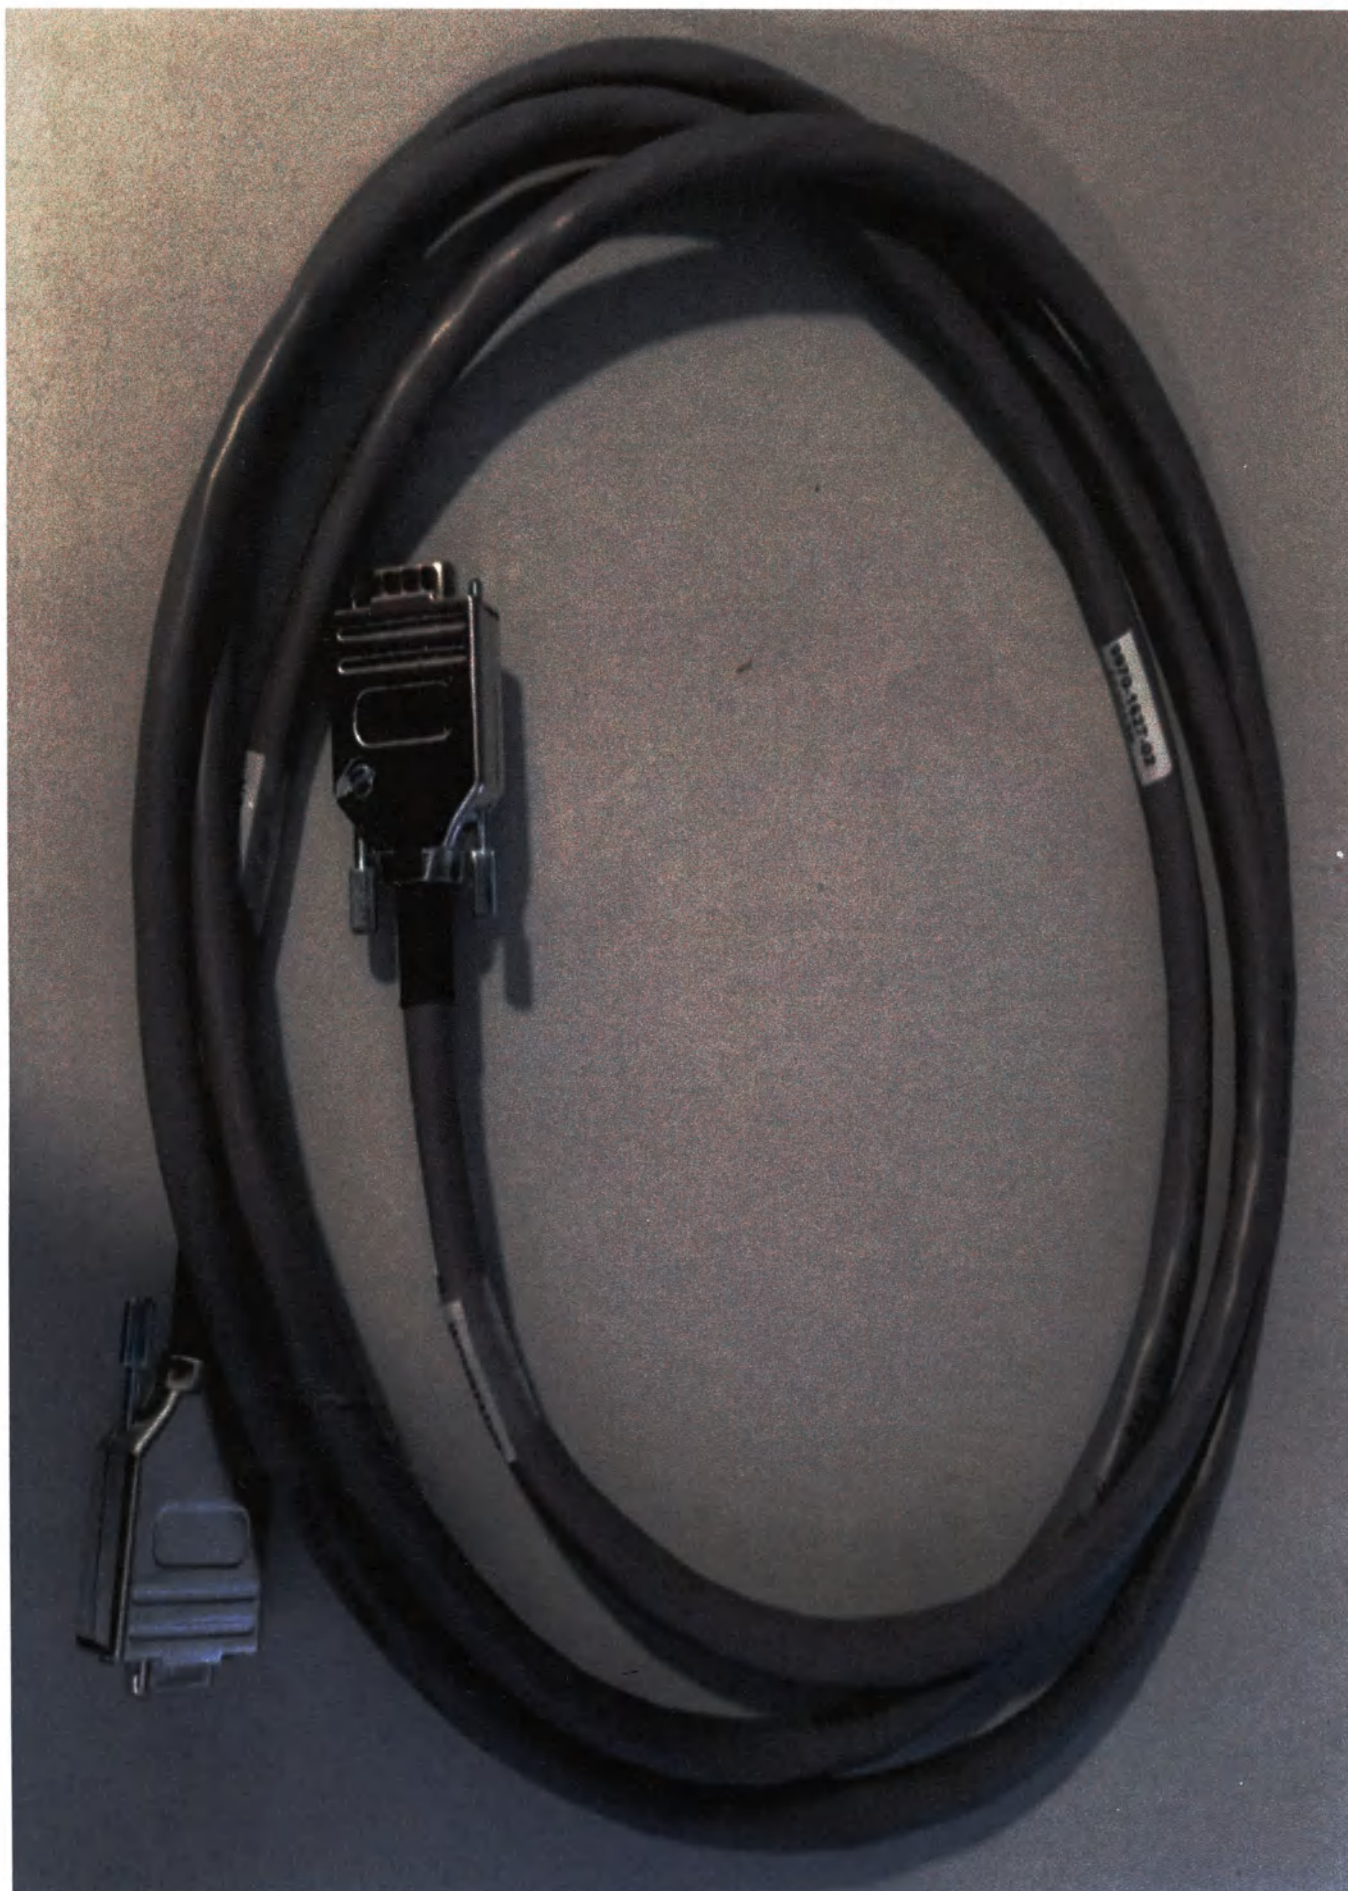


Шнур питания монитора – 1 шт.

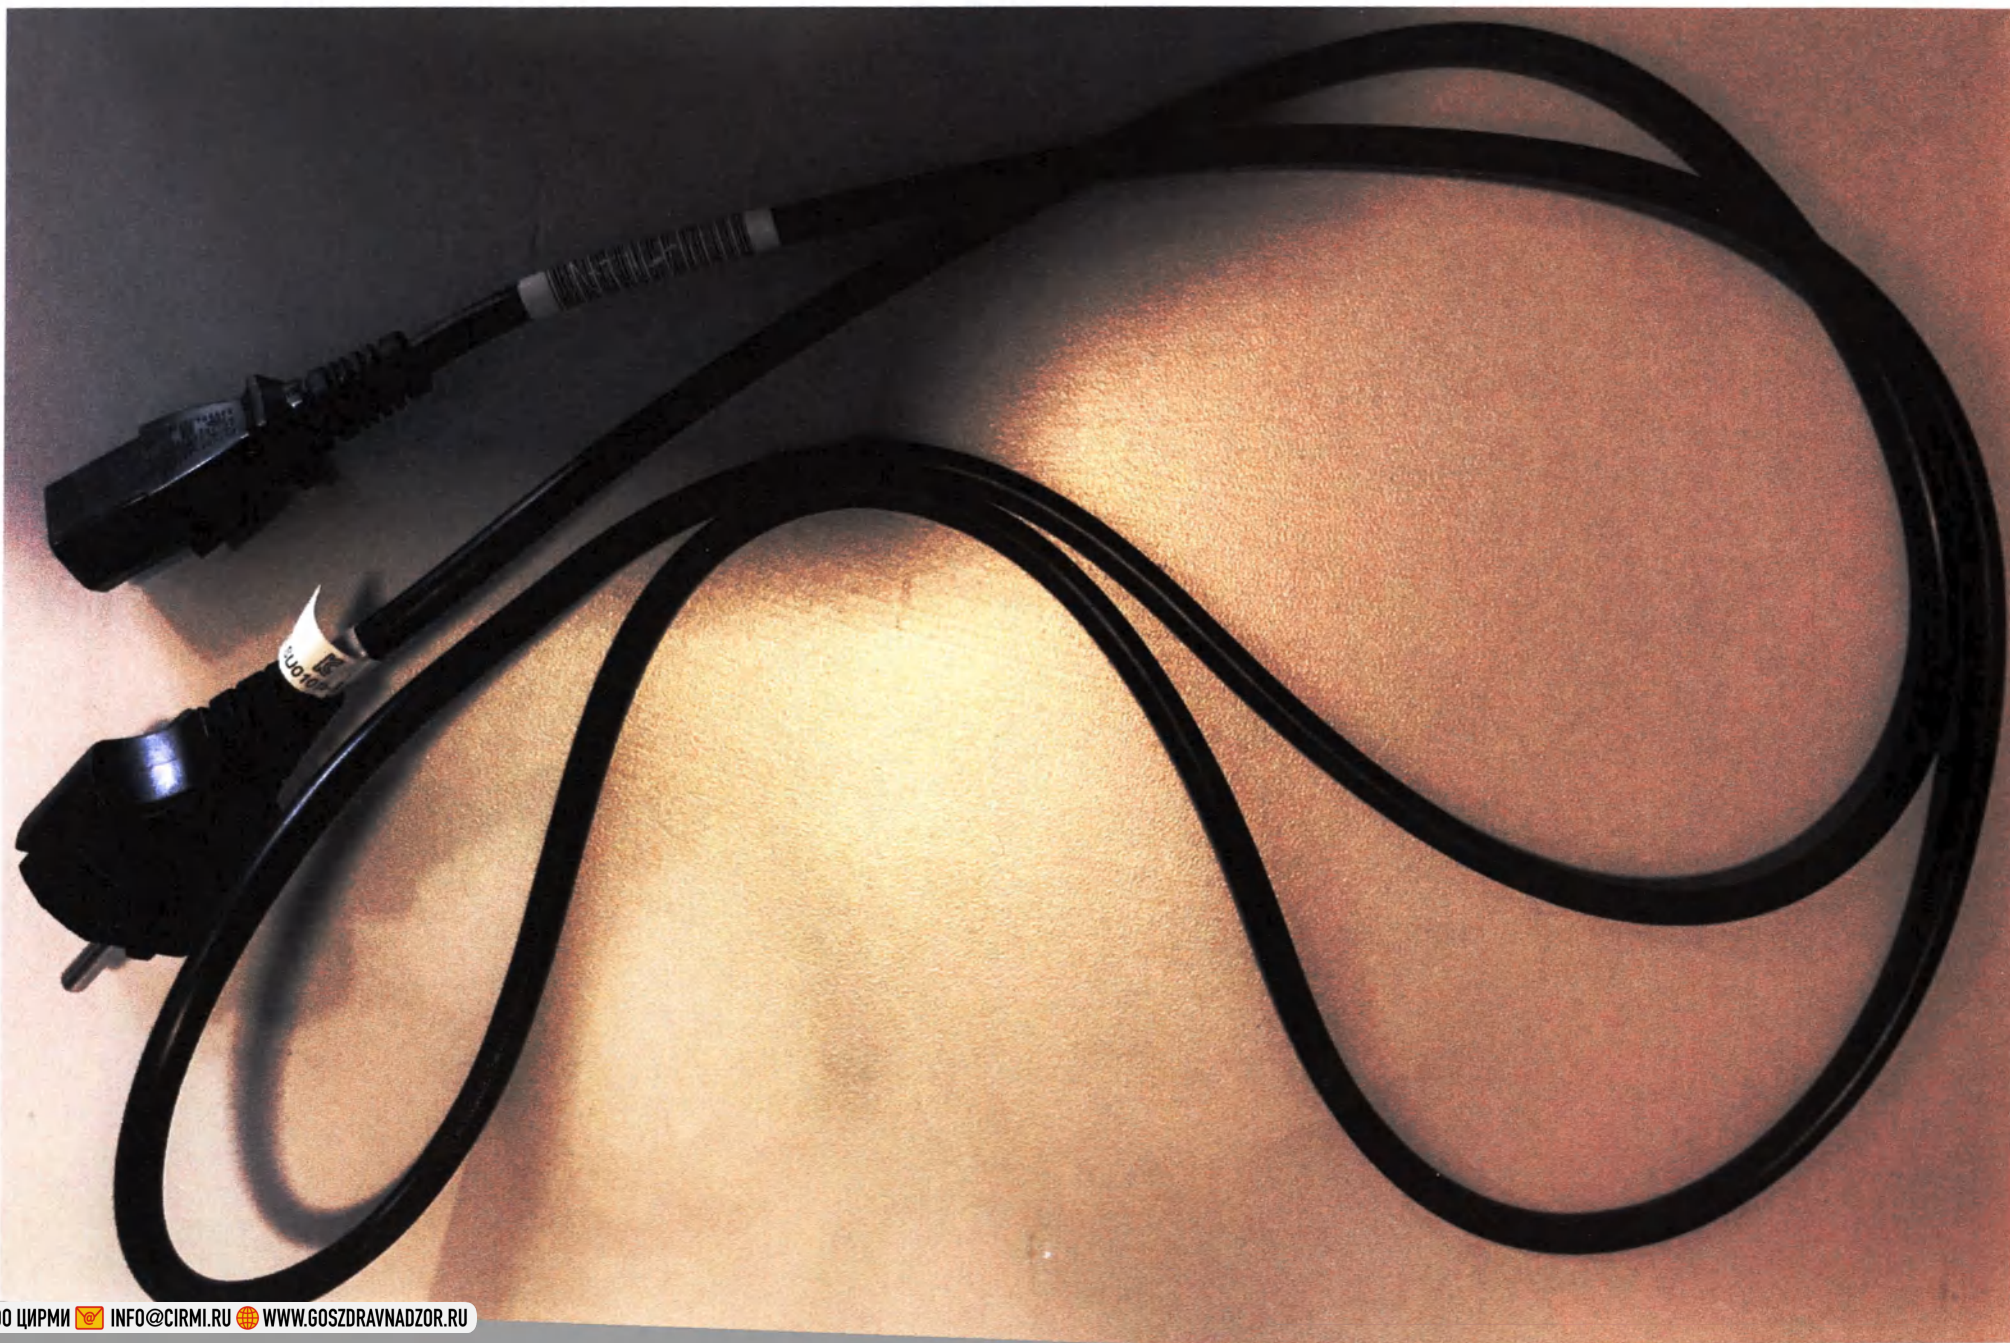


Кабель DVI – 1 шт.

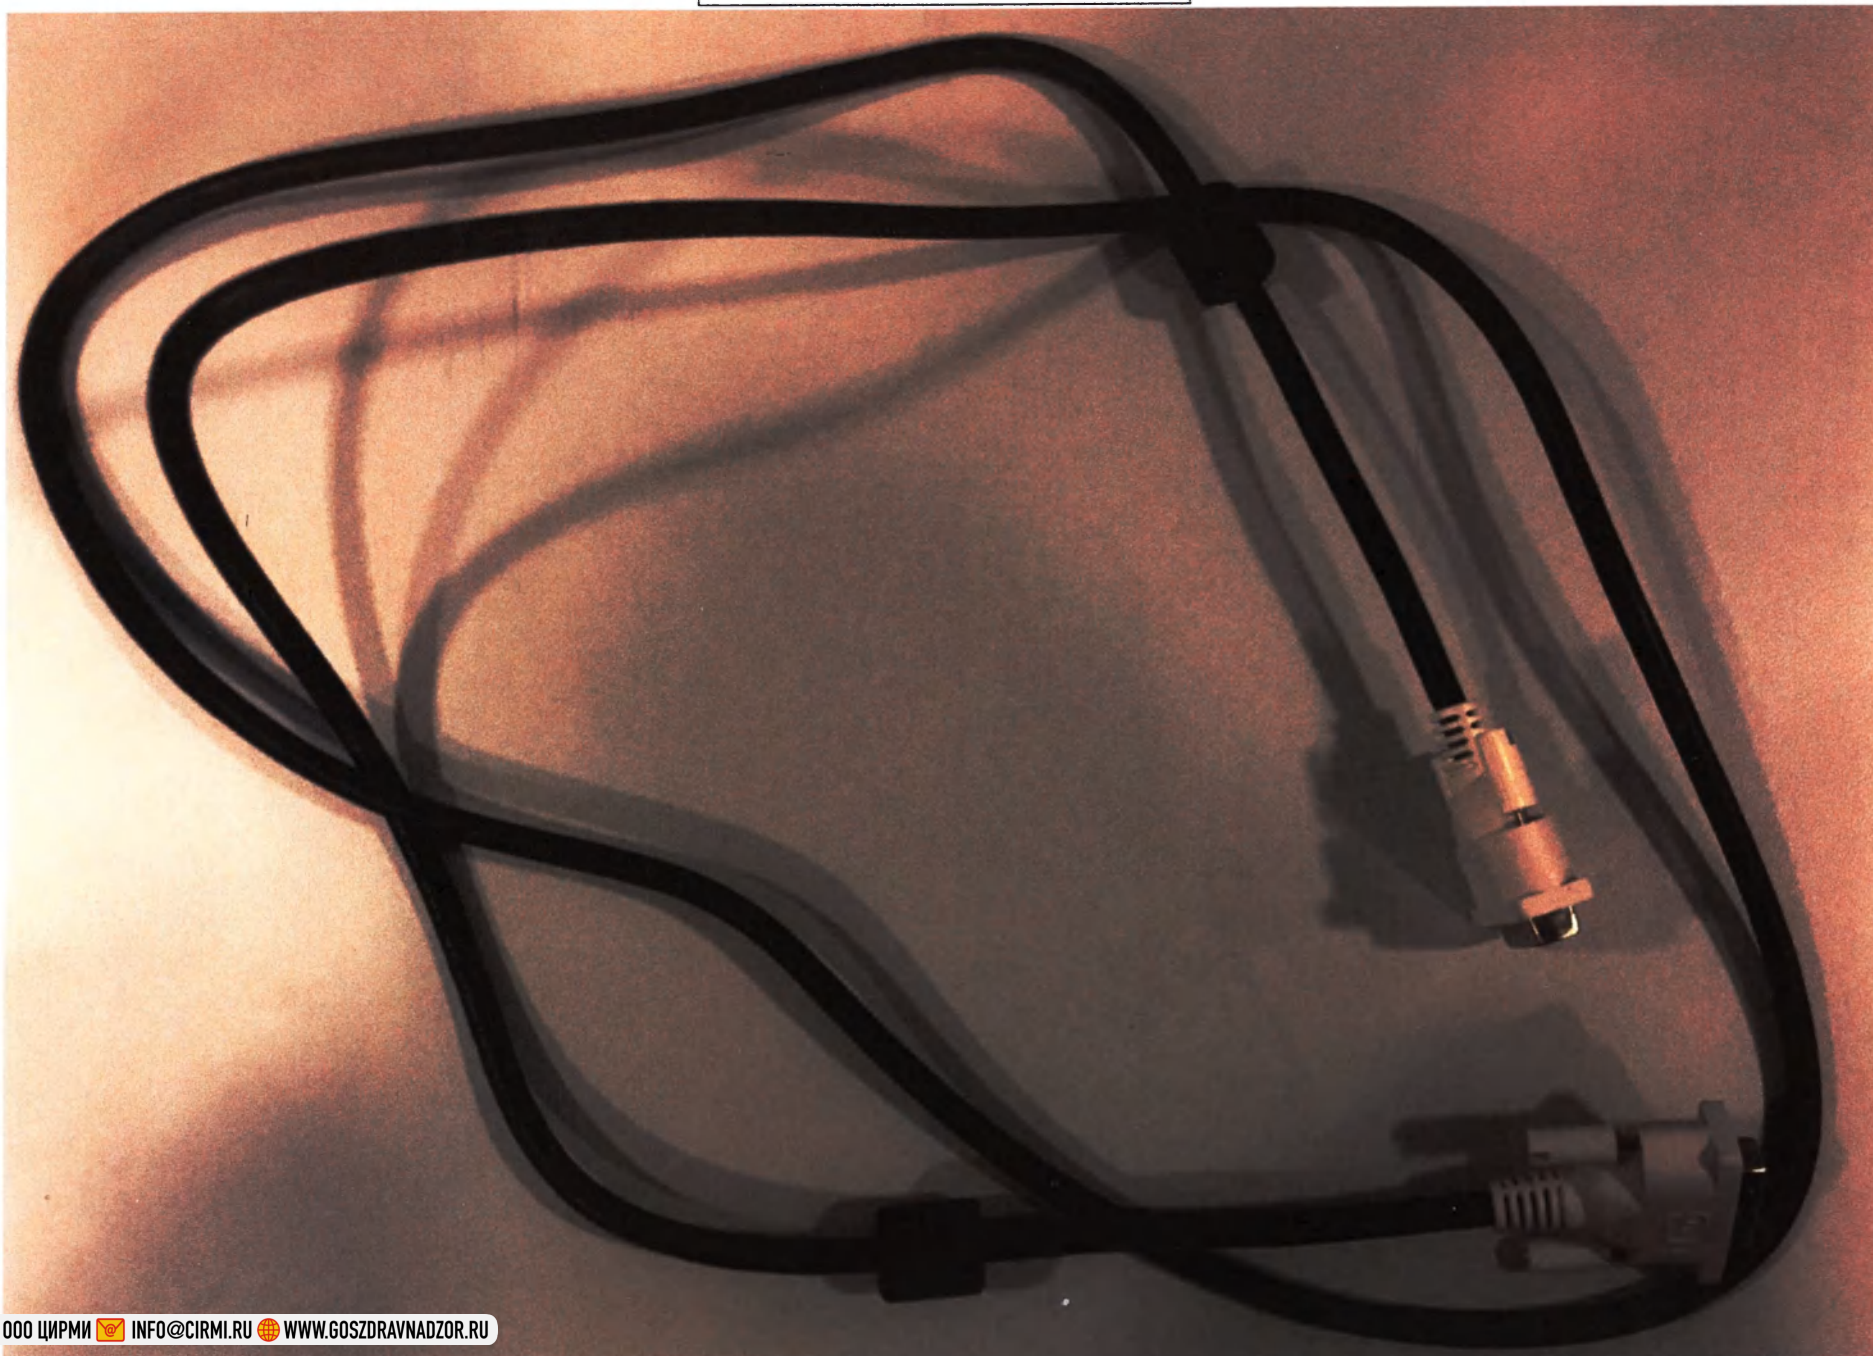

Шнур питания рабочей станции – 1 шт.

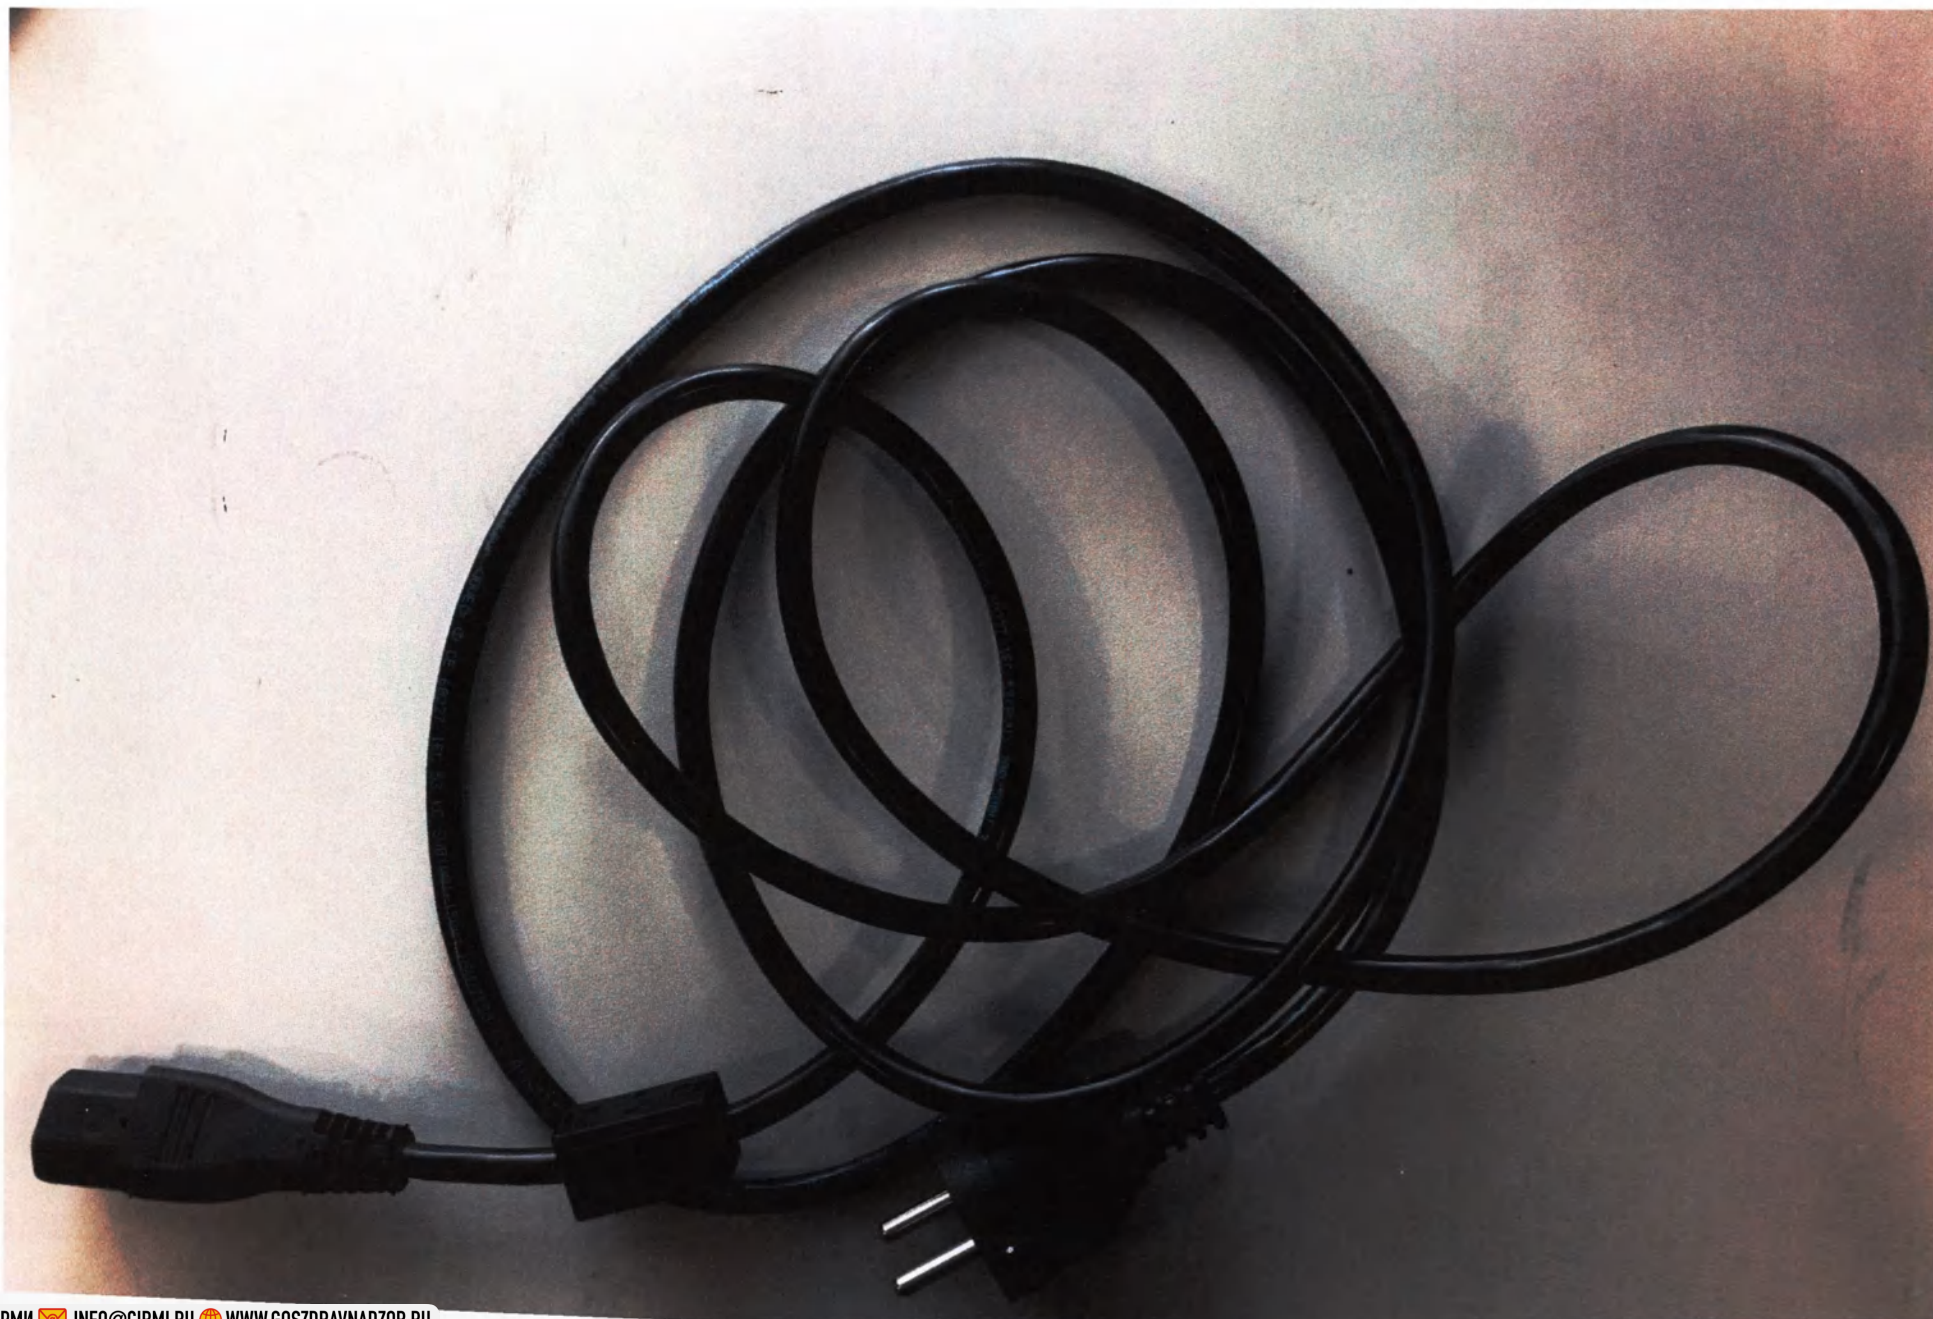

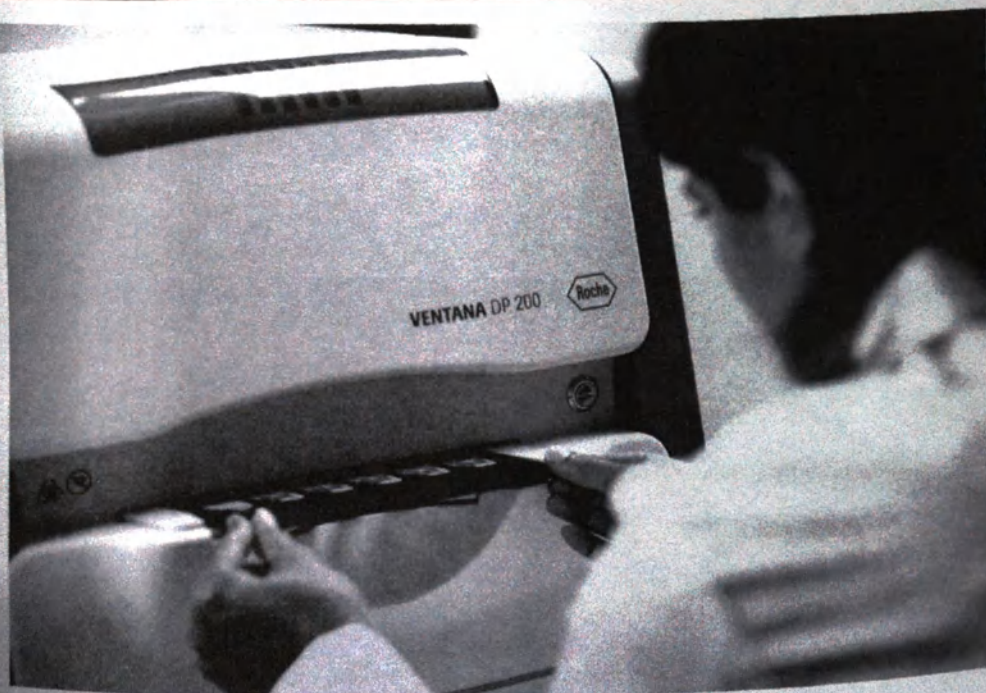

VENTANA DP 200 slide scanner (Сканер предметных стекол)


Руководство пользователя для IVD, Rev. A
Программное обеспечение версии 1.0



Артикул: 1017149RU Rev. A
01.03.2018 г.



Лоток для предметных стекол на 6 позиций – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.

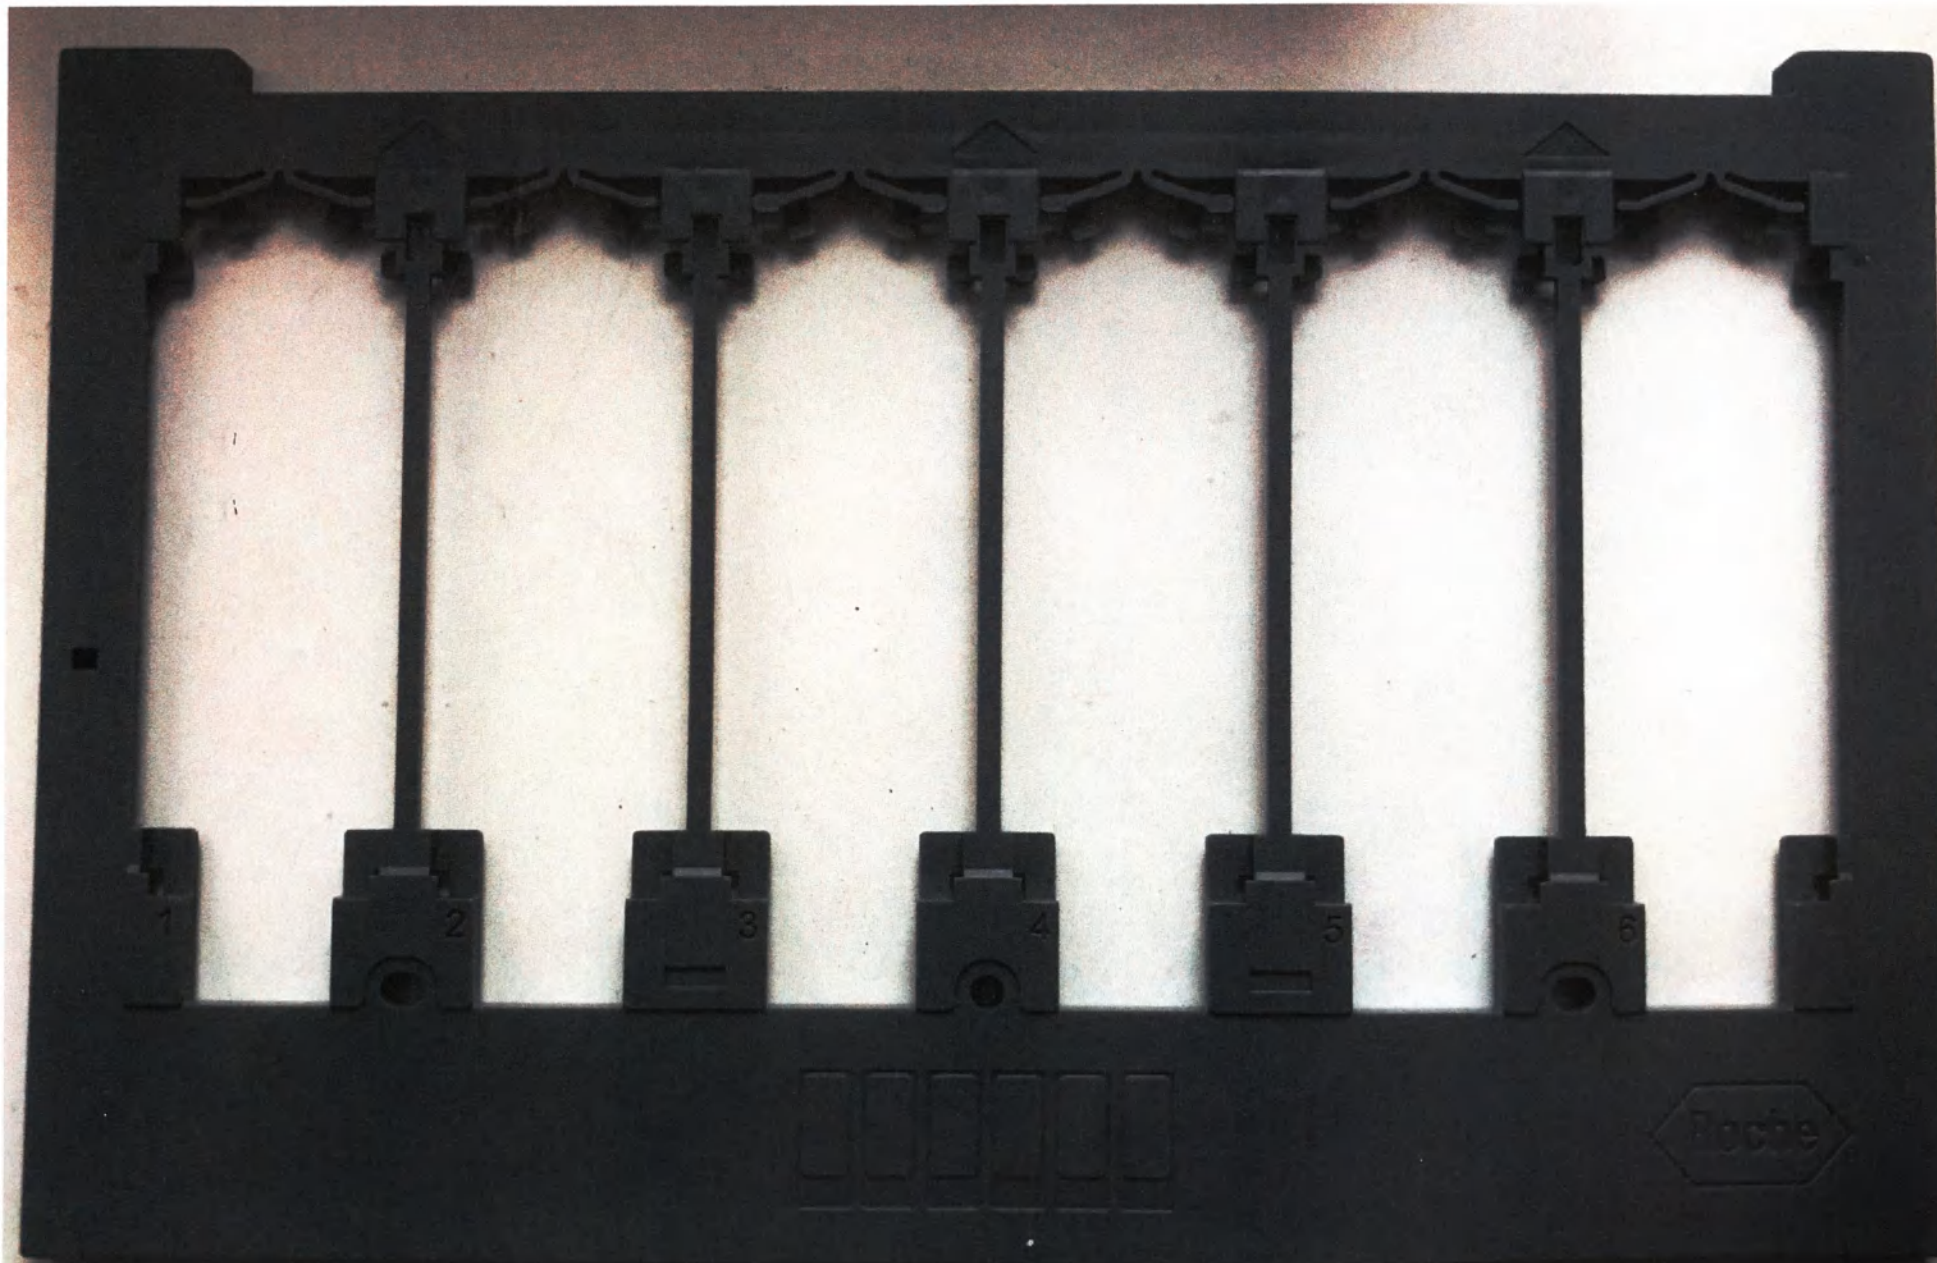


Лоток для предметных стекол на 6 позиций – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.




Лоток для предметных стекол на 6 позиций – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.




Лоток для предметных стекол на 3 позиции – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.

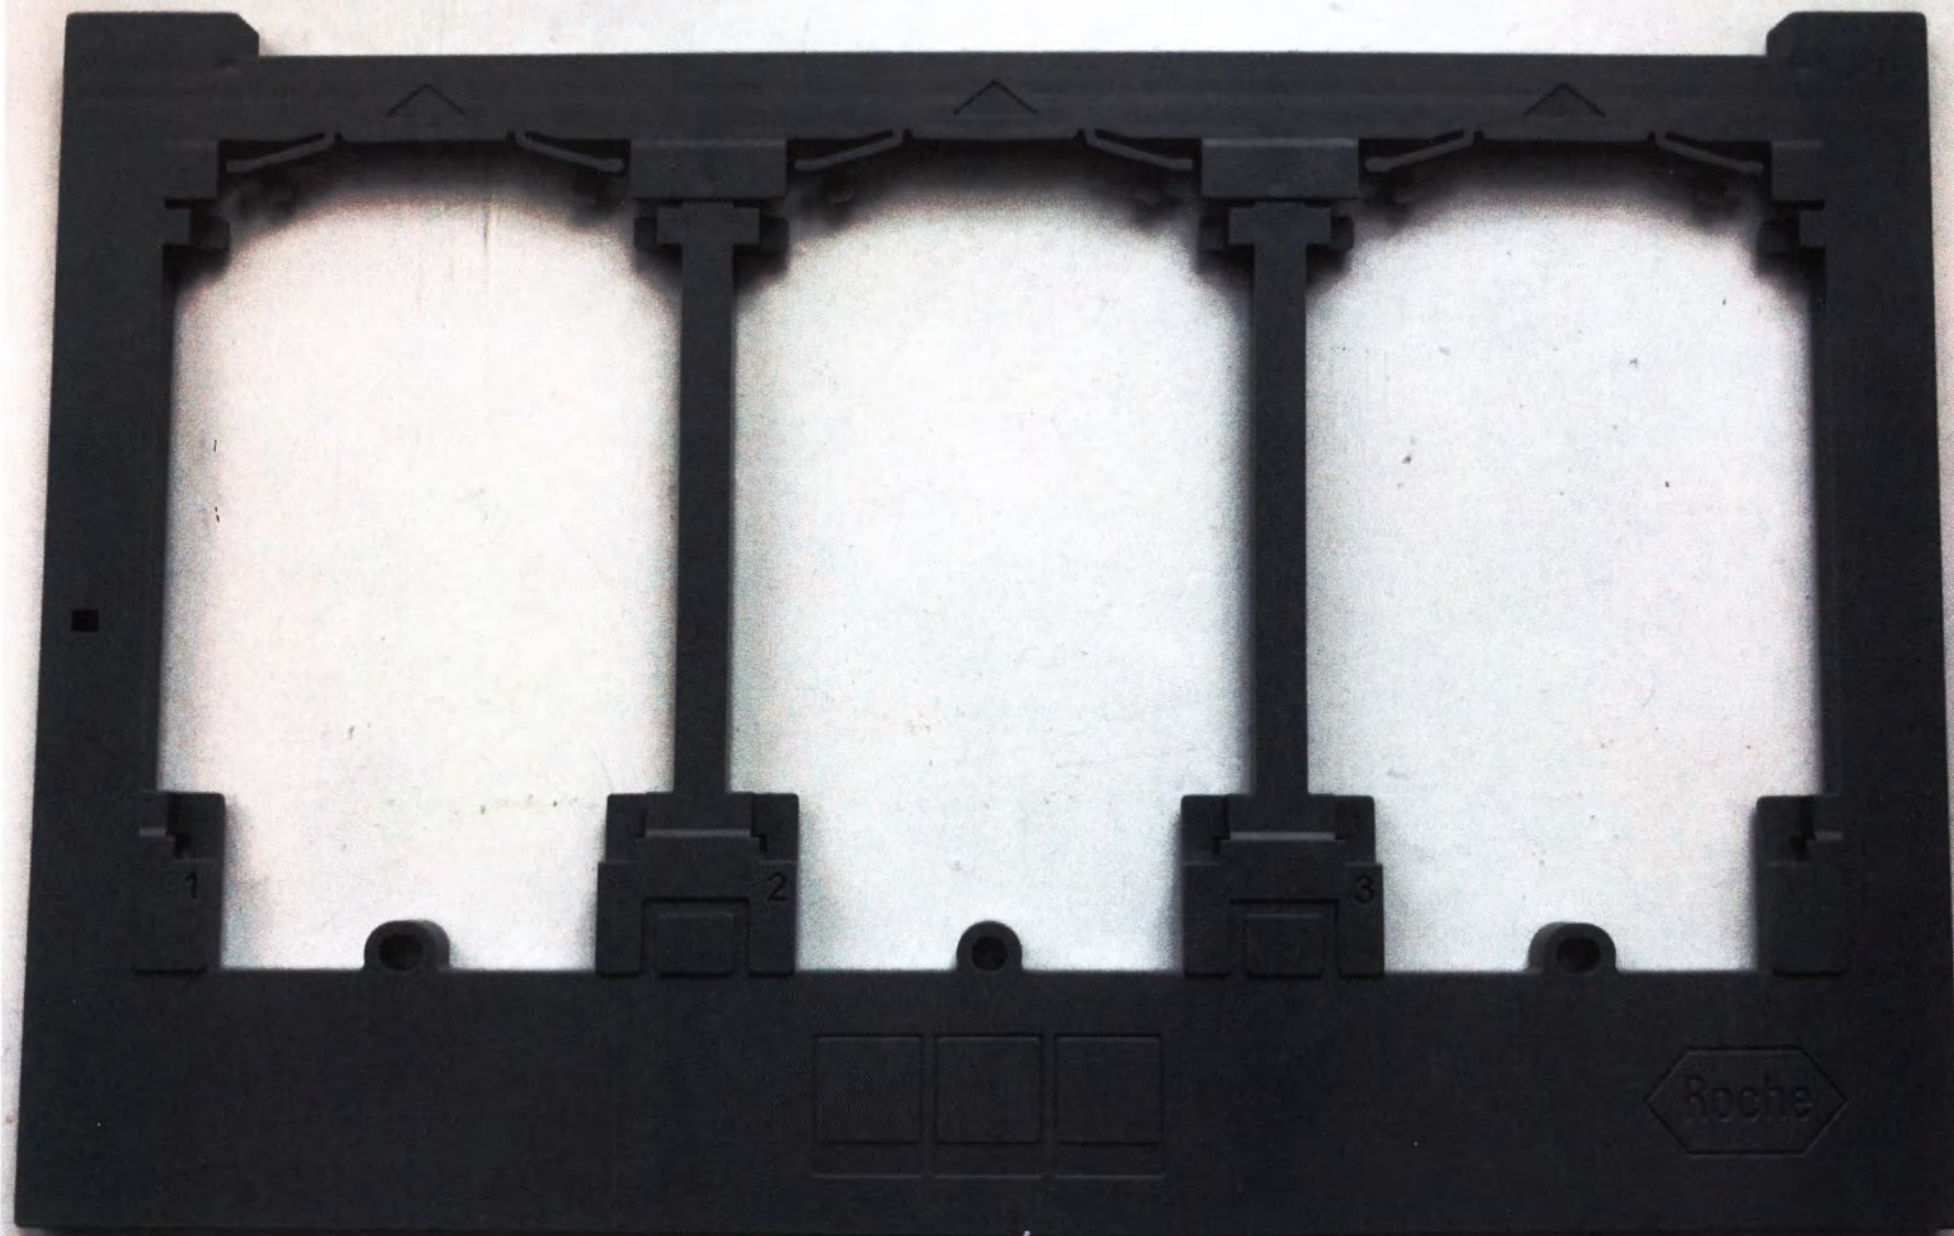

Лоток для предметных стекол на 3 позиции – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.

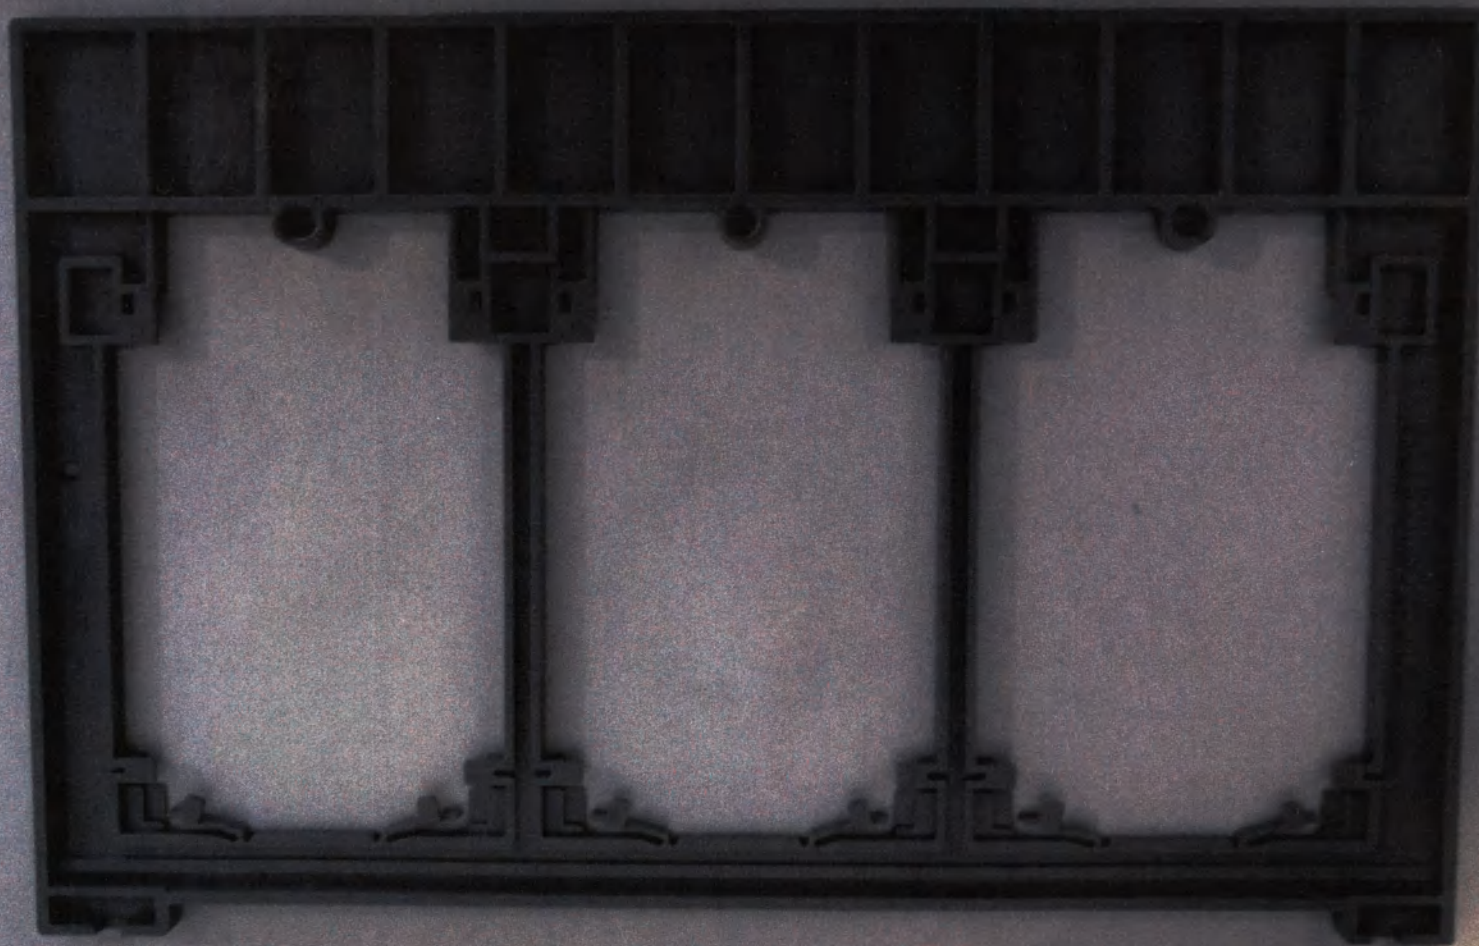

Лоток для предметных стекол на 3 позиции – 5 шт. в упаковке, не более 10 уп.

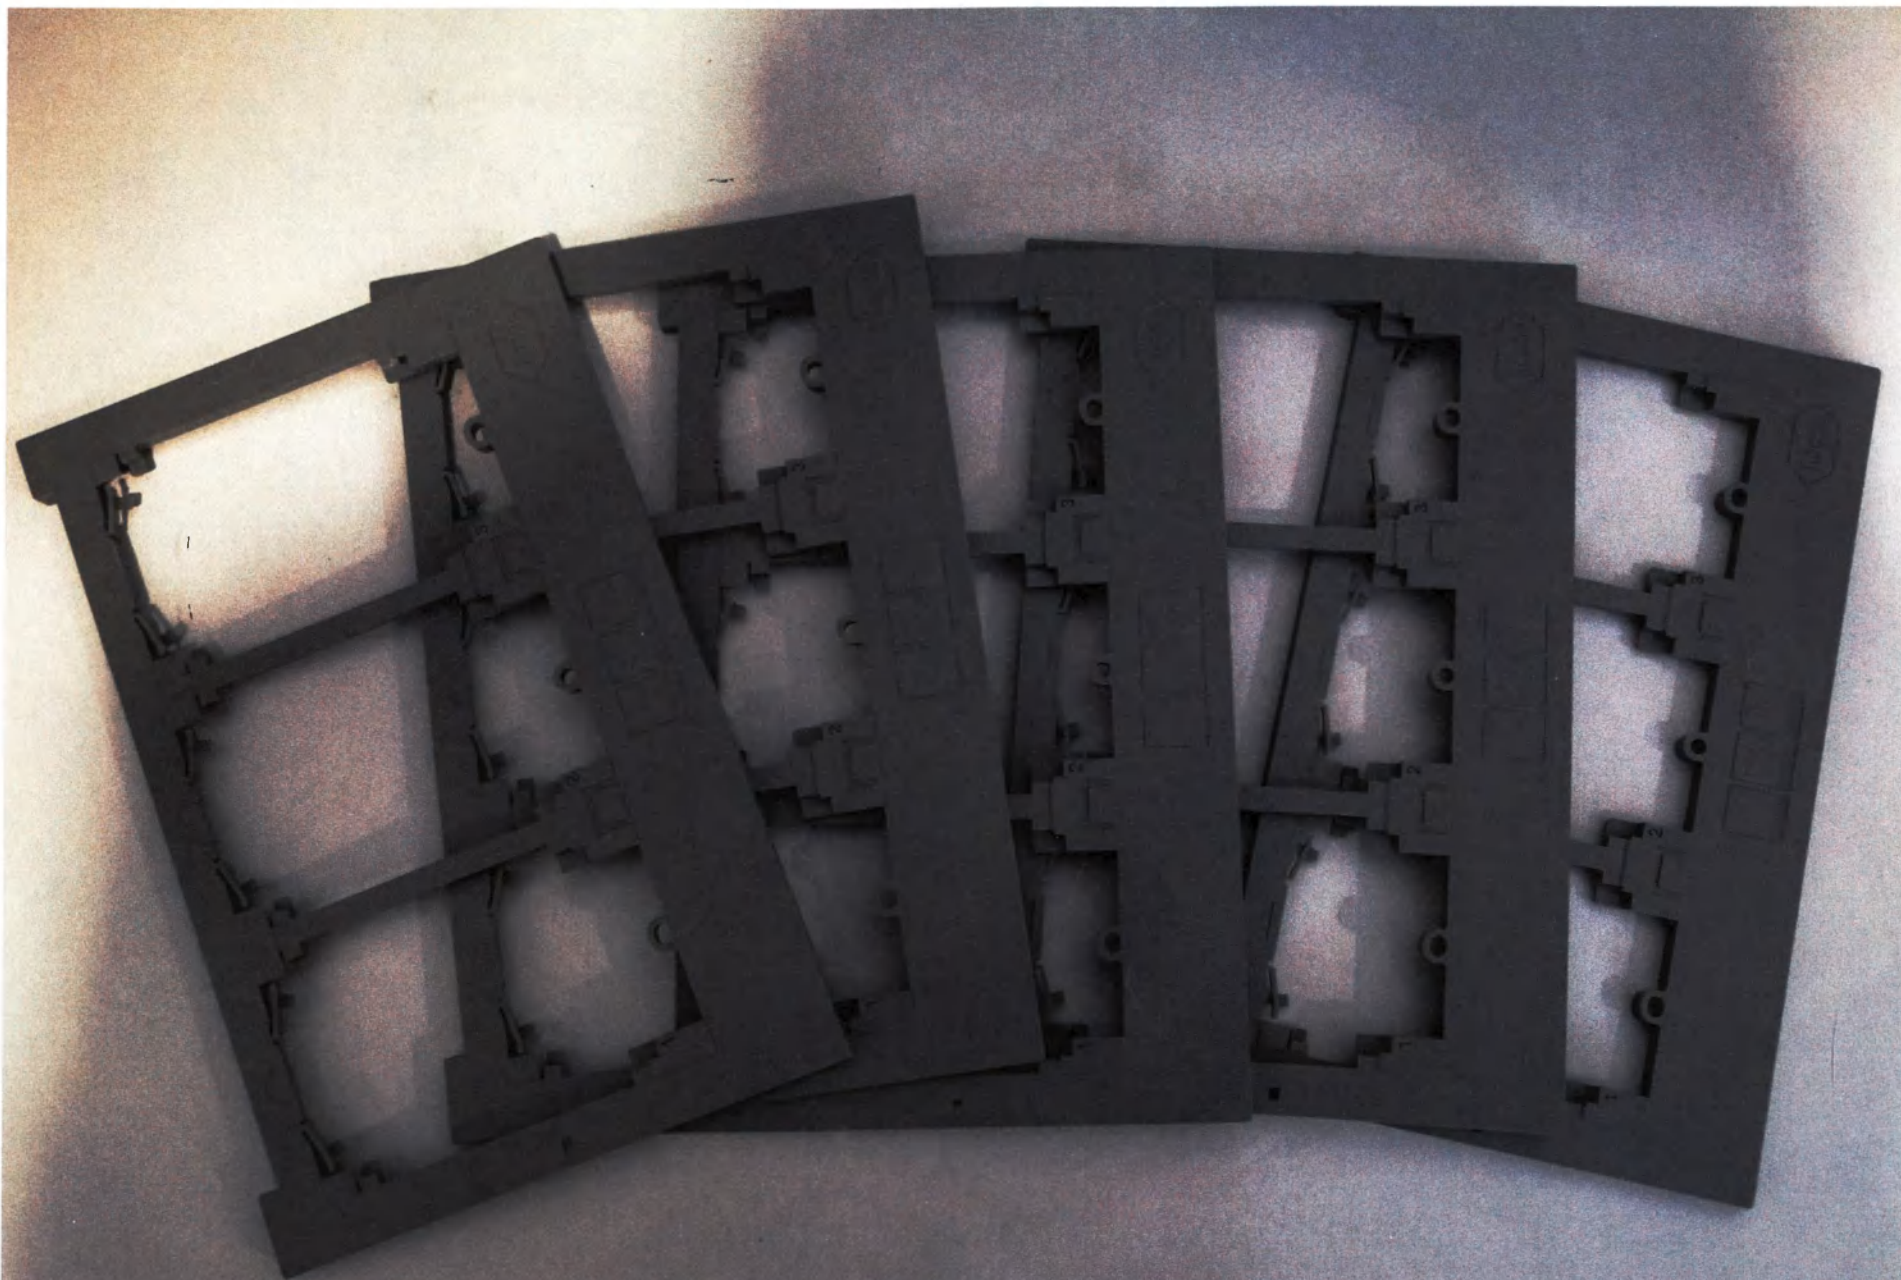

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
24 листа (ов)

Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 июля 2018

