


Фотографические изображения

**Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ)
методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза
автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)**

Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ) методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)

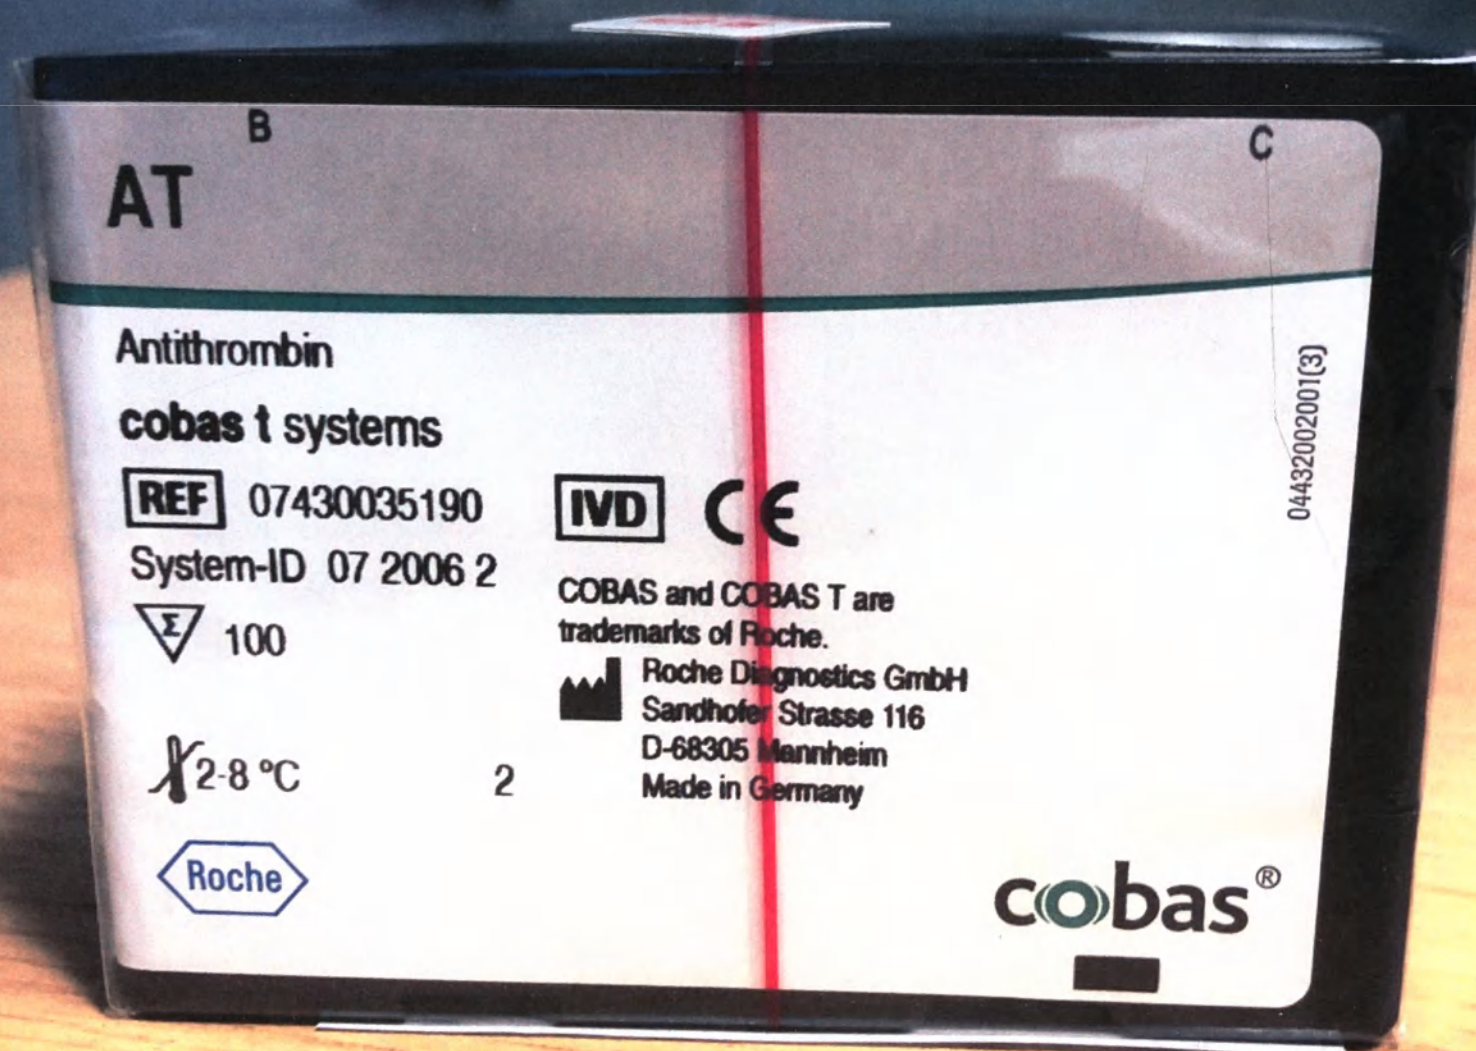

Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ) методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)

AT



REF 07430035190

GTIN 07613336118894



07430035190 ≥ V1 CE

<http://e-labdoc.roche.com>



EU: +800 5505 6606



LOT 45969601

 2021-01-31

 2019-11-18

4

Ser.No. 00992

AT

07430035190

02

Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ) методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)



Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ) методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07430035190

Реагент в кассете для количественного определения активности антитромбина (АТ) методом хромогенного анализа в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (АТ / Antithrombin cobas t systems)





Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
5 листа (ов)