

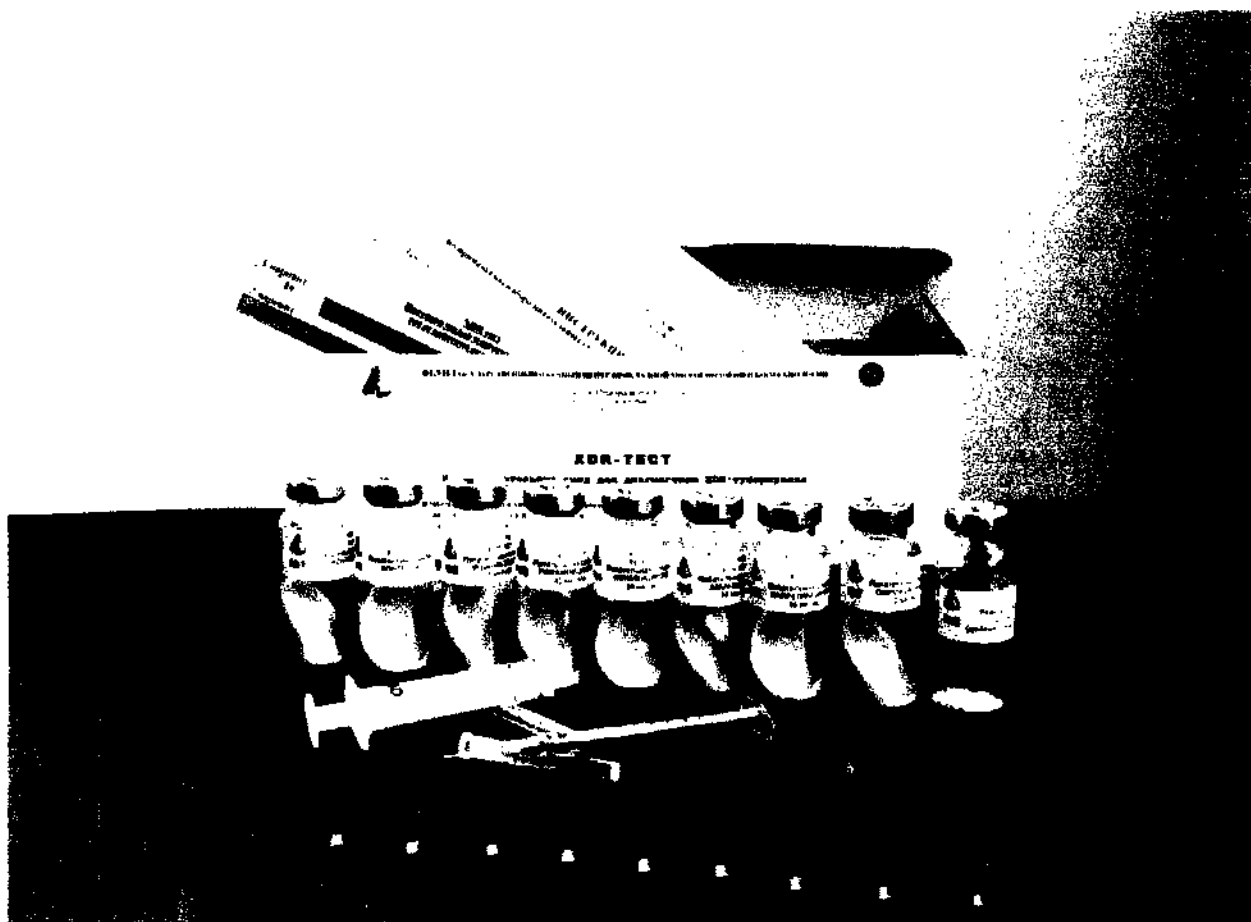


Фотоизображение изделия медицинского назначения

Набор питательных сред для диагностики XDR-туберкулеза (XDR-тест)

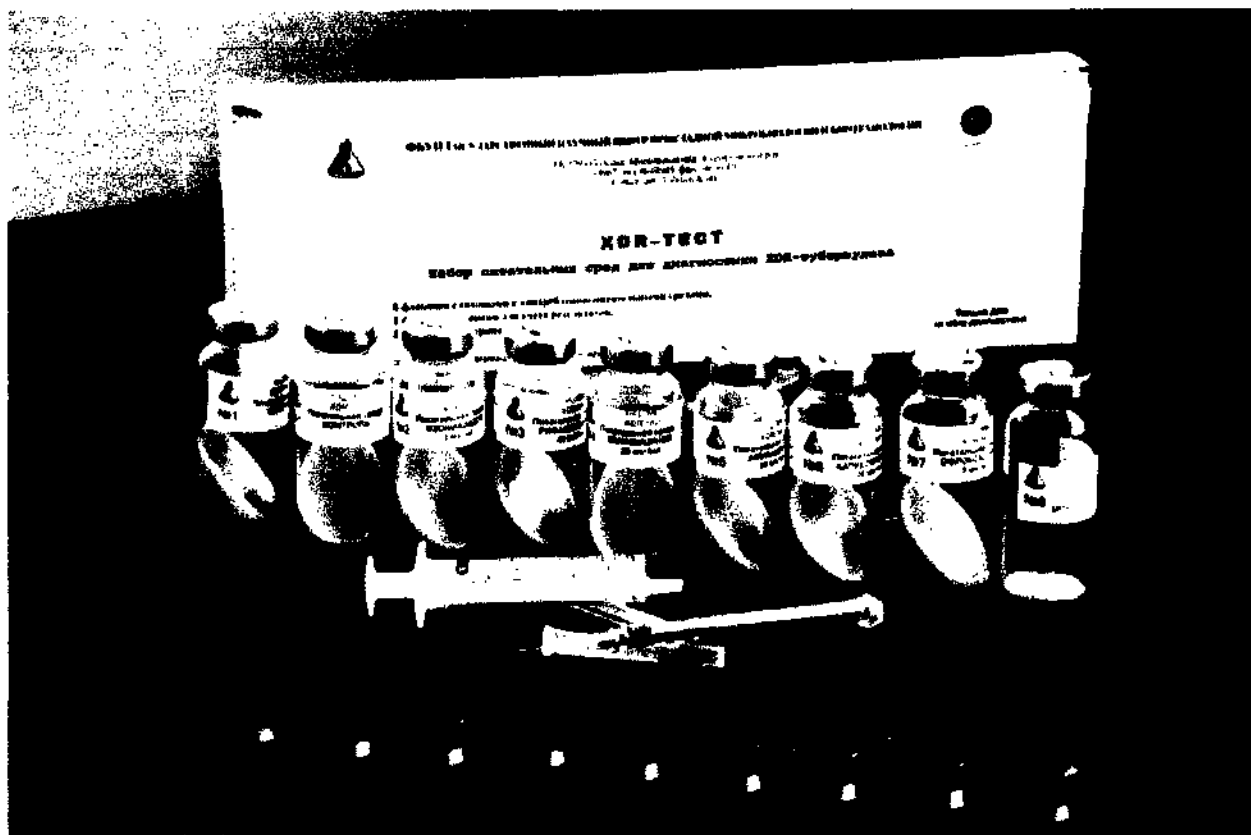

приложение 1
к Протоколу №17-12-165-044

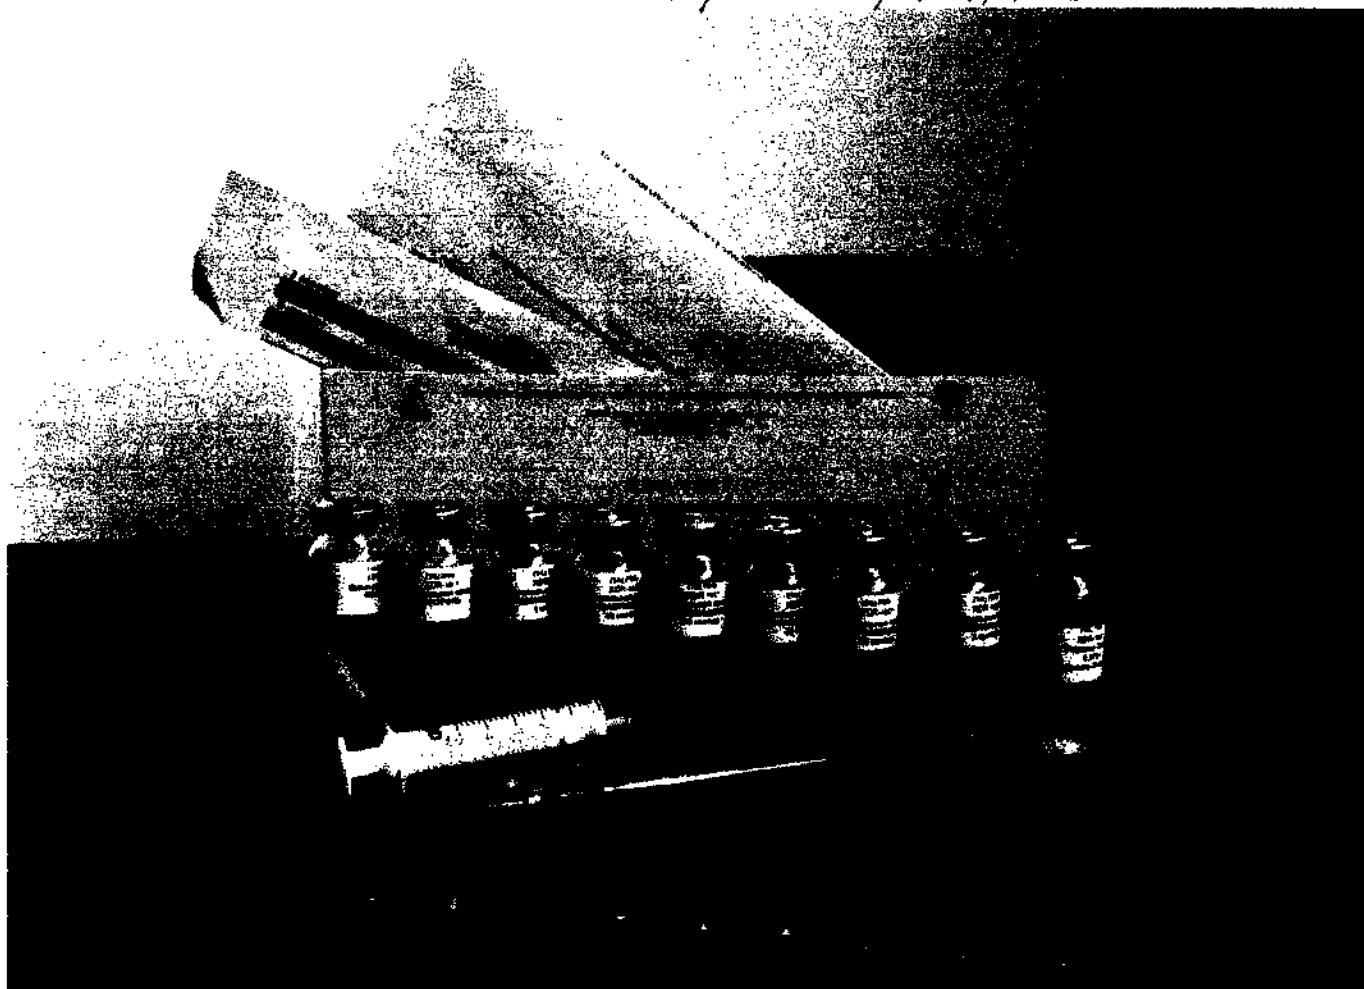

XDR-Тест

Фоторегистрация результатов изучения определения устойчивости
МБТ PS-19 к противотуберкулезным препаратам с помощью XDR-теста.

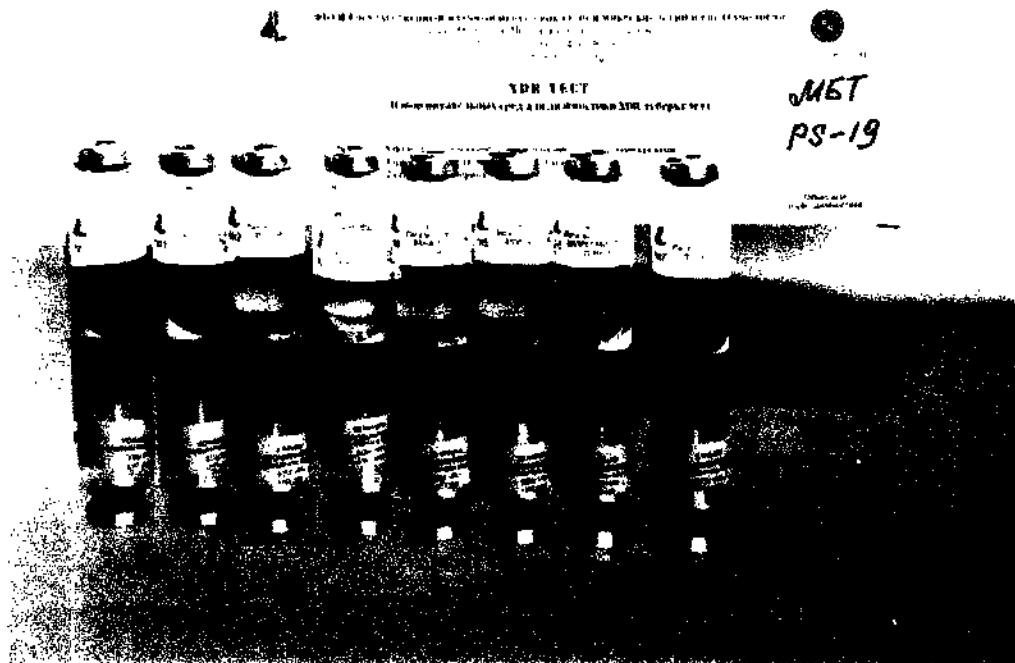


Рис. 4

Фоторегистрация результатов изучения определения устойчивости
МБТ H₃₇R_{vk} противотуберкулезным препаратам с помощью XDR-теста.

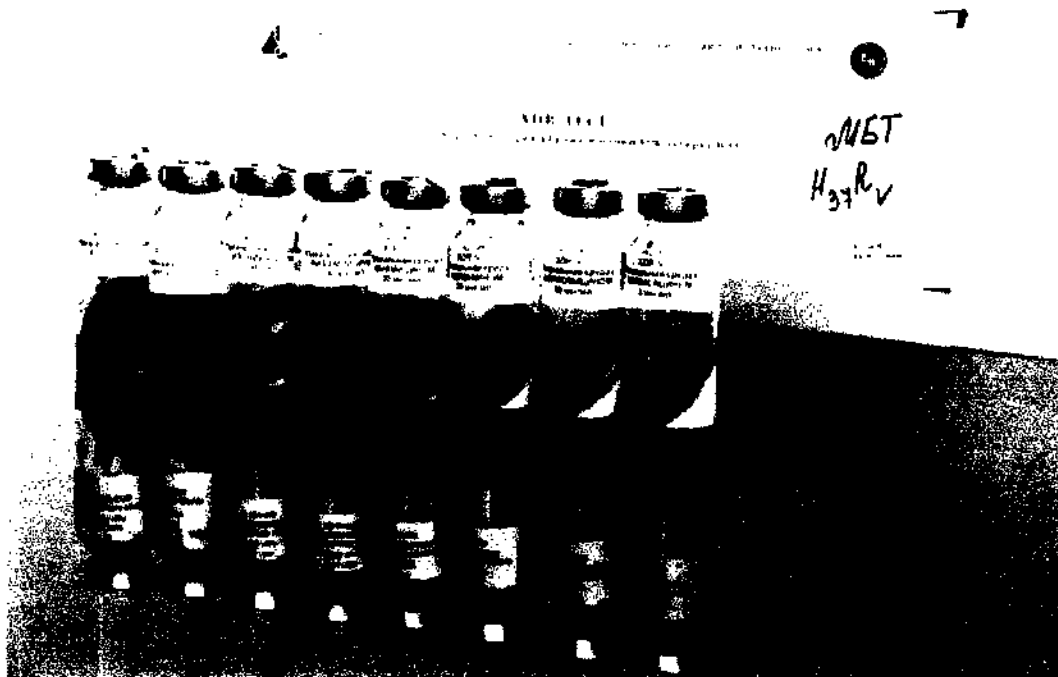


Рис. 4

Фоторегистрация результатов изучения определения устойчивости
МБТ mR-20к противотуберкулезным препаратам с помощью XDR-теста.

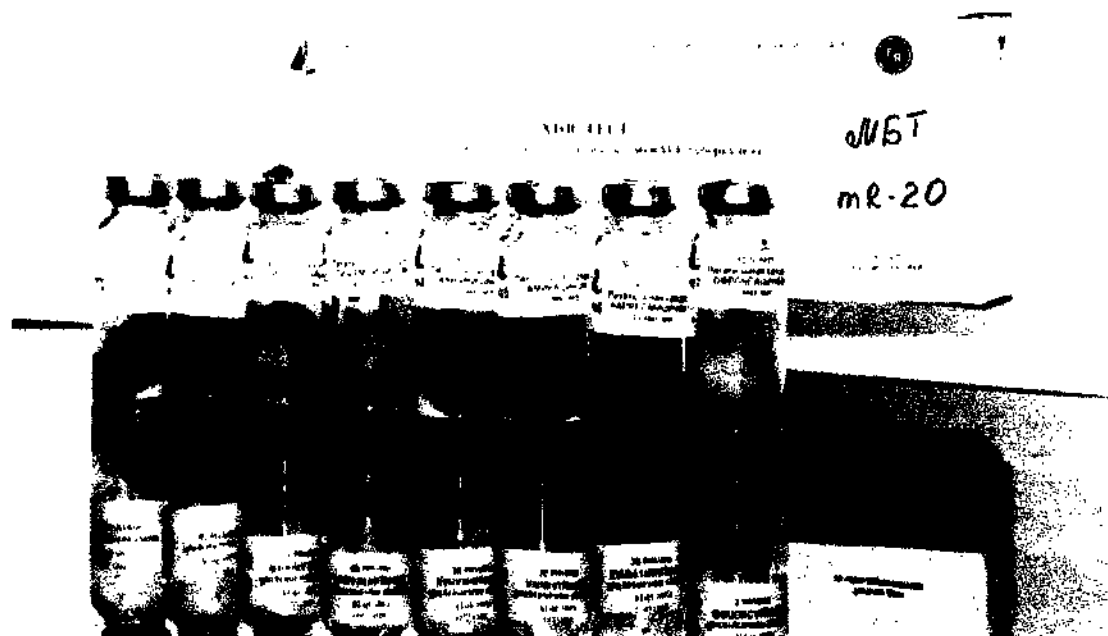


Рис. 3

Фоторегистрация результатов изучения определения устойчивости
МБТ 377к противотуберкулезным препаратам с помощью XDR-теста.

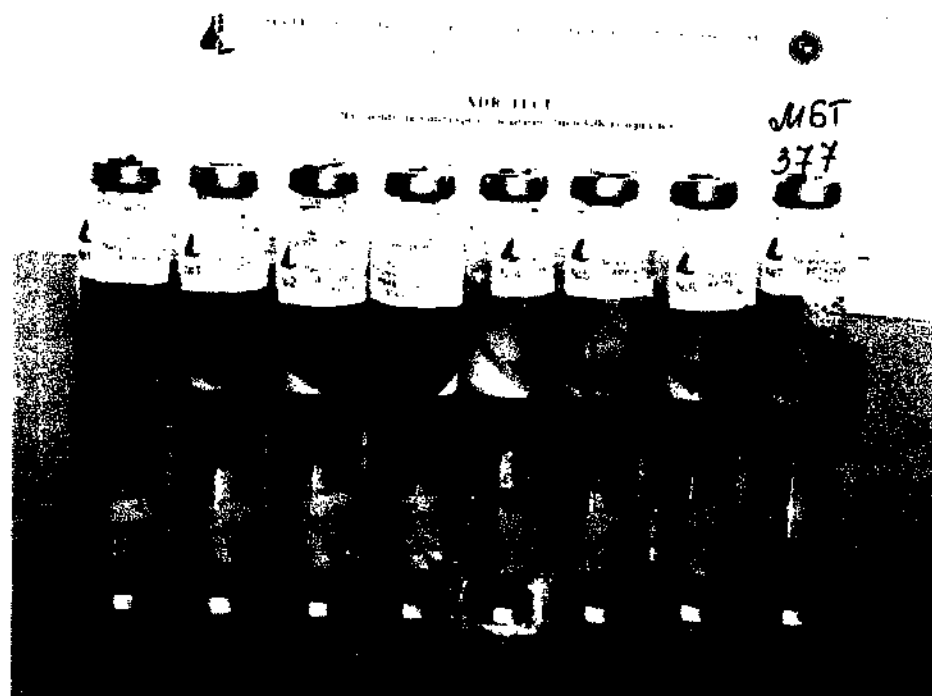


Рис. 2