

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Инкоро»




 А.В. Кондратьев

«25» сентября 2020 г.


**Фотографическое изображение медицинского изделия:
«Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ»,
производства ООО «Инкоро»**

./


2020 год

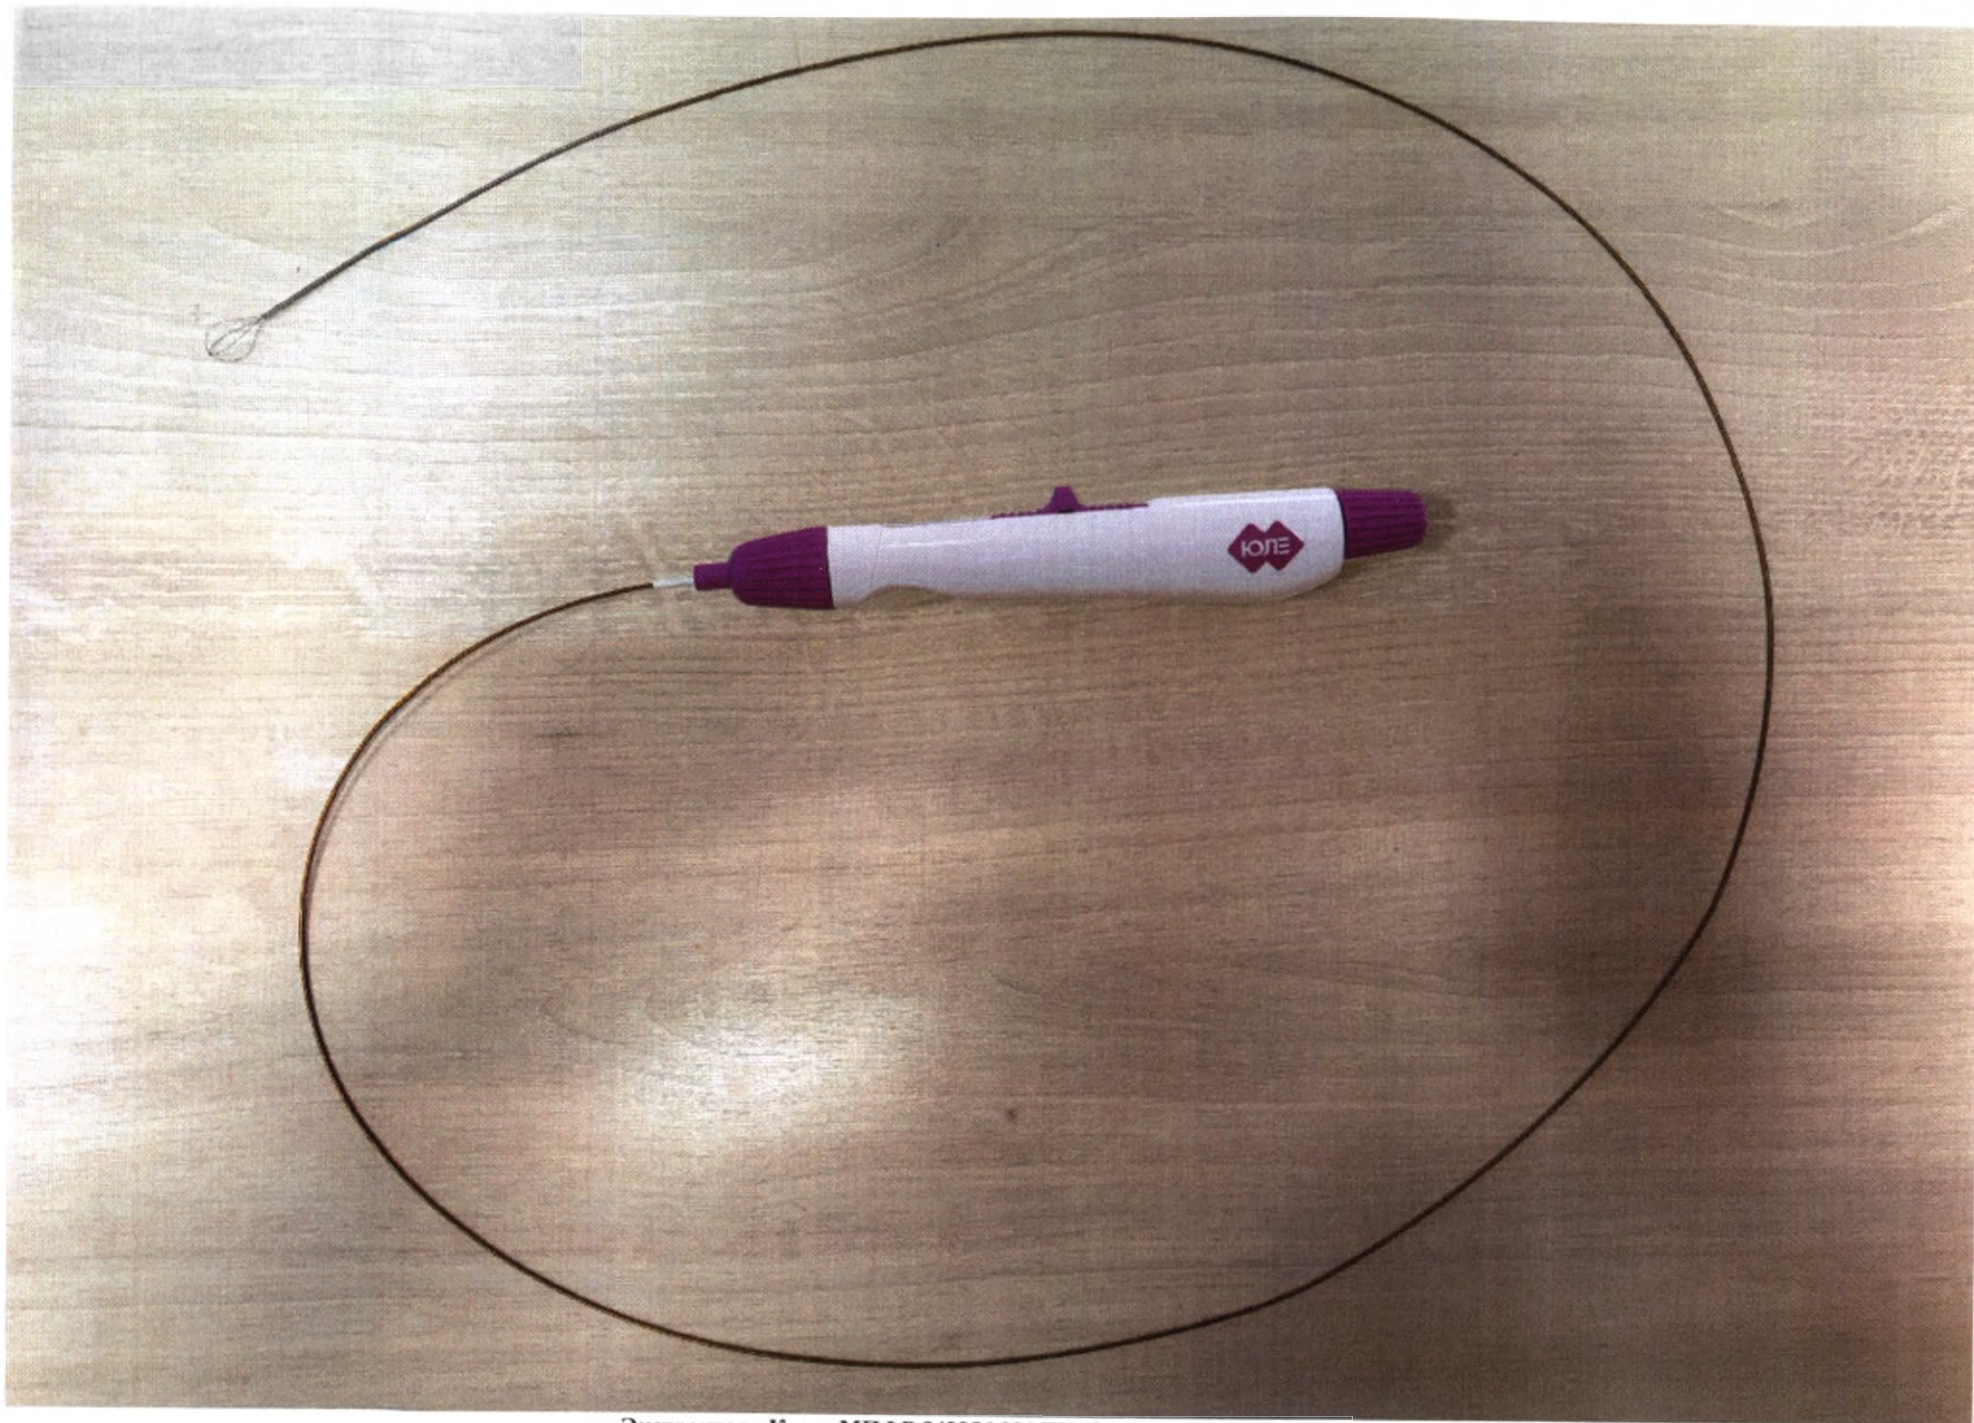


Экстрактор «Крес» МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид экстрактора

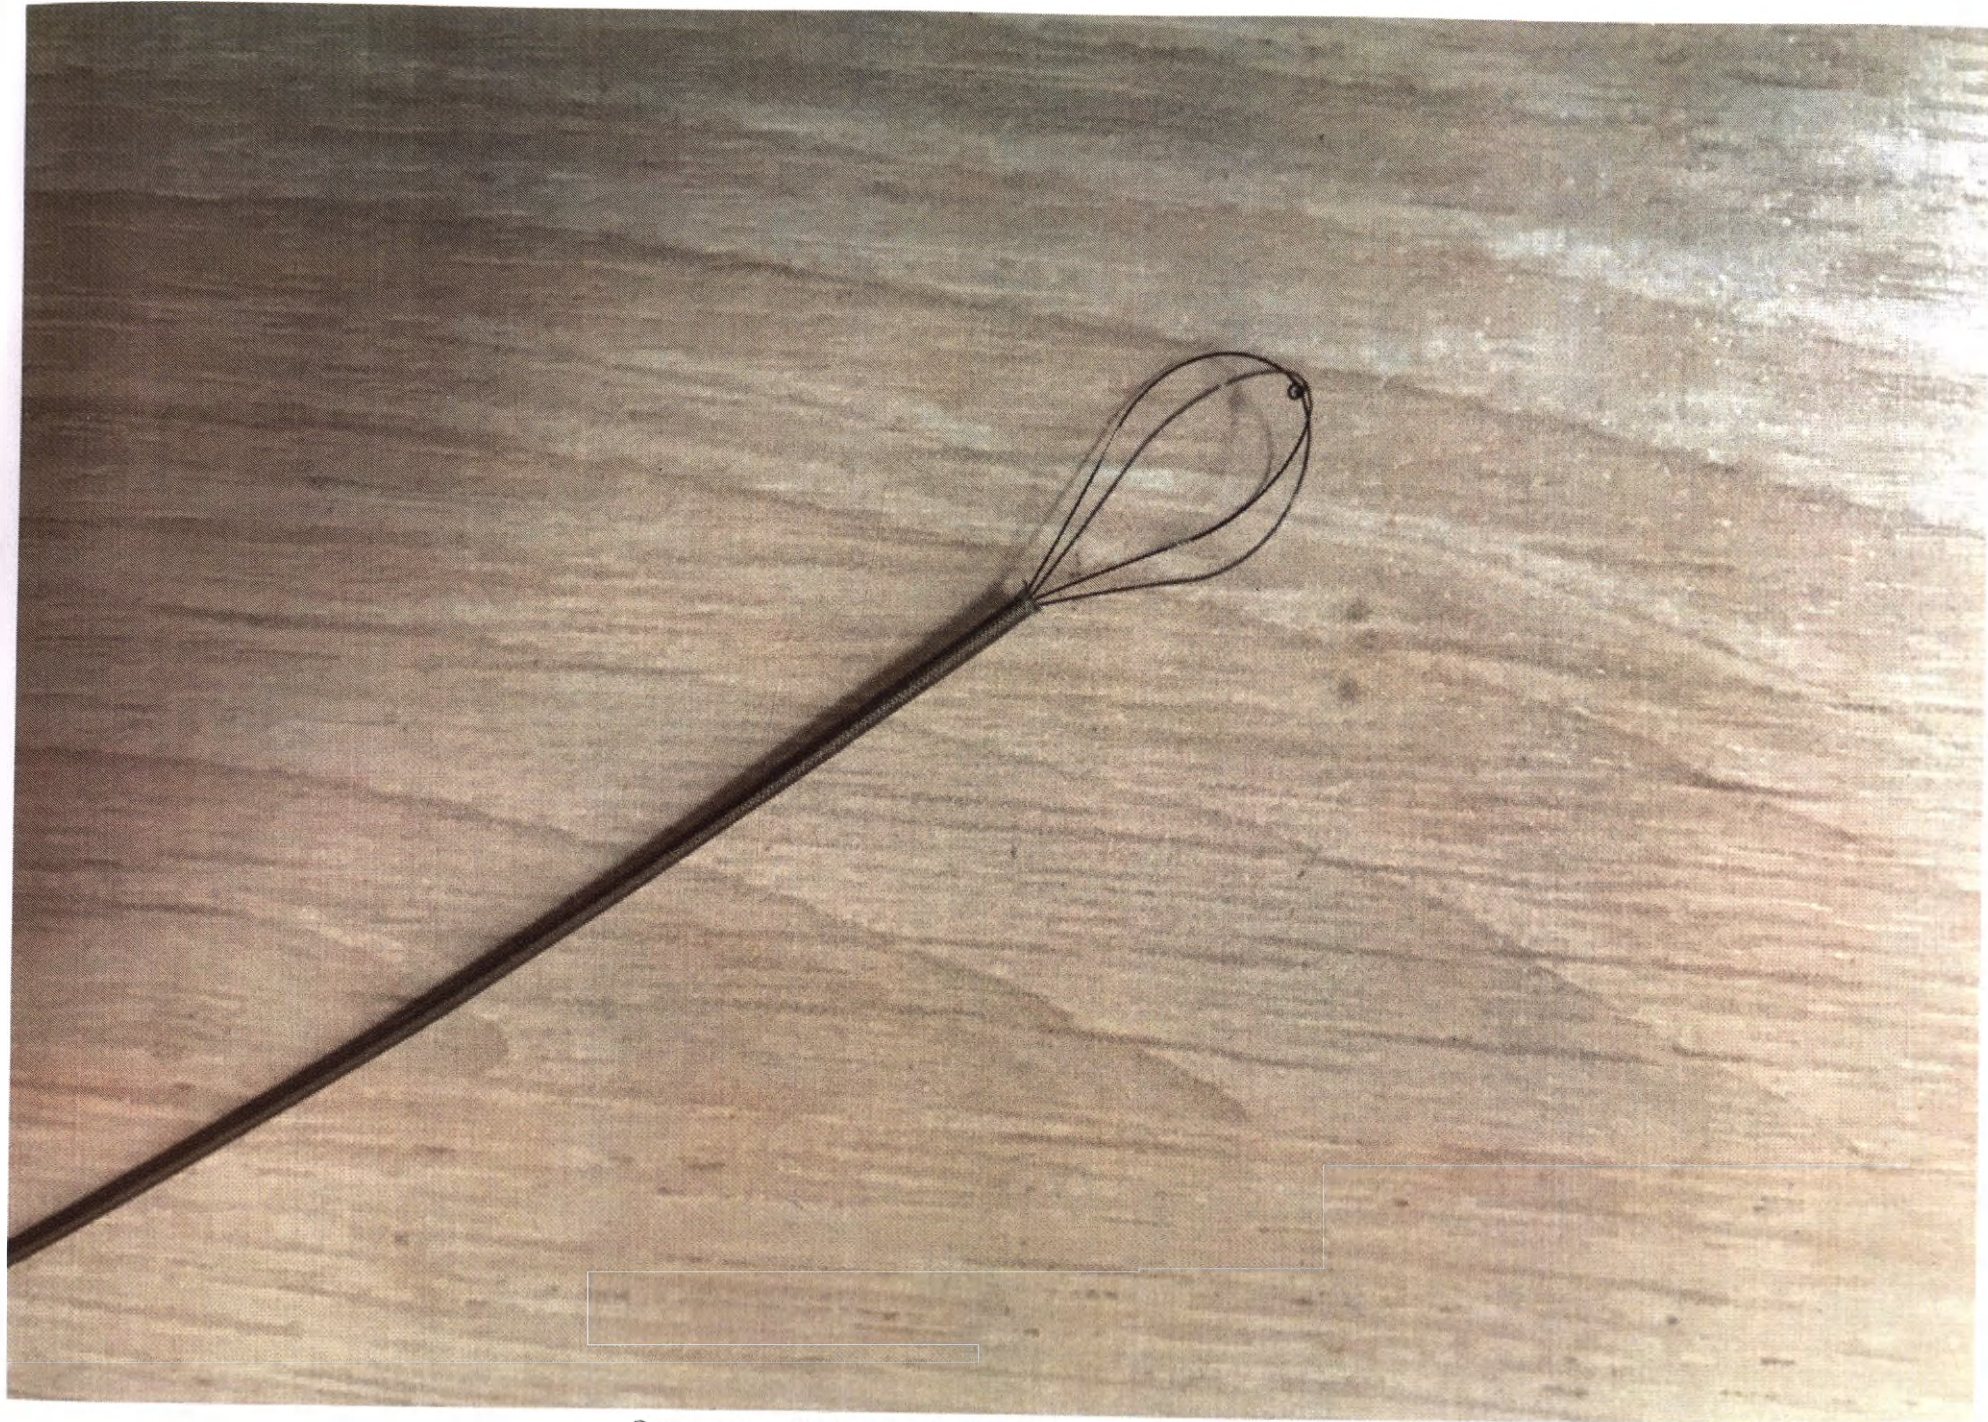


Экстрактора «Крес» МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид корзинки

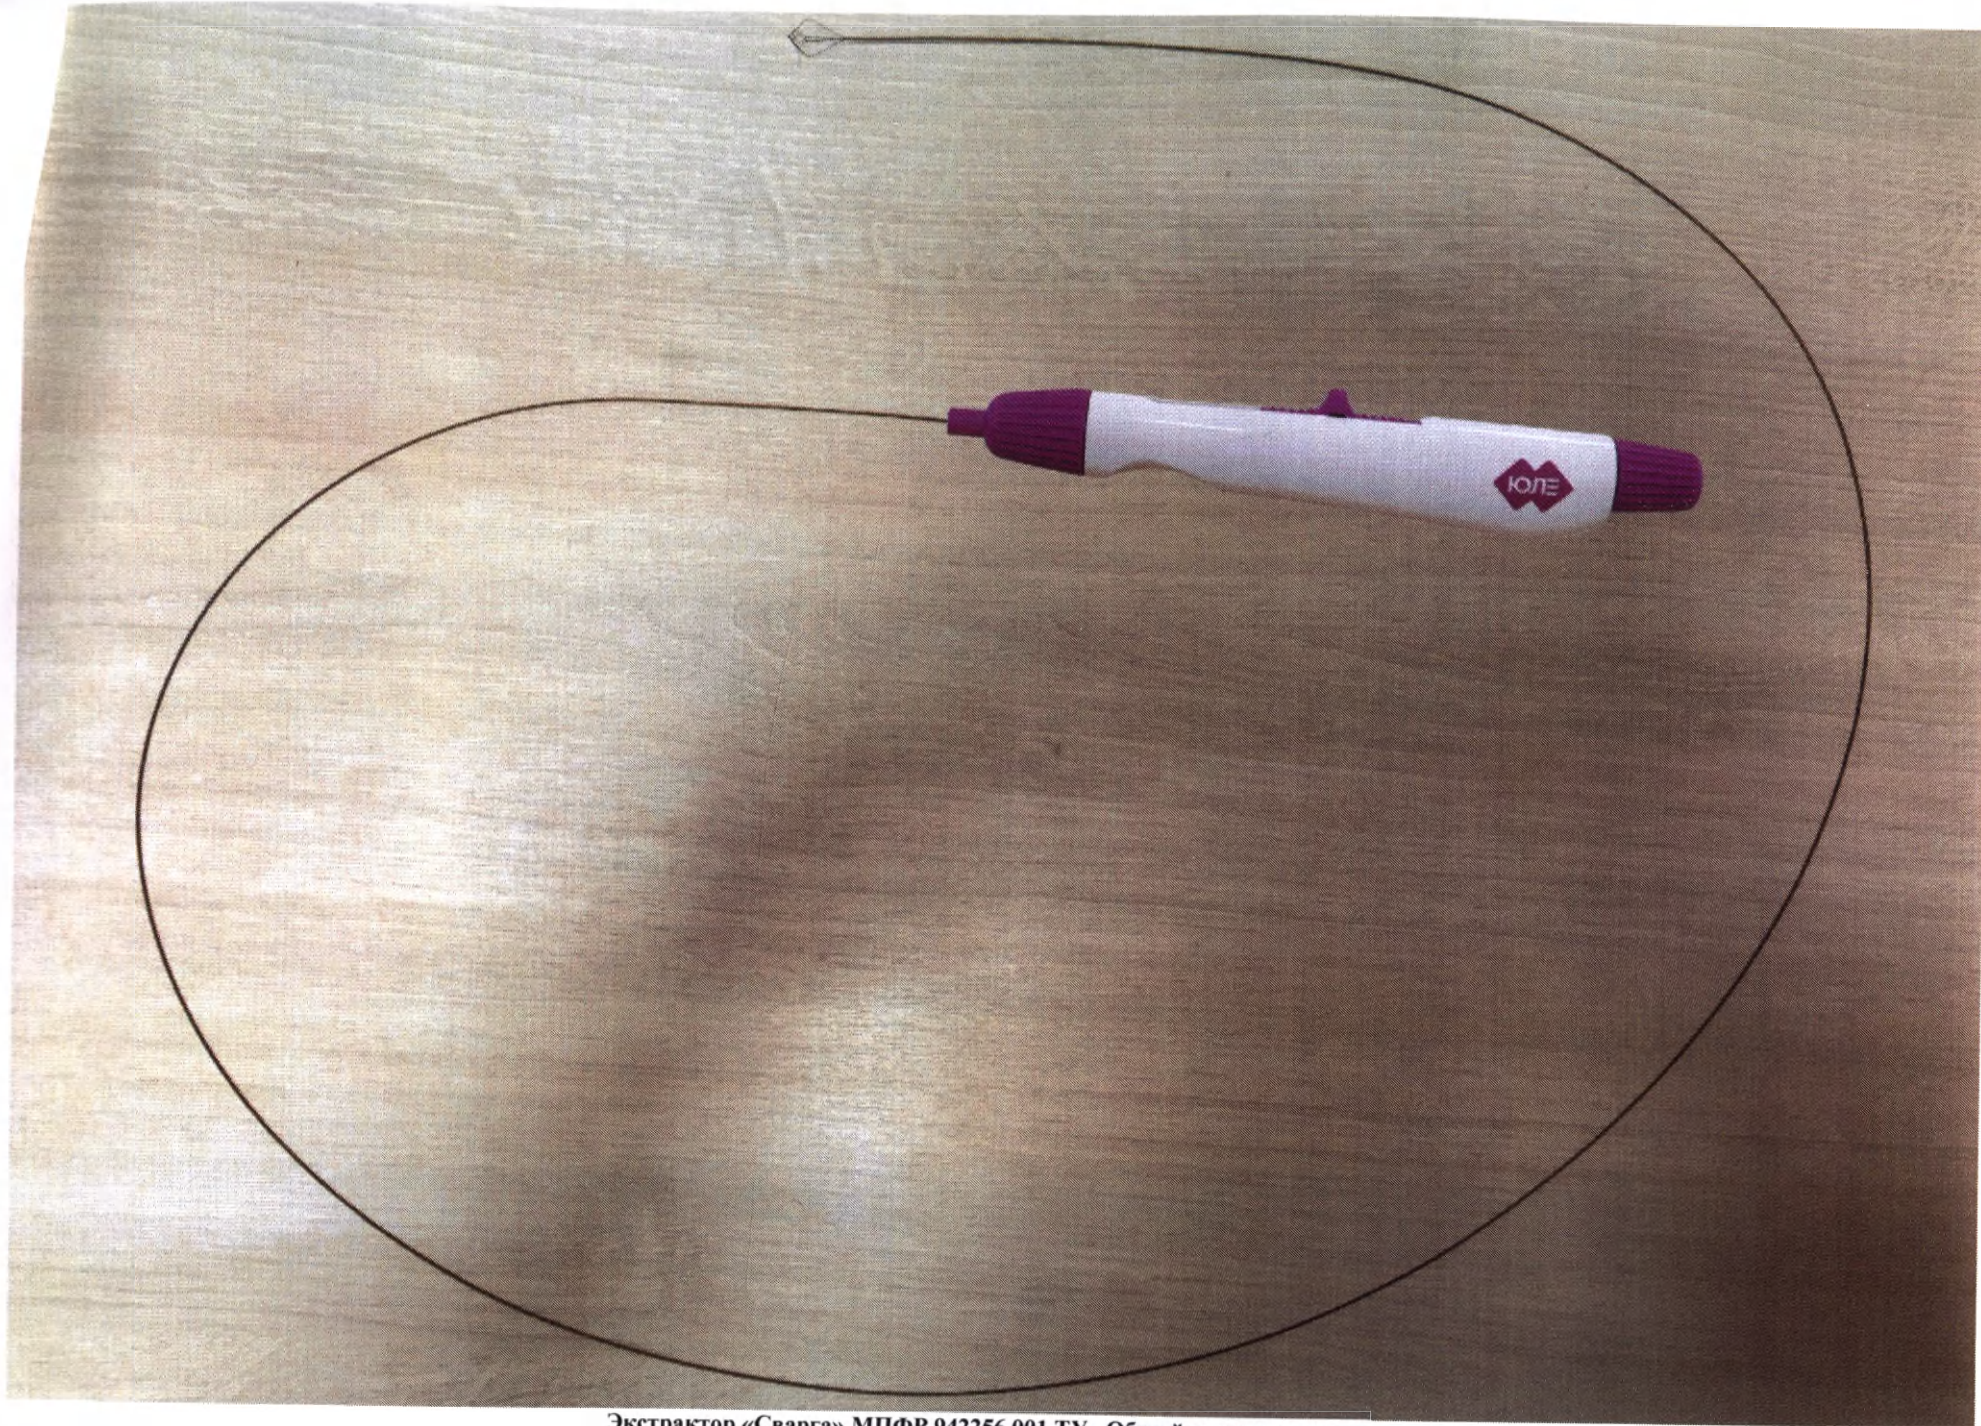

Экстрактор «Сварга» МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид экстрактора

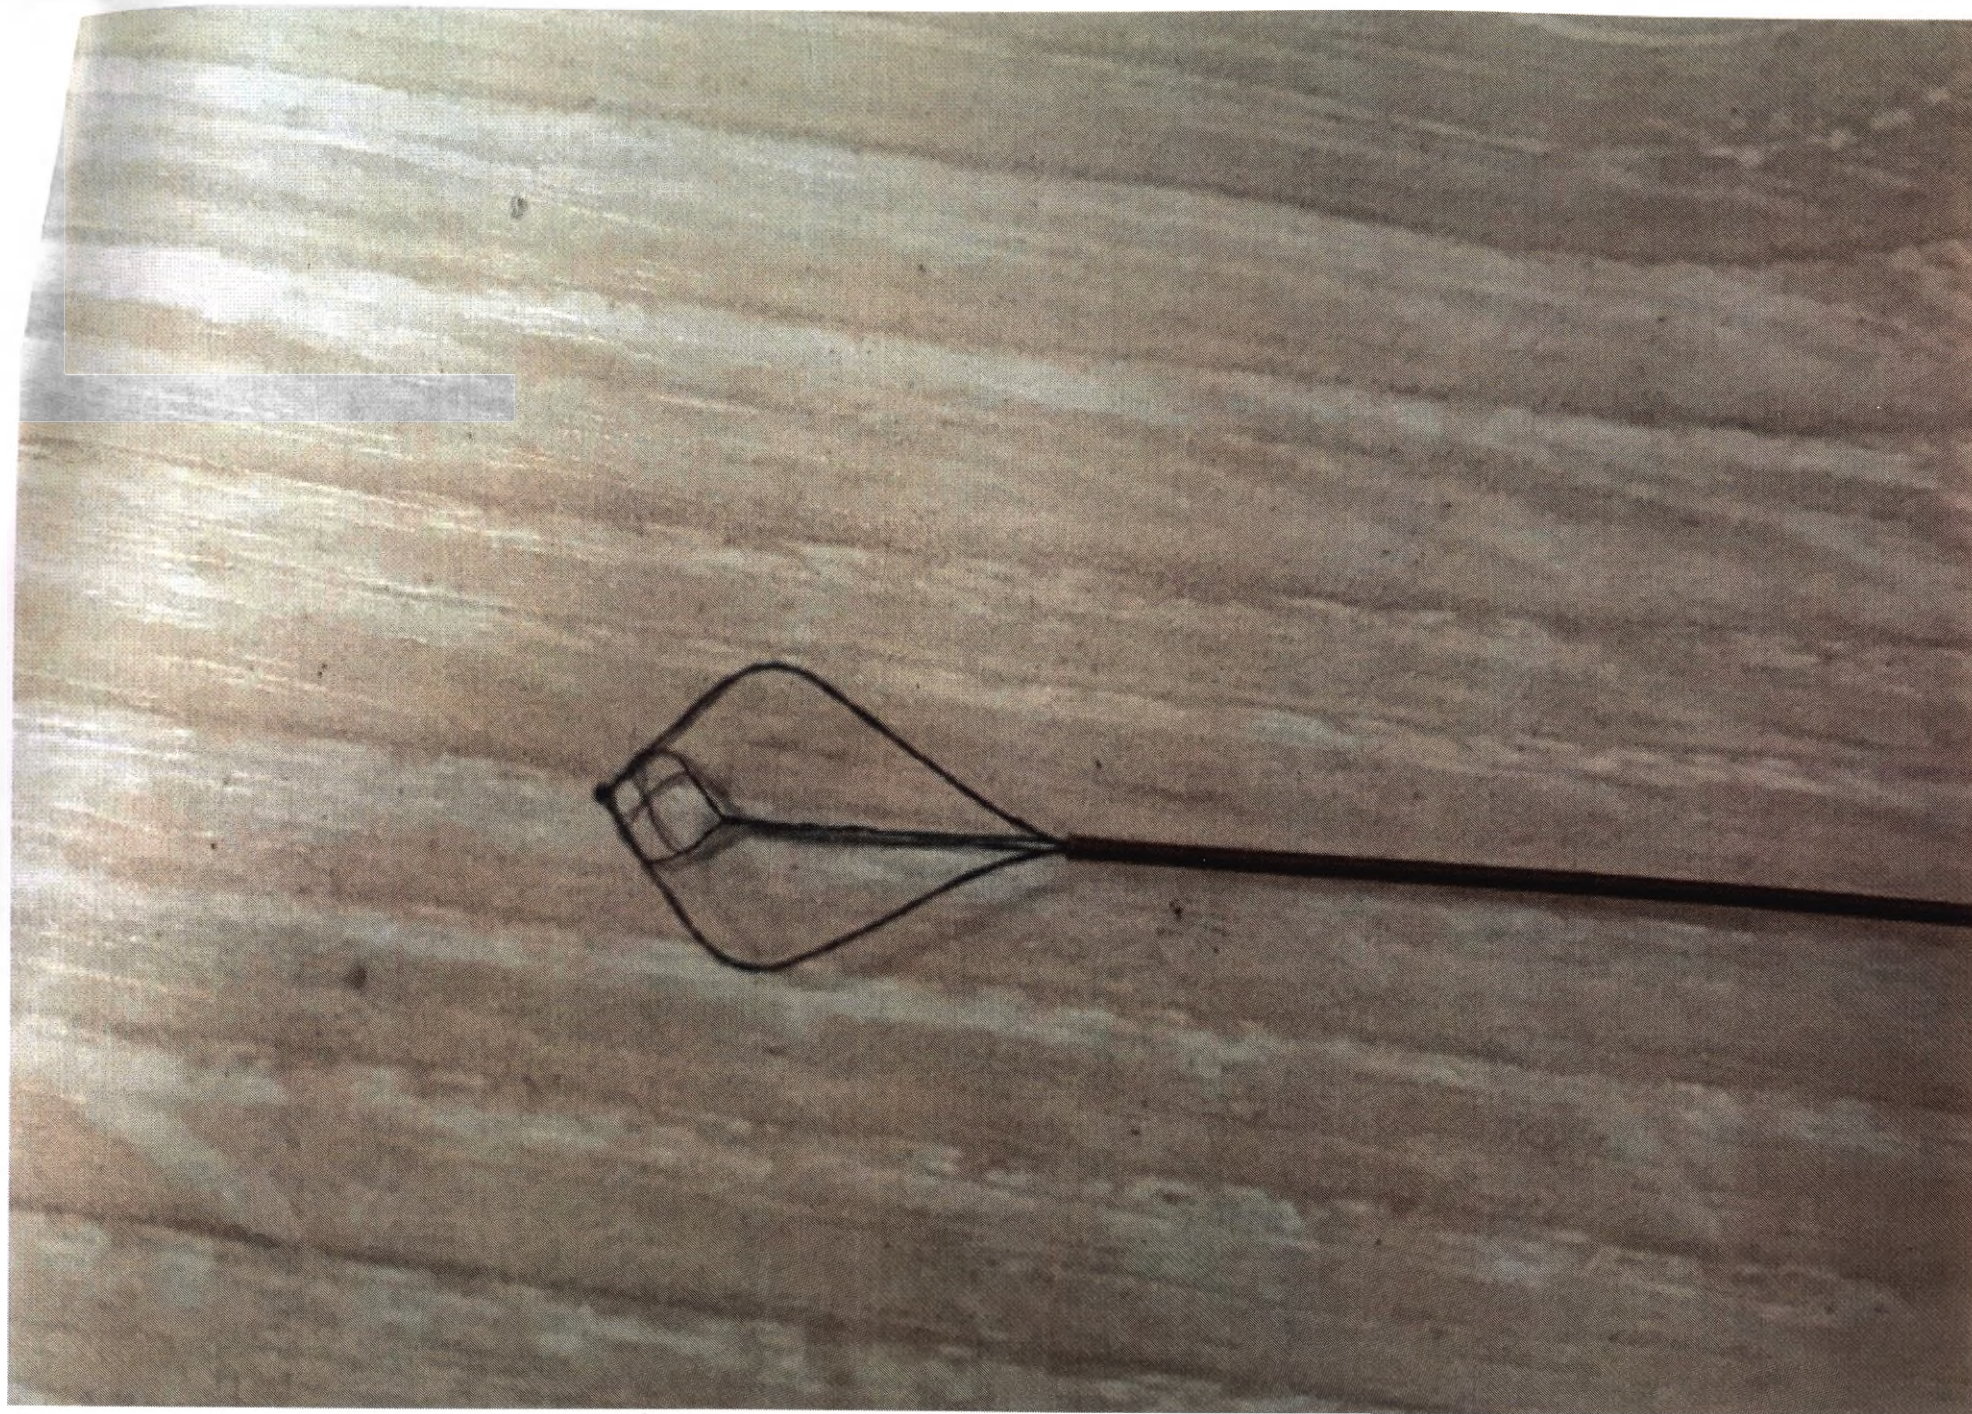


Экстрактор «Сварга» МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид корзинки

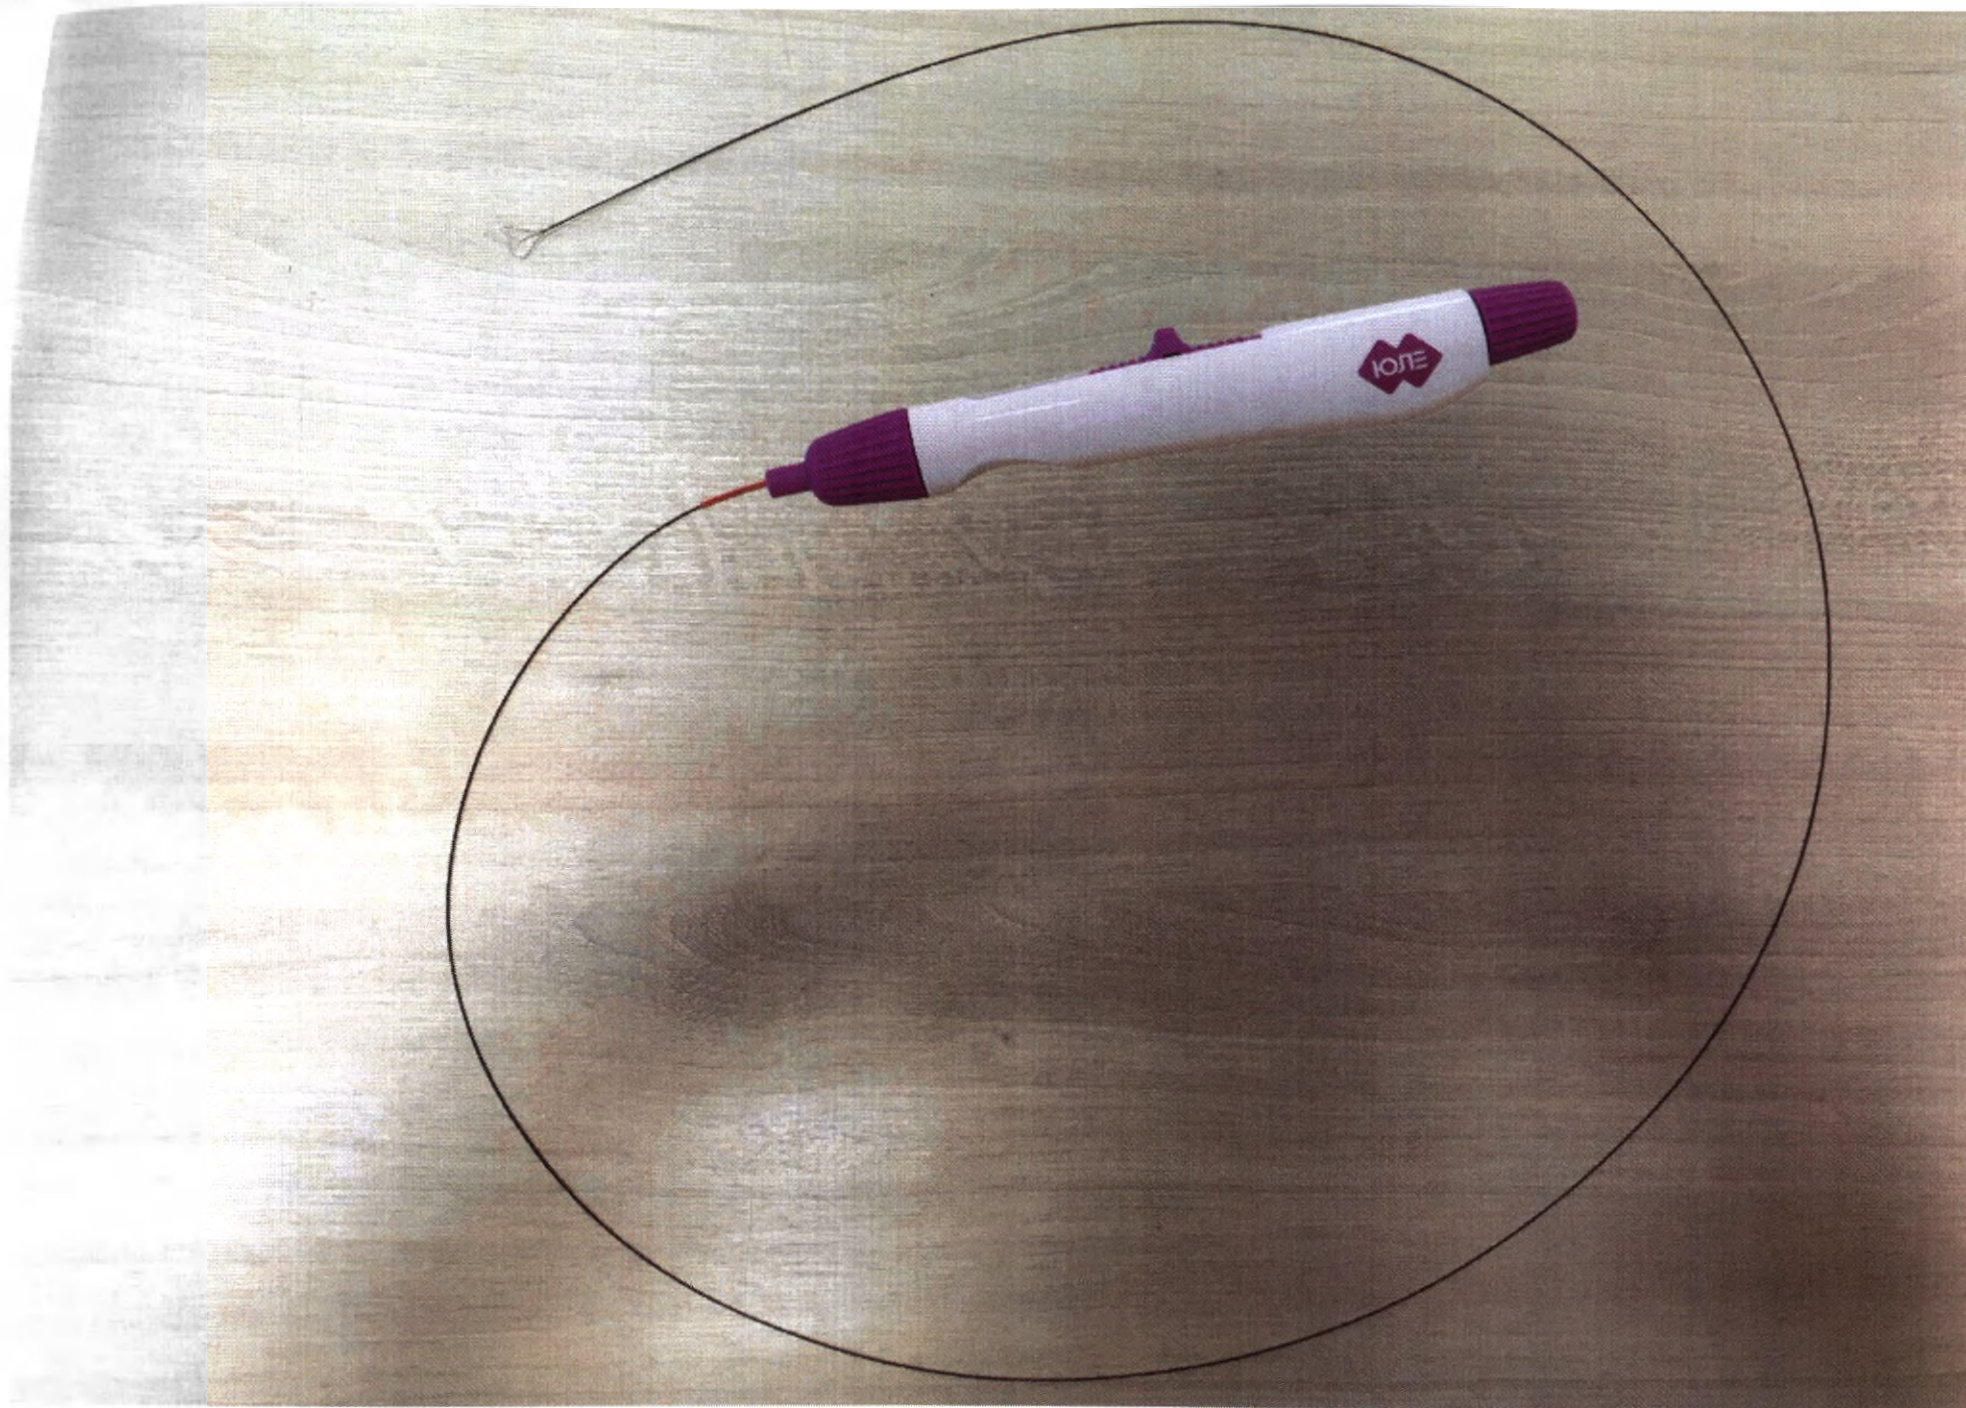

Экстрактор «Гаруда» с 3 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид экстрактора



Экстракт «Гаруда» с 3 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид корзинки

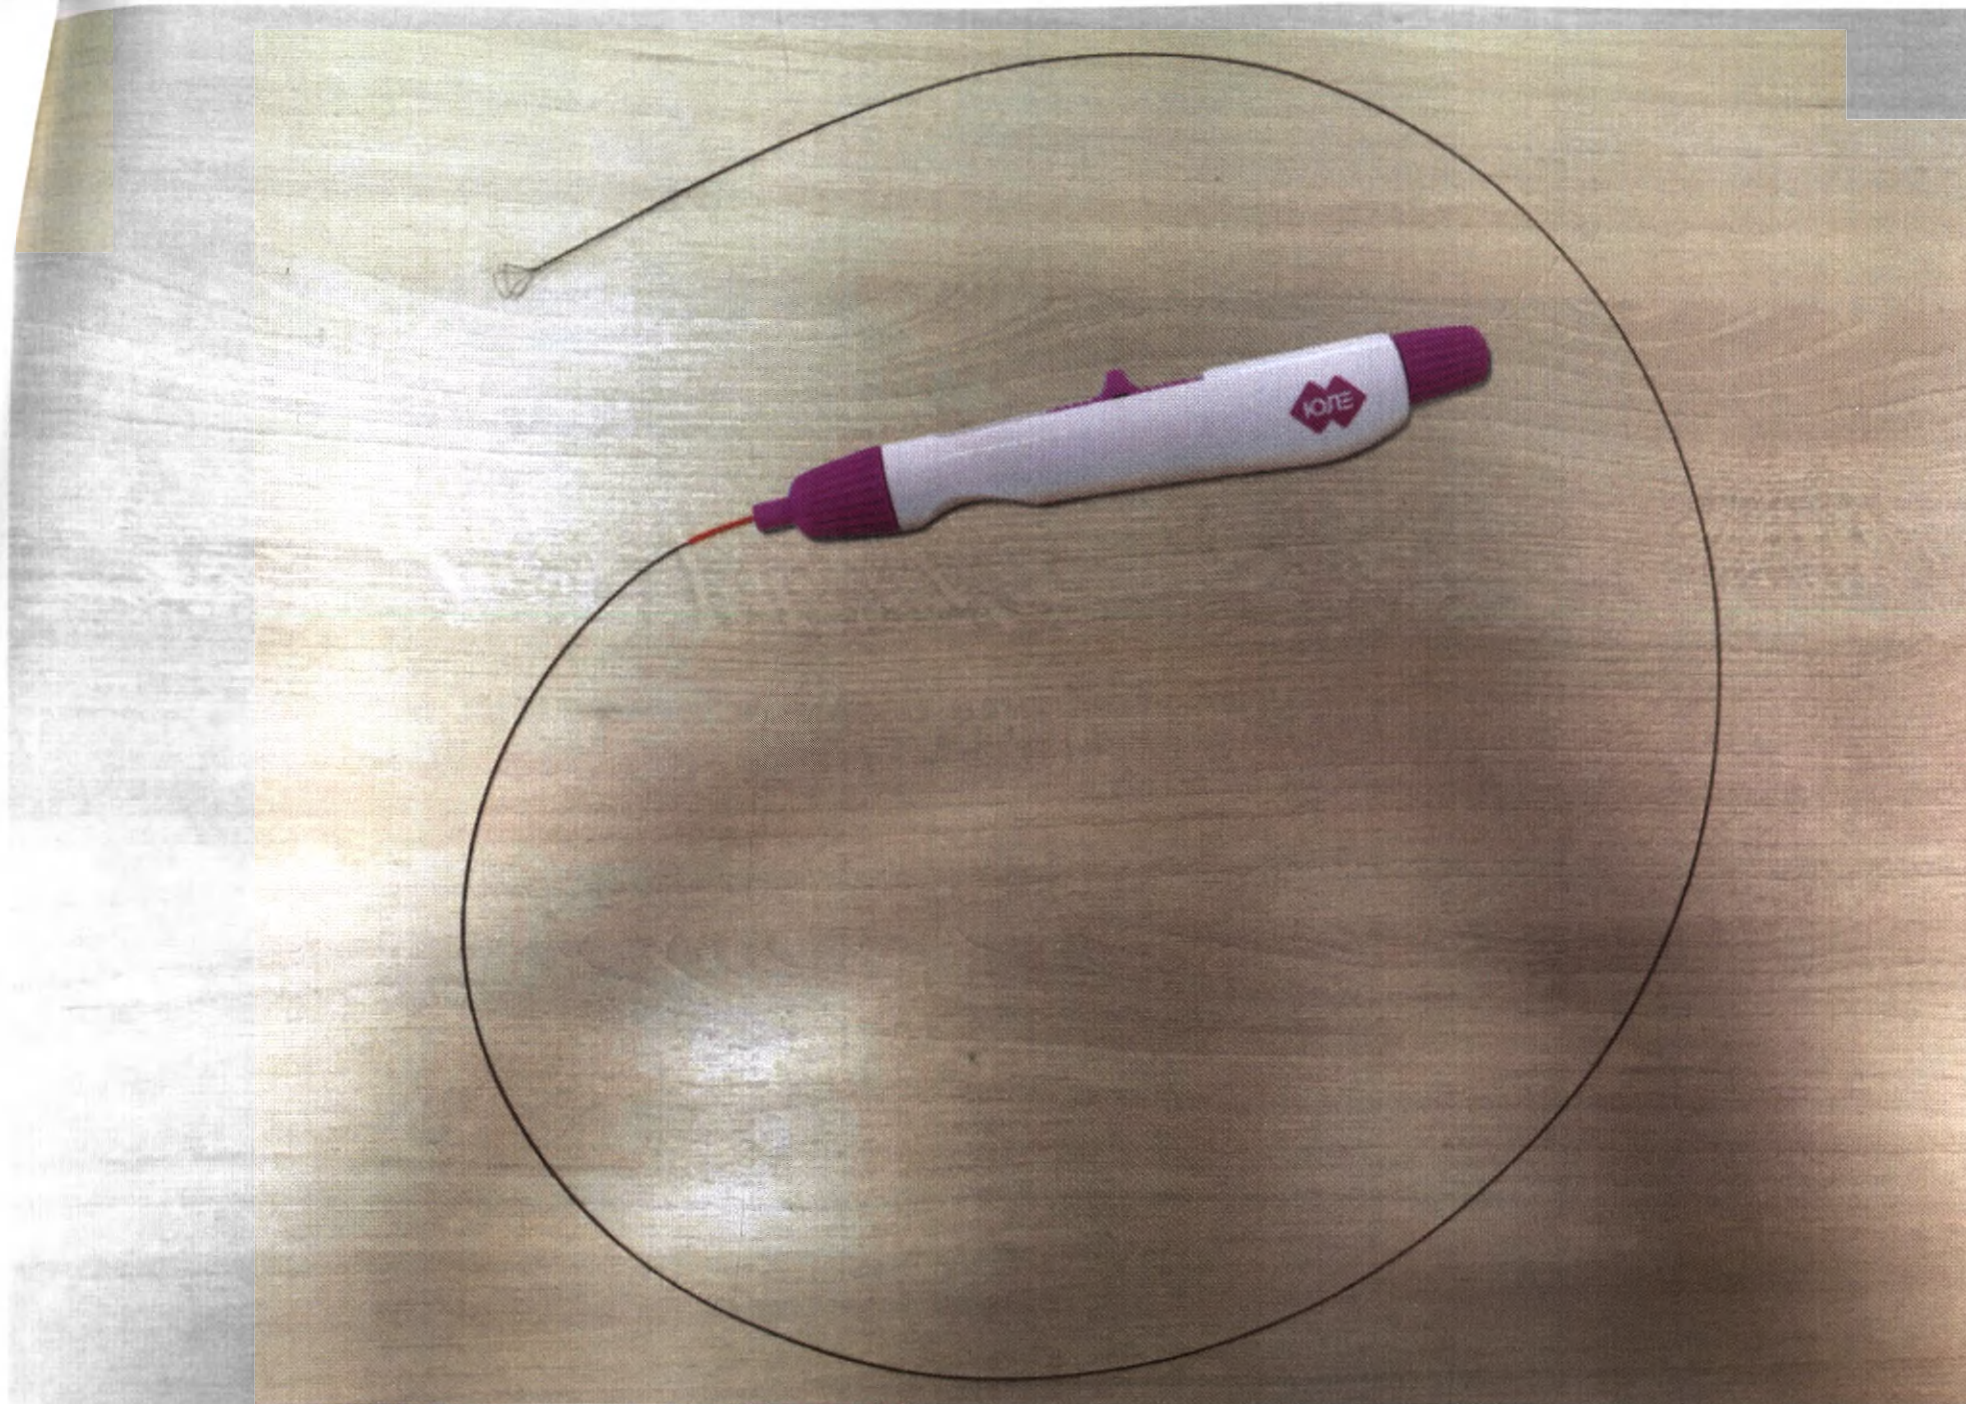

Экстрактор «Гаруда» с 4 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид экстрактора



Экстрактор «Гаруда» с 4 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Общий вид корзинки




Экстрактор "Крес" 1,5-115/10-01



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00015

STERILE EO



Нетоксично



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
корп. 5, этаж 1, пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoromed.ru

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ

REF ИНЭК1501ЮЛ

Диаметр экстрактора - 1,5FR

Диаметр корзины - 10мм

Рабочая длина экстрактора - 115см

LOT


AA00015



2020-06



2023-06

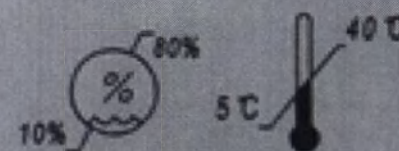

Рез. гл. М

он

Экстрактор «Крес» МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки пакета бумажно-пленочного

REF ИНЭК1501ЮЛ

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ





- Экстрактор "Крес" 1,5-115/10-01 (диаметр экстрактора - 1,5FR, диаметр корзины - 10мм, рабочая длина экстрактора - 115см) - 1 шт.
- Идентификационная наклейка - 2 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00015

STERILEEO



Нетоксично

LOT AA00015



2019-10




2022-10



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, этаж 1,
пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519


www.inkoromed.ru

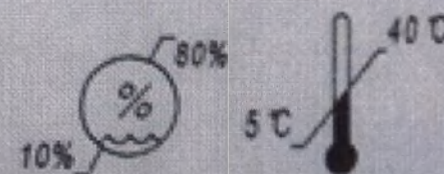

Рес. год № on

Экстрактор «Крес» МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки потребительской упаковки (картонной коробки)

REF ИНЭС1501ЮЛ



Экстрактор "Сварга" 2,0-115/8-02

Диаметр экстрактора - 2,0FR

Диаметр корзины - 8мм

Рабочая длина экстрактора - 115см



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00018

STERILEEO



Нетоксично

LOT AA00018

2020-06


2023-06



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
корп. 5, этаж 1, пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519


www.inkoromed.ru

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ

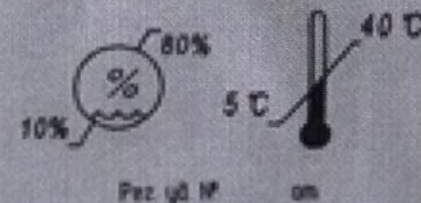

REF ИНЭС1501ЮЛ

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ



- Экстрактор "Сварга" 2,0-115/8-02 (диаметр экстрактора - 2,0 FR, диаметр корзины - 8мм, рабочая длина экстрактора - 115см) - 1 шт.
- Идентификационная наклейка - 2 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00018

STERILE EO




Нетоксично



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, этаж 1,
пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoromed.ru




LOT AA00018



2020-06



2023-06

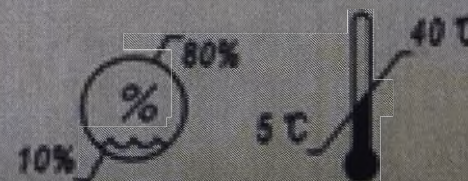

Рез. уа Н

от

Экстрактор «Сварга» МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки потребительской упаковки (картонной коробки)

REF ИНЭГ1703ЮЛ



Экстрактор "Гаруда" 1,7-115/11-3

Диаметр экстрактора - 1,7FR

Диаметр корзины - 11мм

Рабочая длина экстрактора - 115см

Количество ножек экстрактора - 3



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00016

STERILE EO



Нетоксично

LOT

AA00016



2020-06




2023-06



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
корп. 5, этаж 1, пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoramed.ru

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ

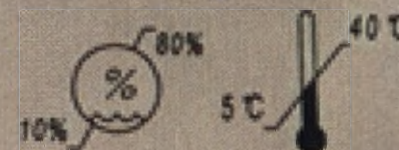


Рег. у в. М

001

Экстрактор «Гаруда» с 3 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки пакета бумажно-пленочного

REF ИНЭГ1703ЮЛ

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ




- Экстрактор "Гаруда" 1,7-115/11-3 (диаметр экстрактора - 1,7FR, диаметр корзины - 11мм, рабочая длина экстрактора - 115см, количество ножек экстрактора - 3) - 1 шт.
- Идентификационная наклейка - 2 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00016

STERILE EO



Нетоксично



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, этаж 1,
пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoromed.ru


LOT AA00016



2020-06




2023-06

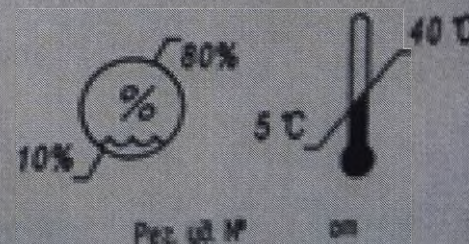

Экстрактор «Гаруда» с 3 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки потребительской упаковки (картонной коробки)

REF ИНЭГ1703ЮЛ



Экстрактор "Гаруда" 2,2-115/16-4

Диаметр экстрактора - 2,2FR

Диаметр корзины - 16мм


Рабочая длина экстрактора - 115см

Количество ножек экстрактора - 4



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00017

STERILE EO



Нетоксично



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42,
корп. 5, этаж 1, пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoromed.ru

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ

LOT


AA00017



2020-06



2023-06

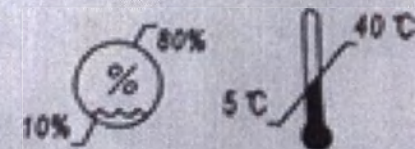


Рез. гл. №

см

Экстрактор «Гаруда» с 4 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки пакета бумажно-пленочного

REF ИНЭГ1703ЮЛ

Экстрактор камней «ЮЛЕ» по МПФР.942256.001 ТУ





- Экстрактор "Гаруда" 2,2-115/16-4 (диаметр экстрактора - 2,2 FR, диаметр корзины - 16мм, рабочая длина экстрактора - 115см, количество ножек экстрактора - 4) - 1 шт.
- Идентификационная наклейка - 2 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.



(01)04620038693027(17)221000(10)AA00017

STERILE EO




Нетоксично



ООО "Инкоро", Россия, 109316, Москва,
Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 5, этаж 1,
пом. 1, комн. № № 500-502 и № № 506-519

www.inkoromed.ru




LOT AA00017



2020-06



2023-06

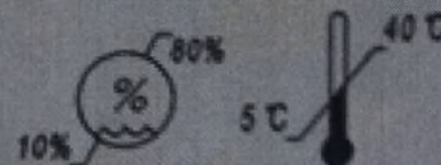

Рез. гл. №

am

Экстрактор «Гаруда» с 4 ножками МПФР.942256.001 ТУ. Пример маркировки потребительской упаковки (картонной коробки)

прошнуровано и
скреплено печатью

17 листов

68

