


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»
производства компании Medax S.r.l. Unipersonale
(Медакс С.р.л. Униперсонале), Италия**

***Фотографические изображения представленных вариантов исполнения медицинского изделия
применимы для всех вариантов исполнения медицинского изделия***


«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для аспирации костного мозга MIELOX (МА-исполнение)», артикул МА 18 040 -
 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 40 мм;
 сечение круглое

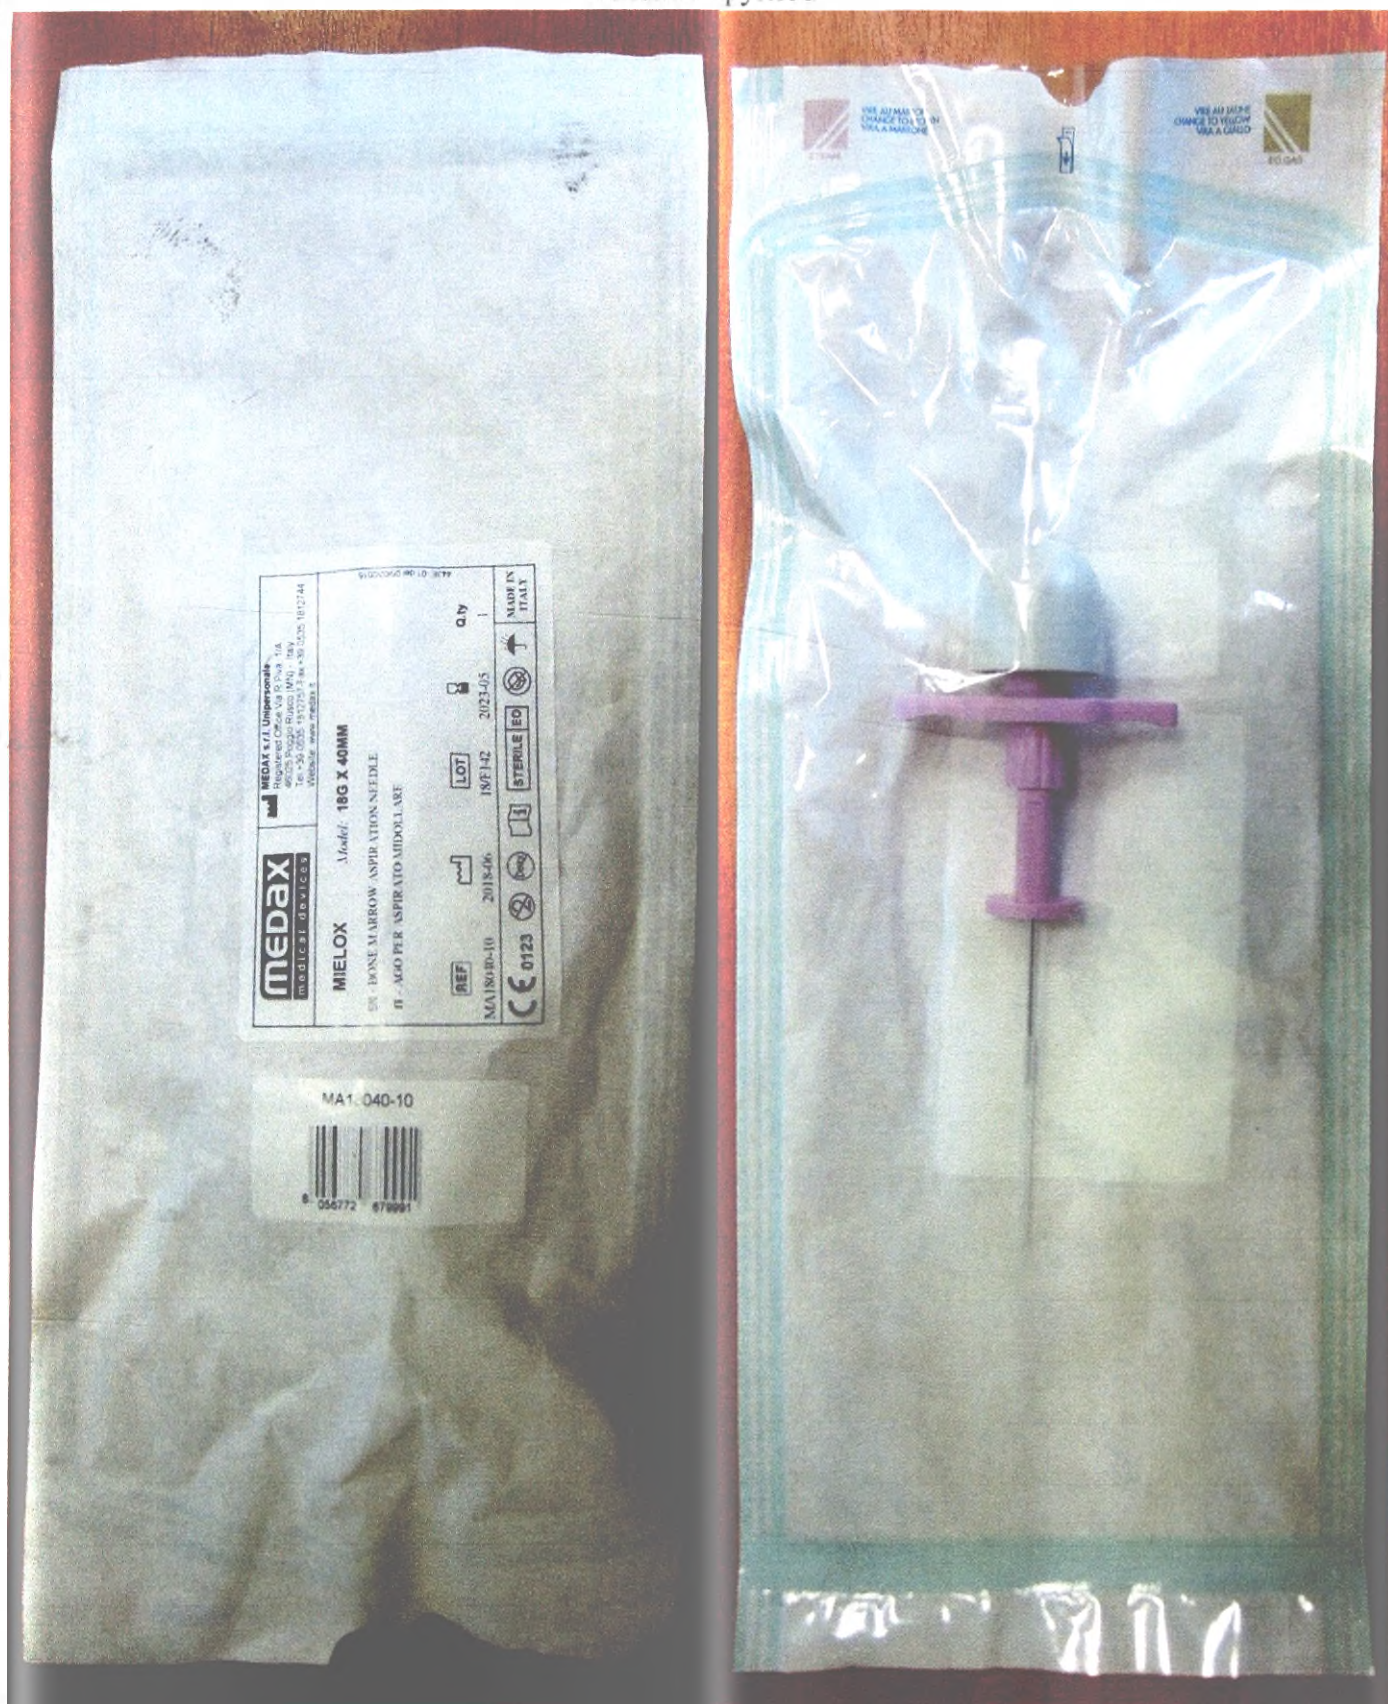

Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»


«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:

«Игла биопсийная для аспирации костного мозга и эксплантации костной ткани MIELOX (Мие-локс)», артикул ME 15 030 - 10 (с рукояткой пластиковой); номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм; сечение круглое

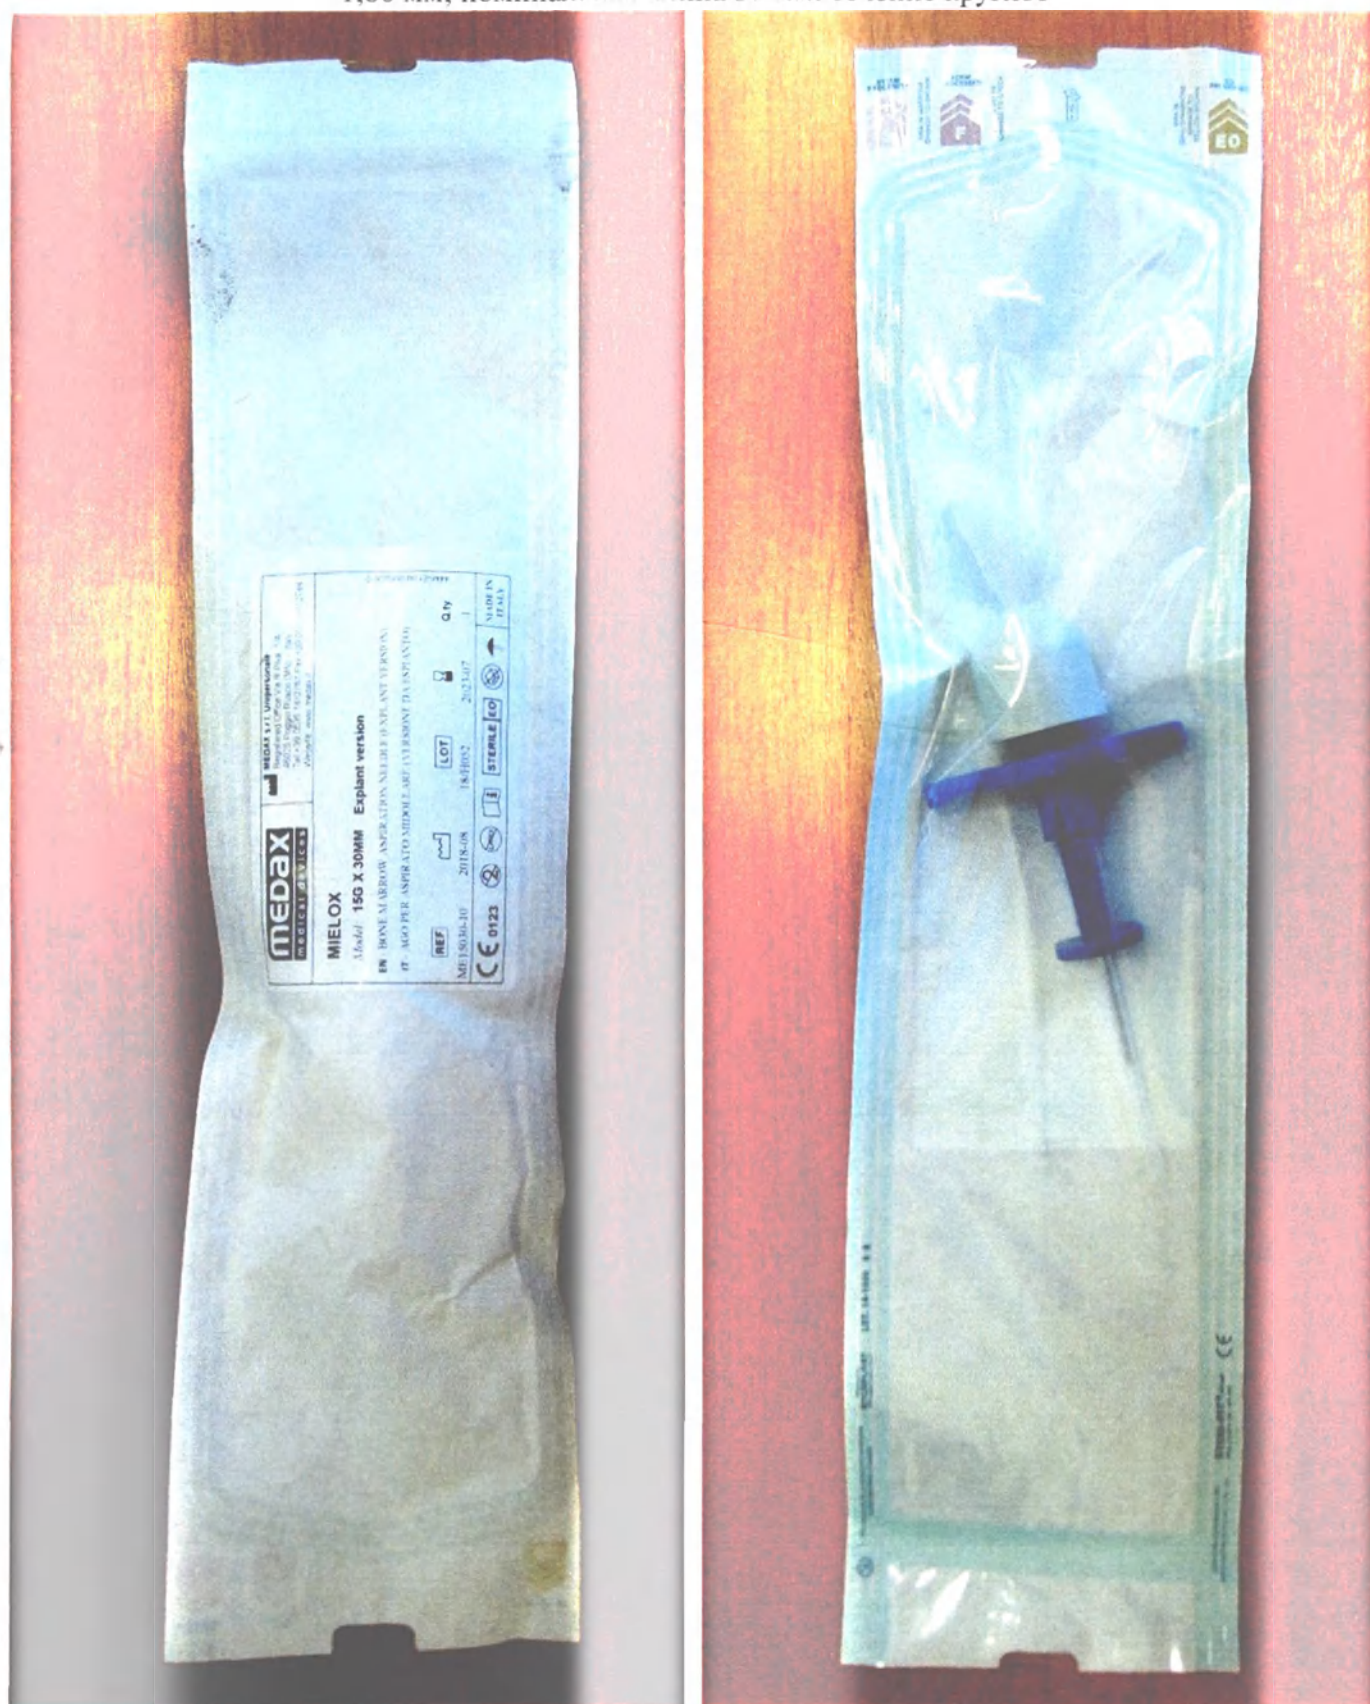

Примечание – Представлены фотографии реальные изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для аспирации костного мозга MEDEM (MD-исполнение)»,
 артикул MD 15 030 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная длина 30 мм;
 сечение круглое

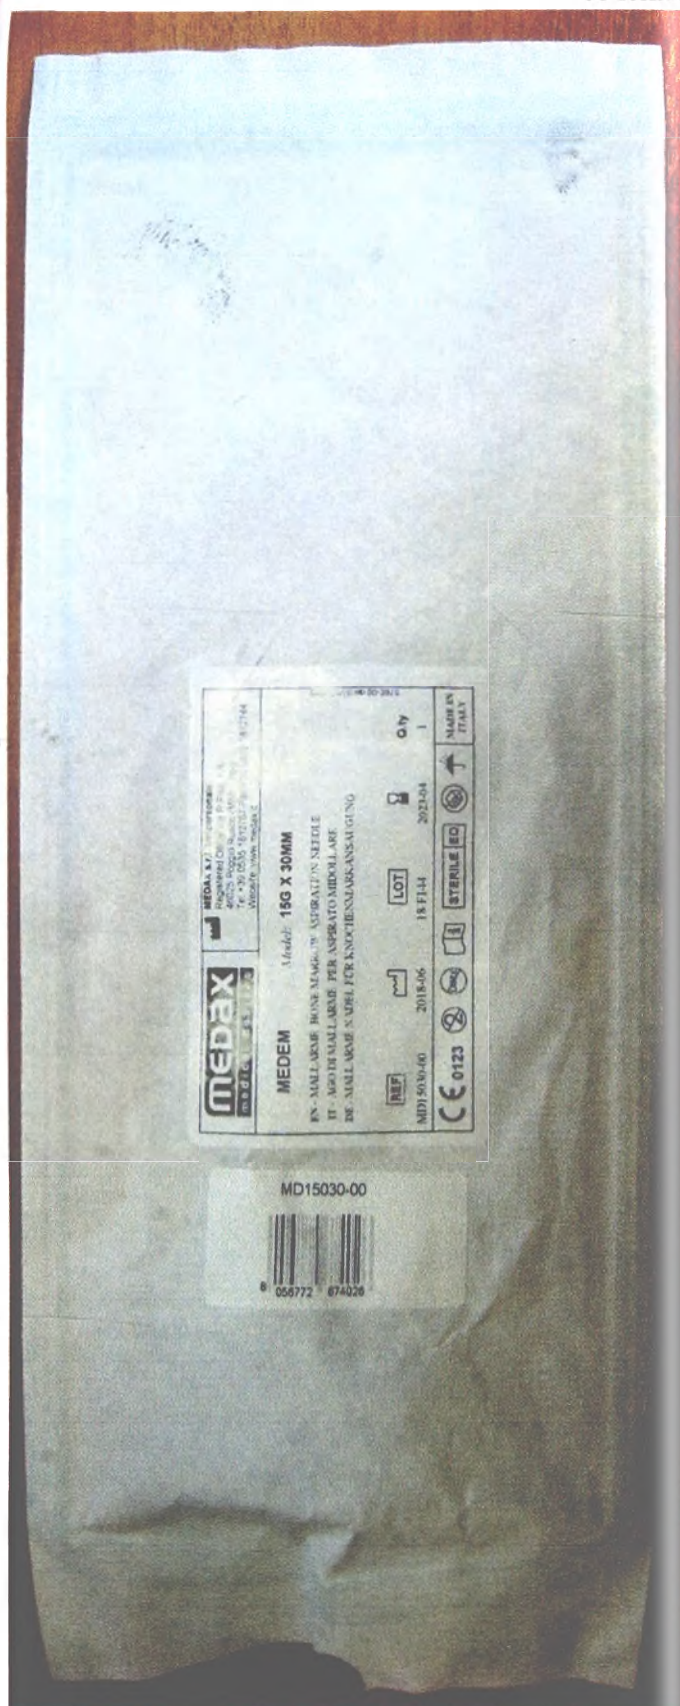



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для аспирации костного мозга и эксплантации костной ткани MEDEM (MX-
 исполнение)», артикул MX 15 070 - 00; номинальный наружный диаметр 1,80 мм; номинальная
 длина 70 мм; сечение круглое




Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDLOCK (ММ-
 исполнение)», артикул ММ 08 100 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная
 длина 100 мм; сечение круглое

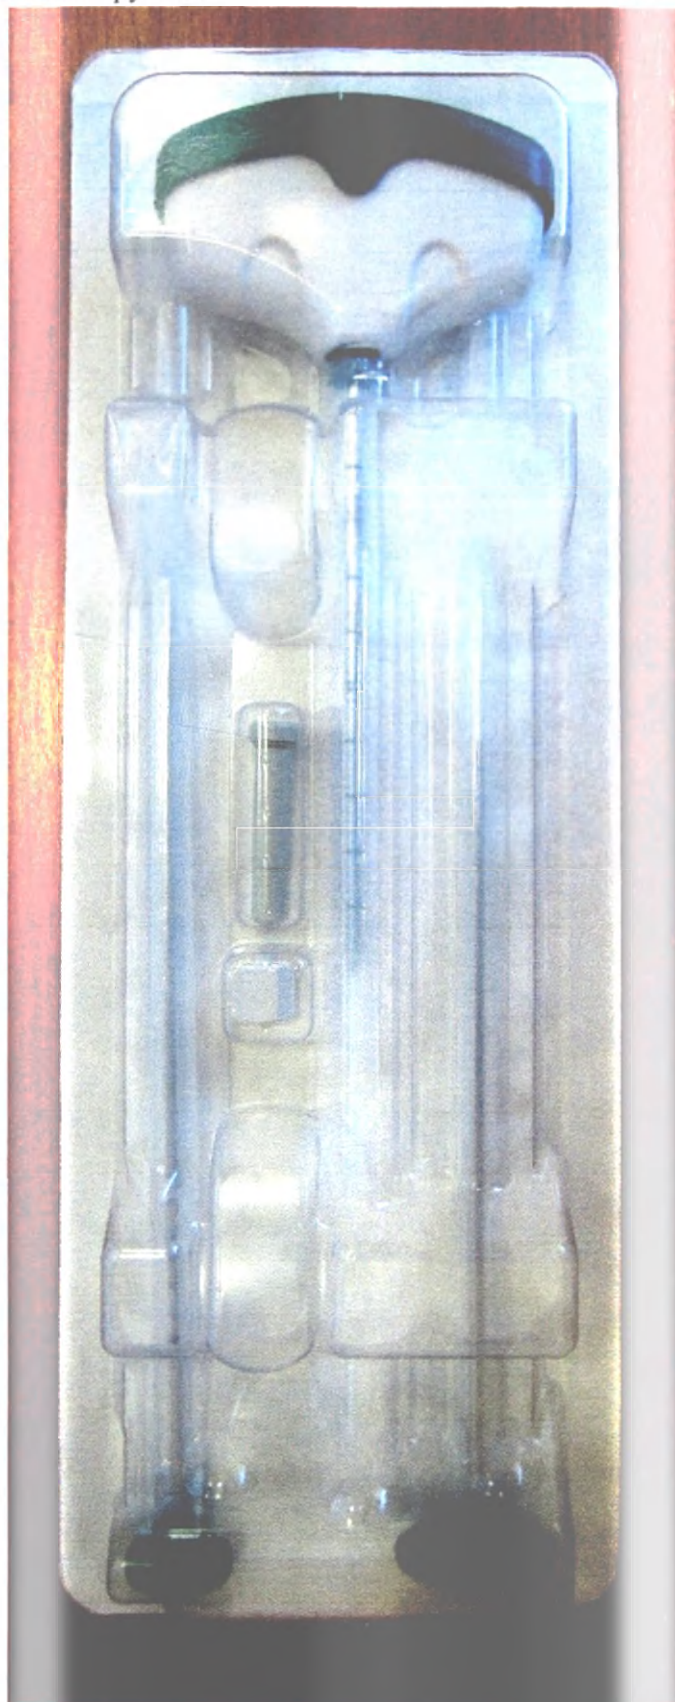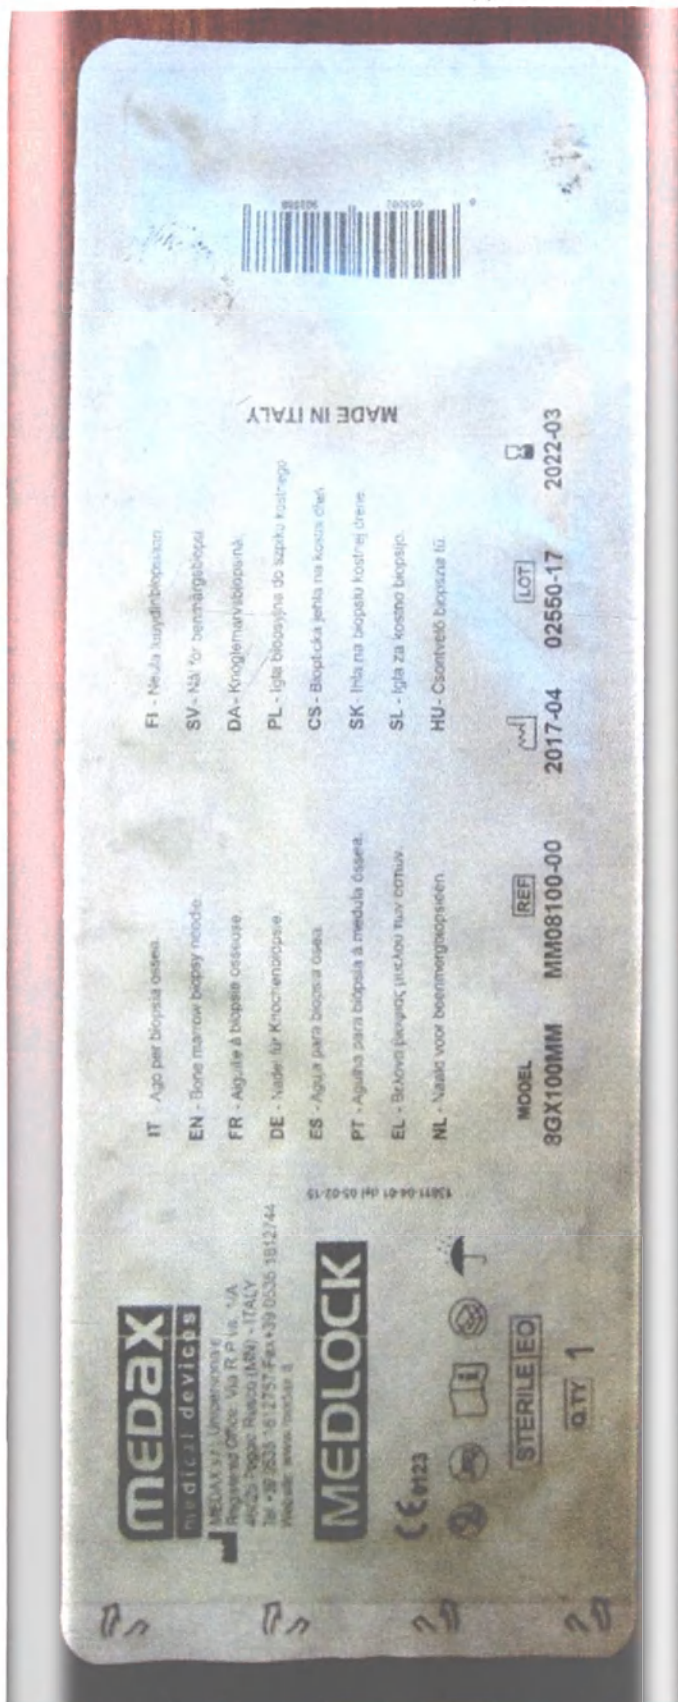



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDLOCK (MF-
 исполнение)», артикул MF 08 150 - 00; номинальный наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина
 150 мм; сечение круглое

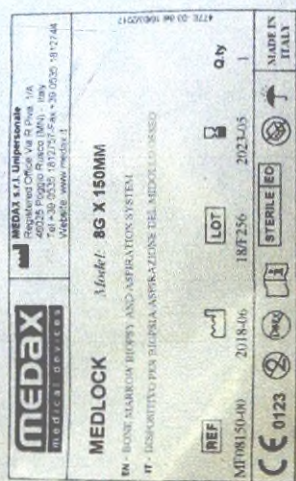

Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для забора образцов костного мозга и костной ткани MEDBONE (MB-
 исполнение)», артикул MB 08 100 - 00 (с трехгранным наконечником канюли); номинальный
 наружный диаметр 4,19 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое

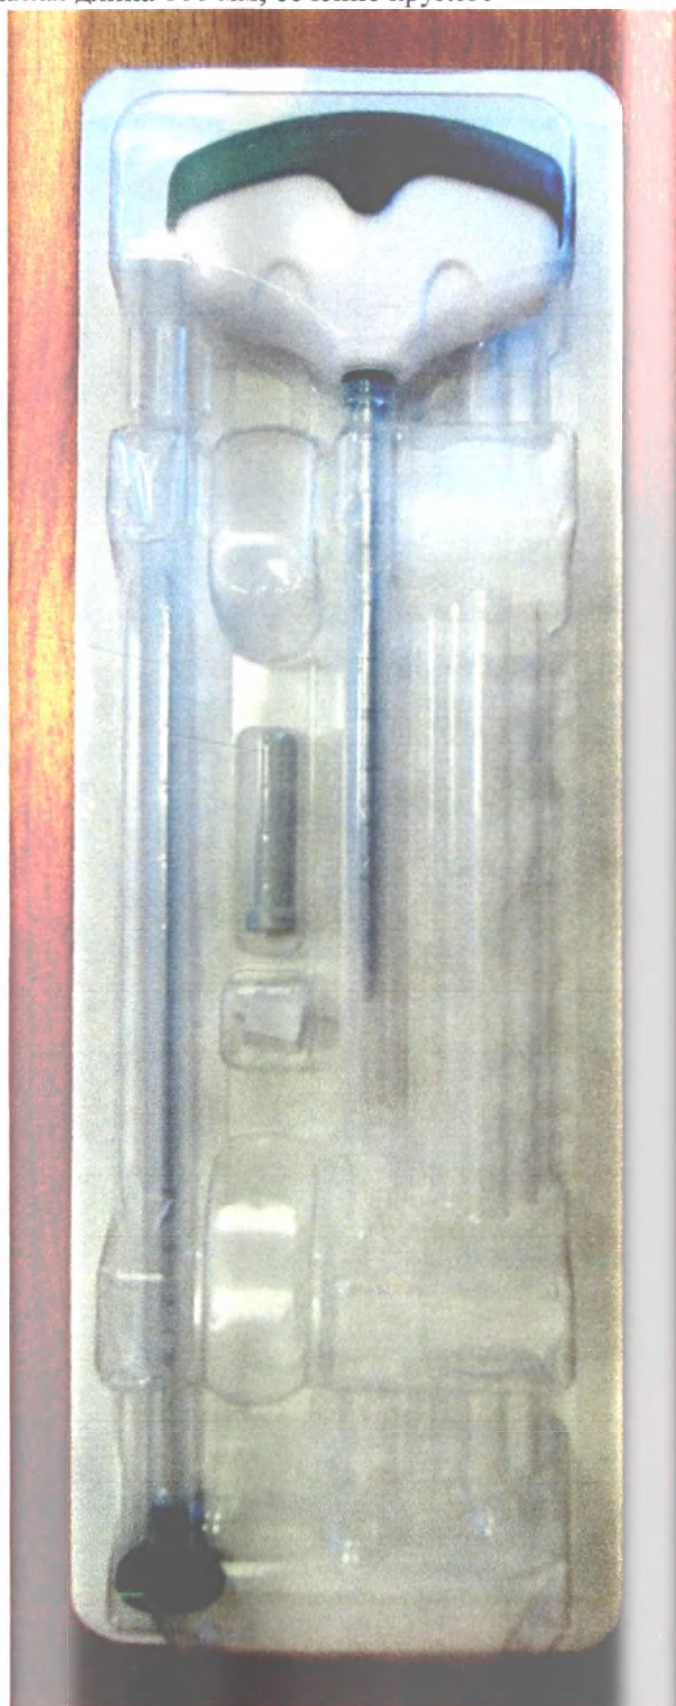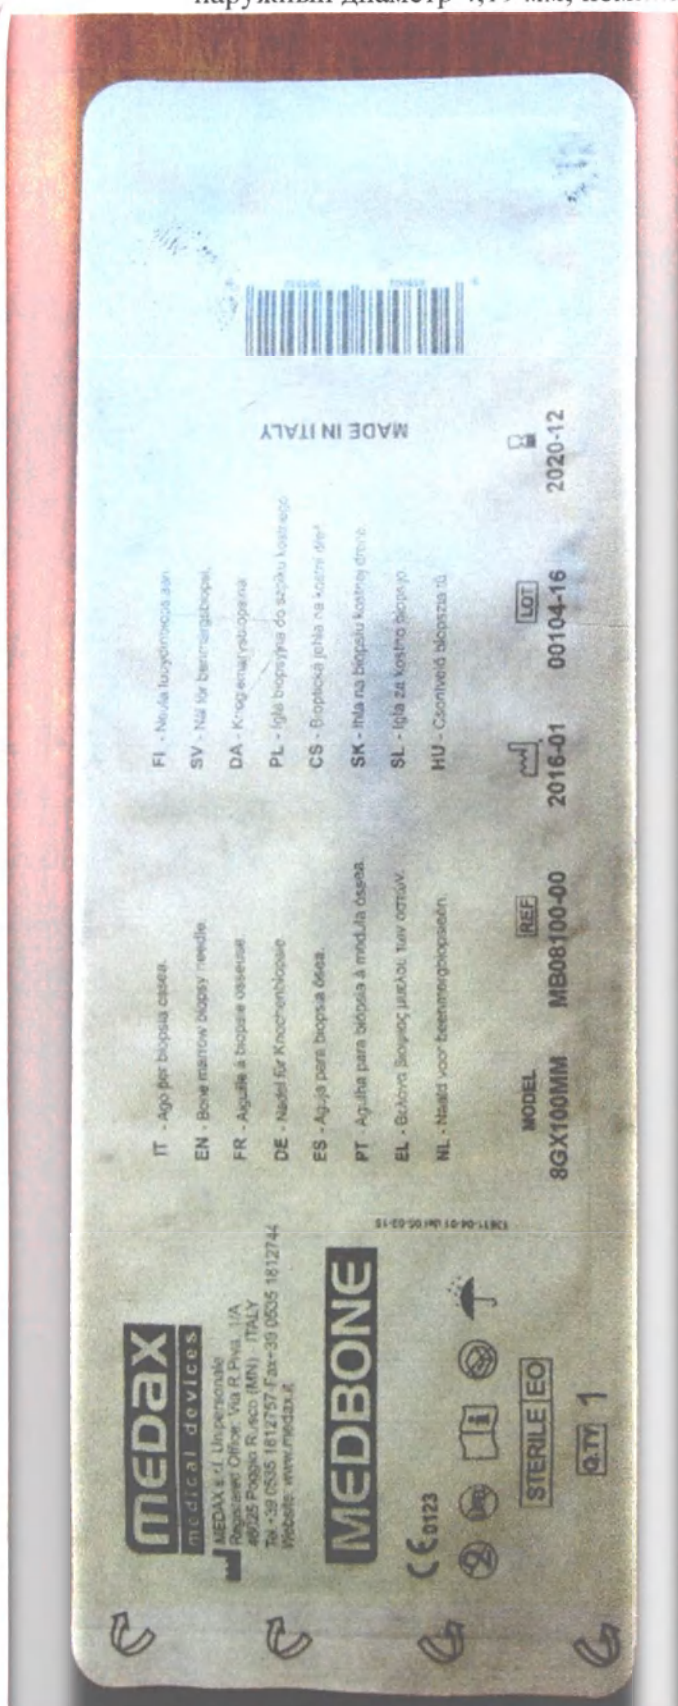

Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования
 UNIGUN (UG-исполнение)», артикул UG 16 120 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена);
 номинальный наружный диаметр 1,60 мм; номинальная длина 120 мм; сечение круглое



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования
 UNICORE (UC-исполнение)», артикул UC 20 200 - 00 (с обычным наконечником мандрена);
 номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 200 мм; сечение круглое



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
 «Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования
 UNIMAG (UM-исполнение)», артикул UM 18 160 - 00 (с обычным наконечником мандрена);
 номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

**«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения:
Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования
UNICUT (UT-исполнение)», артикул UT 14 100 - 01 (с трехгранным наконечником мандрена);
номинальный наружный диаметр 2,10 мм; номинальная длина 100 мм; сечение круглое**



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения: Игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования MEDCUT (MC-исполнение)», артикул MC 18 160 - 01 (с трехгранным наконечником мадерева и глубиной проникновения 22 мм); номинальный наружный диаметр 1,20 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое



Примечание Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»

«Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX», вариант исполнения: игла биопсийная для биопсии мягкой ткани для ее последующего гистологического исследования MEDONE (МО-исполнение)», артикул МО 20 160 - 00 с обычным наконечником мандрены; номинальный наружный диаметр 0,90 мм; номинальная длина 160 мм; сечение круглое



Примечание – Представлены фотографические изображения медицинского изделия с маркировкой производителя. Макет маркировки на русском языке представлен в документе «Выписка из технической документации на медицинское изделие. Игла для биопсии одноразовая стерильная MEDAX»