

РУ № _____

Иглы для инсулиновых инжекторов

по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

0,33 x 12 мм (29G)

ИГЛЫ ИЗ ТРУБОК С НОРМАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ



РУ № _____

Иглы для инсулиновых инжекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019
0,33 x 12 мм (29G)

ИГЛЫ ИЗ ТРУБОК С НОРМАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ



РУ № _____

Иглы для инсулиновых инжекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019
0,33 x 12 мм (29G)

ИГЛЫ ИЗ ТРУБОК С НОРМАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите колпачок шприца-ручки;
2. Снимите индивидуальную упаковку от иглы;
3. Прикрутите иглу к концу шприца-ручки;
4. Снимите внешний колпачок иглы;
5. Снимите предохранительный колпачок;
6. Выполните инъекцию согласно инструкции к вашей шприц-ручке;
7. Аккуратно поместите внешний колпачок на использованную иглу;
8. Отвинтите иглу и утилизируйте ее, соблюдая меры предосторожности;
9. Закройте шприц-ручку колпачком.

“Н”



STERILE EO



32. SD 13-APF-34102293-2019

Стерильно. Нетоксично.

Иглы перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

Транспортировать при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Условия хранения игл по ГОСТ 15150, соответствуют условиям хранения по группе 2 (С).

Хранить при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Универсальная винтовая резьба позволяет использовать иглы со всеми шприц ручками следующих производителей:

Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Ypsomed, Owen Mumford, AstraZeneca, Beckton Dickinson, Медсинтез, Фармстандарт.

Матрица изменений
на 9.8 изменений
№ 32.50.13-001-34/09723-2019



Иглы для инсулиновых инъекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019
(29G)

Иглы для инсулиновых инъекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

0,33 x 12 мм (29G)

LOT 01022020


 02-2025

 02-2020

Производитель: ООО «БЕРИМЕД»
Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1,
корпус 1, эт.1 комната (101/1)
Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10
WWW.BERIMED.RU



Уважаемые коллеги,
по ТУ 32.50.13-001-341017.13-2019

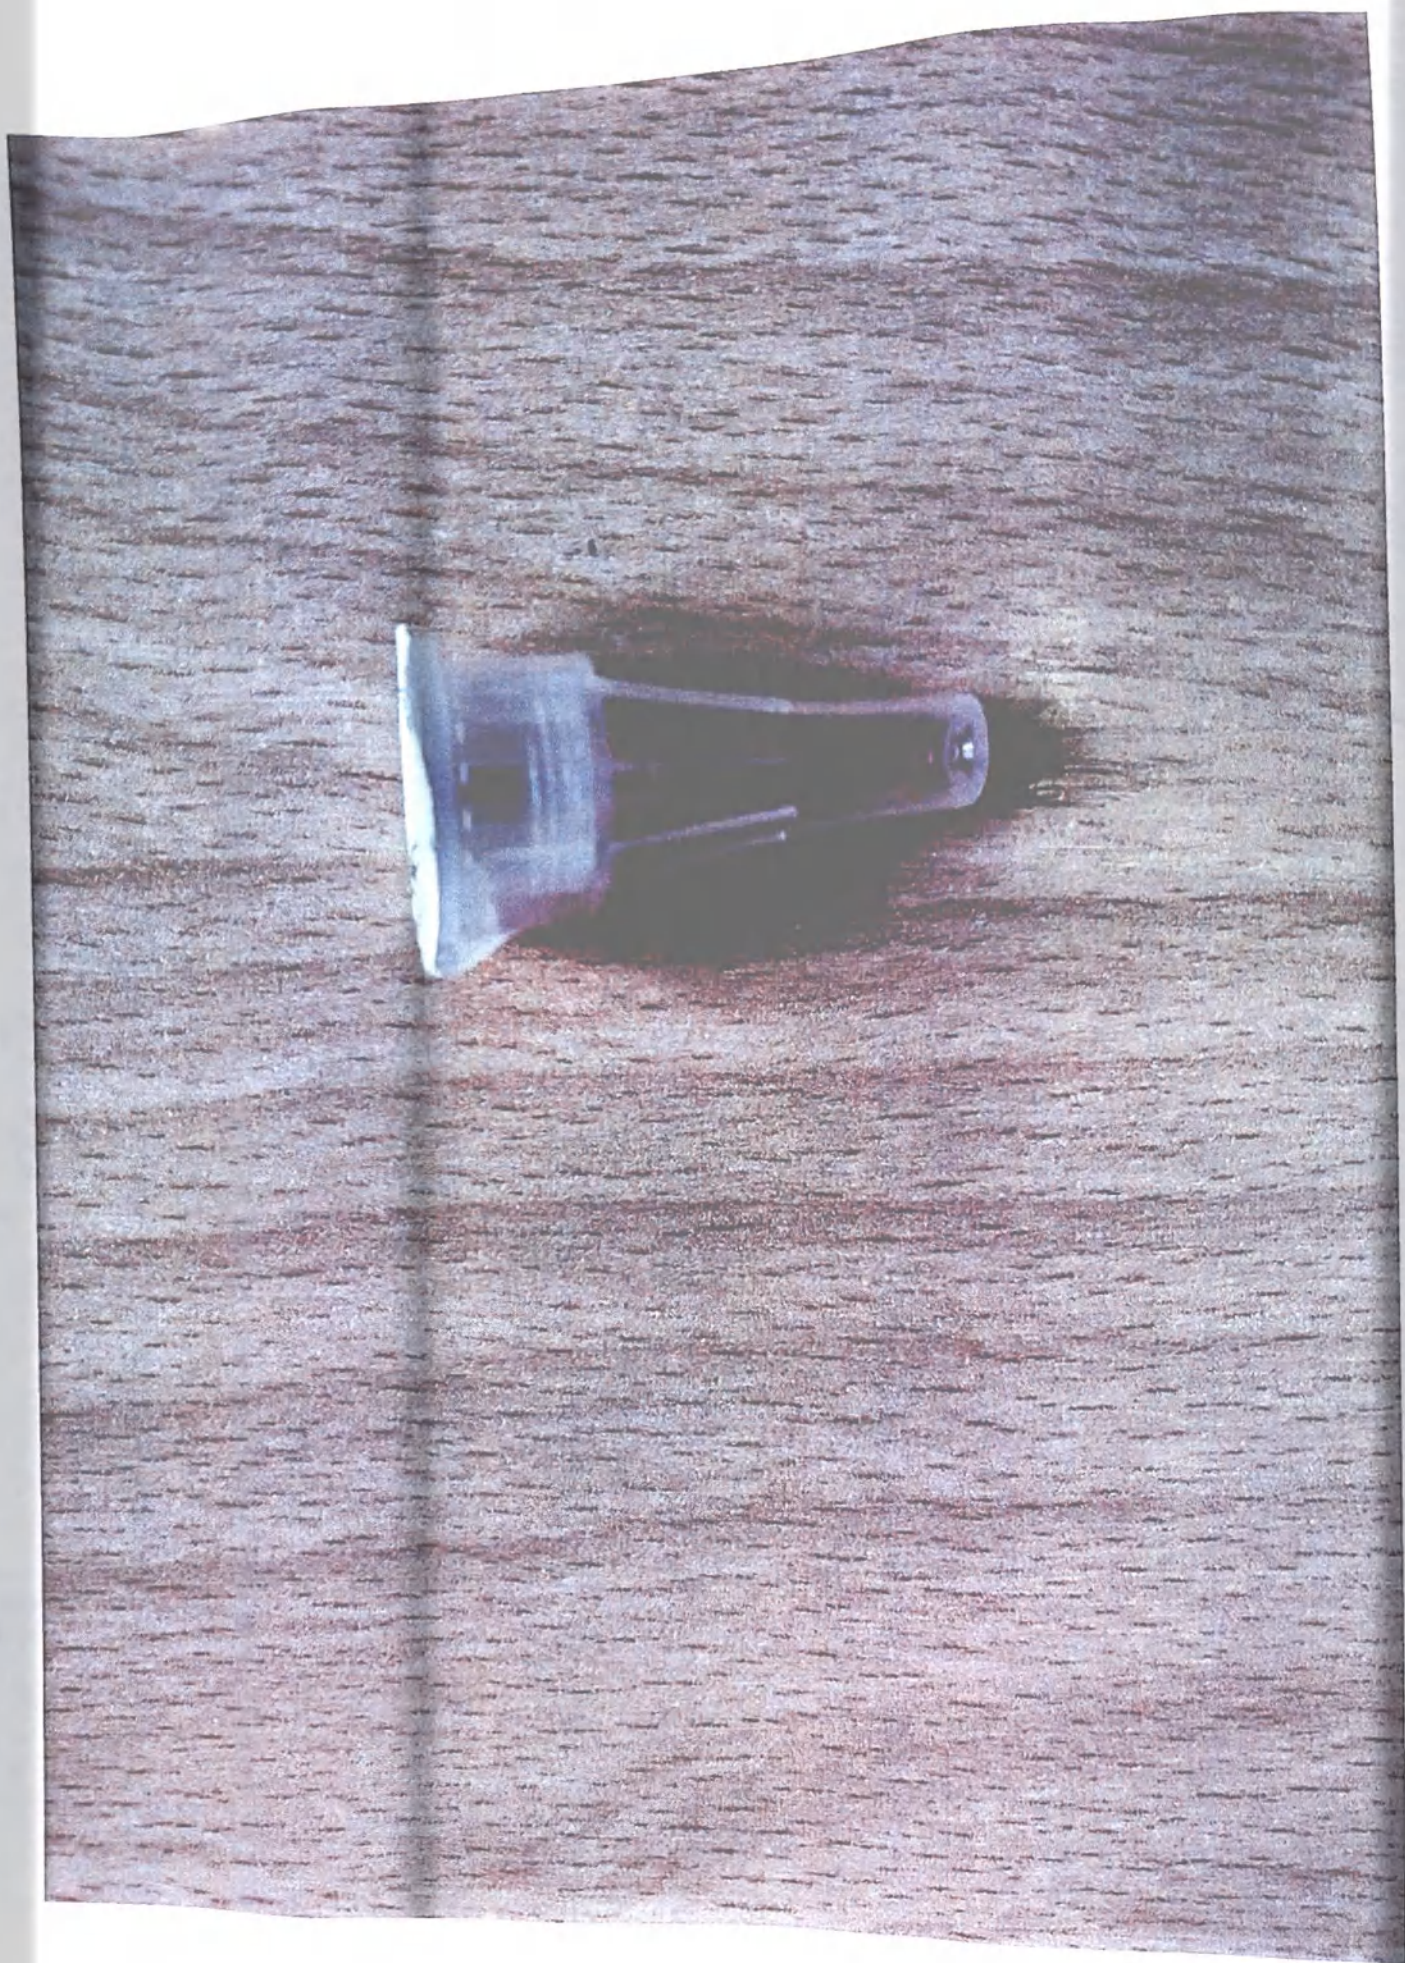

Учла для ценсуреникових сммексоров по

РУ №

Иглы для инсулиновых инжекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019
0,23 x 4 мм (32G)

ИГЛЫ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК

100
ШТ.

РУ №

Иглы для инсулиновых инжекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019
0,23 x 4 мм (32G)

ИГЛЫ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК

100
ШТ.

Стерильно. Нетоксично.

Иглы перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Условия хранения игл по ГОСТ 15150, соответствуют условиям хранения по группе 2 (С).

Хранить при температуре от -50°C до +40°C.

Универсальная винтовая резьба позволяет использовать иглы со всеми шприц ручками следующих производителей:

Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Ypsomed, Owen Mumford, AstraZeneca, Beckton Dickinson, Медсинтез, Фармстандарт.

Министерство здравоохранения
Литва при университете
№ 79 32.50.13-001-201-017

Иглы для инсулиновых инъекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

0,23 x 4 мм (32G)

 **02022020**

 **02-2025**

 **02-2020**

Производитель: ООО «БЕРИМЕД»
Юридический адрес: 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1,
корпус 1, эт.1 комната (101/1)
Место производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы. ул. Зеленая, д. 16
тел: 8 (495) 659 57 10

WWW.BERIMED.RU

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите колпачок шприца-ручки;
2. Снимите индивидуальную упаковку от иглы;
3. Прикрутите иглу к концу шприца-ручки;
4. Снимите внешний колпачок иглы;
5. Снимите предохранительный колпачок;
6. Выполните инъекцию согласно инструкции к вашей шприц-ручке;
7. Аккуратно поместите внешний колпачок на использованную иглу;
8. Отвинтите иглу и утилизируйте ее, соблюдая меры предосторожности;
9. Закройте шприц-ручку колпачком.

“Н”



STERILE EO



Управление государственной
Улице при Министерстве
№ 32.50.13-001-34/027.02-2019



Ваше гос. учреждение
№ 44 32.50.13-001-341 027 23-2019



Увед. гос. учреждения
№ 5 32.50.13-001-34/02723-2019



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БЕРИМЕД»
Лейбутин А.П.
«10» января 2019 г.

Макеты индивидуальной и групповой упаковки

Иглы для инсулиновых инъекторов по ТУ 32.50.13-001- 34102723-2019

ООО БЕРИМЕД

_____ X _____ MM

STERILE EO



LOT



Стерильно. Нетоксично.

Иглы перевозят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C. Иглы следует хранить в условиях, установленных для группы 1(II) по ГОСТ 15150.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Условия хранения игл по ГОСТ 15150, соответствуют условиям хранения по группе 2 (C).

Хранить при температуре от -50°C до +40°C.

Универсальная винтовая резьба позволяет использовать иглы со всеми шприц-ручками следующих производителей:

Elly, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Ureamed, Owen Mumford, AstraZeneca, Beckton Dickinson, Мединтек, Фармстандарт.

РУ № _____

Иглы для инсулиновых инжекторов по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

Иглы из трубок с нормальными стенками

ИГЛЫ ИЗ ТРУБОК С НОРМАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ

100
шт.



Иглы для инсулиновых инжекторов по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

Иглы из трубок с нормальными стенками

LOT



Производитель: ООО «БЕЗМЕД»
Юридический адрес: 125029, г. Москва, ул. Невский дом 1,
корпус 1, эт. 1 комната (101/1)
Место производства: 215600, Смоленская область,
Кадыйский район, д. Кривцы, ул. Золотая, д. 16
тел: 8 (495) 669 57 10
WWW.BEZMED.RU

100
шт.

Иглы для инсулиновых инжекторов по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

РУ № _____

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите колпачок шприца-ручки;
2. Снимите индивидуальную упаковку от иглы;
3. Прикрутите иглу к концу шприца-ручки;
4. Снимите внешний колпачок иглы;
5. Снимите предохранительный колпачок;
6. Выполните инъекцию согласно инструкции к вашей шприц-ручке;
7. Аккуратно поместите внешний колпачок на использованную иглу;
8. Отвинтите иглу и утилизируйте ее, соблюдая меры предосторожности;
9. Закройте шприц-ручку колпачком.

"H"



STERILE EO



Стерильно. Нетоксично.
Иглы перевозят транспортом всех видов в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
Транспортировать при температуре от -50°C до +50°C.
Иглы следует хранить в условиях, установленных для группы 1(II) по ГОСТ 15150.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.
Условия хранения игл по ГОСТ 15150, соответствуют условиям хранения по группе 2 (C).
Хранить при температуре от -50°C до +40°C.

Универсальная винтовая резьба позволит использовать иглы со всеми шприц-ручками следующих производителей:
Eli Lilly, Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Ureamed, Owen Mumford, AstraZeneca, Beckton Dickinson, Medomita, Фармстандарт.

РУ № _____

Иглы для инсулиновых инжекторов по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

ИГЛЫ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК

100
ШТ.



Иглы для инсулиновых инжекторов по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019



Производитель: ООО «ЦИРМИ»
Юридический адрес: 125025 г. Москва, ул. Исаков, дом 1, корпус 1, эт.1 комната (101/1)
Место производства: 215850, Смоленская область, Калязинский район, д. Крыжы, ул. Зеленая, д. 16
телефон: 8 (495) 659 57 10
WWW.CIRMED.RU

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Снимите колпачок шприца-ручки;
2. Снимите индивидуальную упаковку от иглы;
3. Прикрутите иглу к концу шприца-ручки;
4. Снимите внешний колпачок иглы;
5. Снимите предохранительный колпачок;
6. Выполните инъекцию согласно инструкции к вашей шприц-ручке;
7. Аккуратно поместите внешний колпачок на использованную иглу;
8. Отвинтите иглу и утилизируйте ее, соблюдая меры предосторожности;
9. Закройте шприц-ручку колпачком.

"H"



STERILE EO



Иглы для инсулиновых инжекторов
по ТУ 32.50.13-001-34102723-2019

РУ № _____

100
ШТ.

ИГЛЫ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 4 (четыре) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «БЕРИМЕД»
А. П. Лейбутин

