

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН»

Ипатов С.Б.
25.06.2020




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Система автоматического капиллярного электрофореза CAPILLARYS 3, в вариантах
исполнения

CAPILLARYS 3 OCTA, в составе:

1. CAPILLARYS 3 OCTA

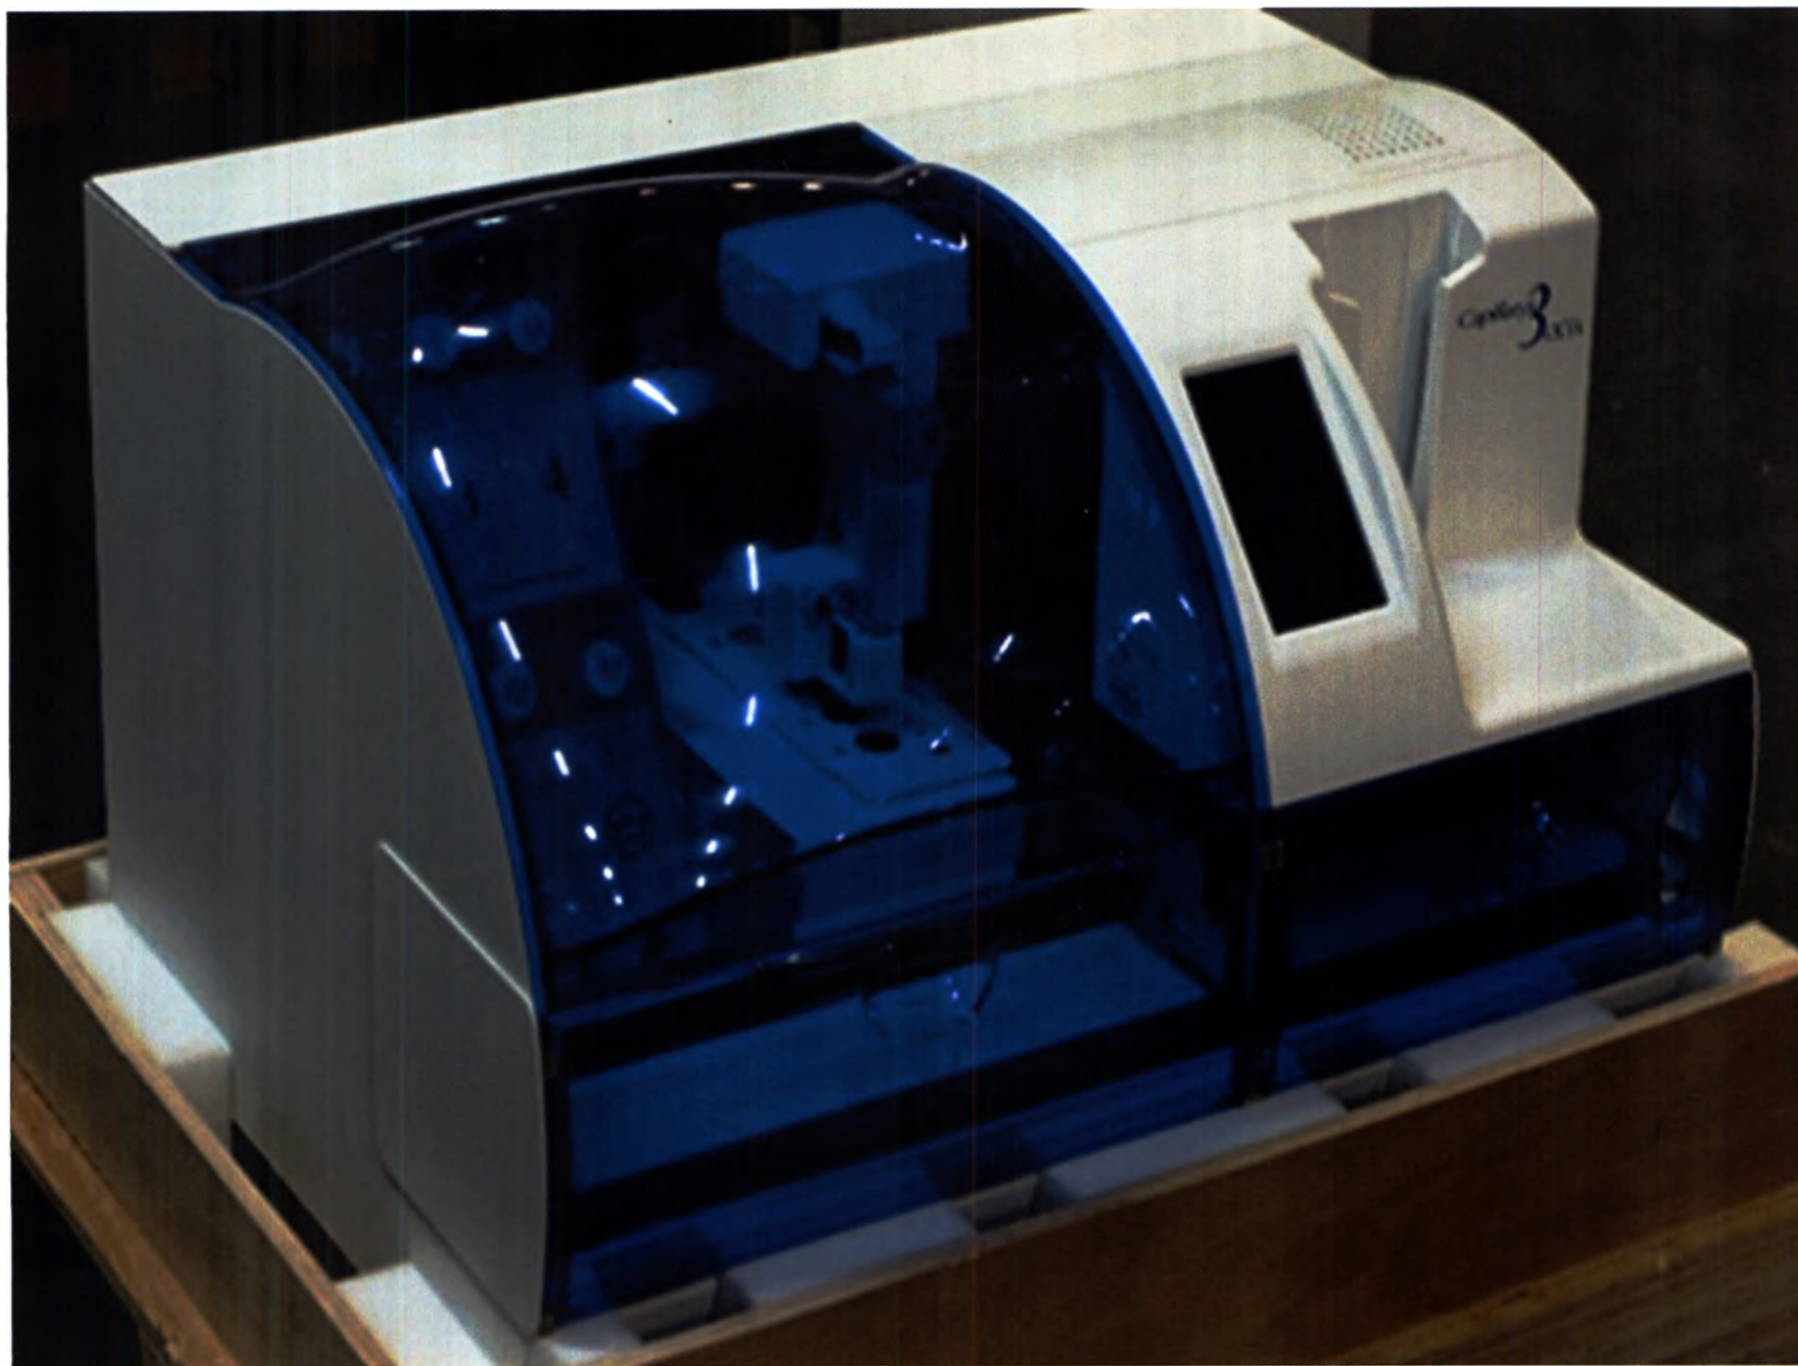


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ CAPILLARYS 3 ОСТА

Код продукта 1245

Версия 1.20

2018/07

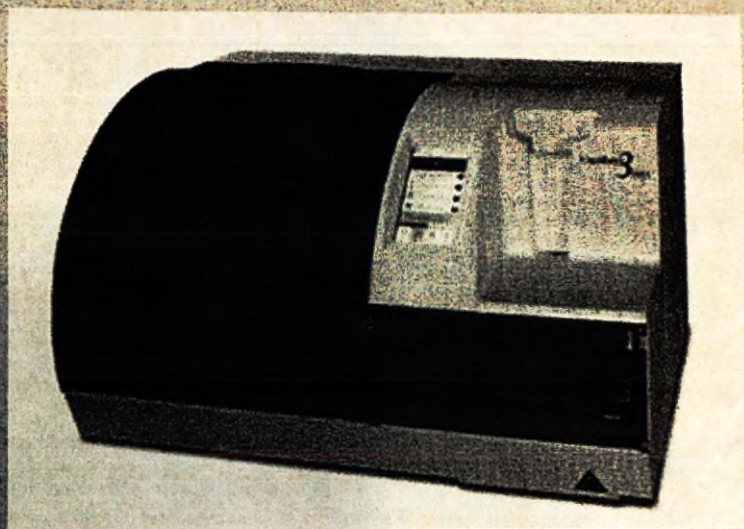

CE

IVD

sebia

sebla

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
 SAFETY INSTRUCTIONS
 SICHERHEITSHINWEISE
 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 SÄKERHETSINSTRUKTIONER
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 SIGURNOSNE UPUTE
 SAUGOS INSTRUKCIJOS
 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE
 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
 GÜVENLİK TALİMATLARI
 OBSAH
 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 SIKKERHETSINSTRUKSJONER
 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
 安全説明
 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 安全に関する説明
 DROŠĪBAS INSTRUKCIJA
 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

IVD

CE

2017/04



5. Кабель для подключения к компьютеру



6. Кабель для подключения к сети



7. Коврик для компьютерной «мыши»



8. Комплект для настройки прибора, в составе:

8.1 сегмент для разведения прозрачный САРІ 3;


8.2 пробирка для гемолиза;

8.3 микропробирка;


8.4 пробирка с крышкой для контролей;

8.5 тубик с силиконовой смазкой.


8.1 сегмент для разведения прозрачный СAPI 3

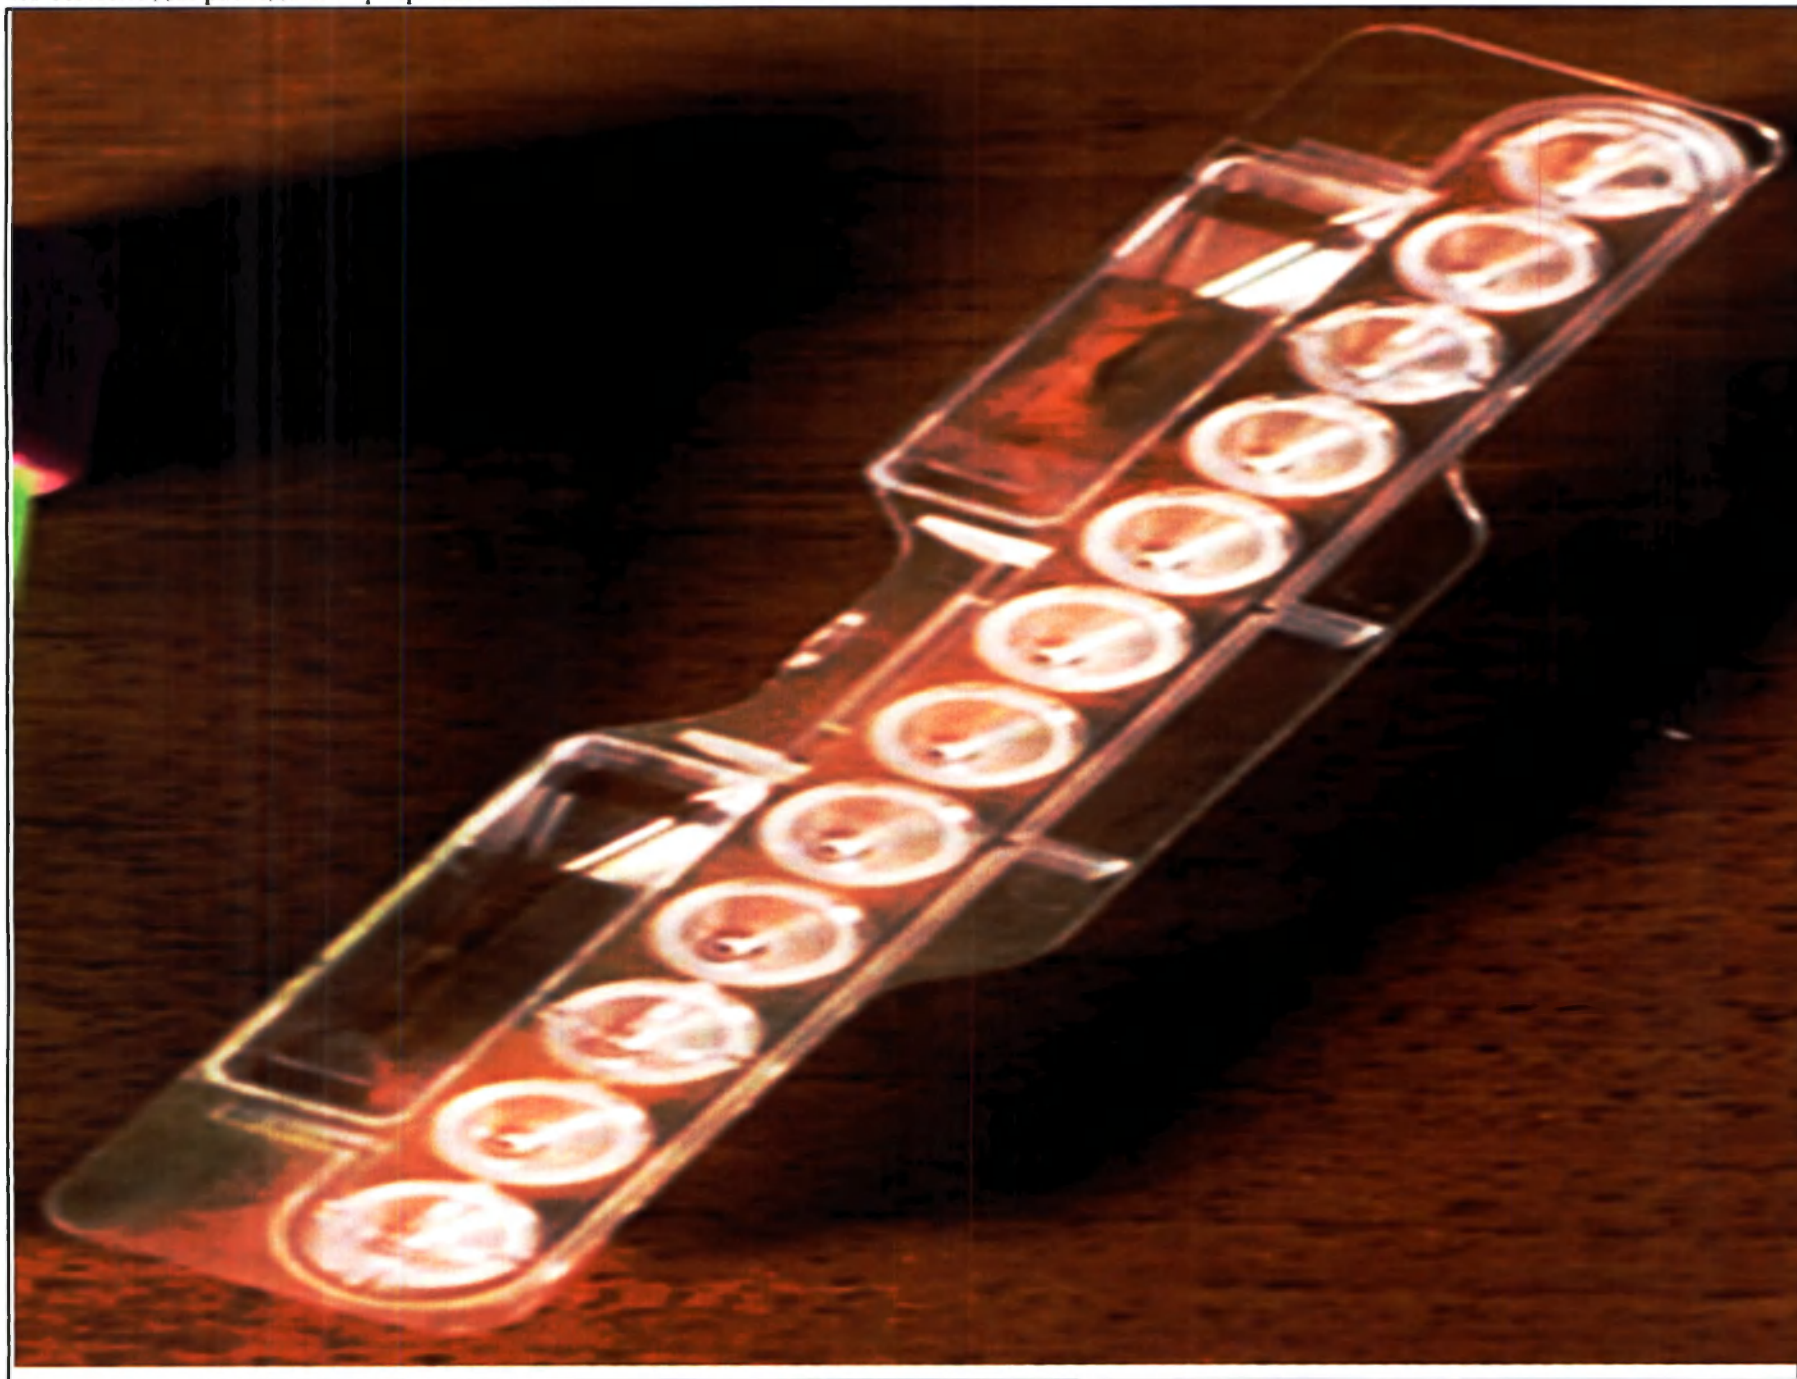


8.2 пробирка для гемолиза

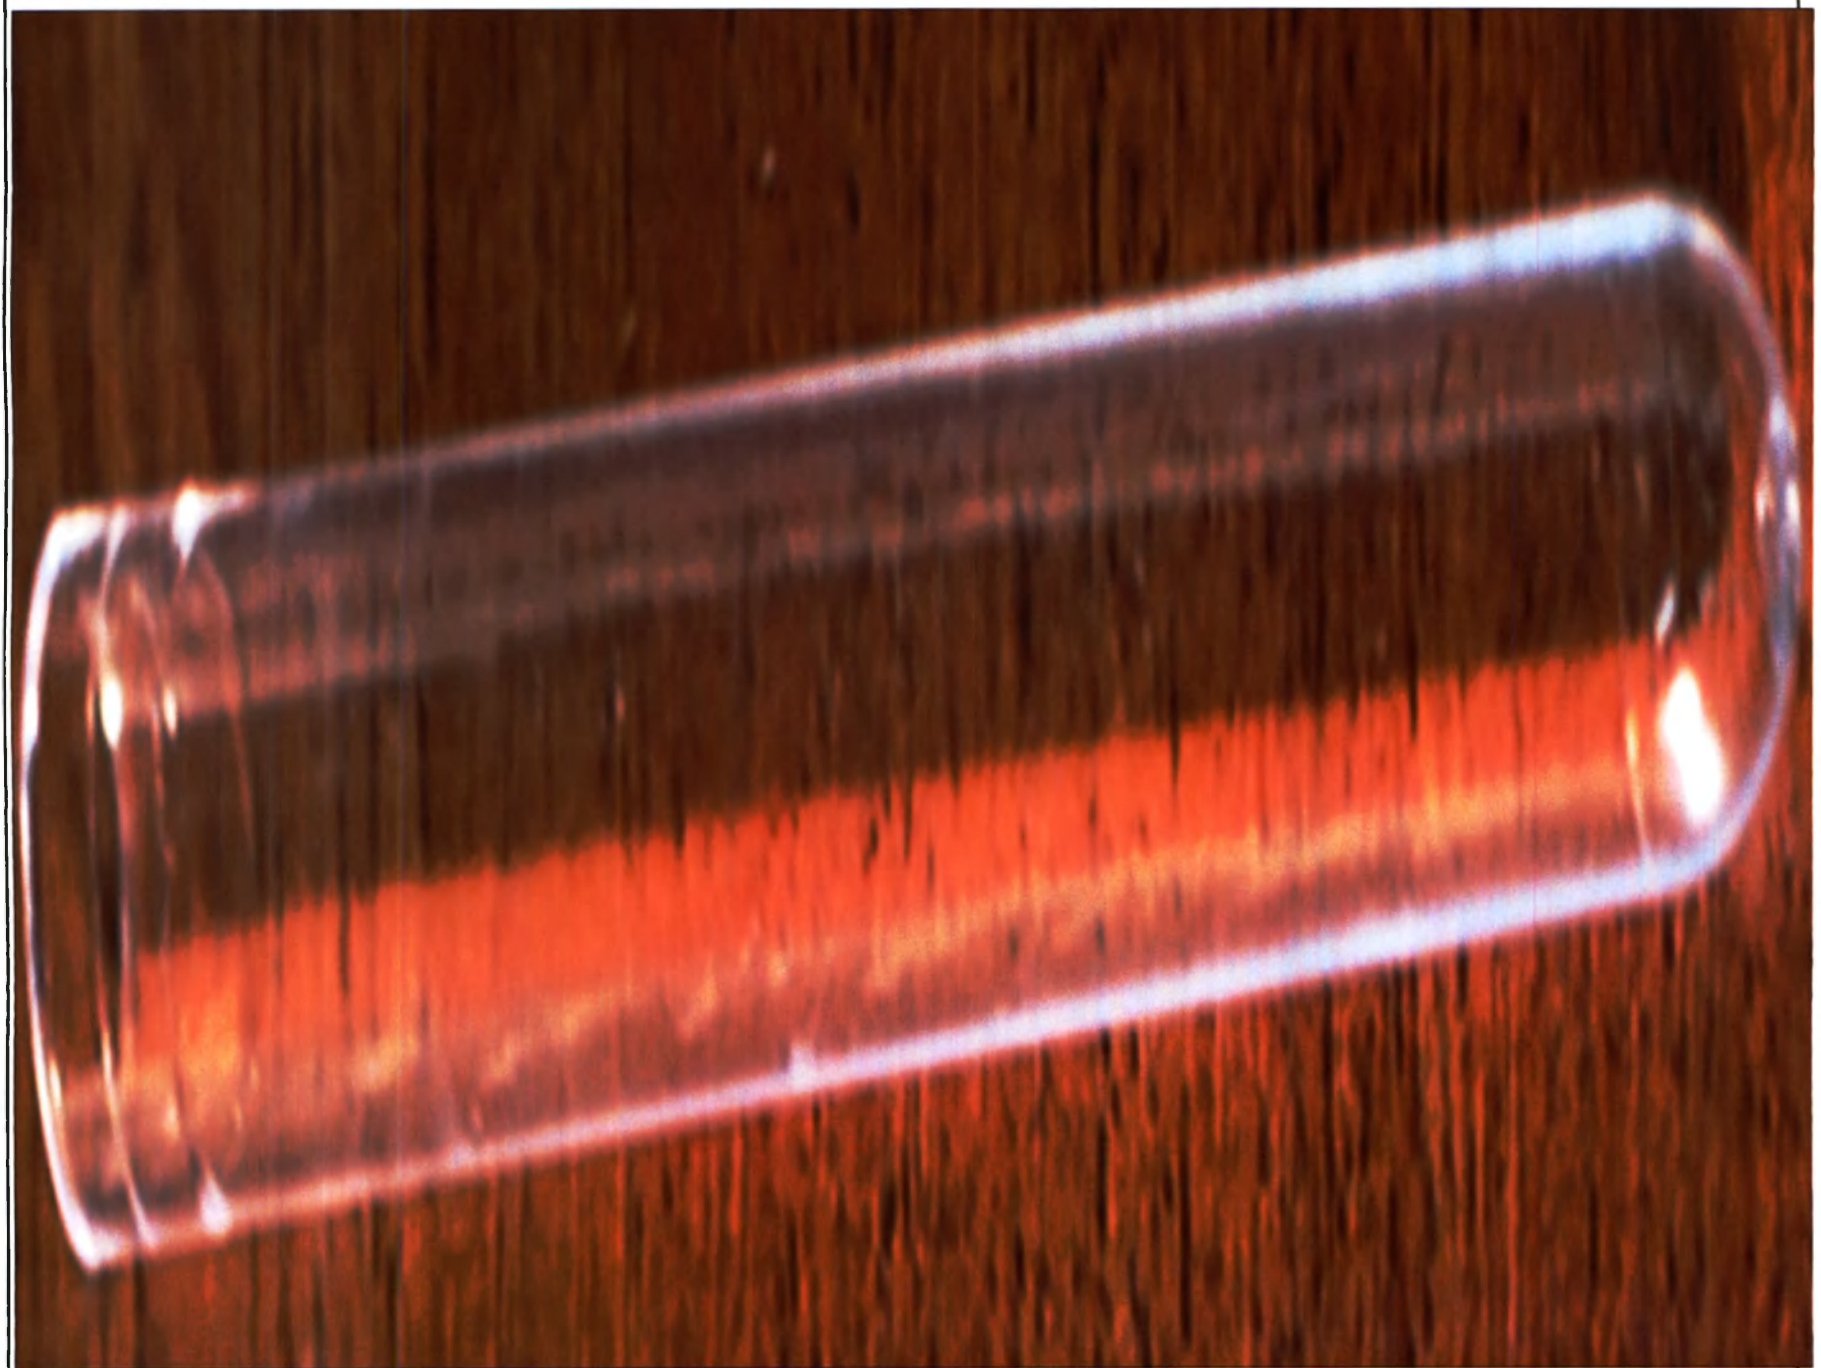

8.3 микропробирка

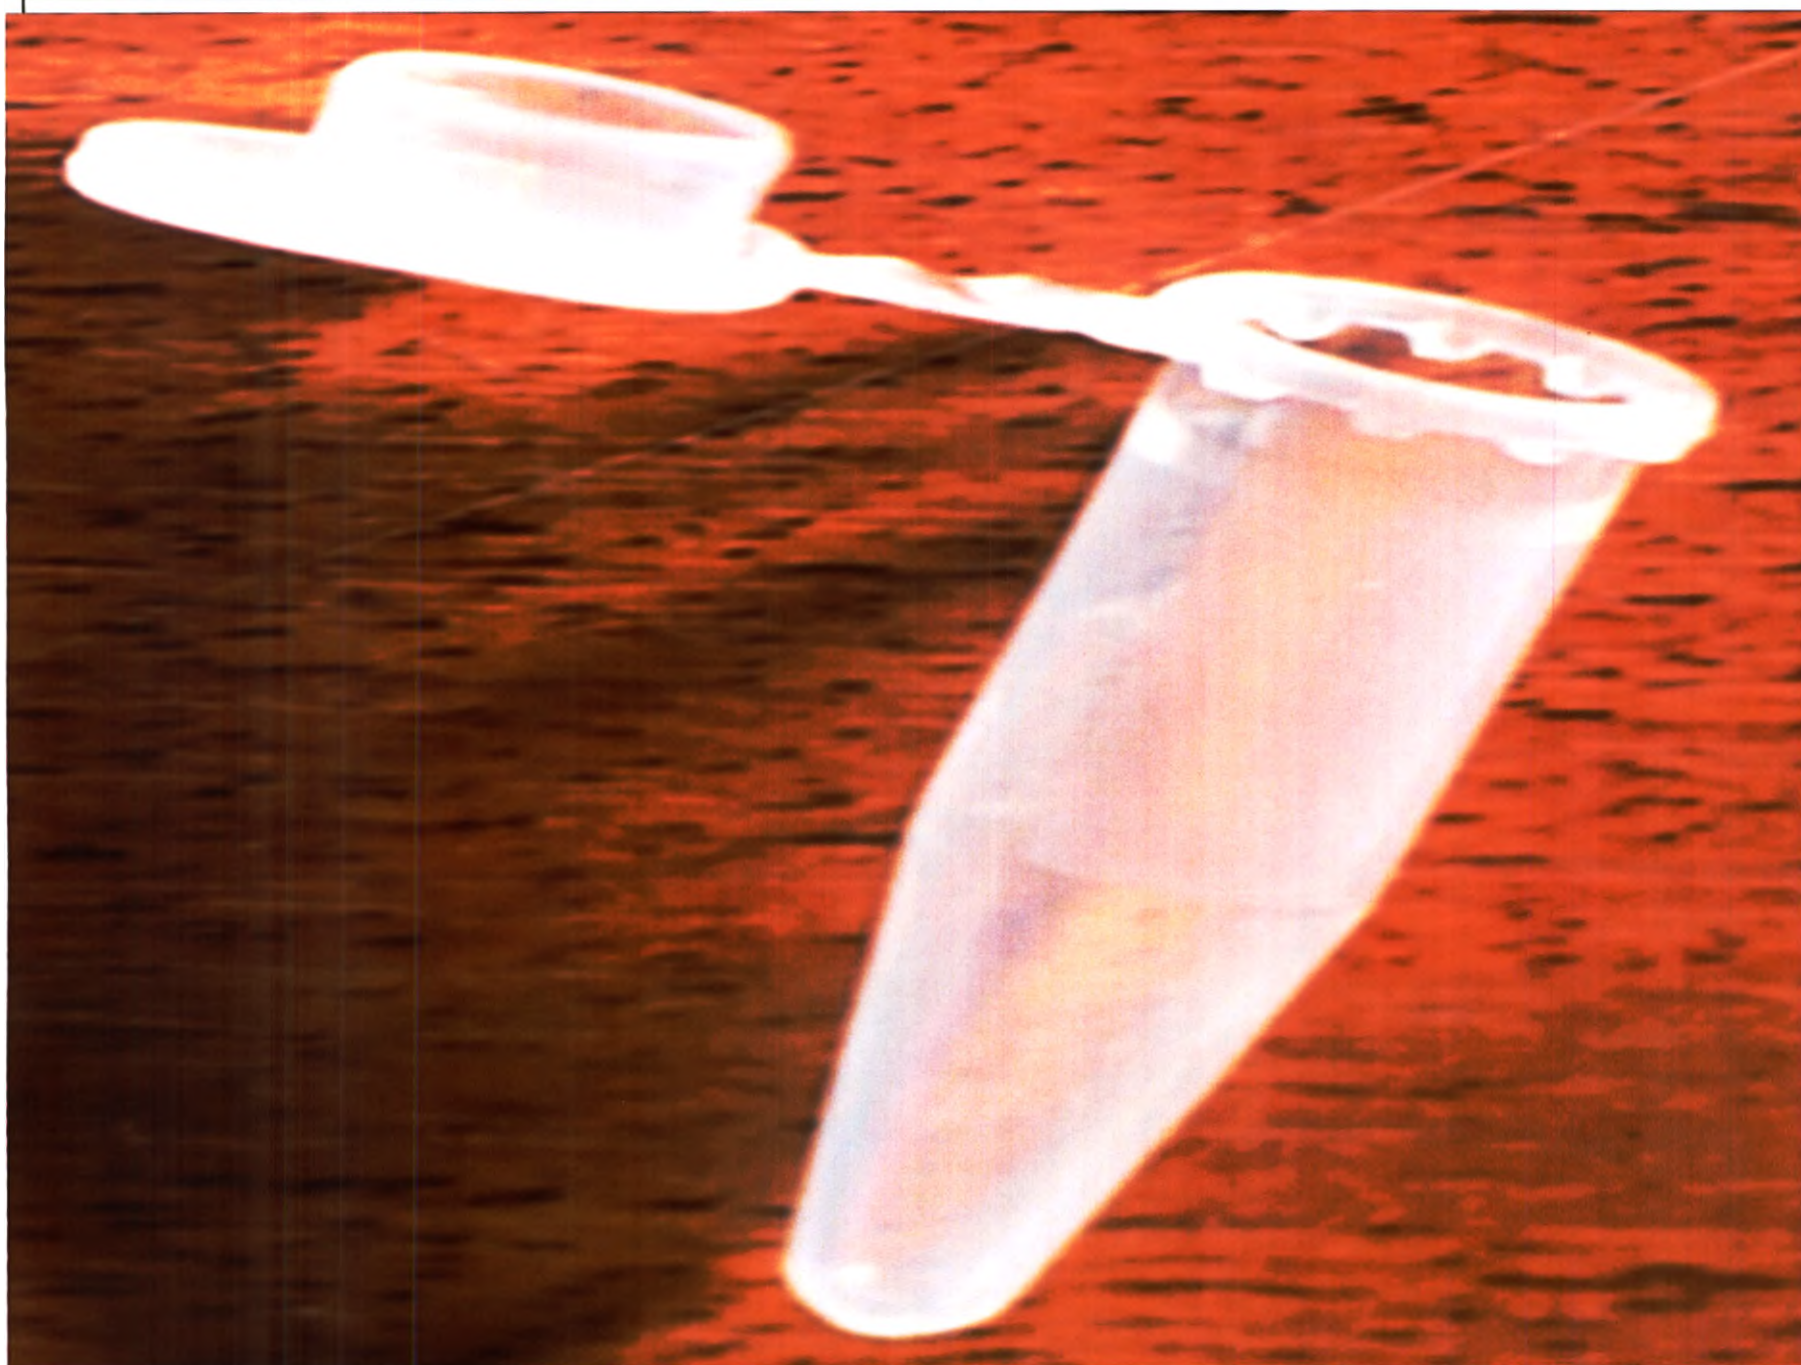

8.4 пробирка с крышкой для контролей

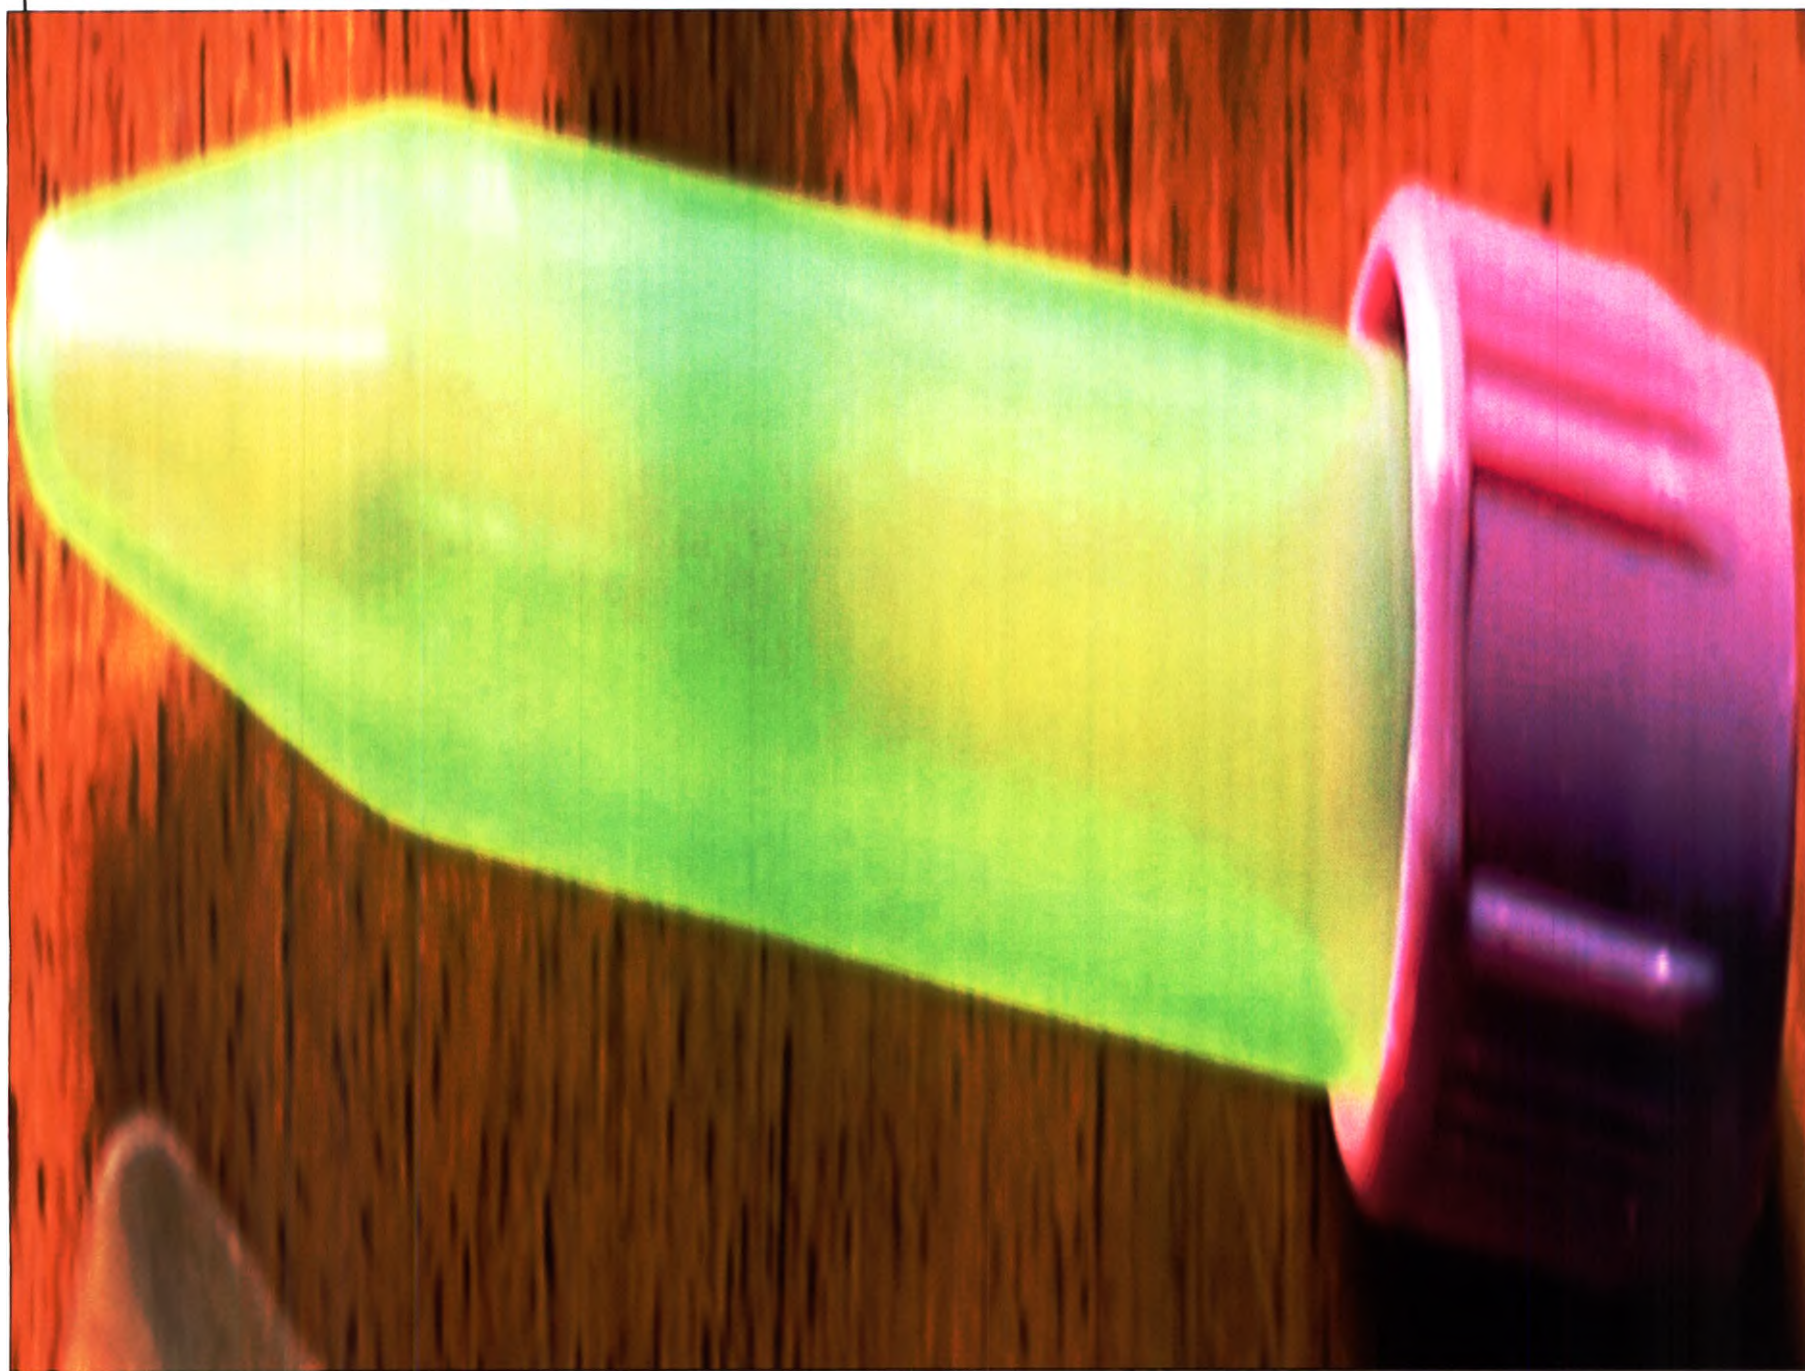





9. Контейнер для воды (Water)



10. Контейнер для промывочного раствора (Wash)

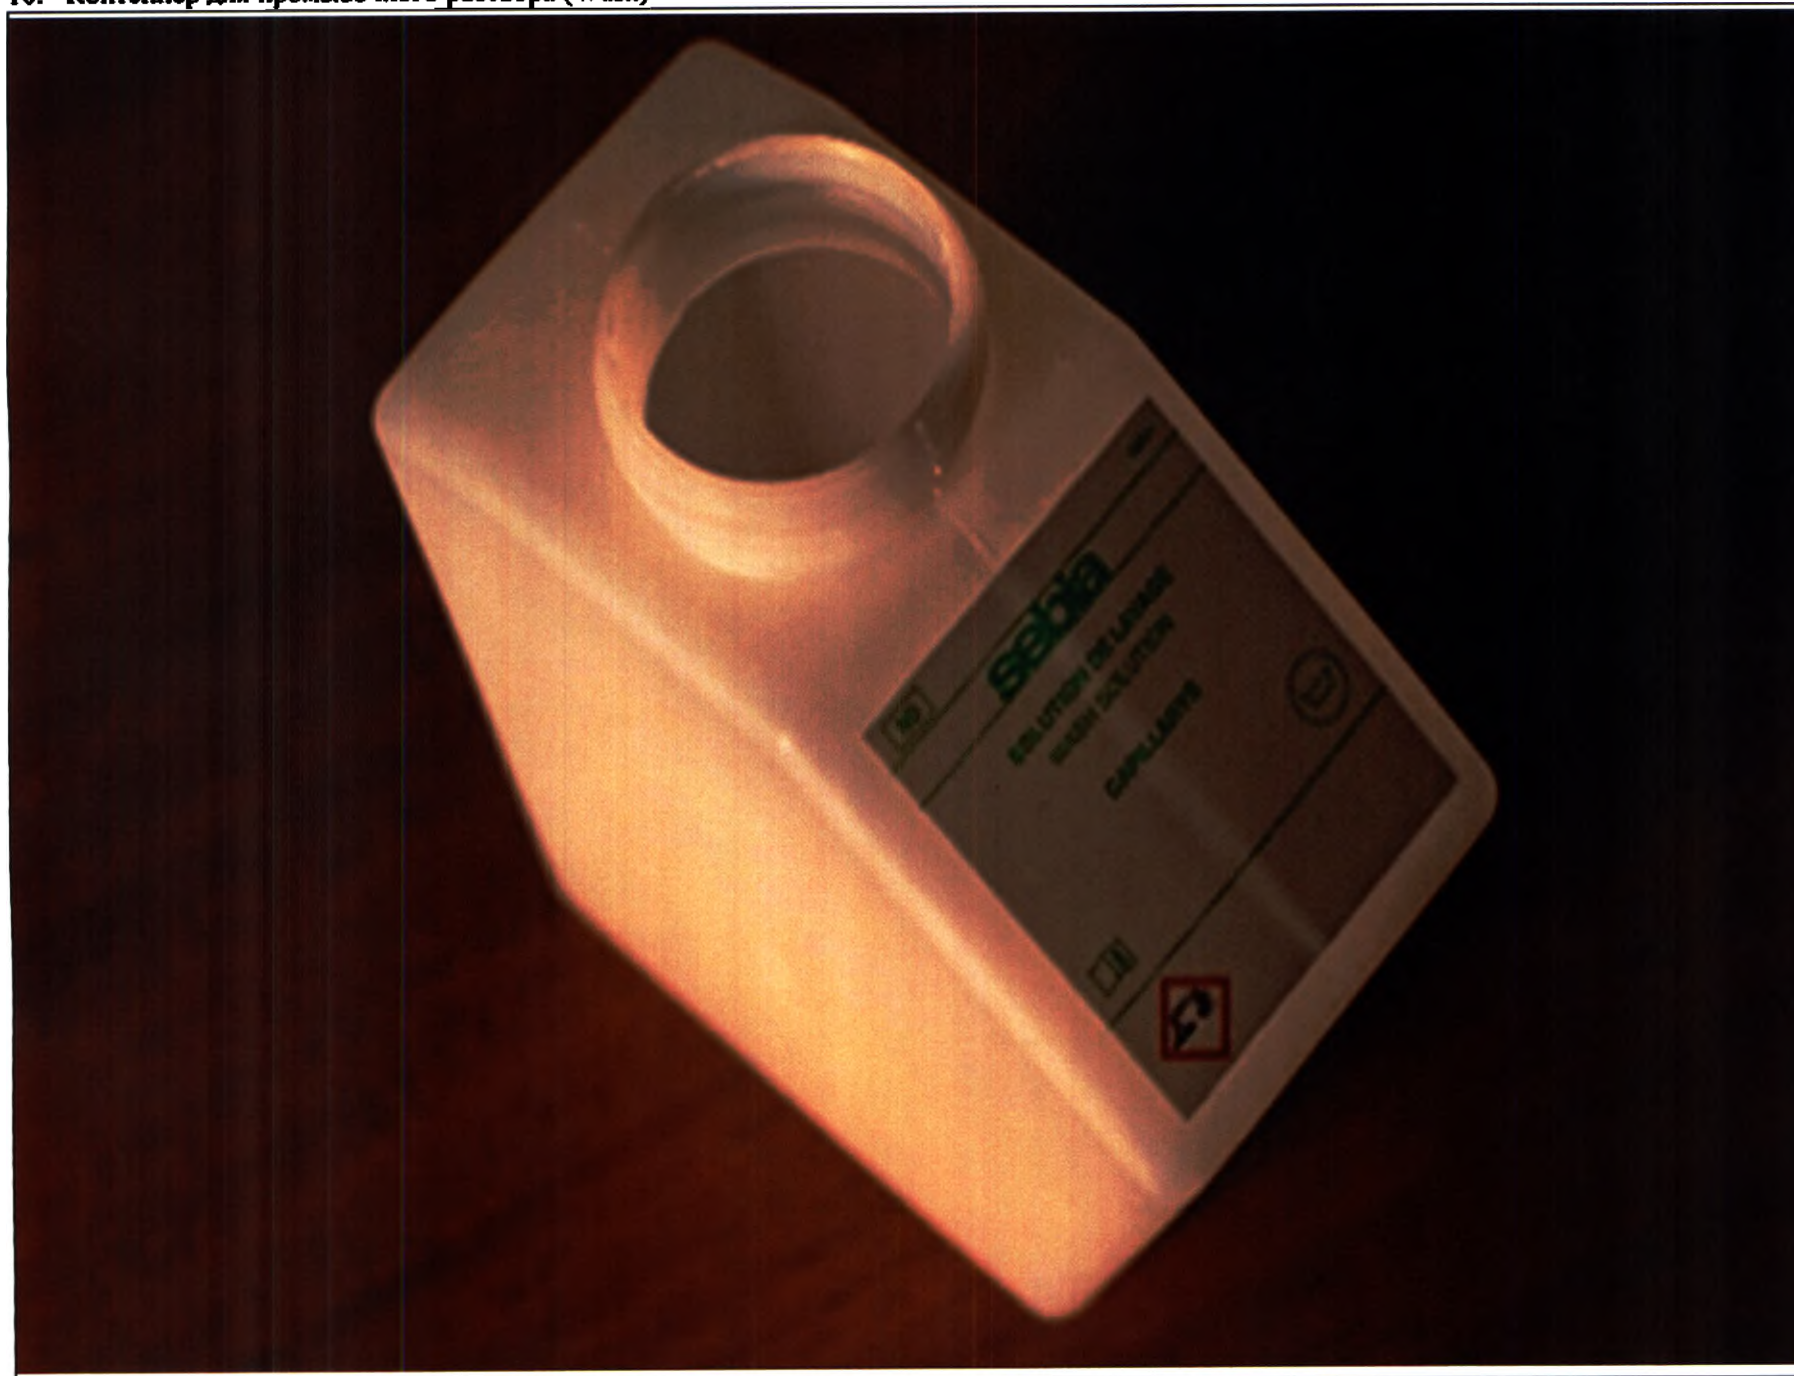

Пример RFID-этикетки на контейнере

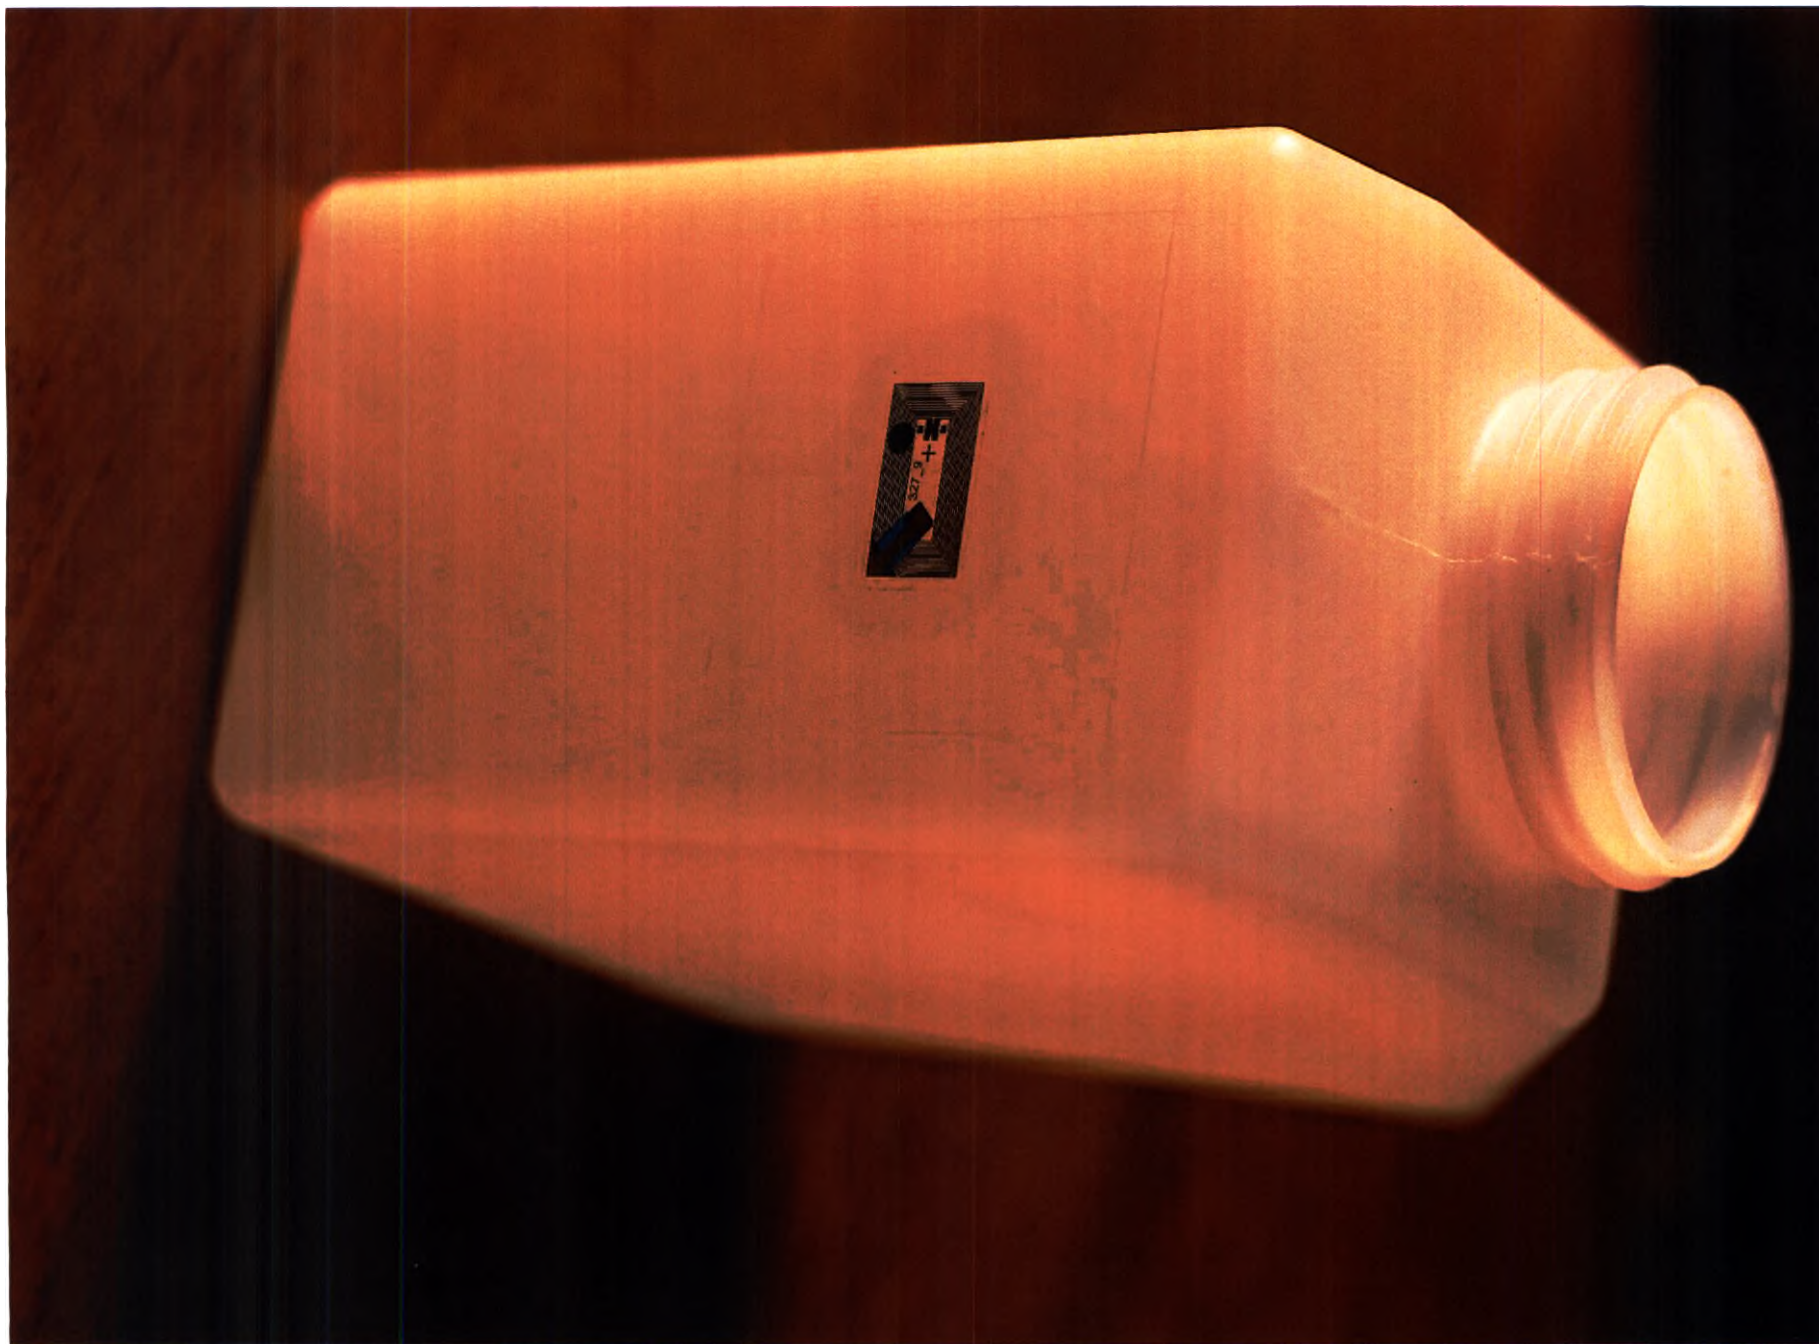


11. Контейнер для отходов внутренний



12. Контейнер на 750 мл для буферных и промывочных растворов



13. Контейнер для отходов внешний

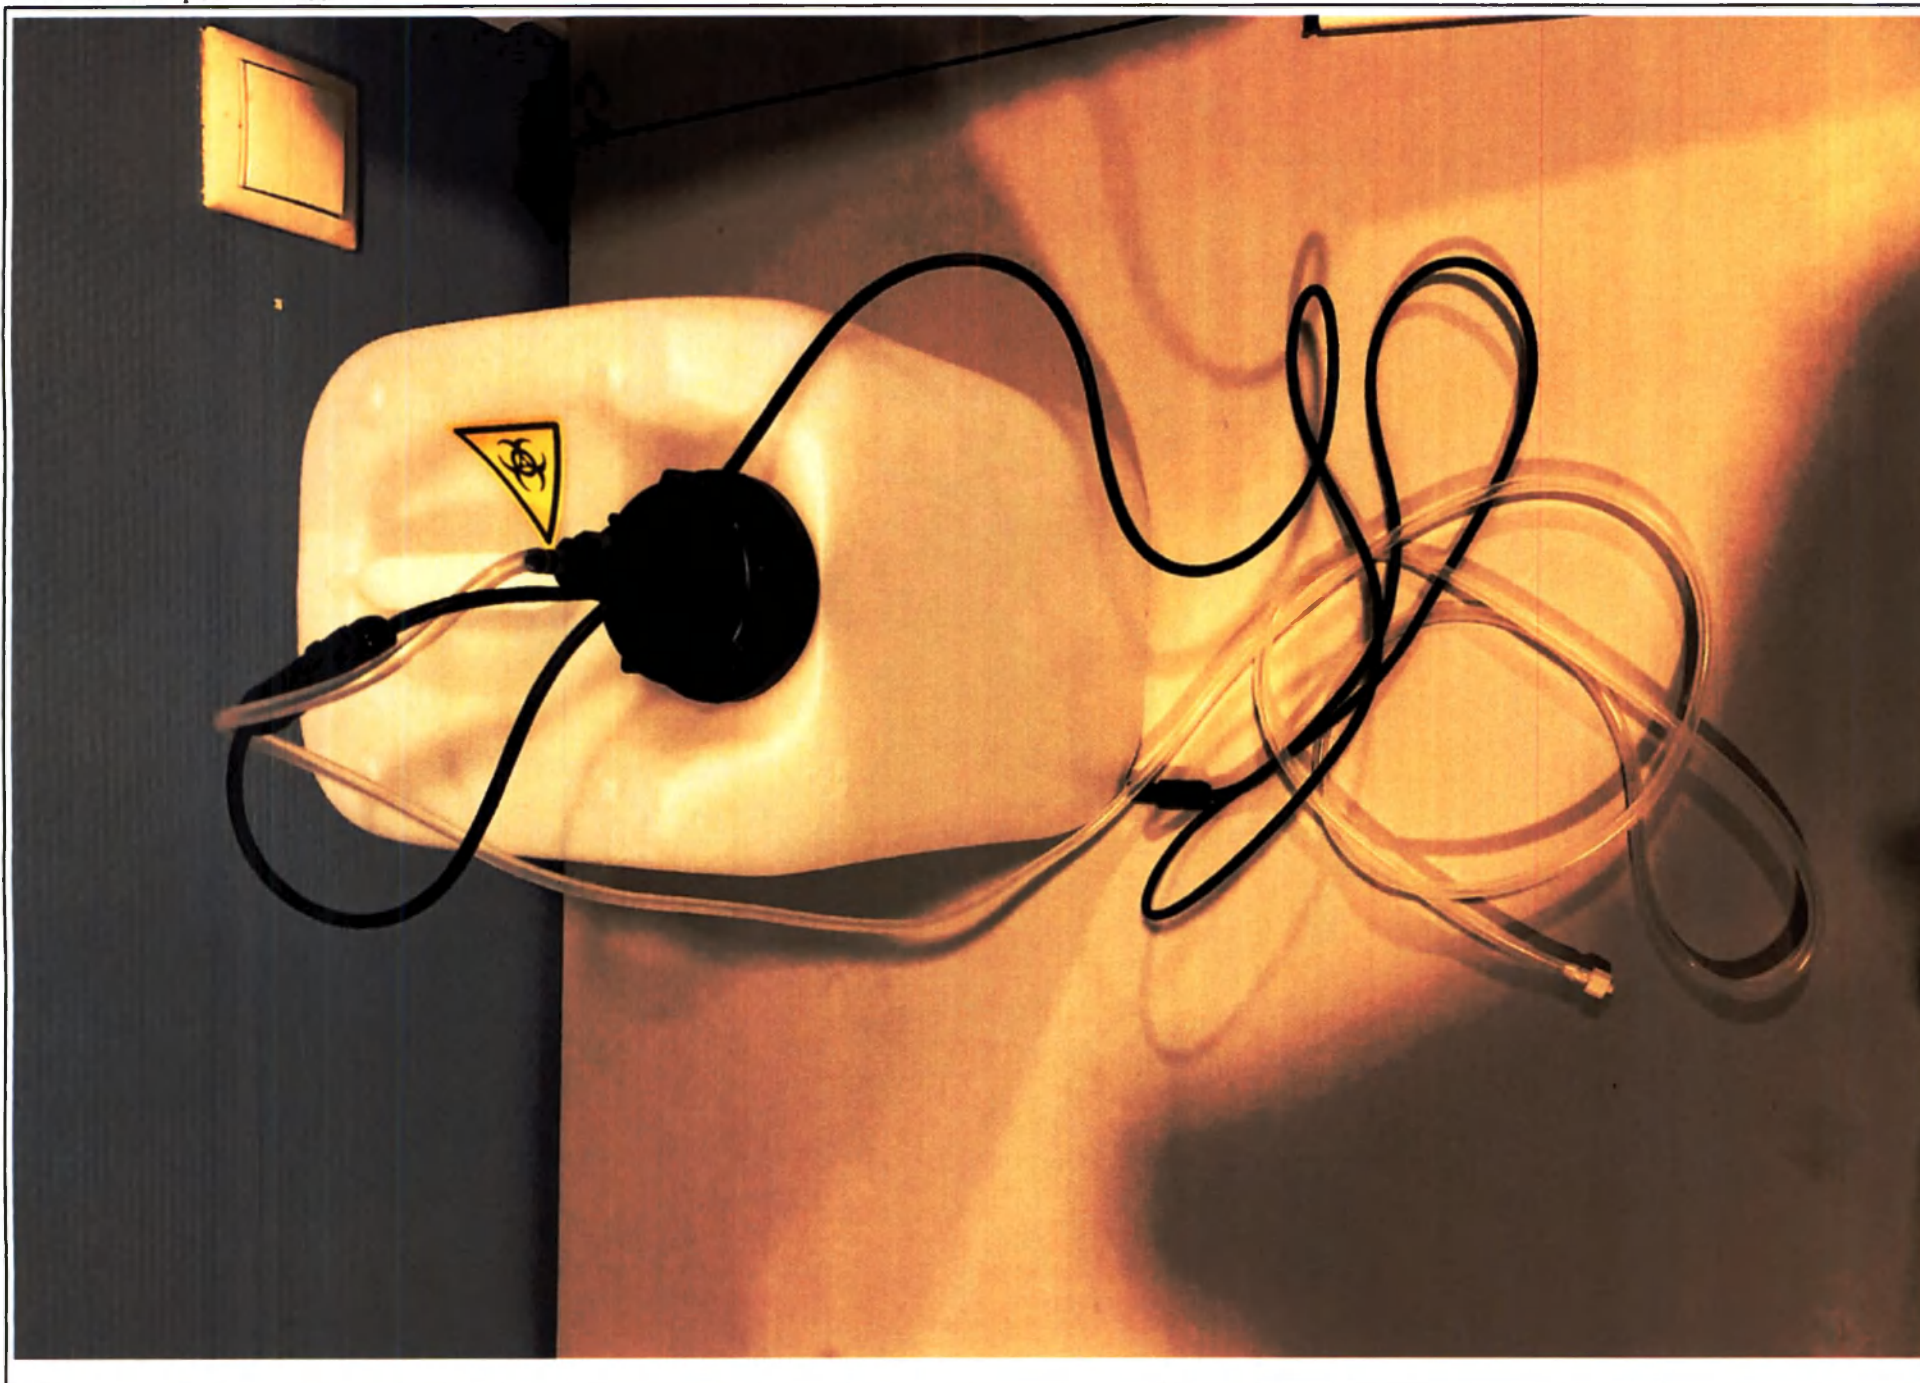

14. Контейнер для использованных сегментов для разведения САРІ 3




15. Принадлежности для подключения внешнего контейнера для отходов, в составе

15.1 трубочка;

15.2 датчик наполнения;

15.3 винт для крепления.

15.1 трубочка

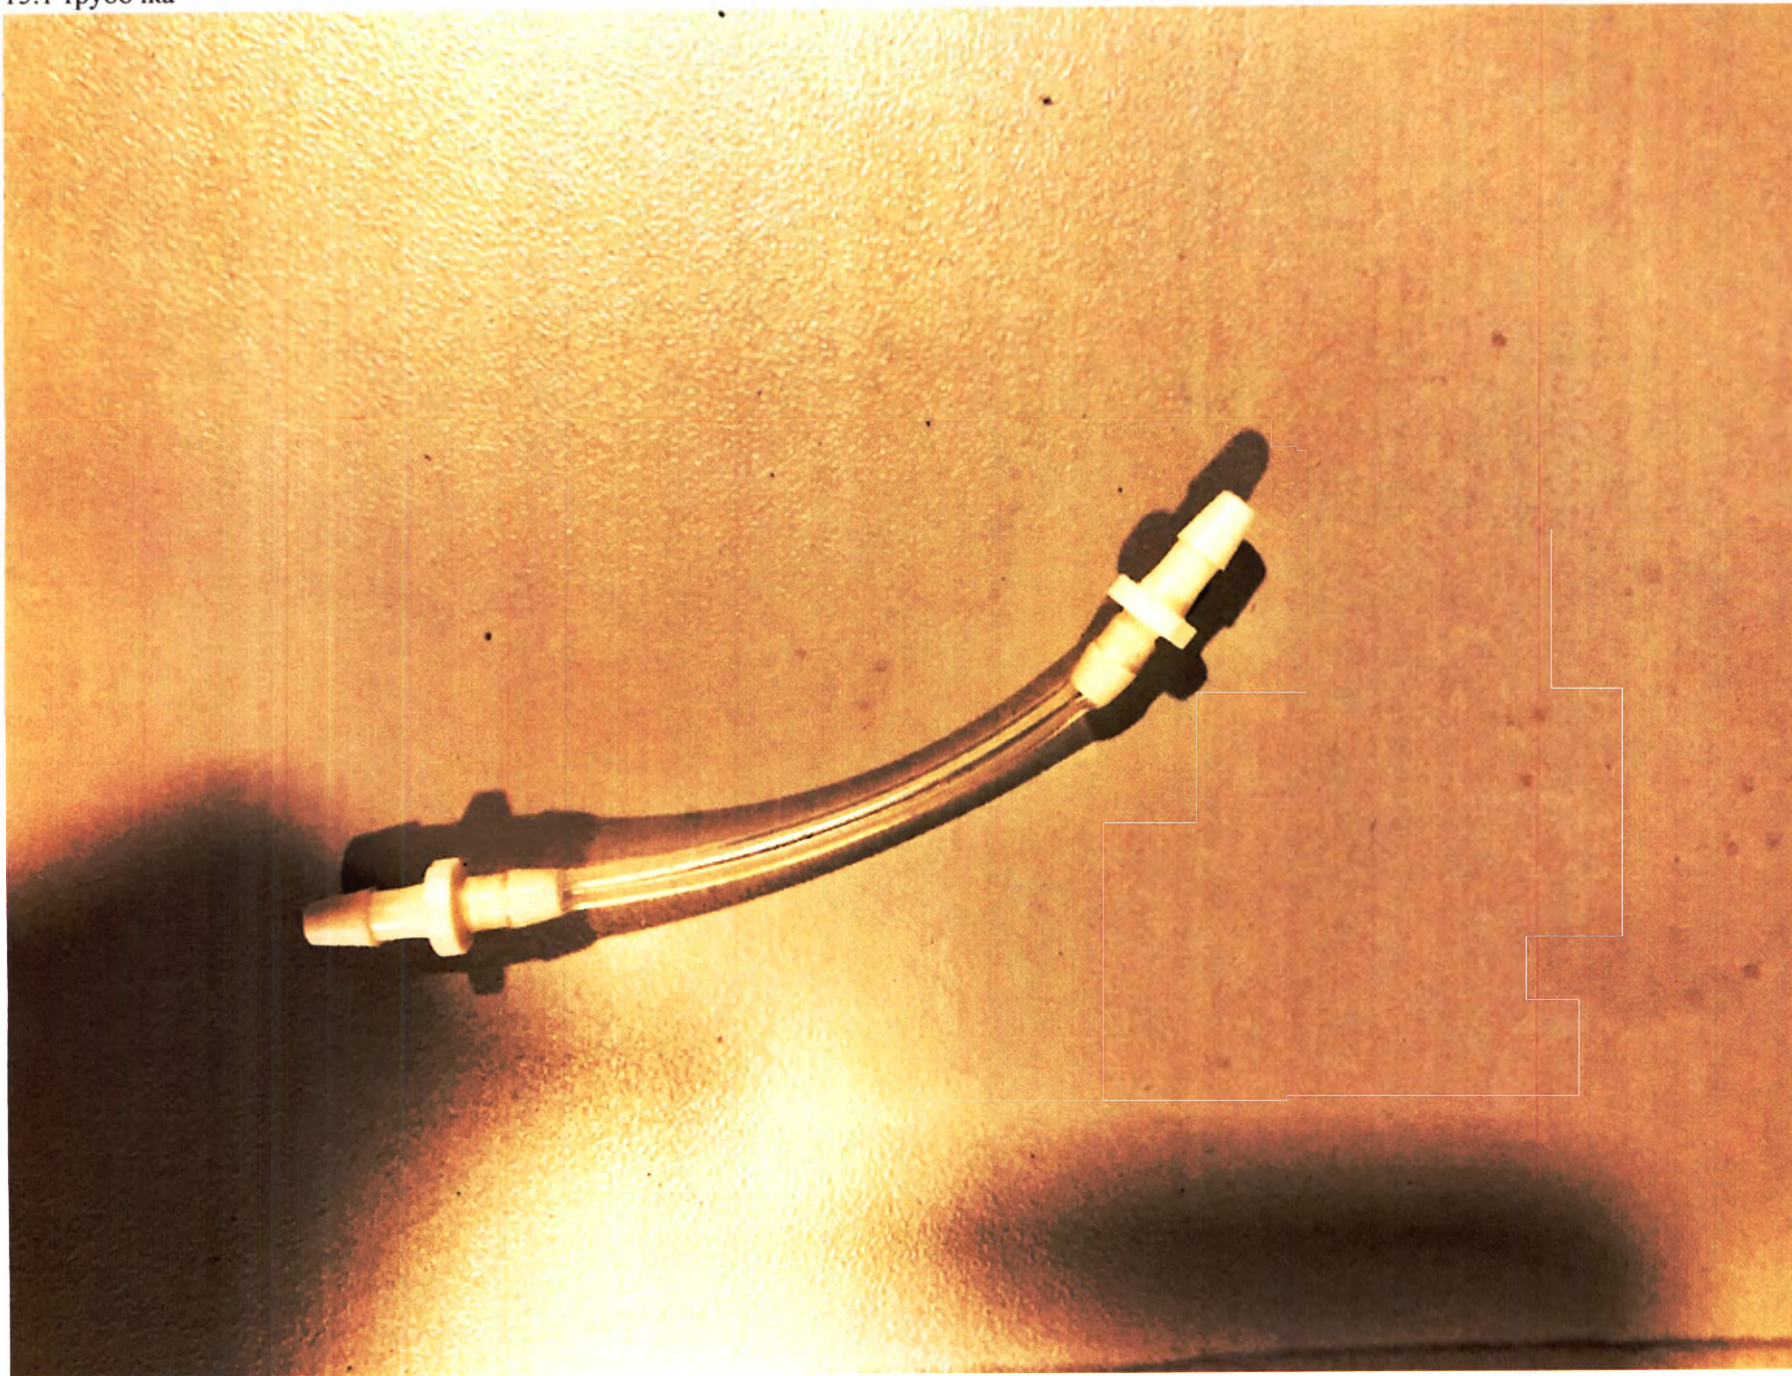



15.3 винт для крепления




16. Принадлежности для подключения внешнего контейнера для использованных сегментов для разведения САРІ 3, в составе

16.1 элемент для сегментов металлический направляющий;

16.2 винт;

16.3 пластина для крепления.

16.1 элемент для сегментов металлический направляющий

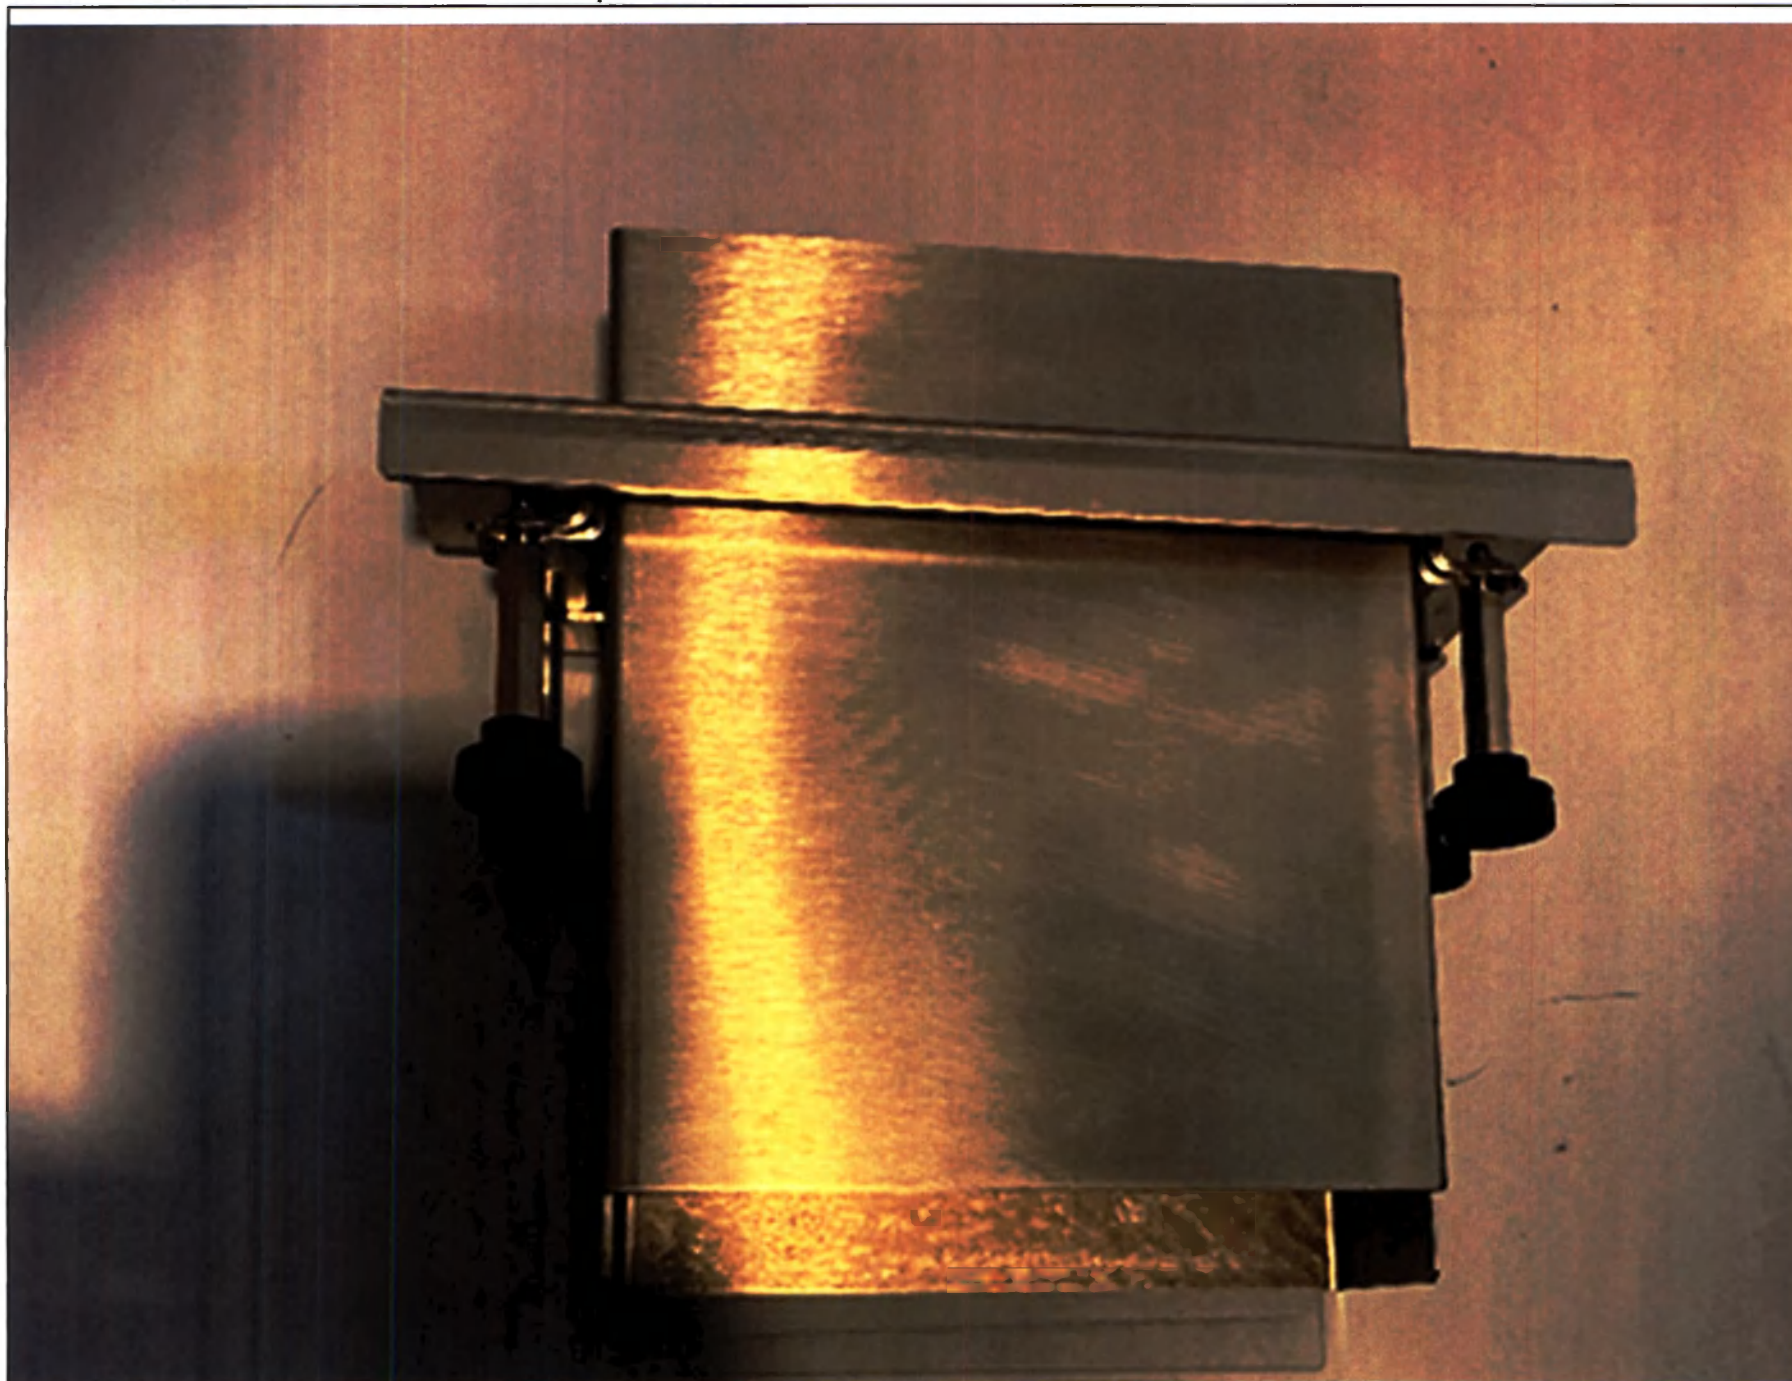




16.3 пластина для крепления



17. Крышка быстрого подсоединения

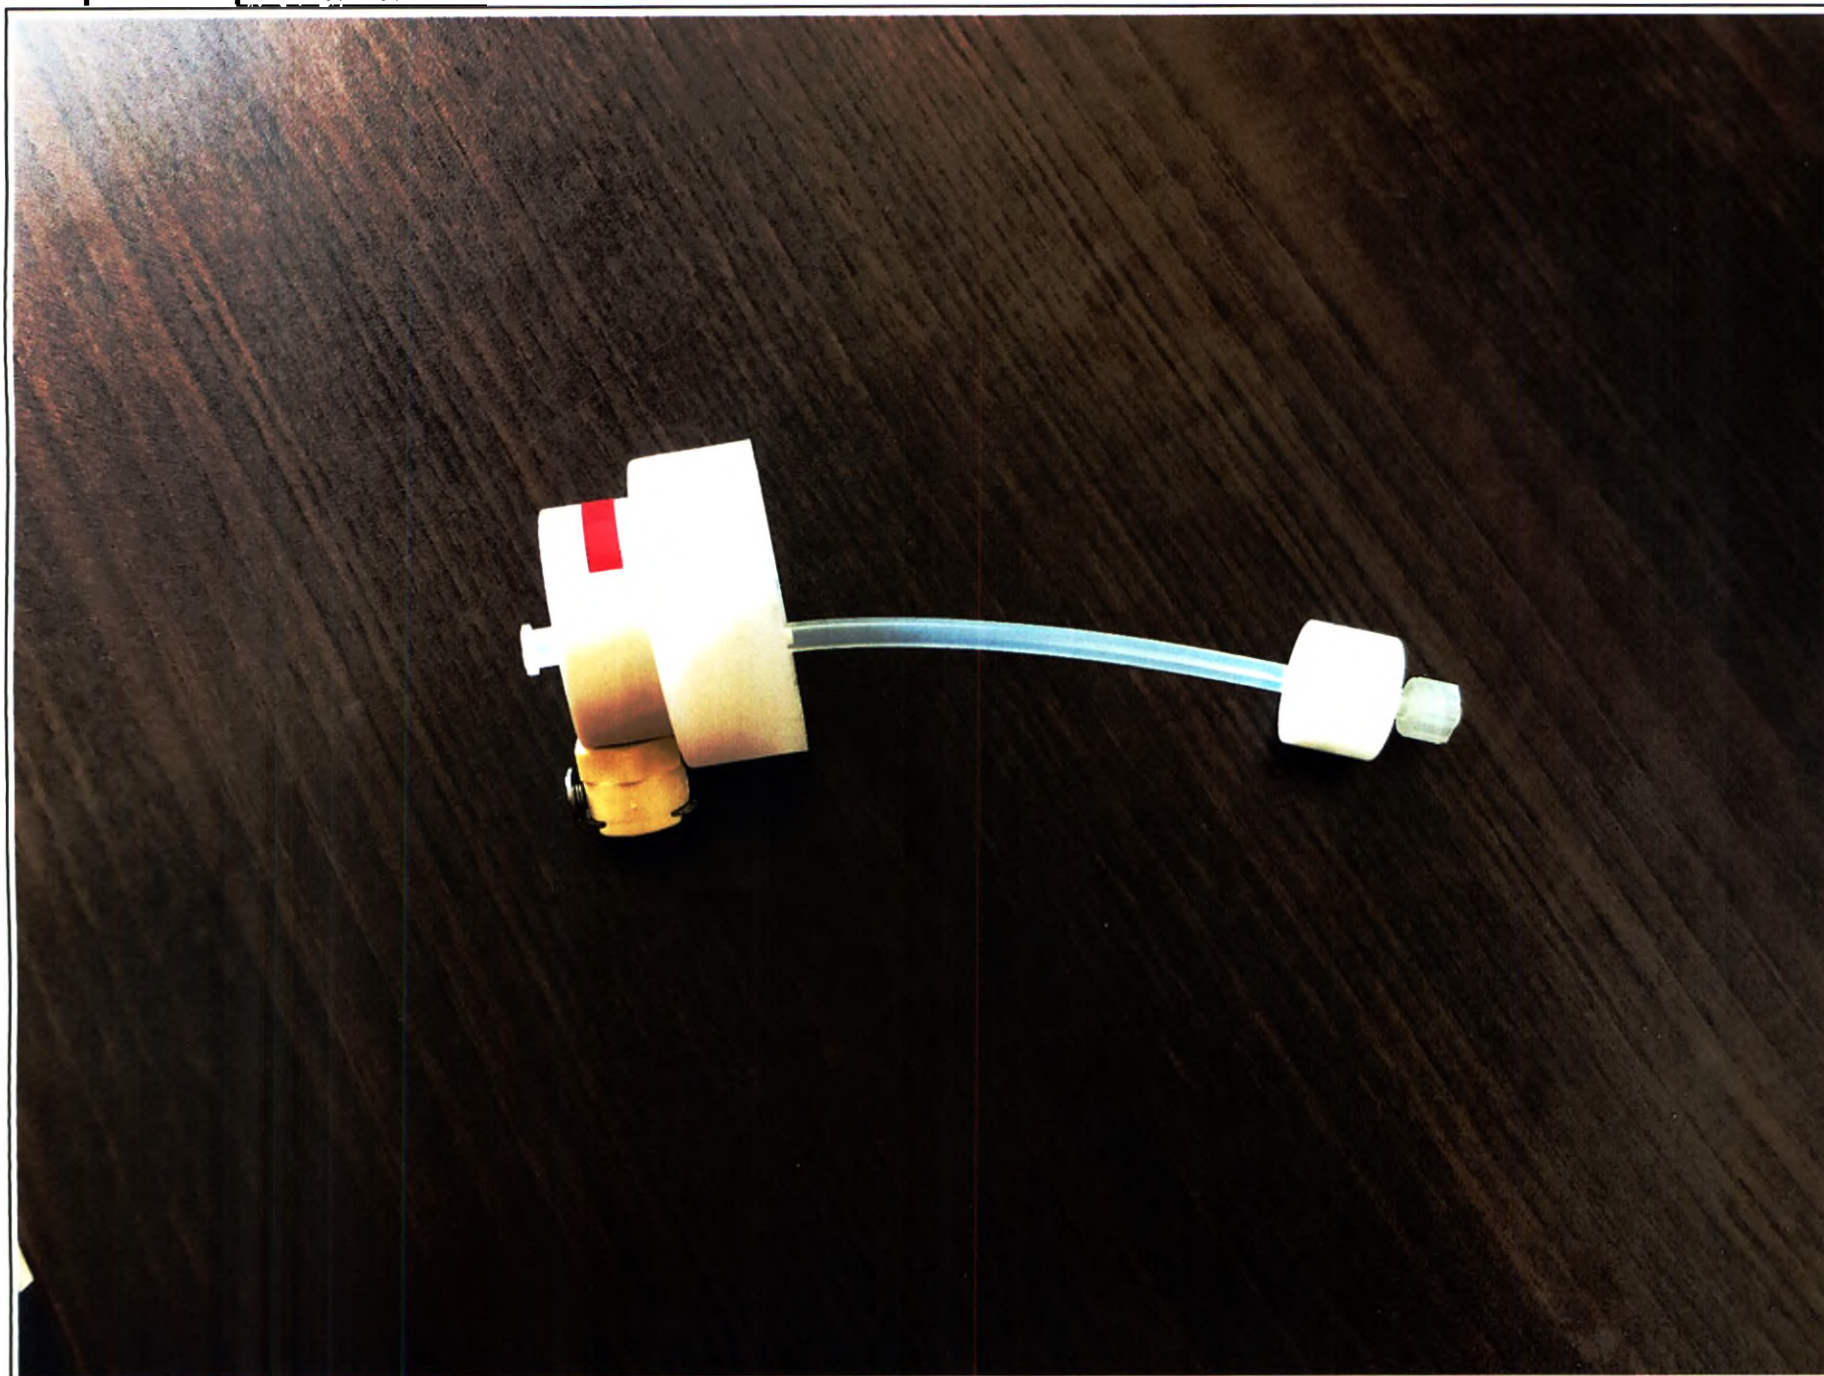

18. Наклейка с RFID-кодом для контейнера для воды



19. Наклейка с RFID-кодом для контейнера для отходов



20. Штатив для образцов CAPILLARYS 3 & MC









23. Штатив для образцов капиллярной крови CAPILLARYS 3 & MC





24. Штатив для образцов с малым объемом CAPILLARYS 3 & MC

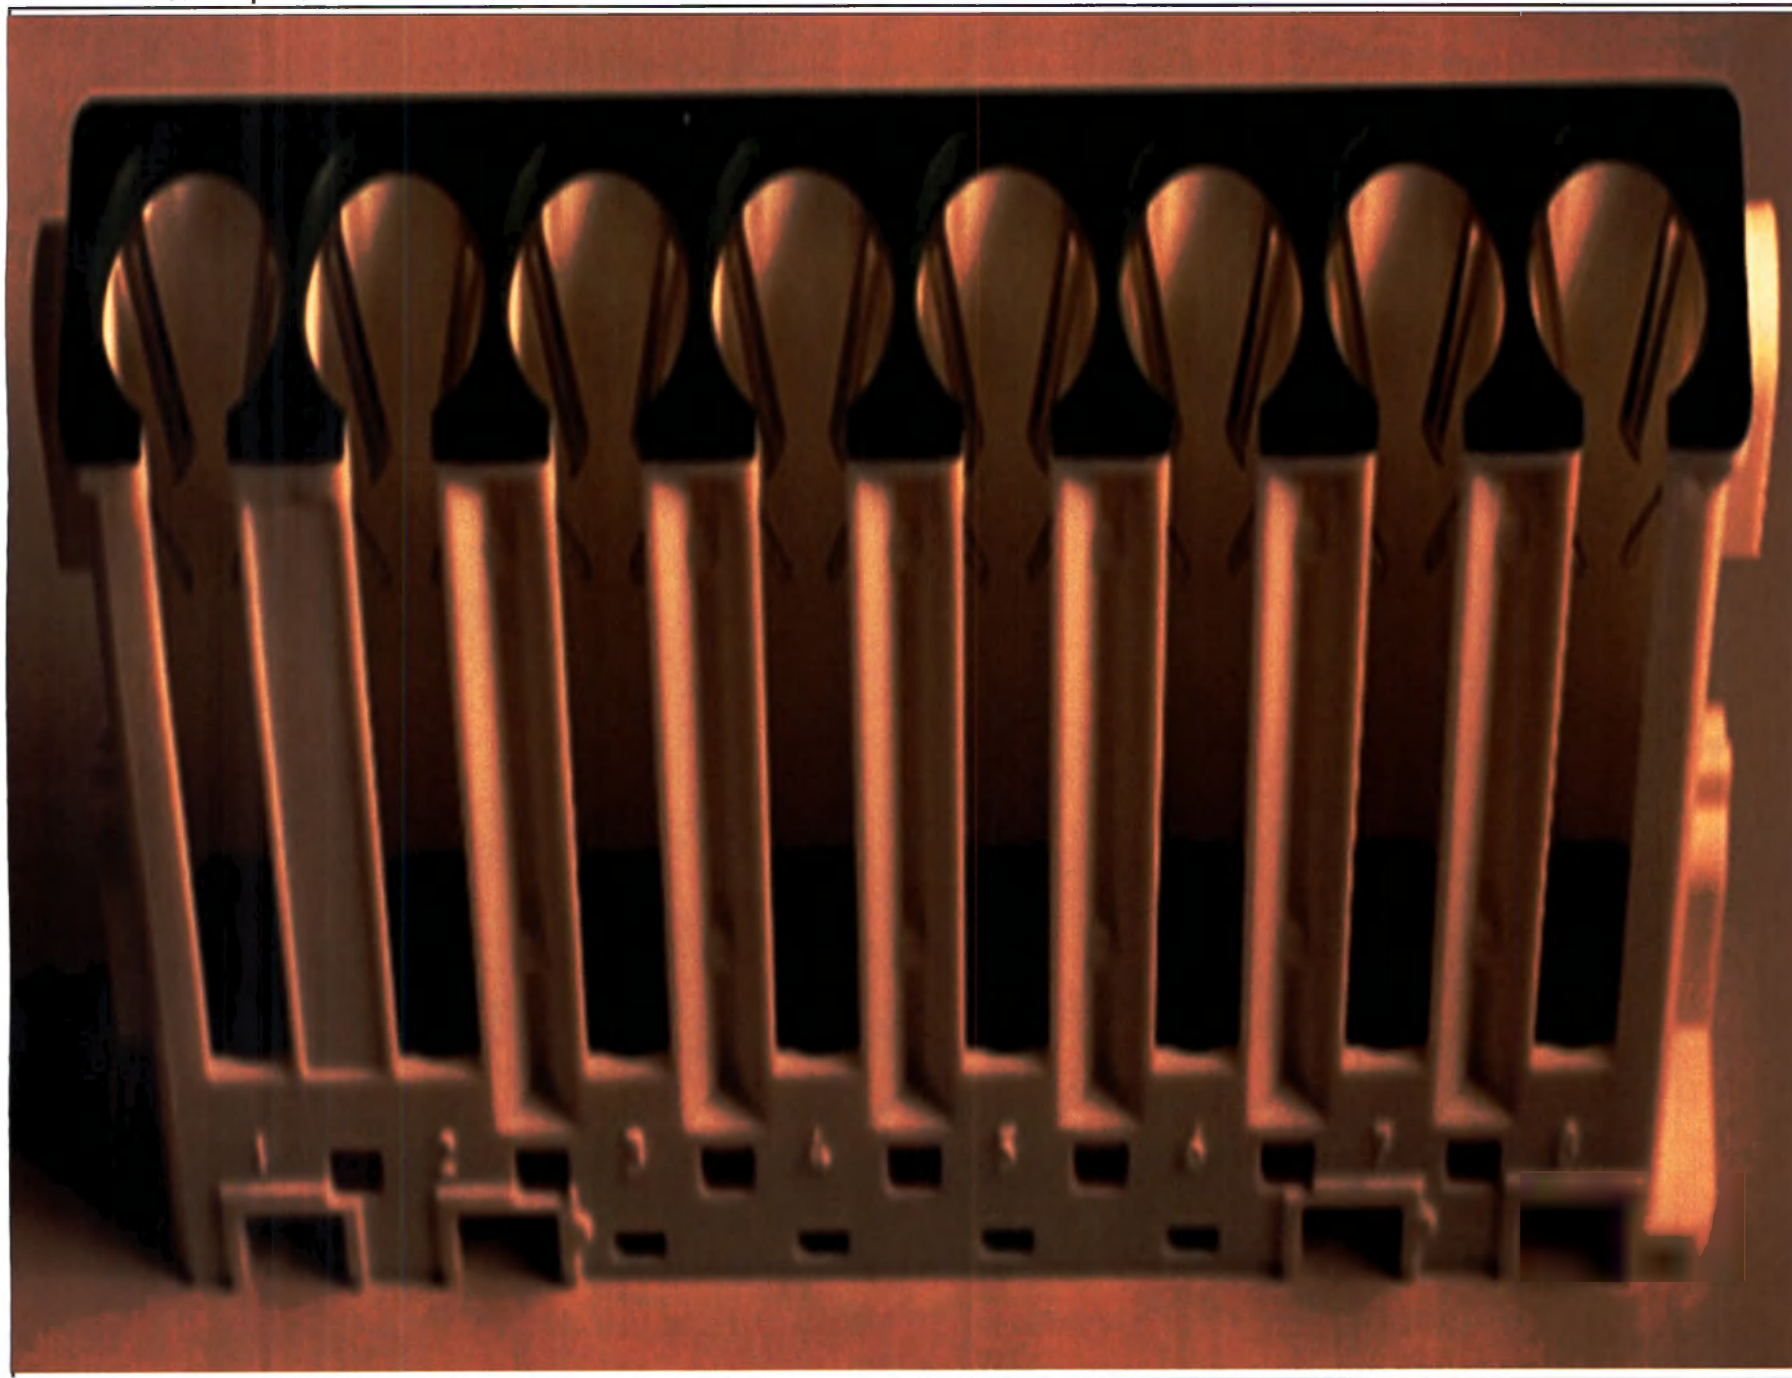

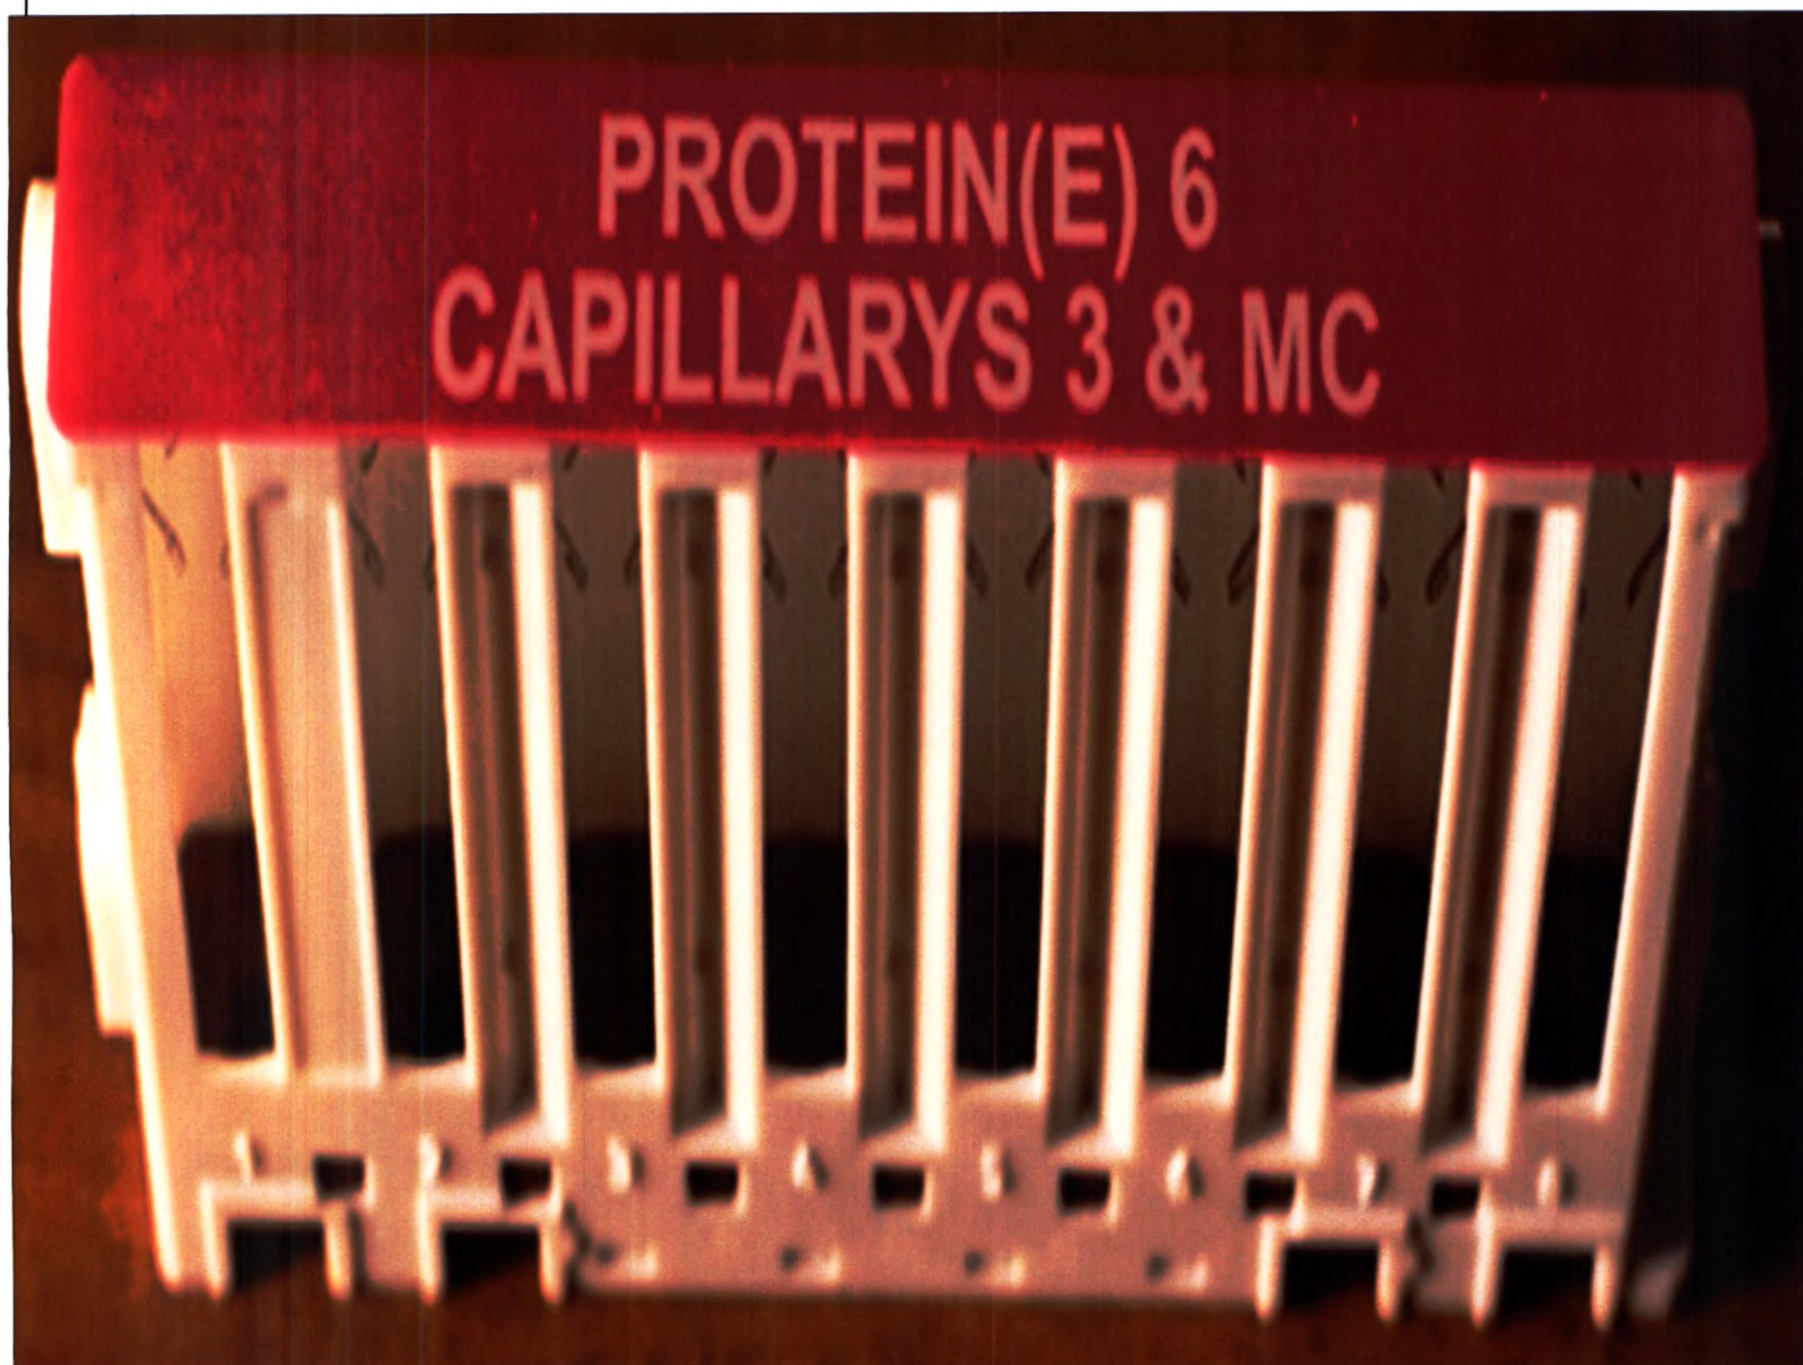


26. Штатив переключения CAPILLARYS 3 & MC для методики Hb A1c

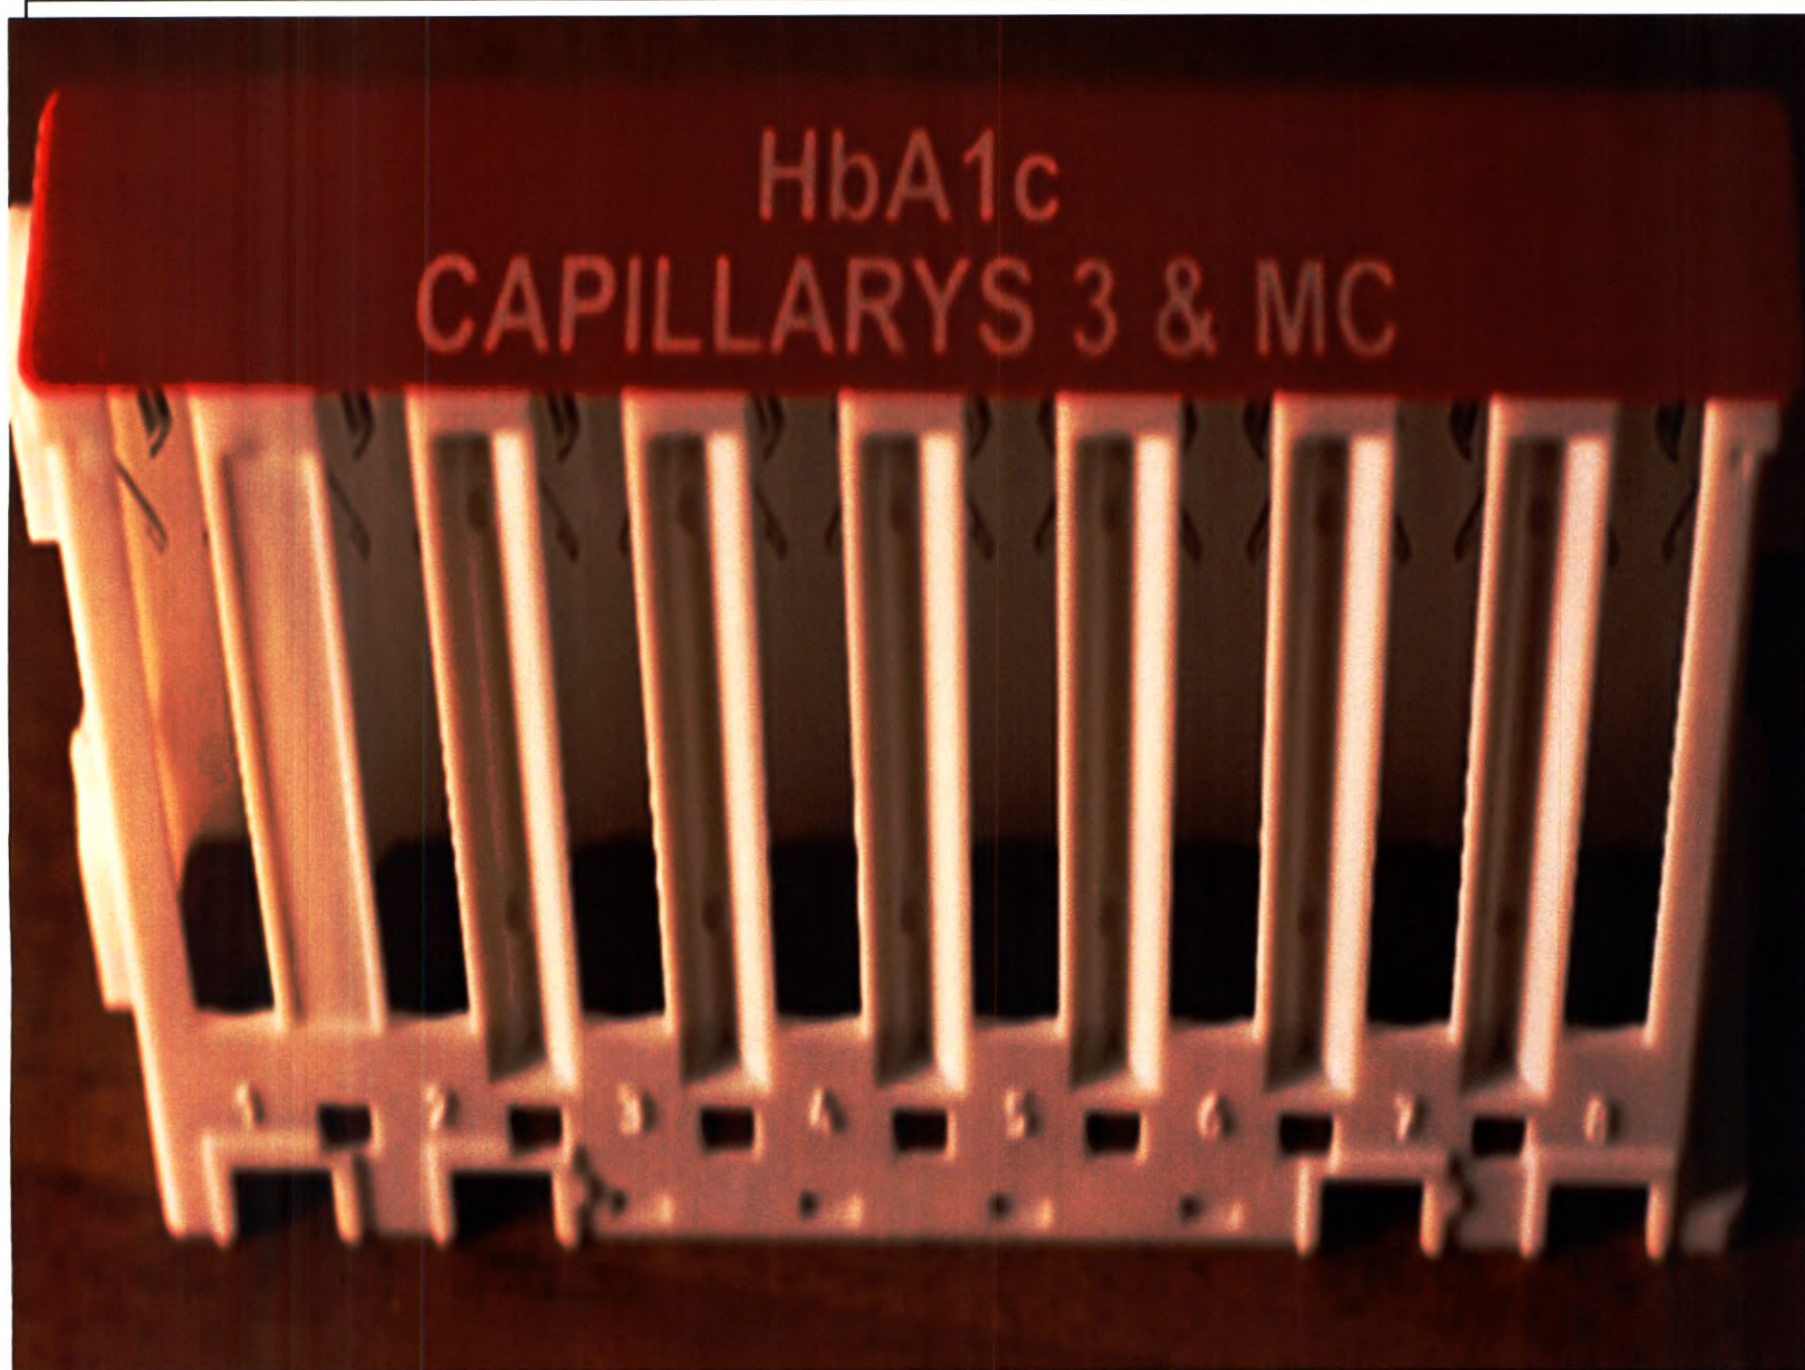


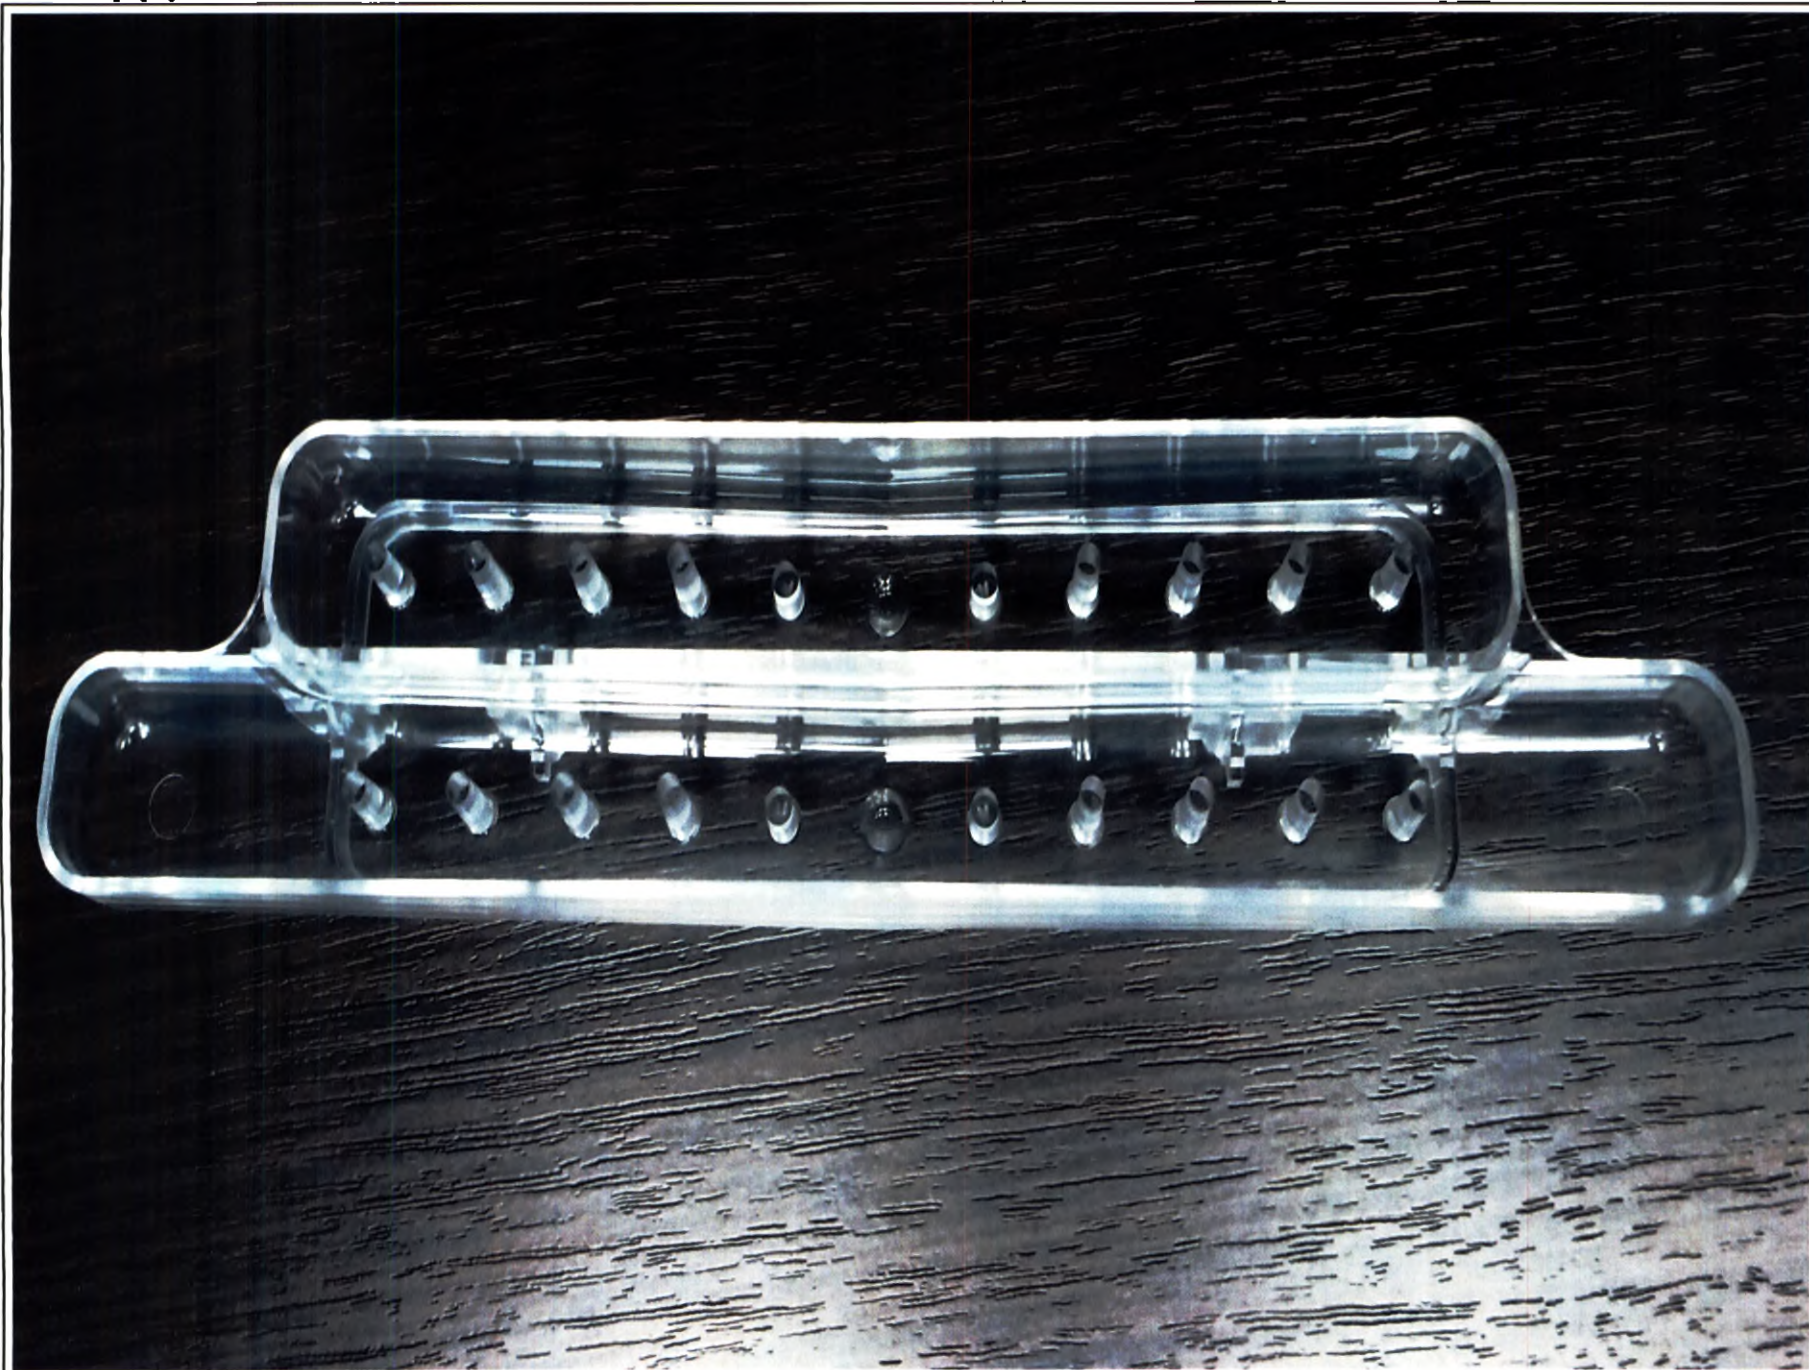

28. Пробирка с крышкой для контролей

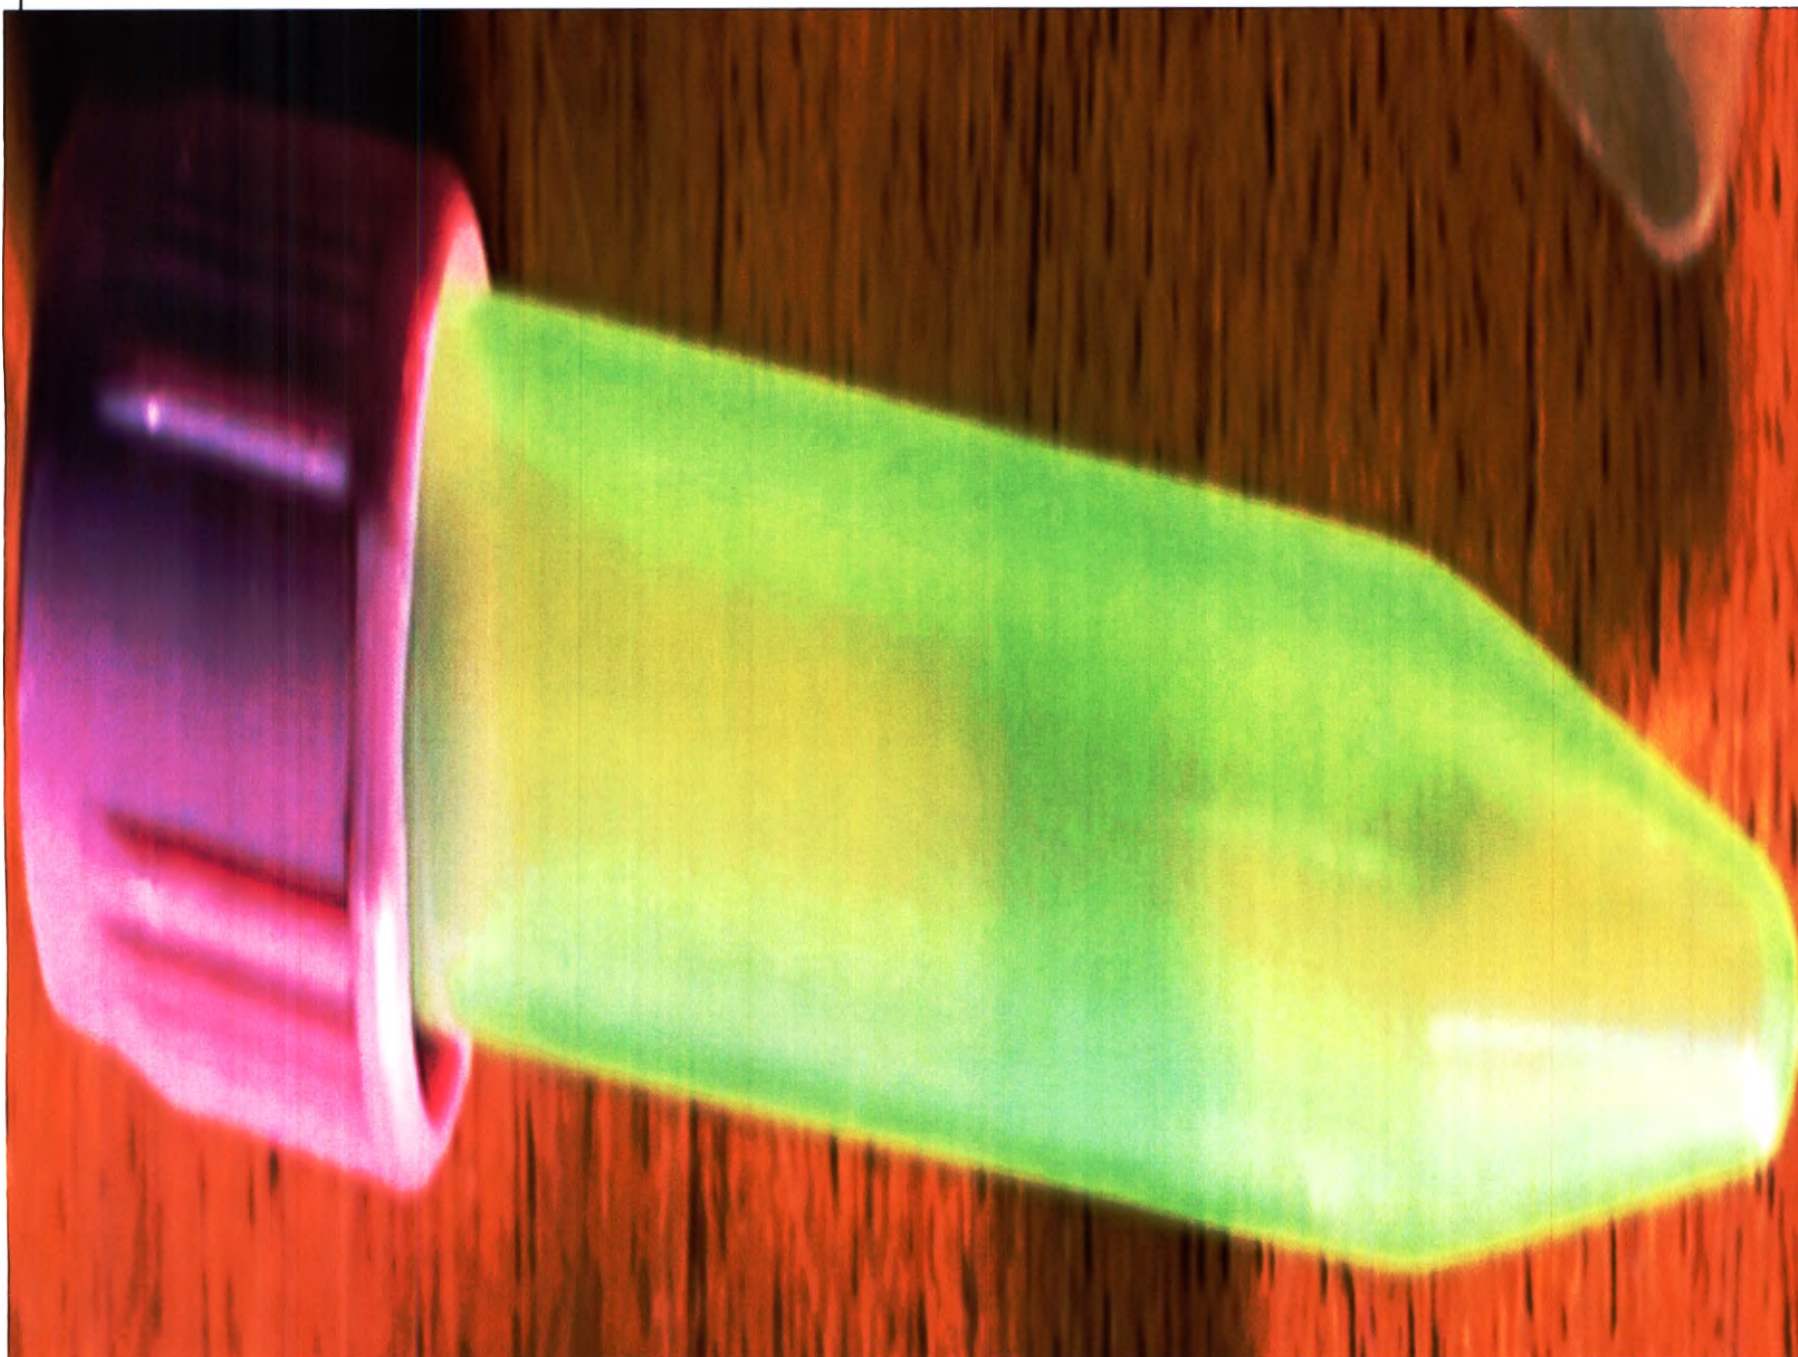


29. Сегмент для разведения CAPI 3

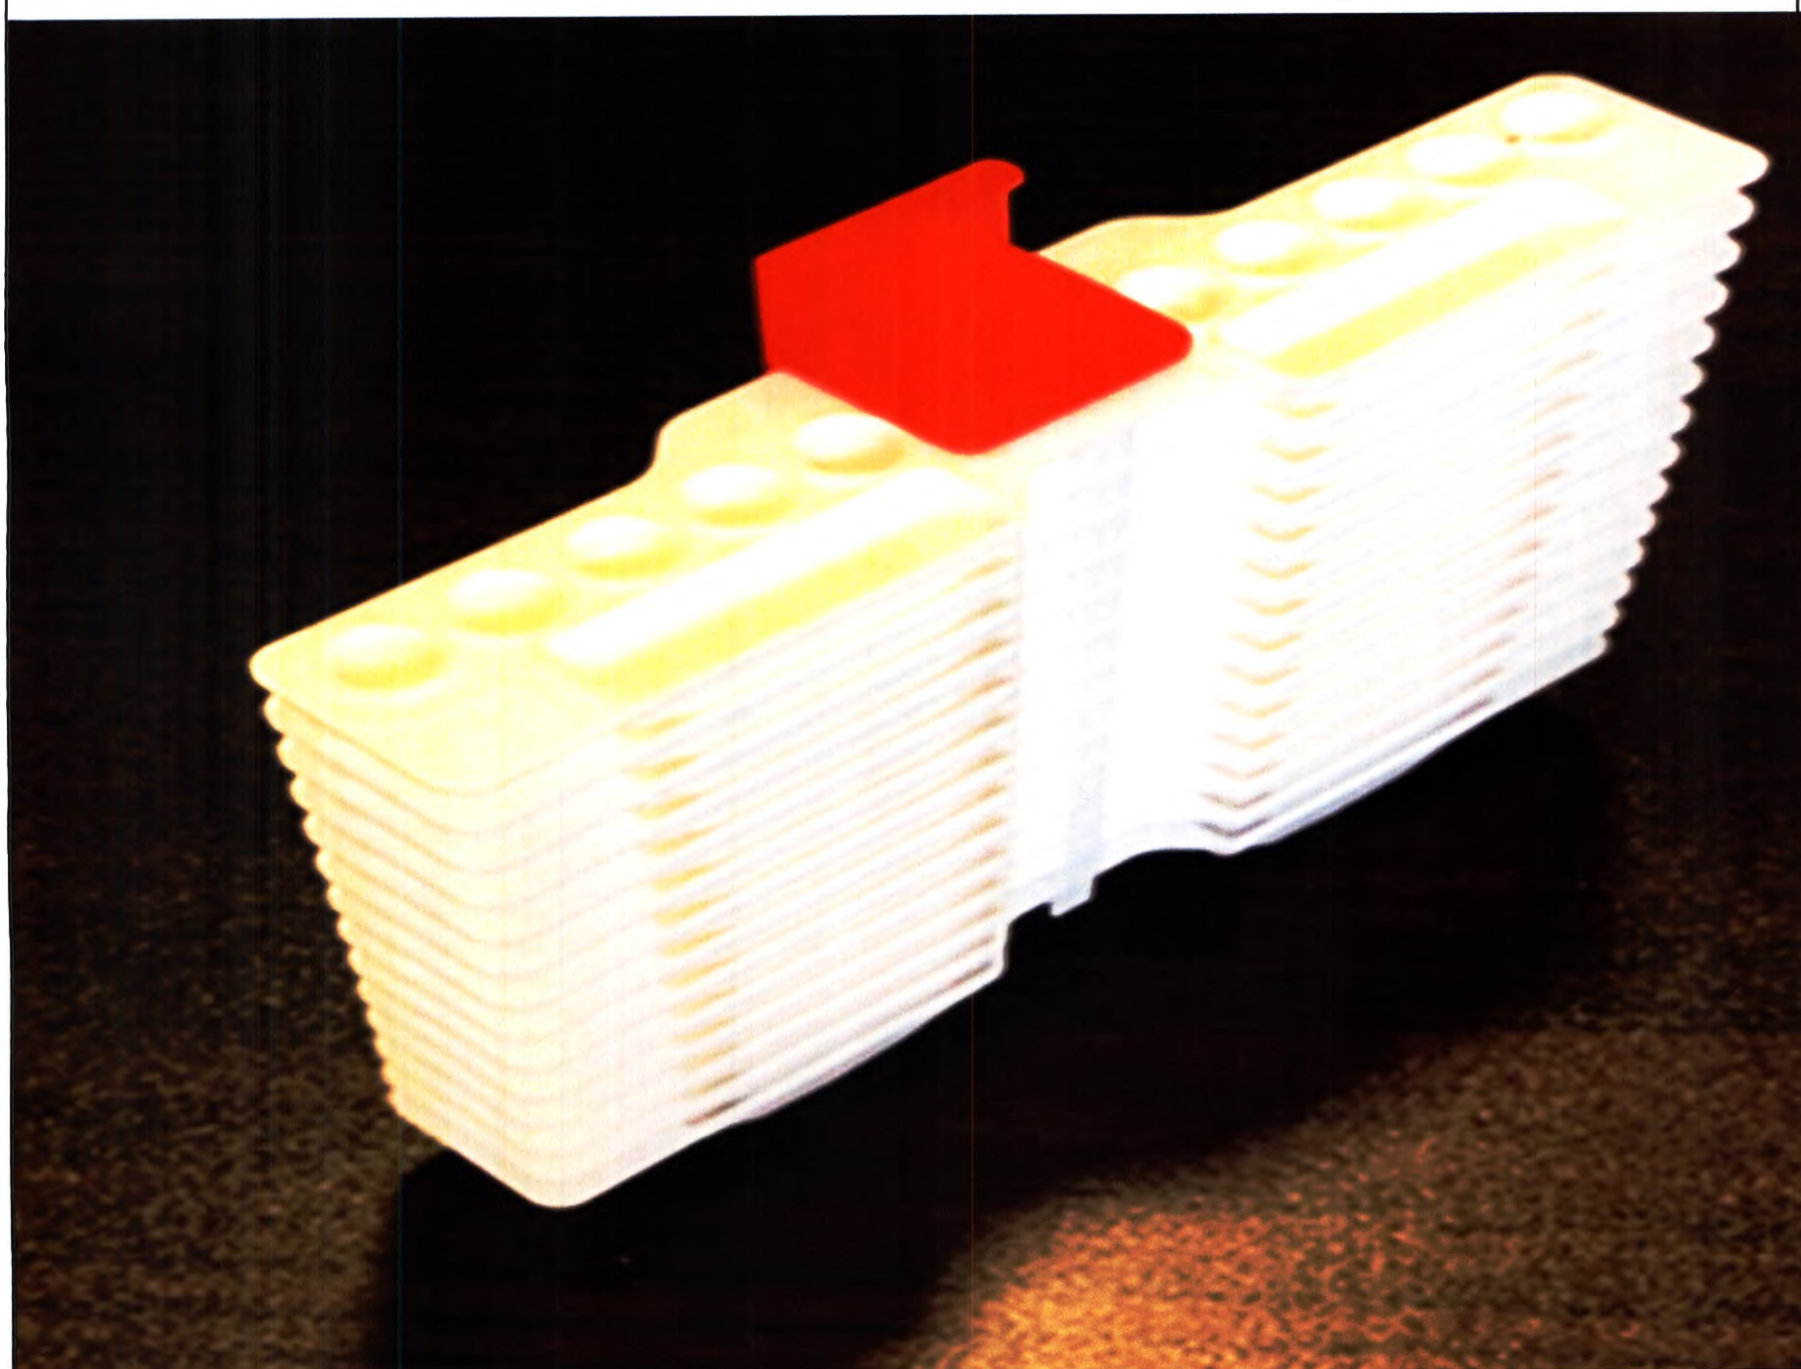

30. Программное обеспечение Phoresis



31. Фильтр для реагентов

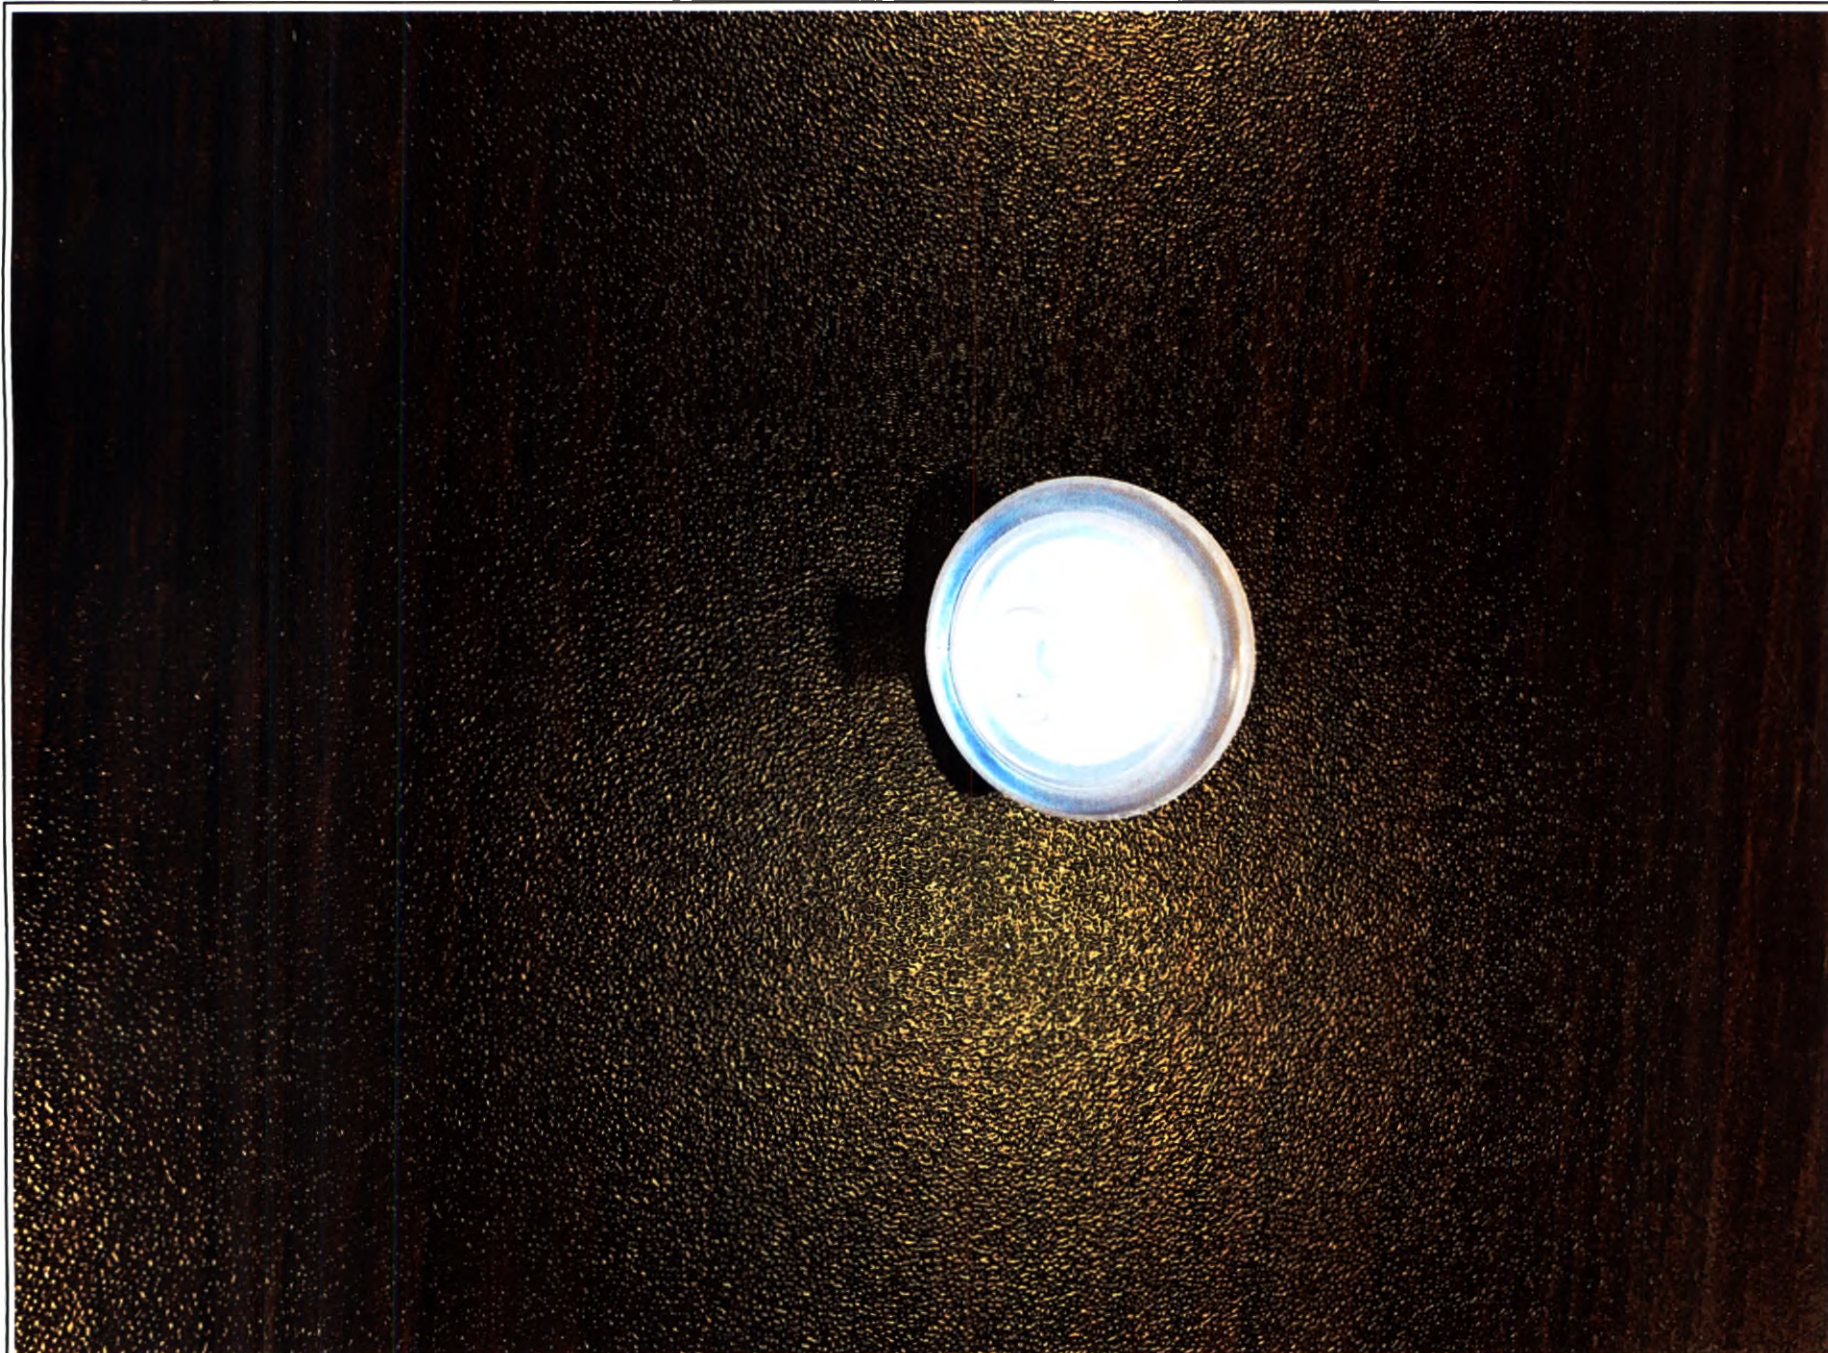


32. Игла-пробоотборник для прокалывания крышек





33. Картридж с капилляром для денситометрии

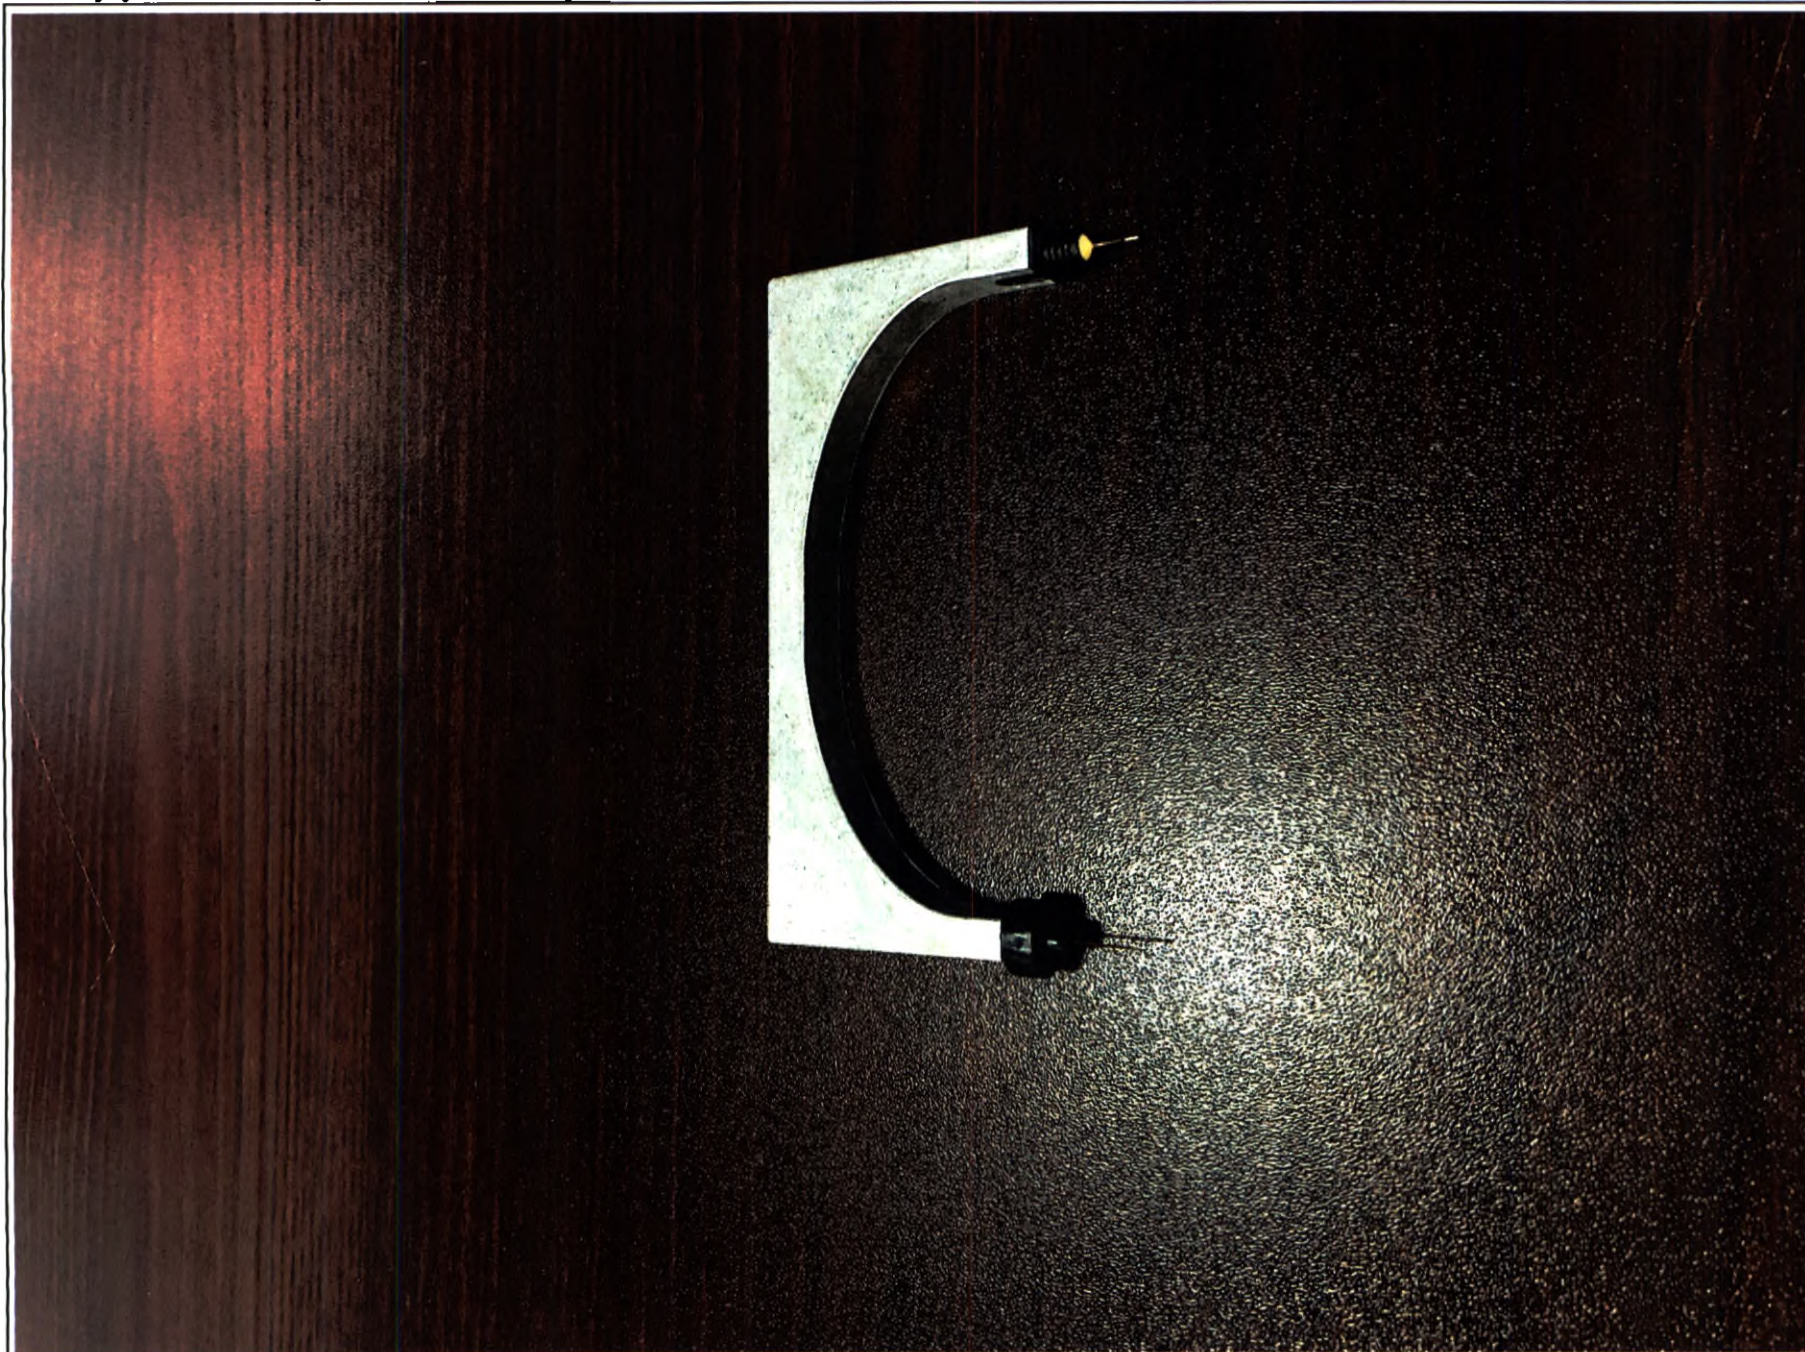



sebia

CAPILLAIRE / CAPILLARY

CAPILLAIRE / CAPILLARY
(CAPILLARYS 3)



10059286S

sebia

Parc Technologique Léonard de Vinci
CP 8010 Lisses
91008 EVRY-Corbeil - France

80200181

34.1 фильтр воздушный;

34.2 трубочка силиконовая

34.3 дозатор

34.4 клапан 8-ходовой;

34.5 клапан 6-ходовой;

34.6 шайба дозатора металлическая;


34.7 О-кольцо для крышки быстрого подсоединения;

34.8 смазка для О-колец крышки;


34.9 контейнер для отходов внутренний;

34.10 контейнер для промывочного раствора.


34.1 фильтр воздушный

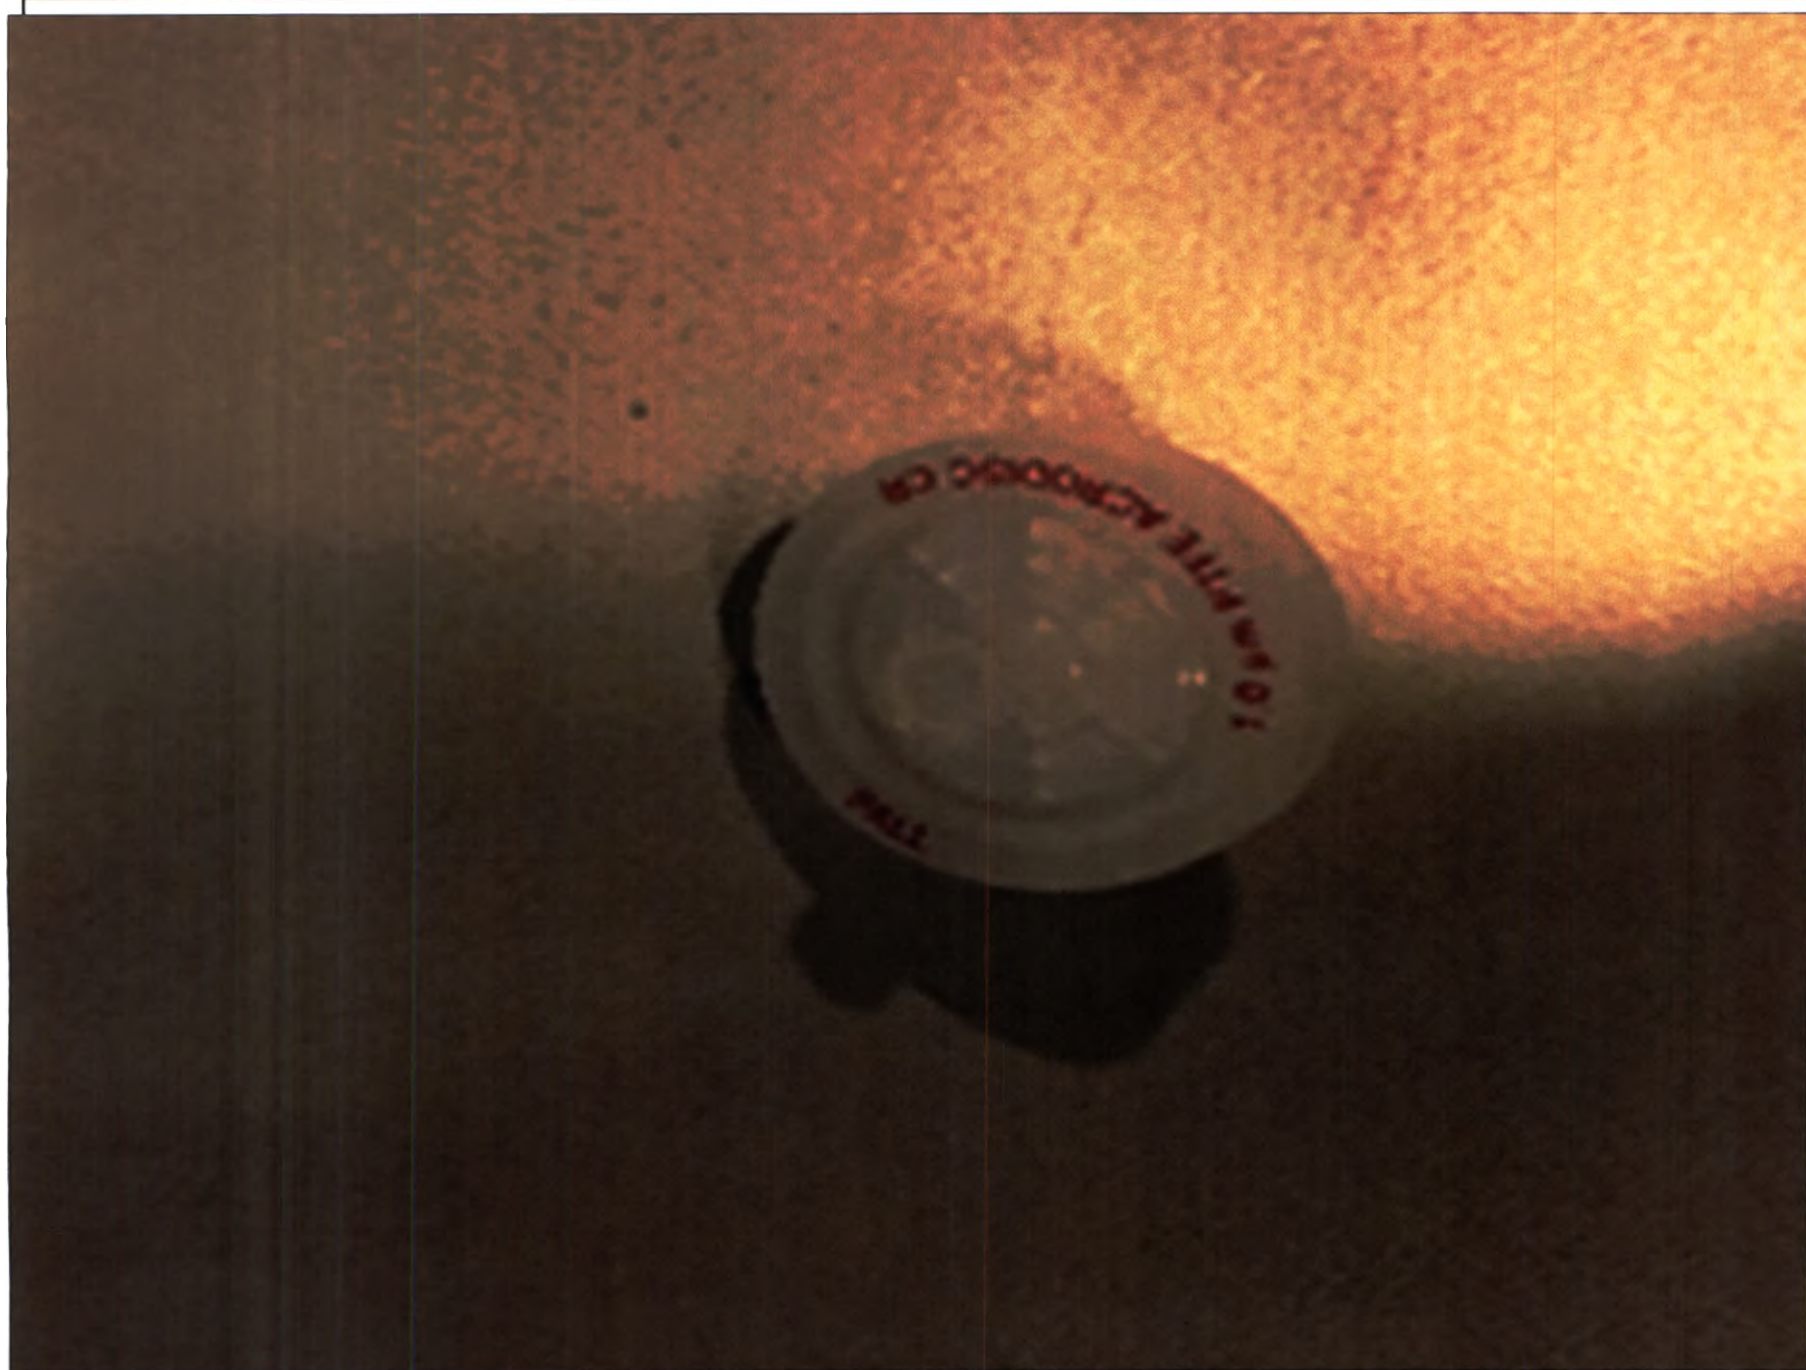


34.2 трубочка силиконовая

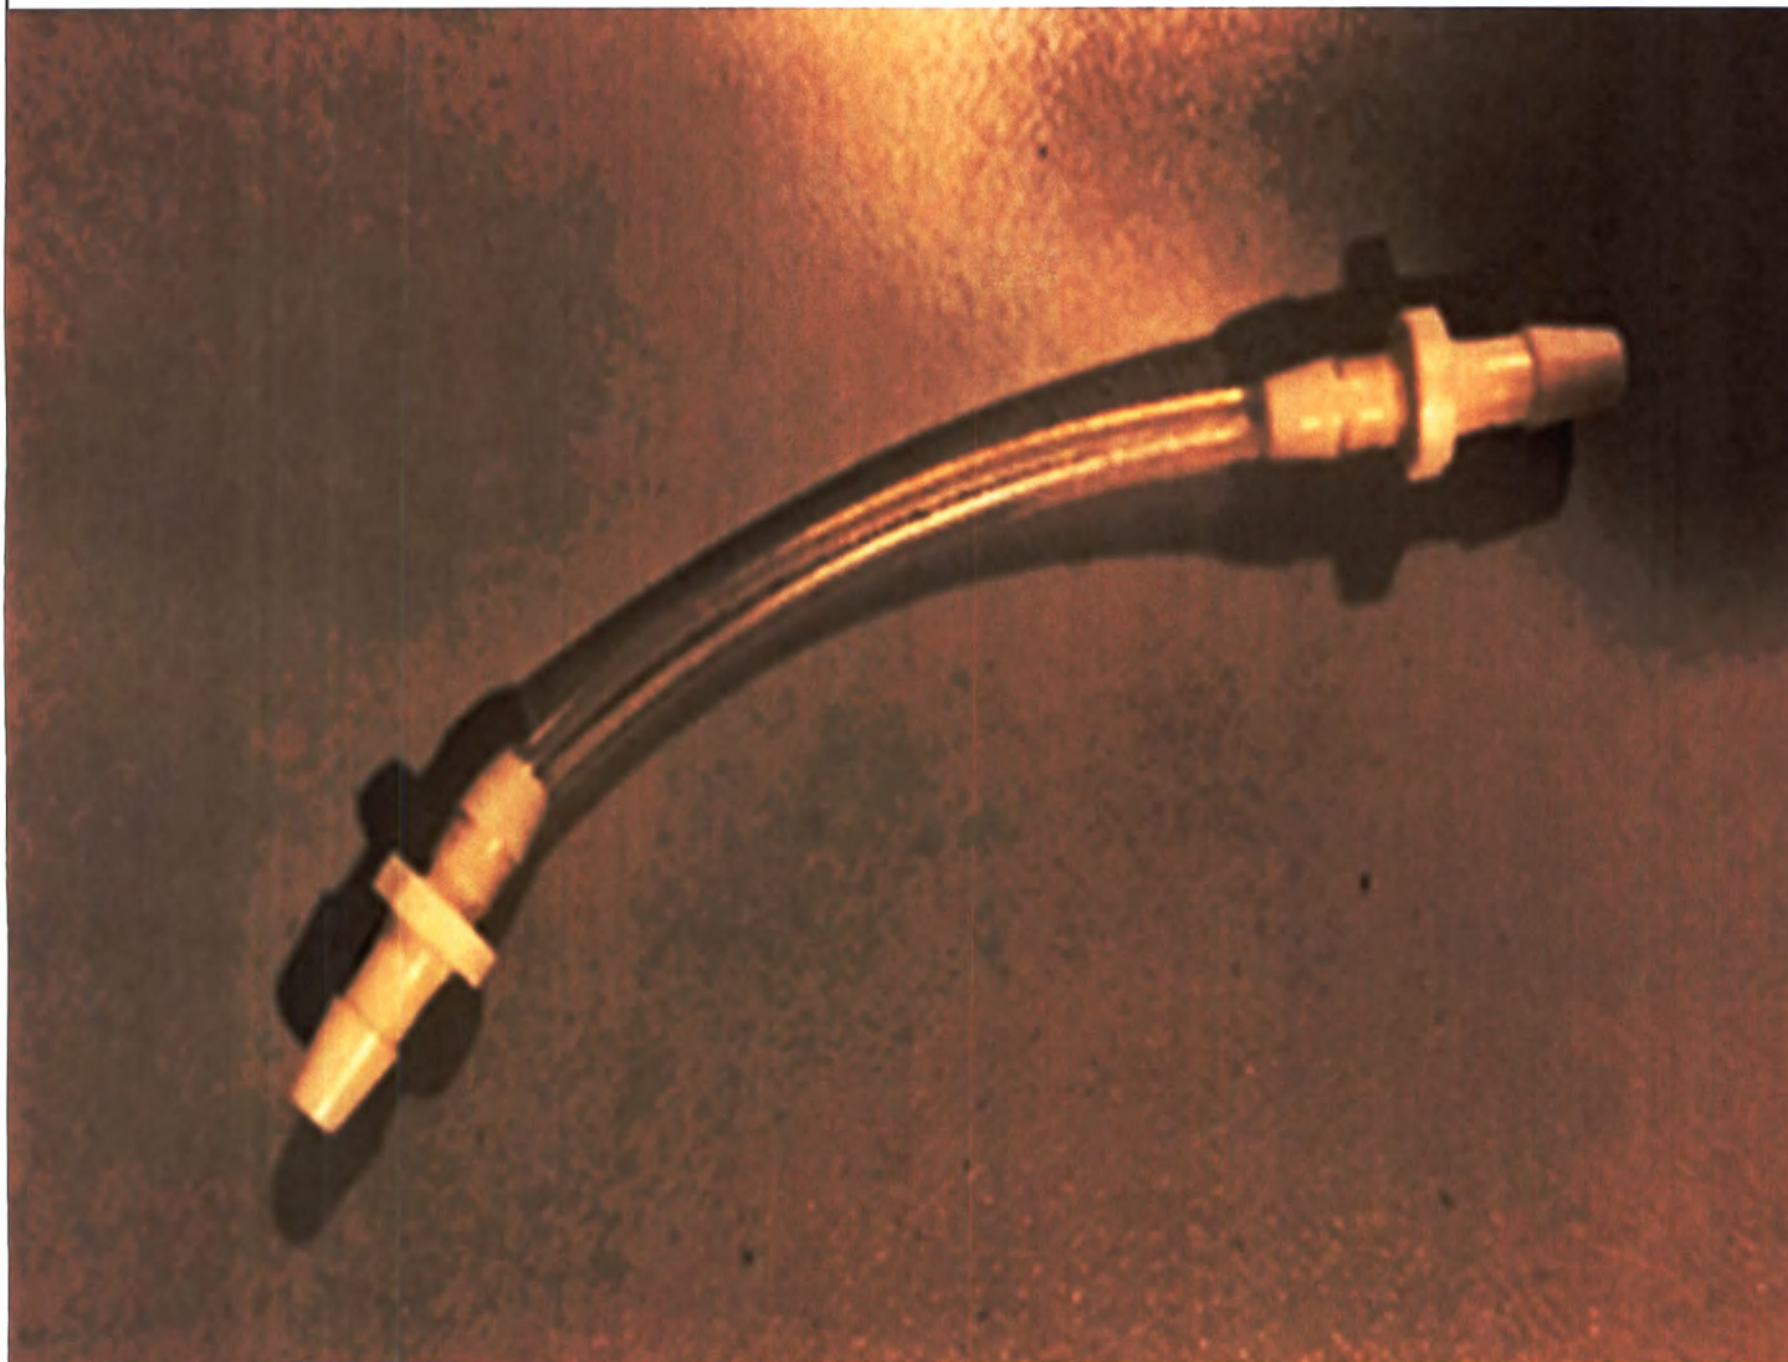

34.3 дозатор

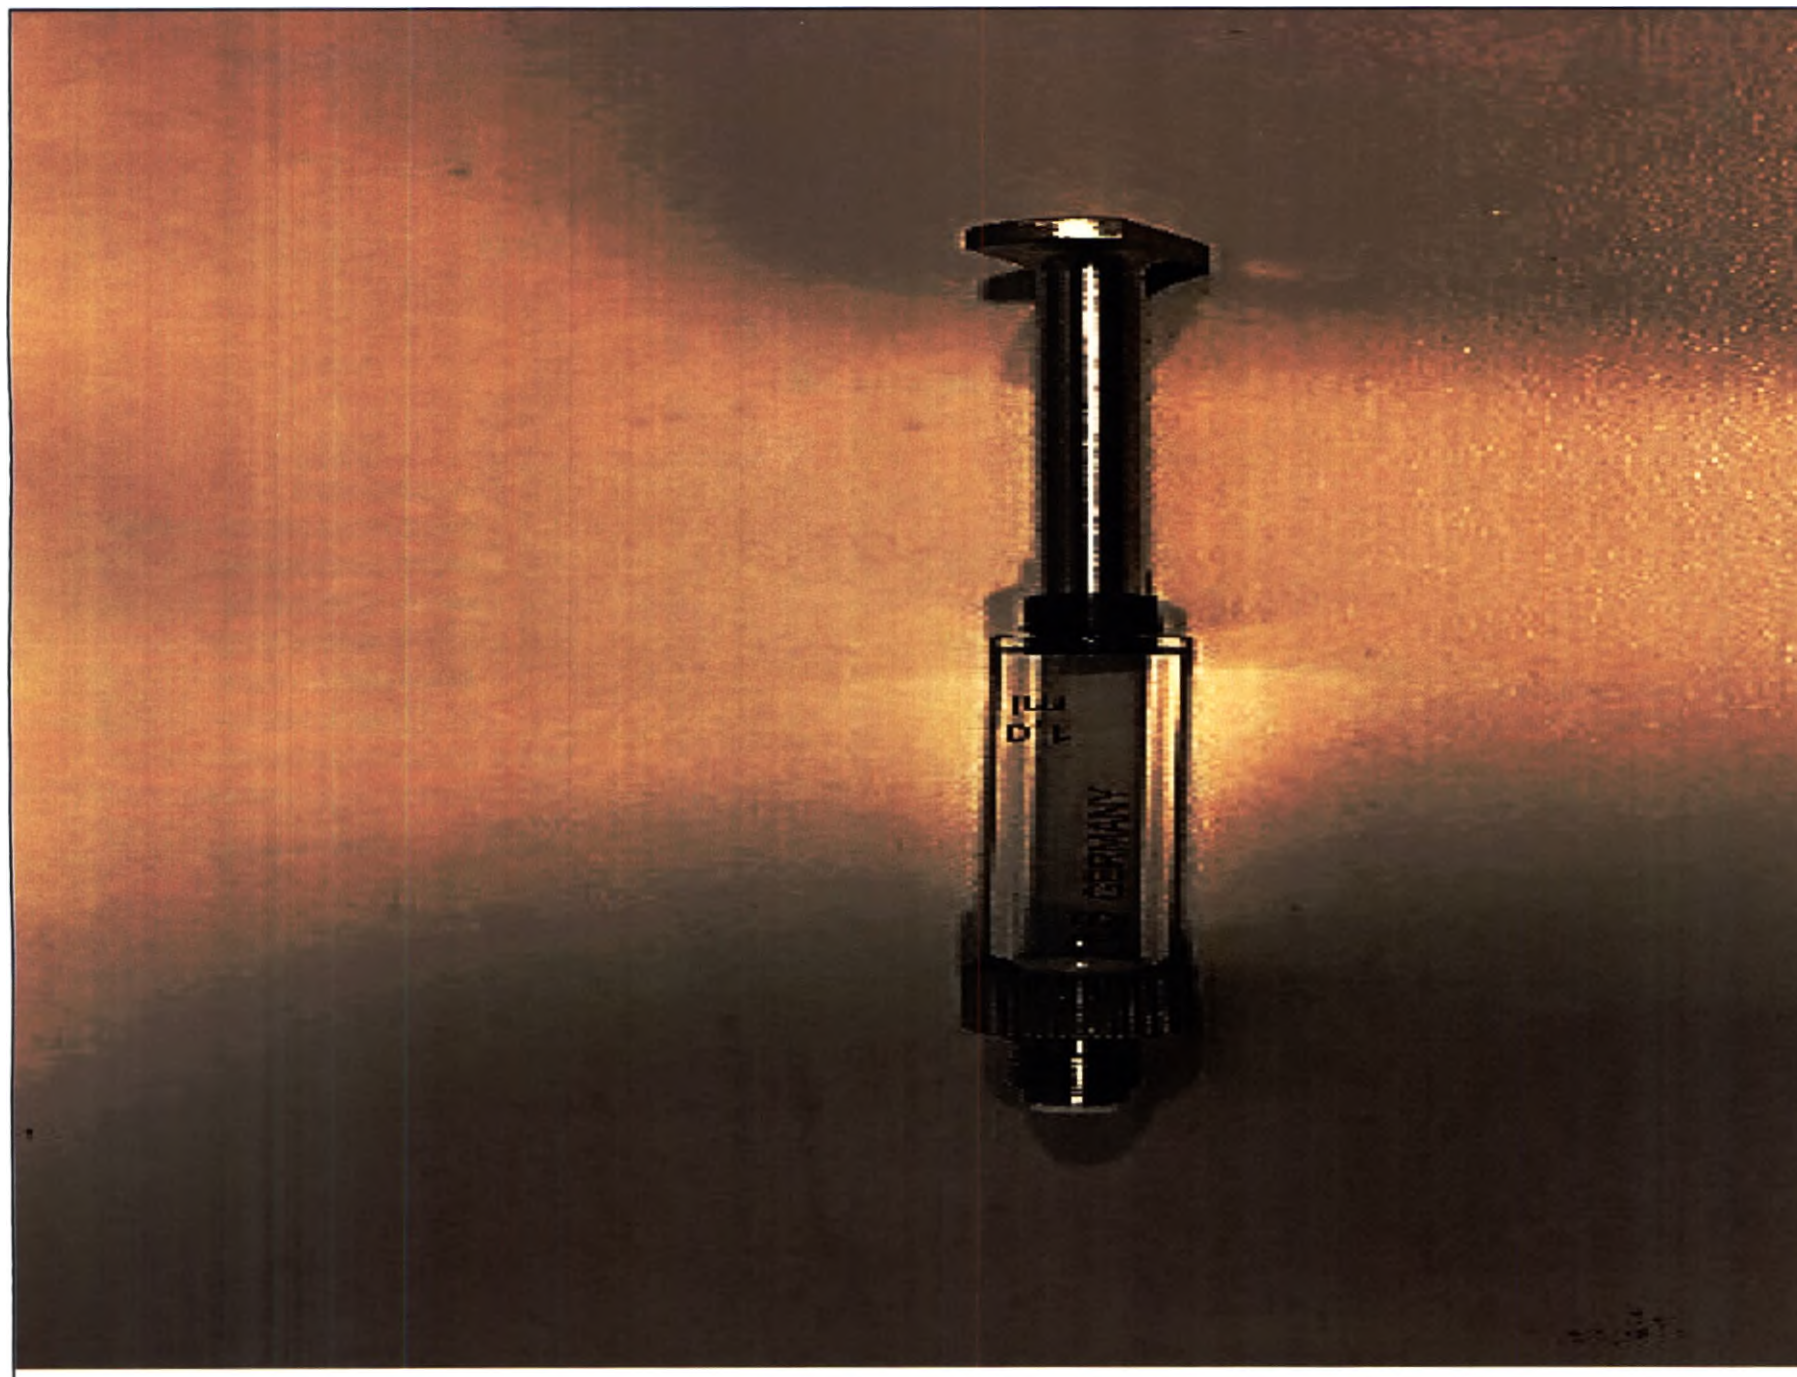


34.4 клапан 8-ходовой

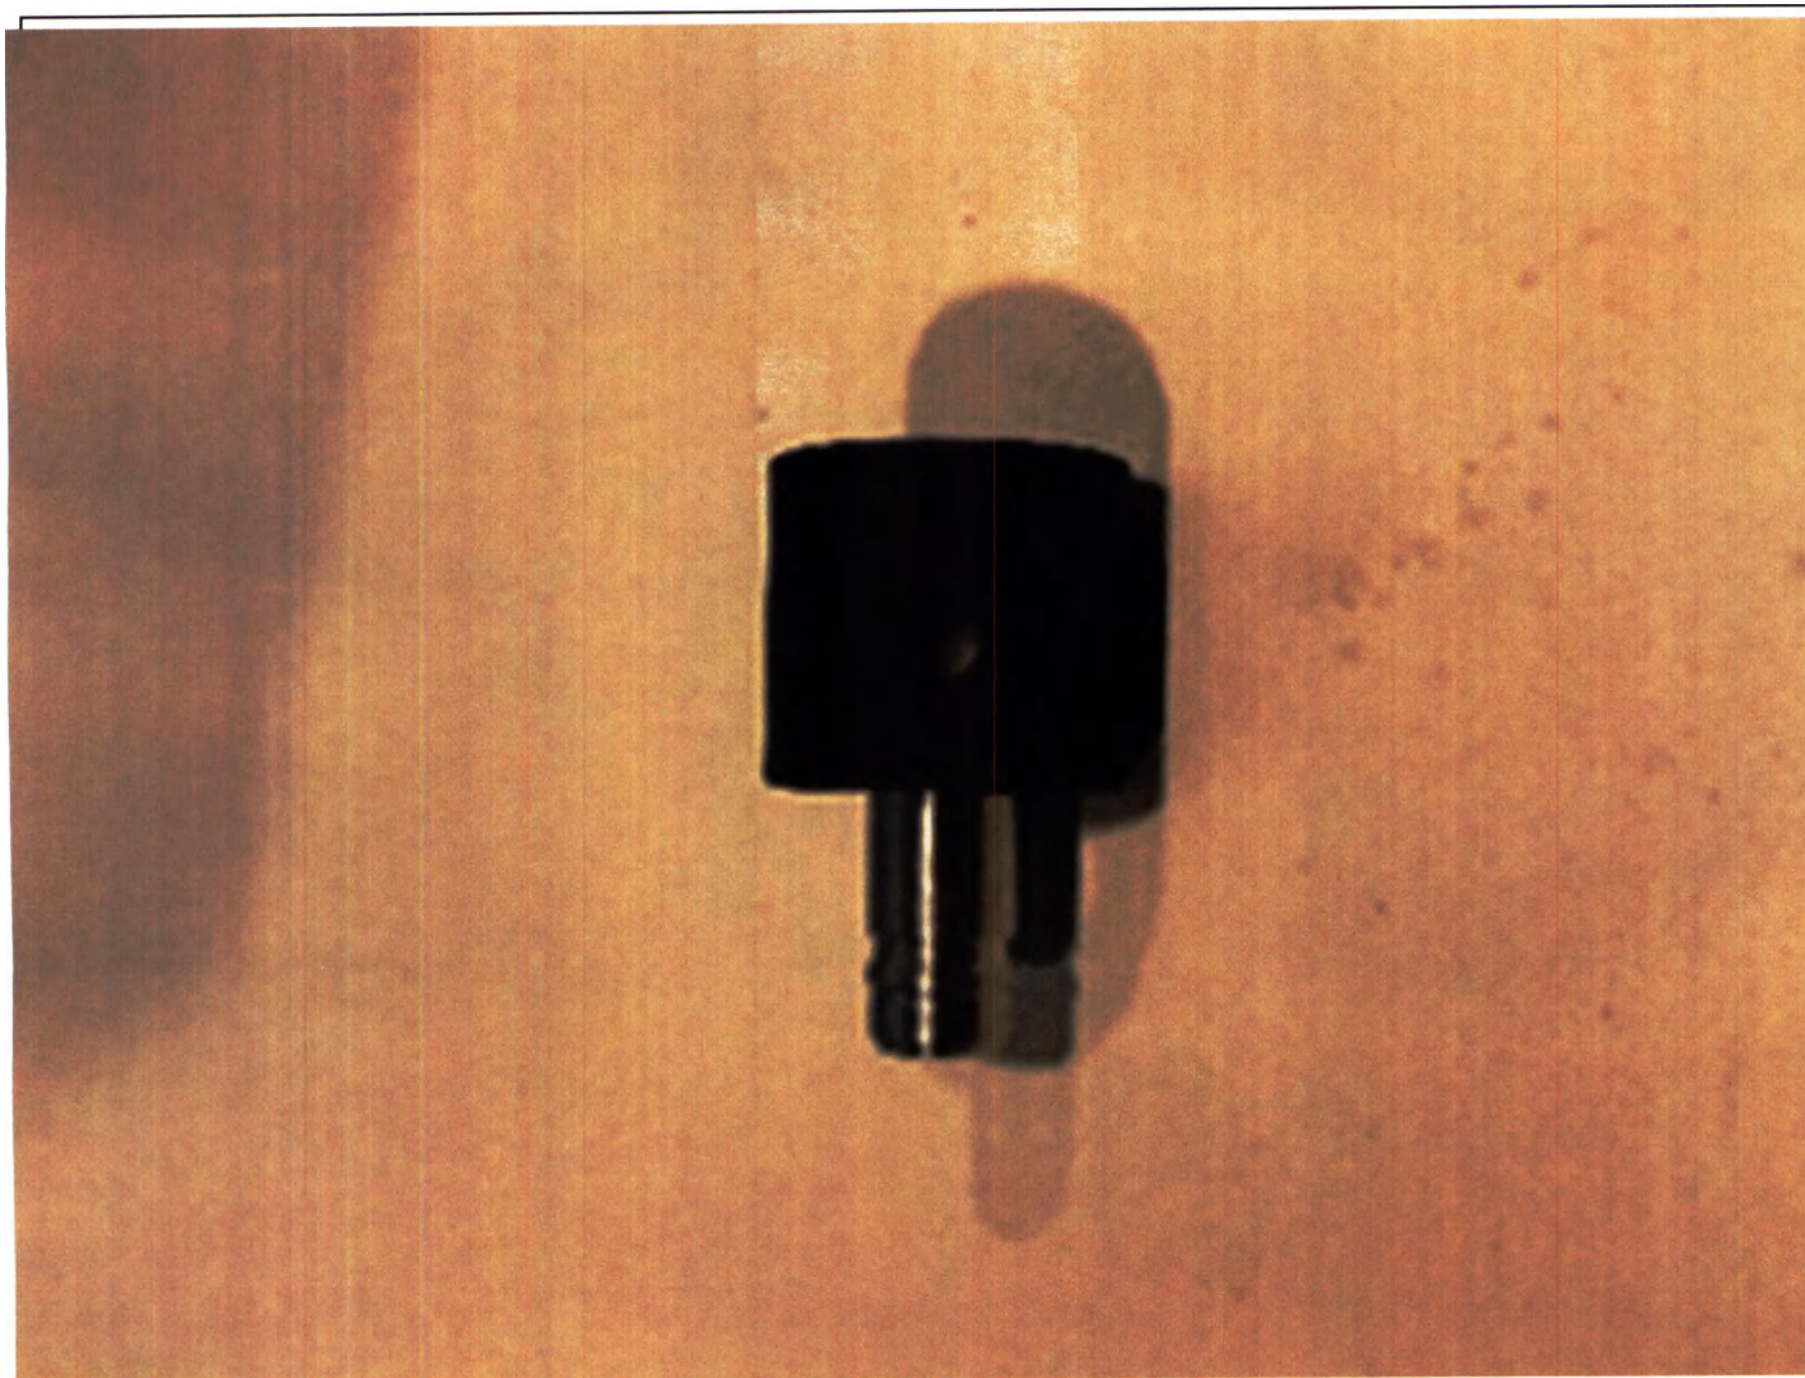


34.5 клапан 6-ходовой



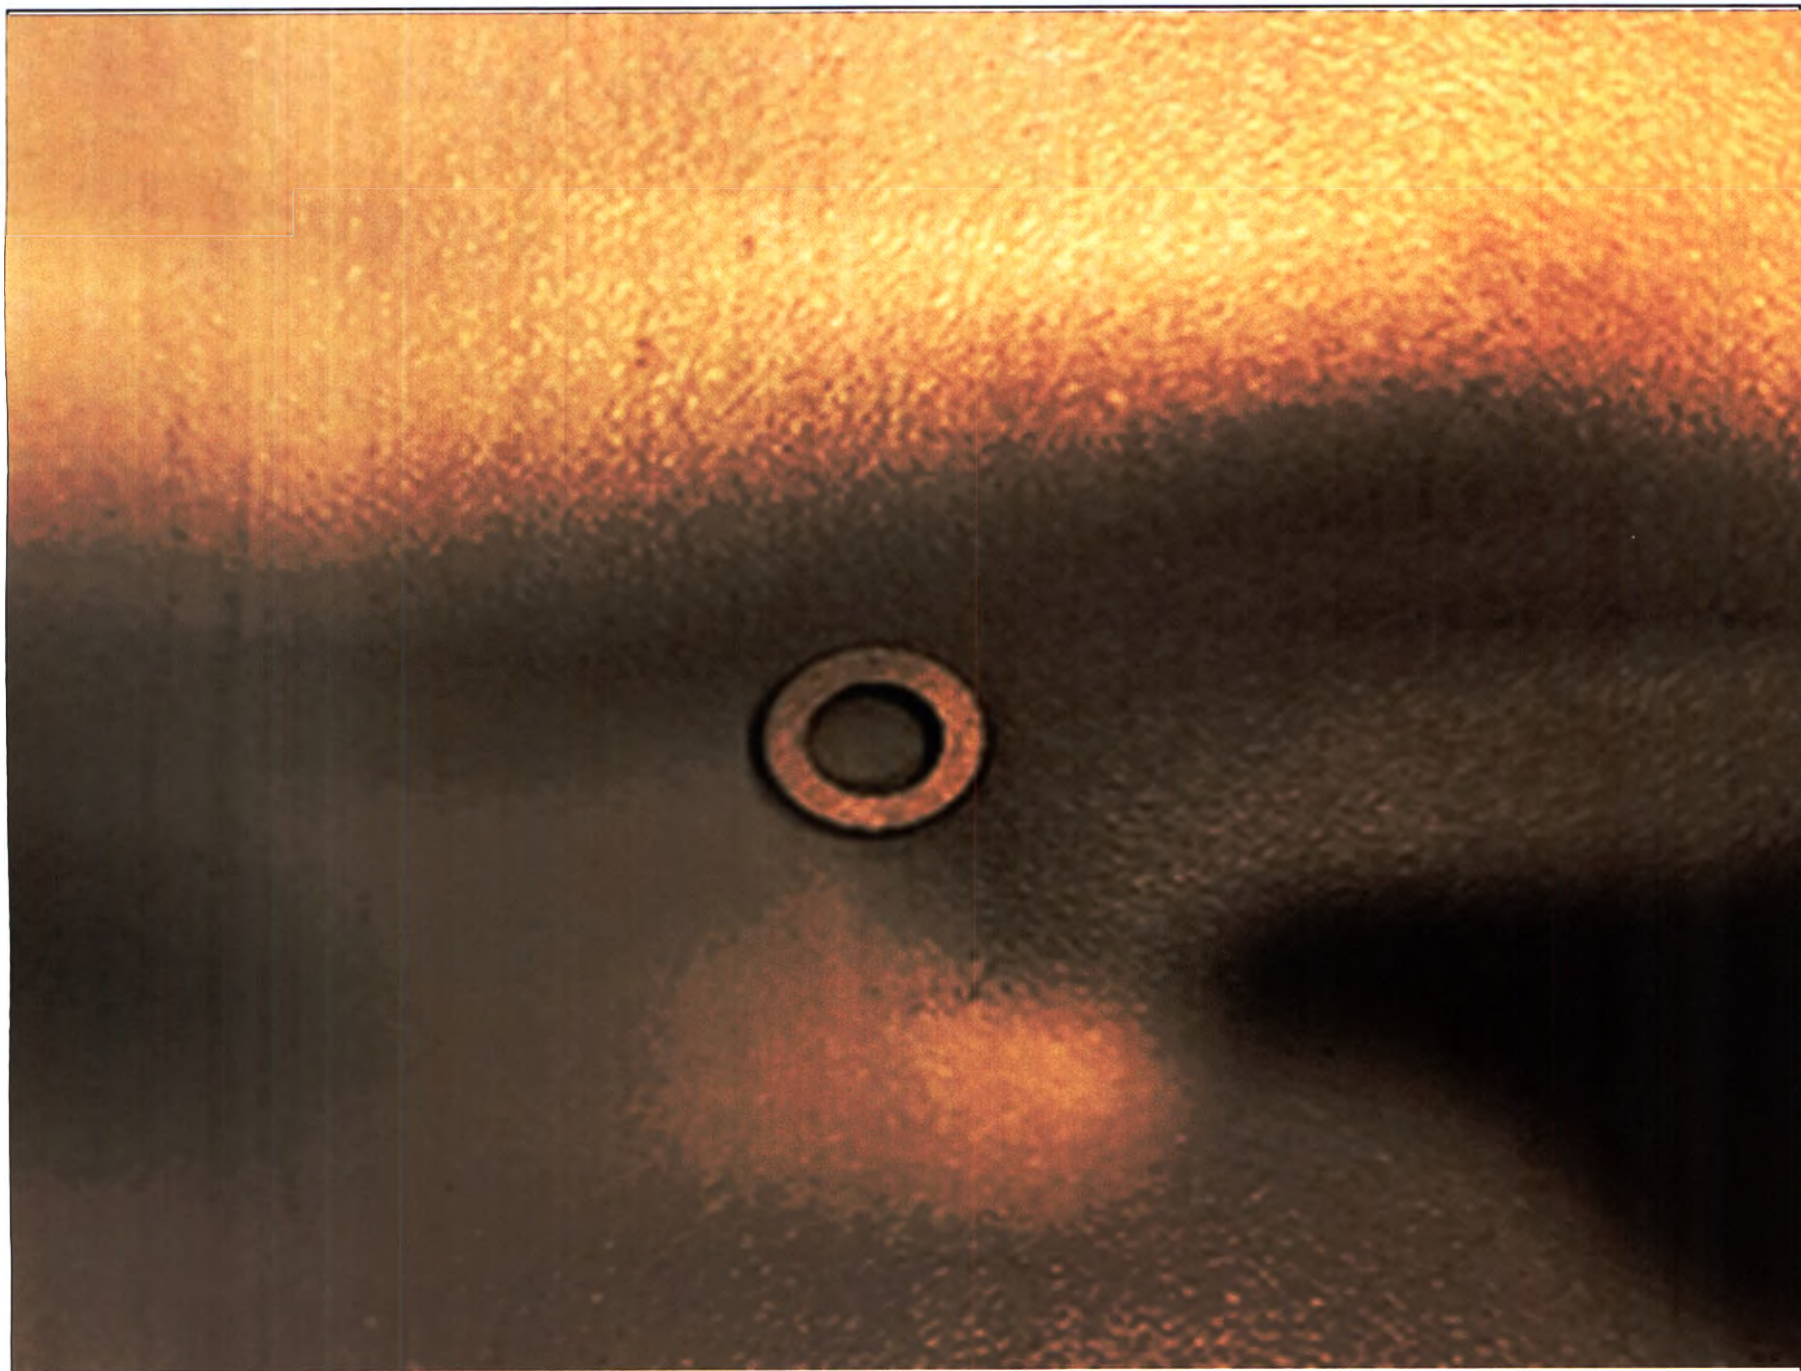

34.7 О-кольцо для крышки быстрого подсоединения

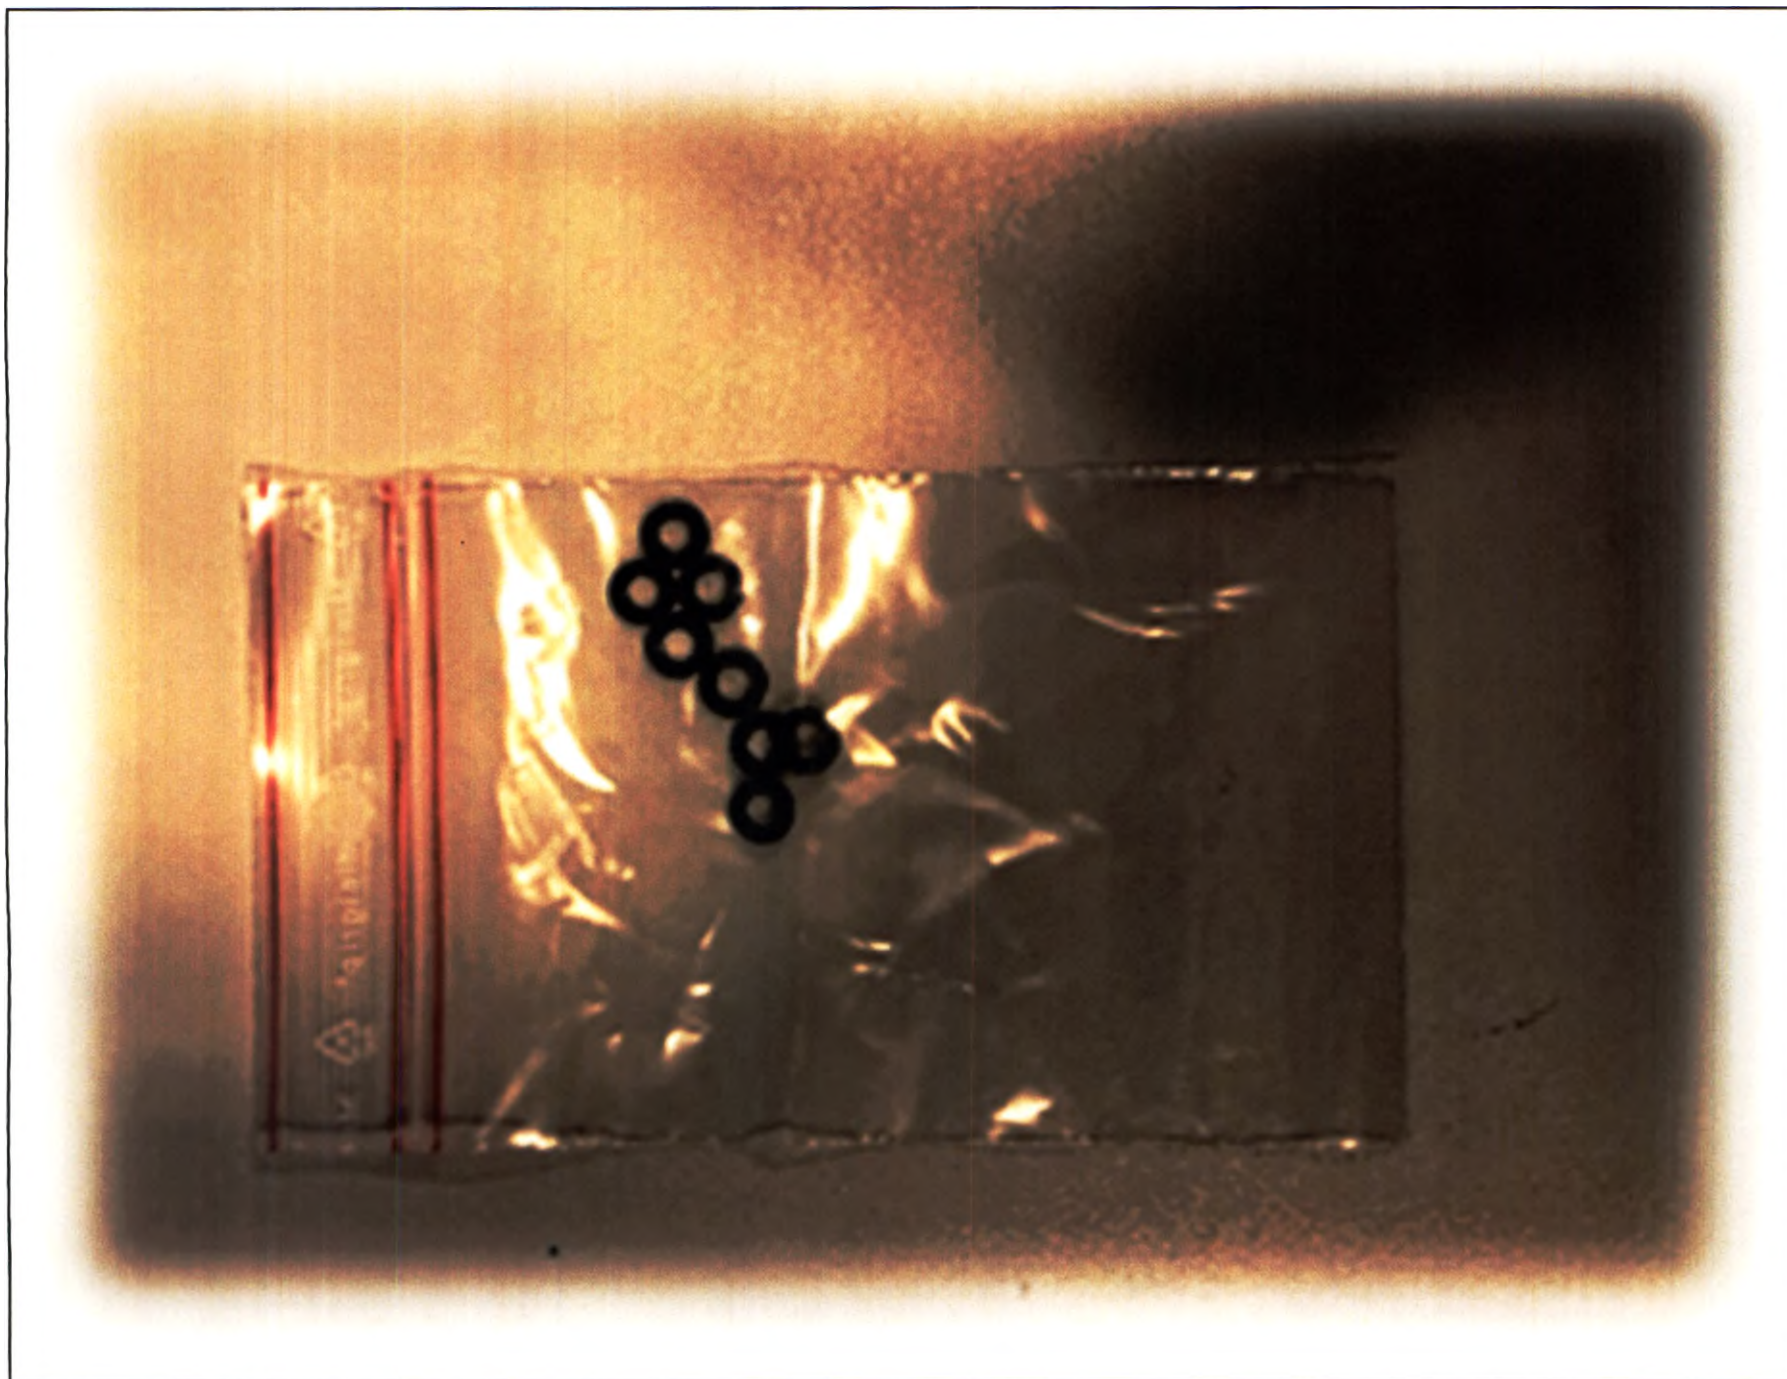








CAPILLARYS 3 TERA, в составе:

1. CAPILLARYS 3 TERA

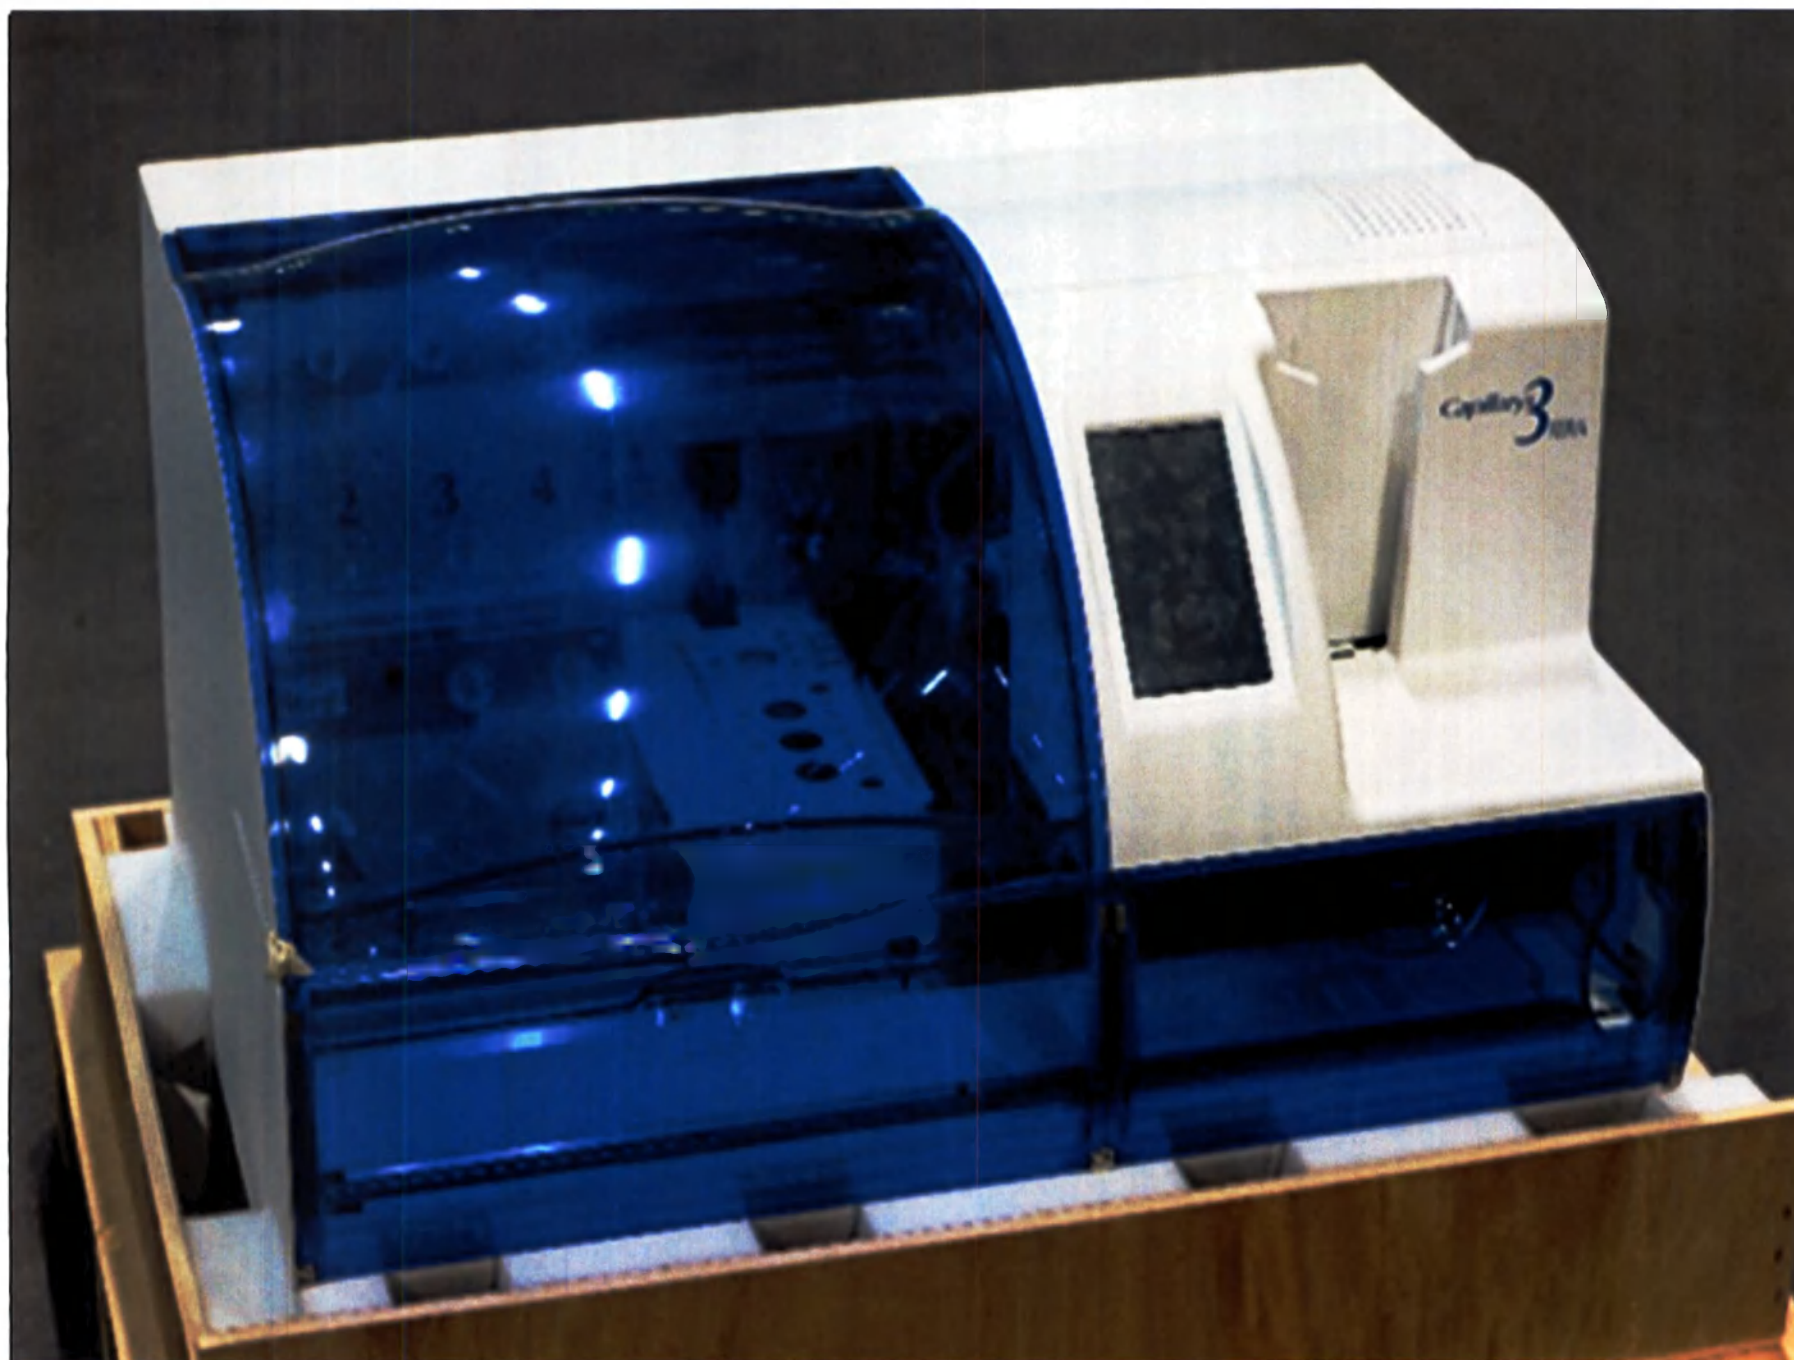


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**CAPILLARYS
3 TERA**

Код продукта 1246

Версия 1.20
2018/07

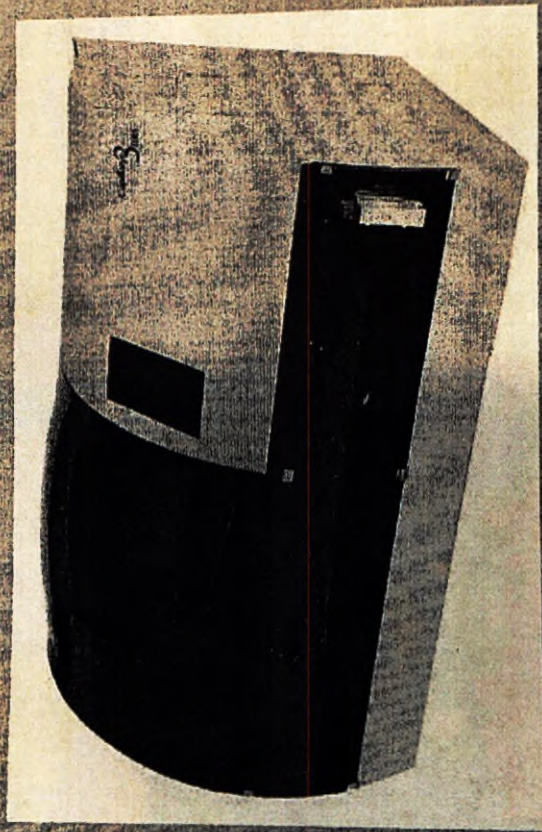

CE



sebia

sebla

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
 SAFETY INSTRUCTIONS
 SICHERHEITSHINWEISE
 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
 SÄKERHETSINSTRUKTIONER
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 SIGURNOSNE UPUTE
 SAUGOS INSTRUKCIJOS
 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
 INSTRUȚIUNI DE SECURITATE
 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
 BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
 GÜVENLİK TALİMATLARI
 OBSAH
 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 SIKKERHETSINSTRUKSJONER
 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
 安全説明
 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 安全に関する説明
 DROŠĪBAS INSTRUKCIJA
 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

IVD

CE

2017/04

4. Кабель питания



5. Кабель для подключения к компьютеру



6. Кабель для подключения к сети



7. Коврик для компьютерной «мыши»



8. Комплект для настройки прибора, в составе:

8.1 сегмент для разведения прозрачный САРІ 3;


8.2 пробирка для гемолиза;

8.3 микропробирка;

8.4 пробирка с крышкой для контролей;


8.5 тубик с силиконовой смазкой.

8.1 сегмент для разведения прозрачный САРІ 3

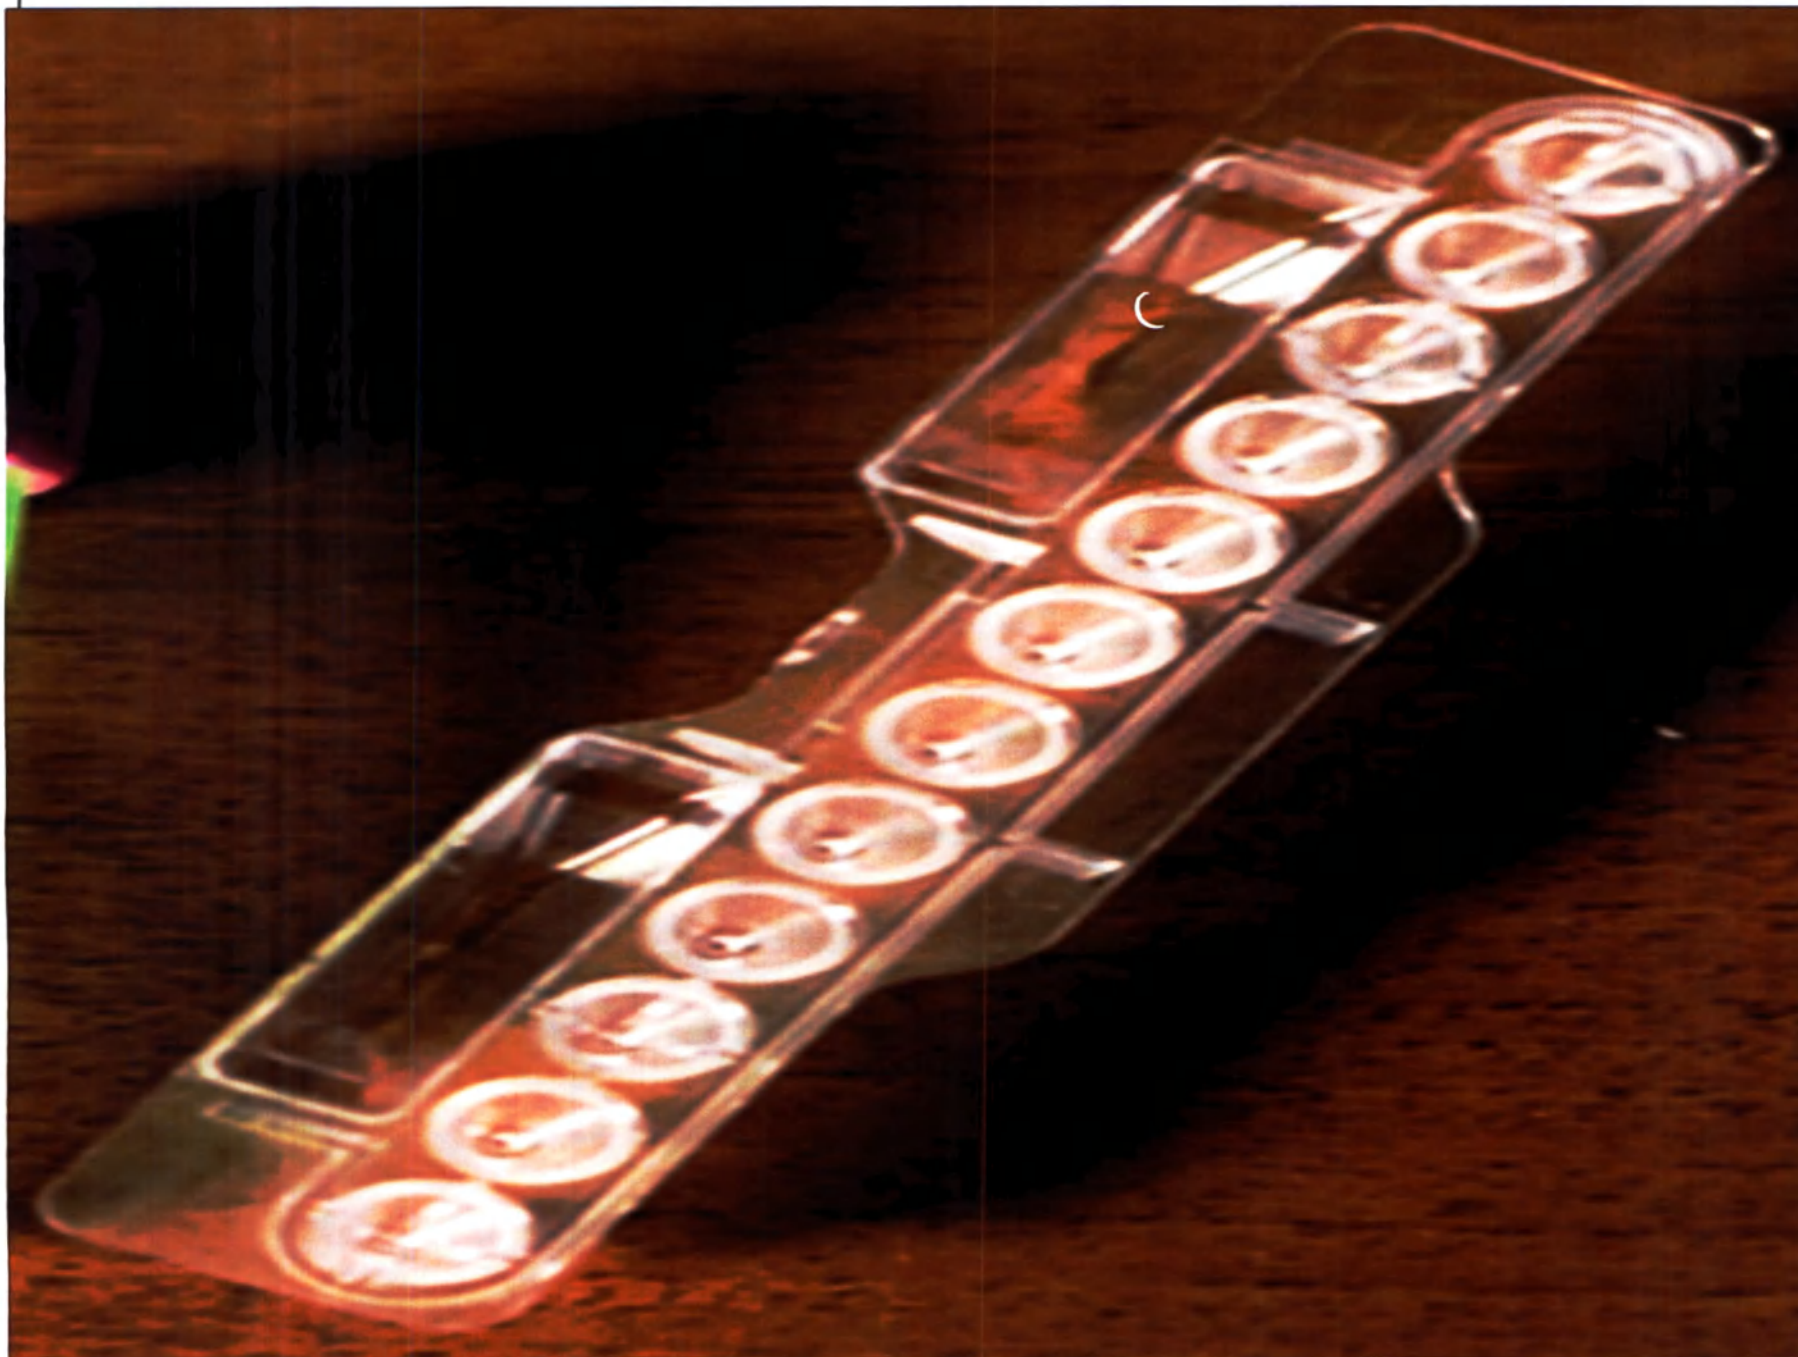


8.2 пробирка для гемолиза



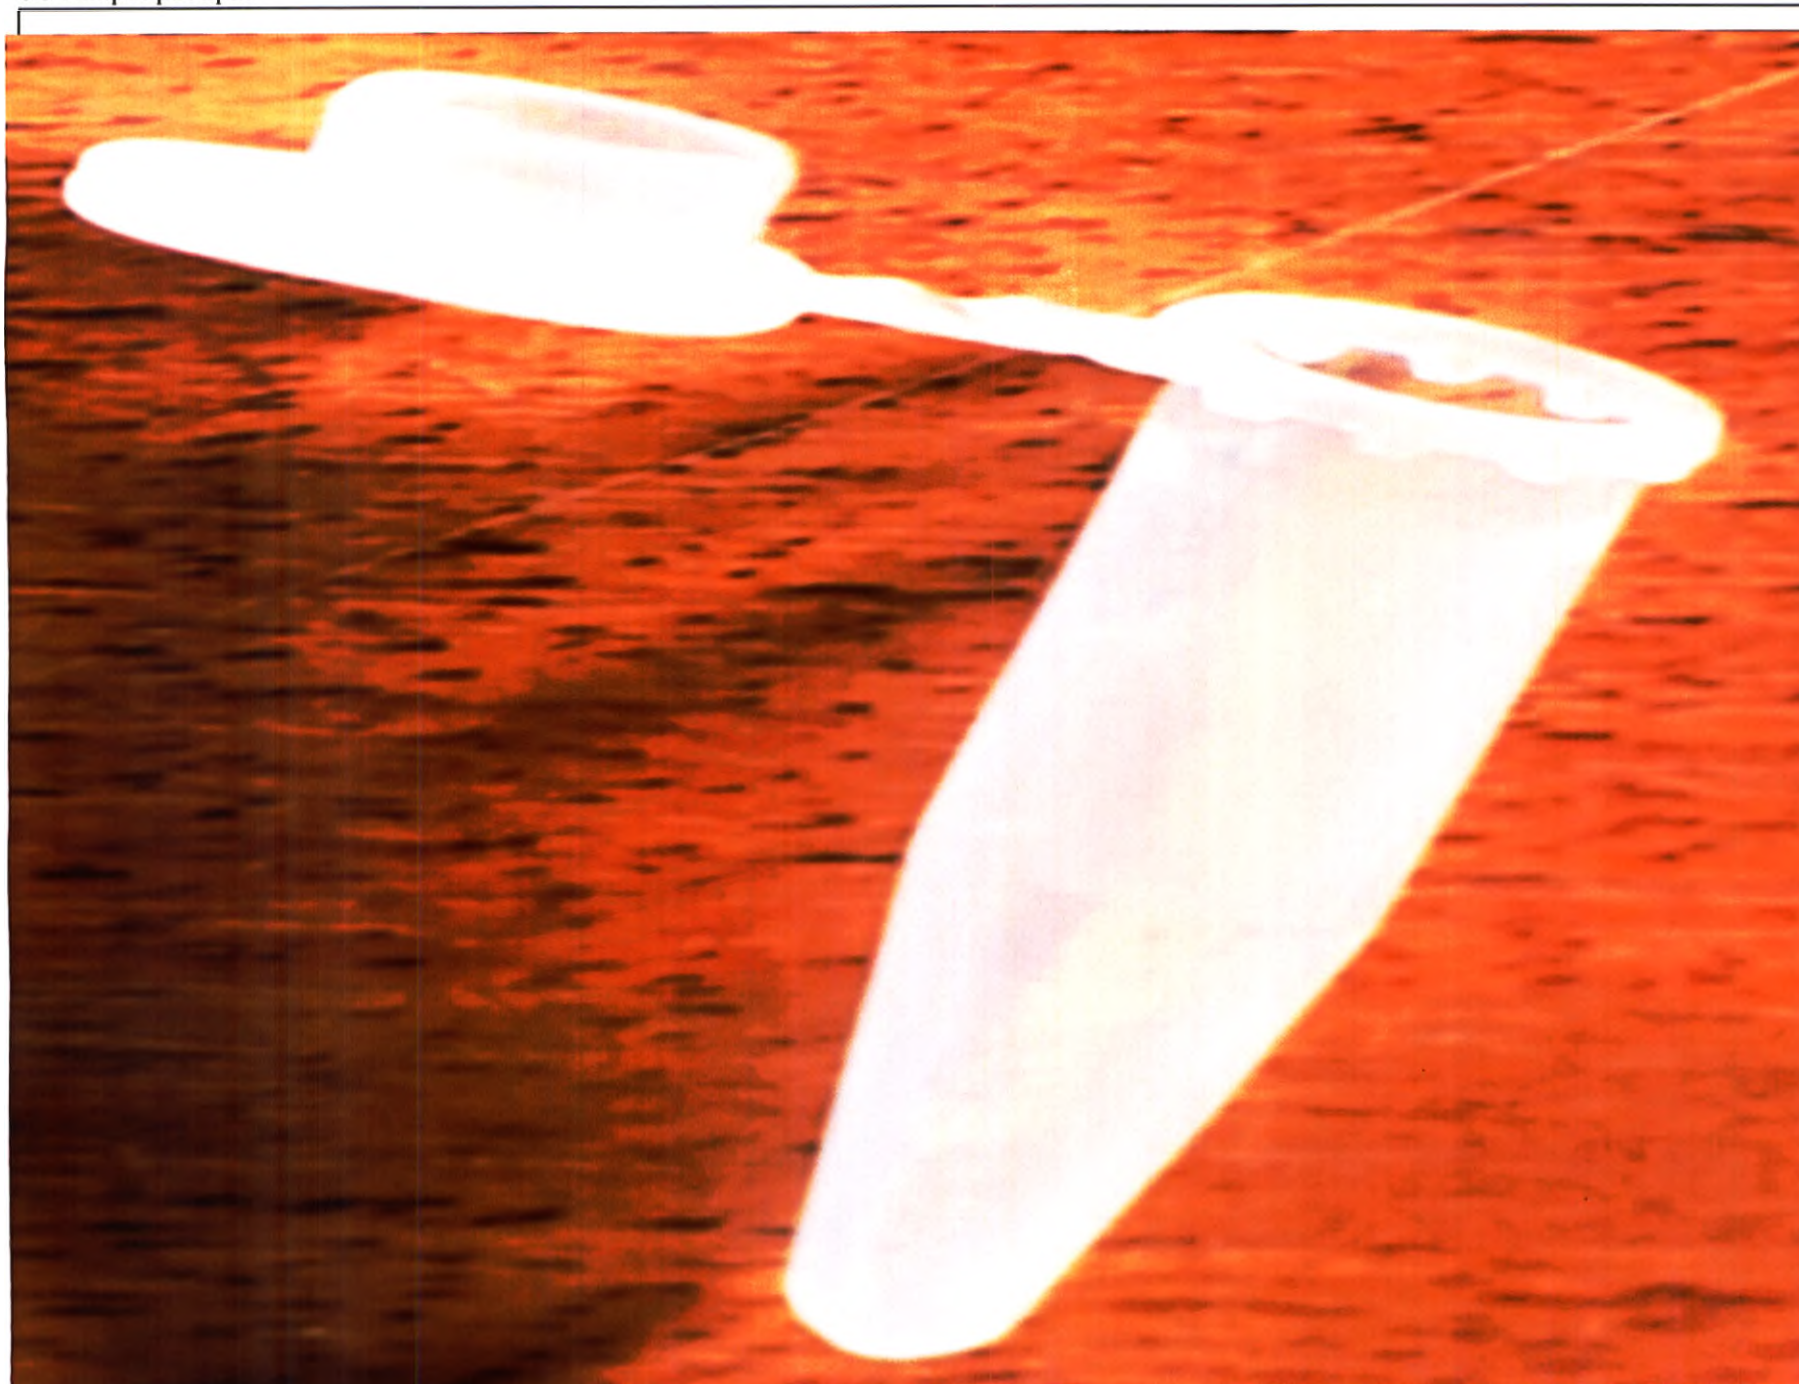

8.4 пробирка с крышкой для контролей

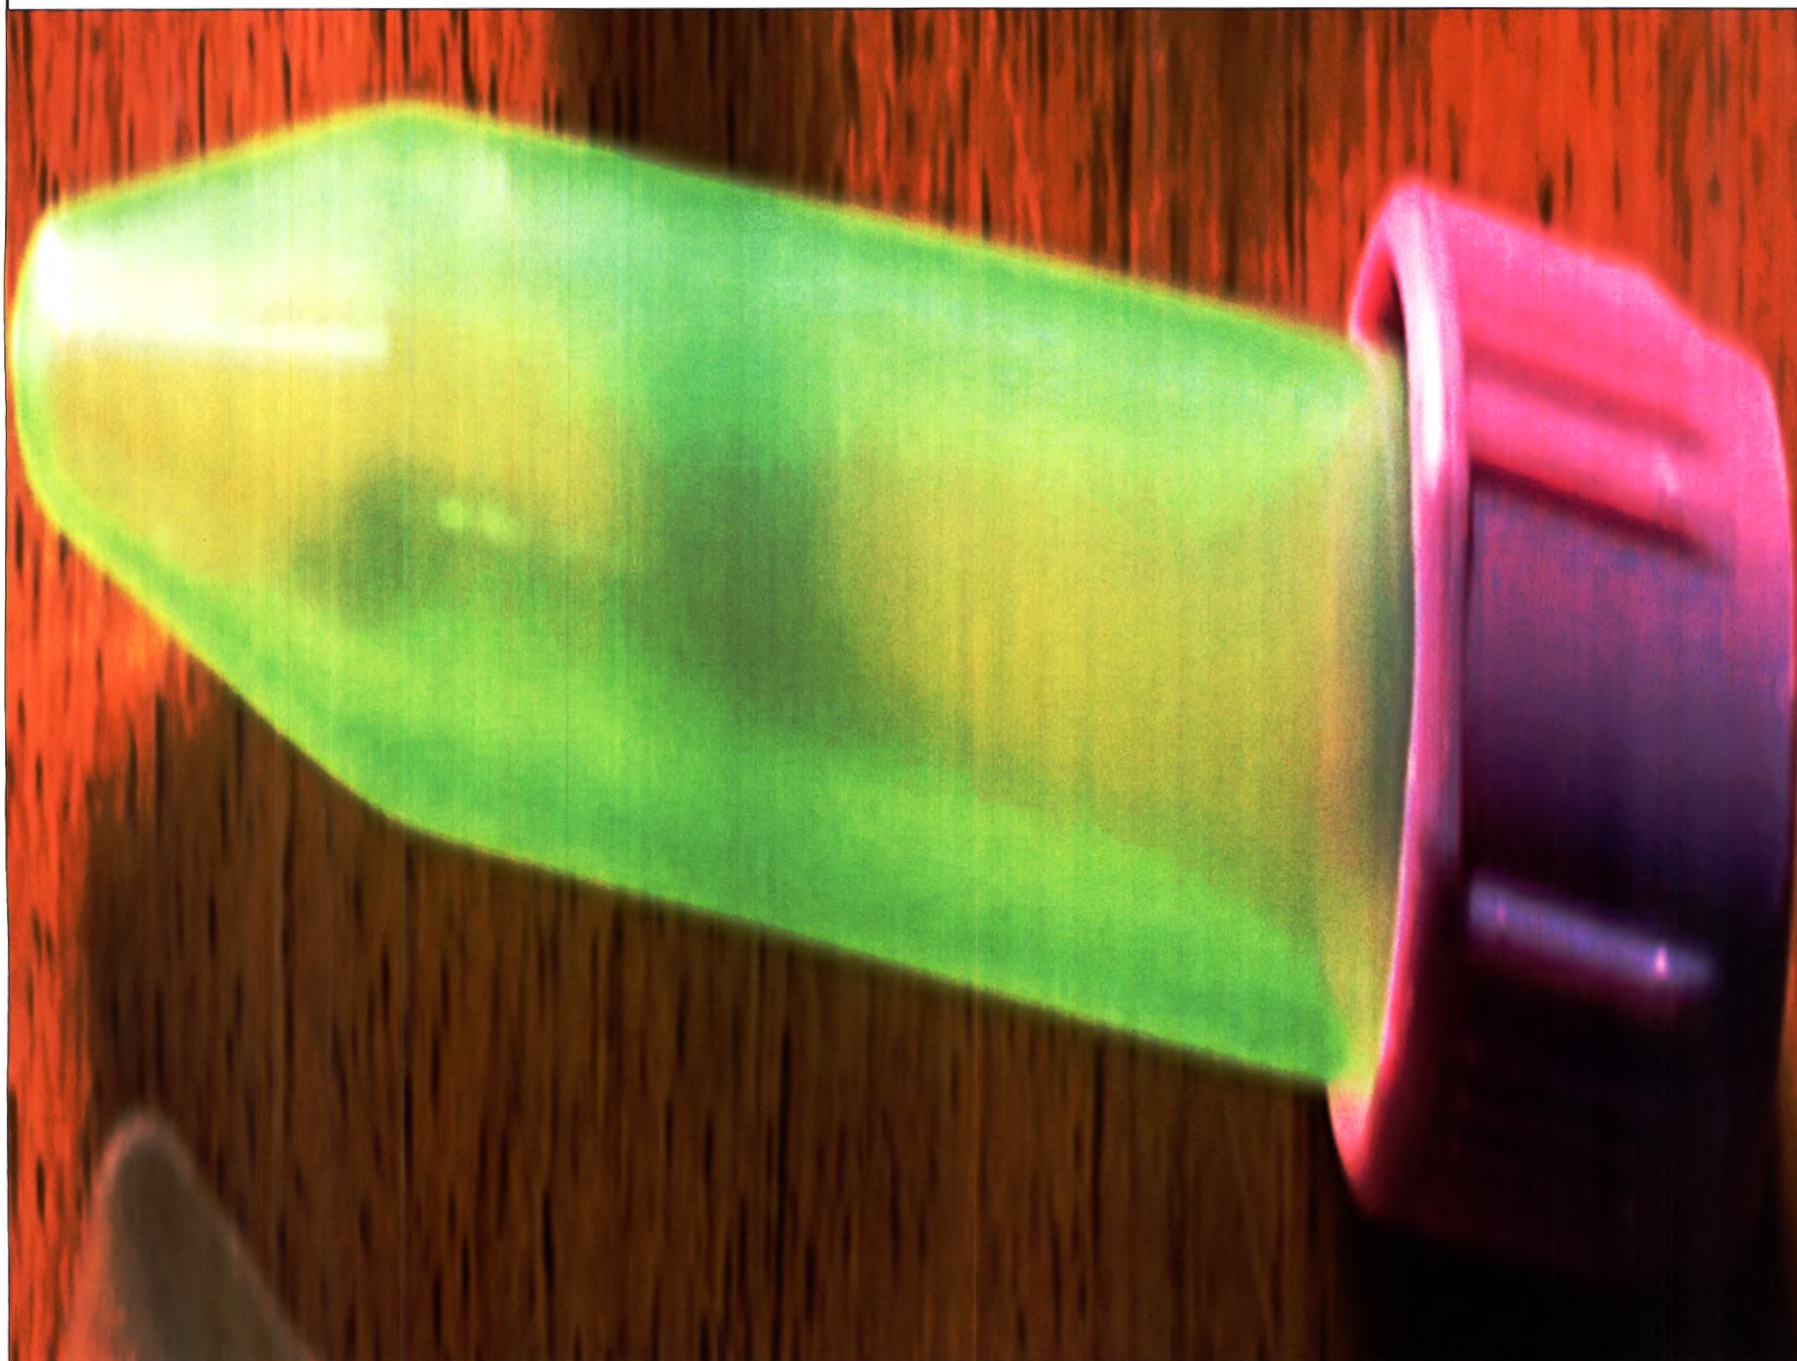



9. Контейнер для воды (Water)




10. Контейнер для промывочного раствора (Wash)



11. Контейнер для отходов внутренних




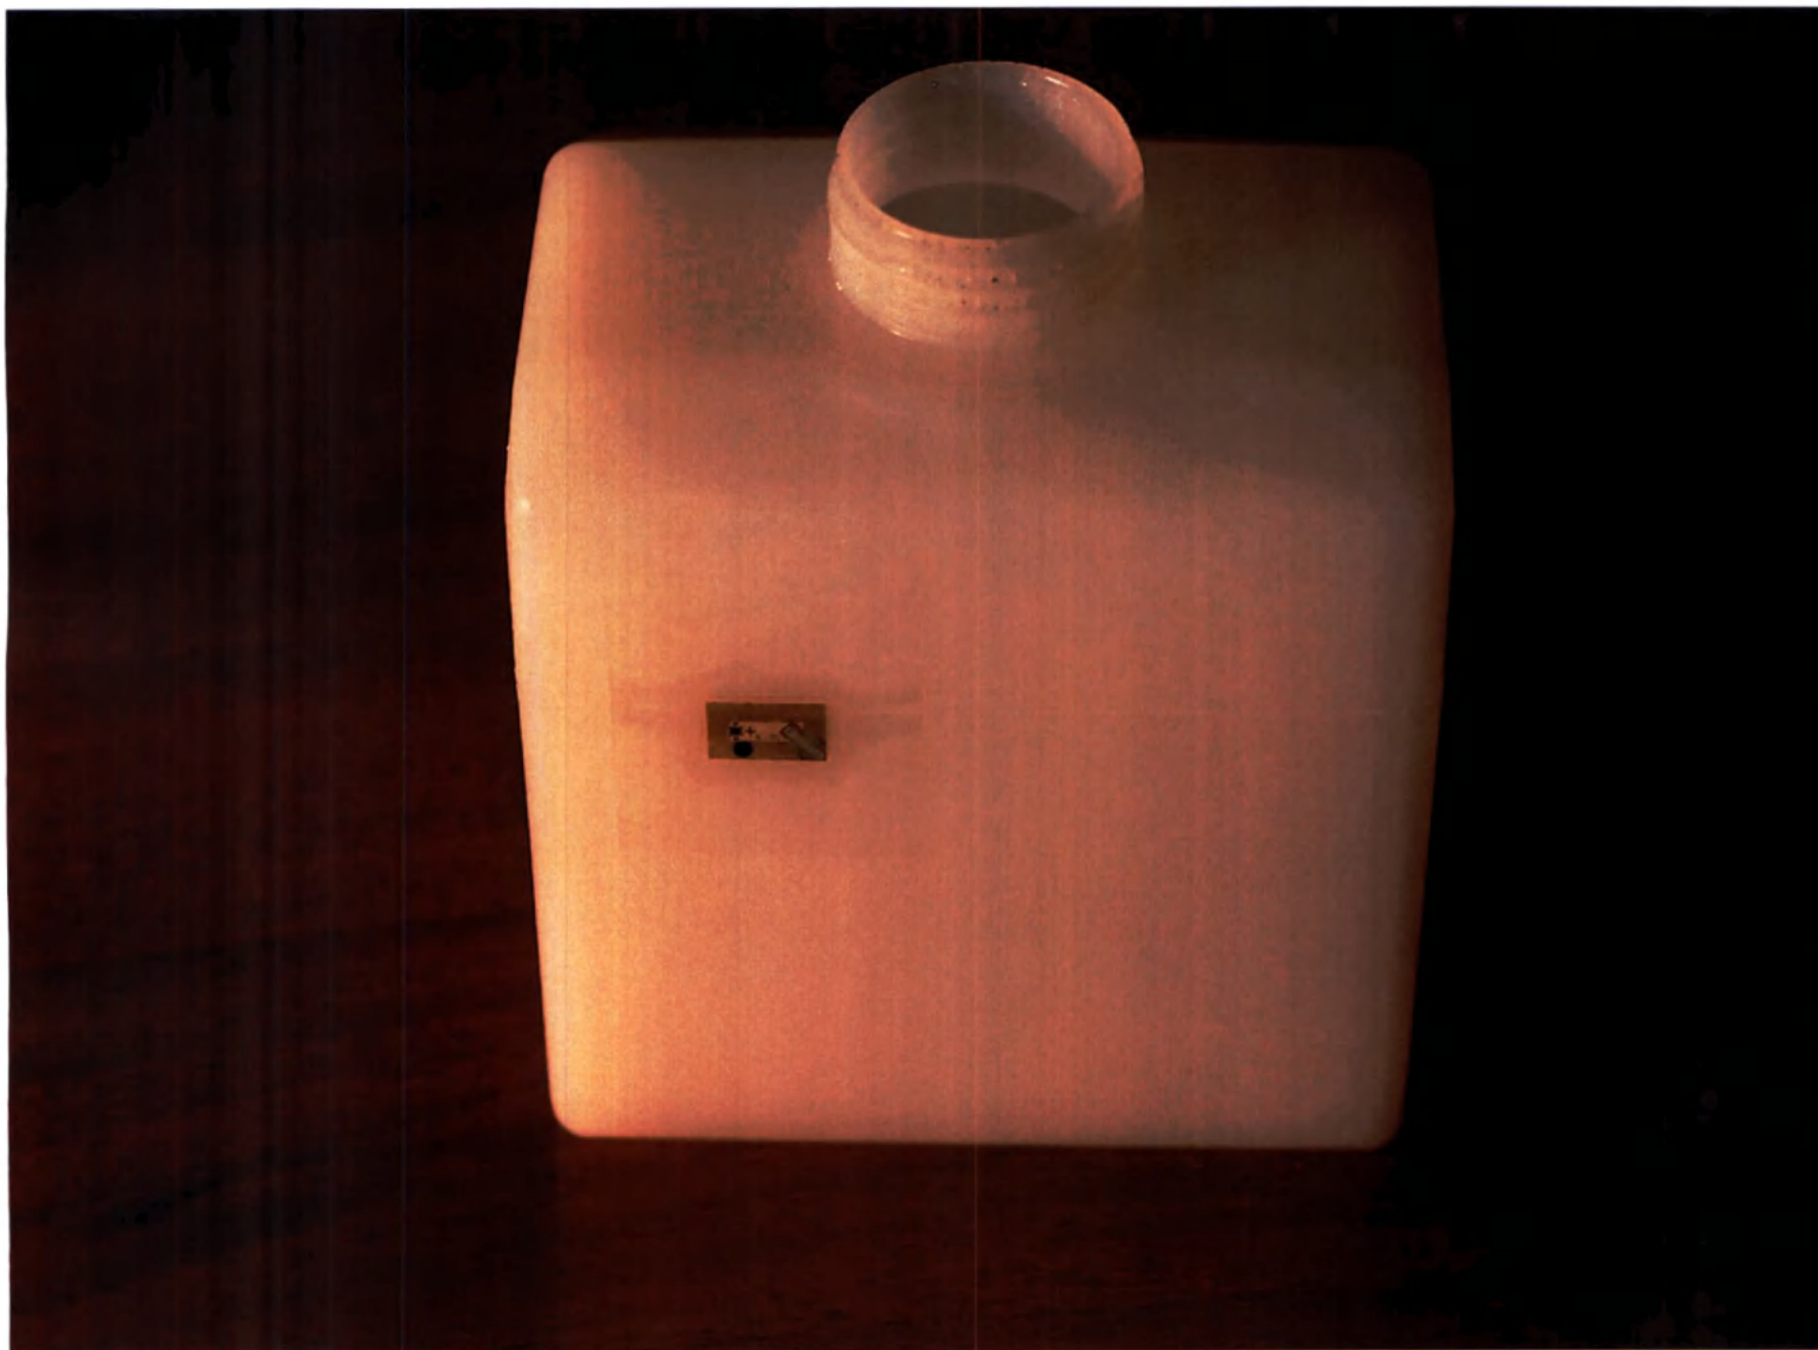

12. Контейнер на 750 мл для буферных и промывочных растворов



13. Контейнер для отходов внешний

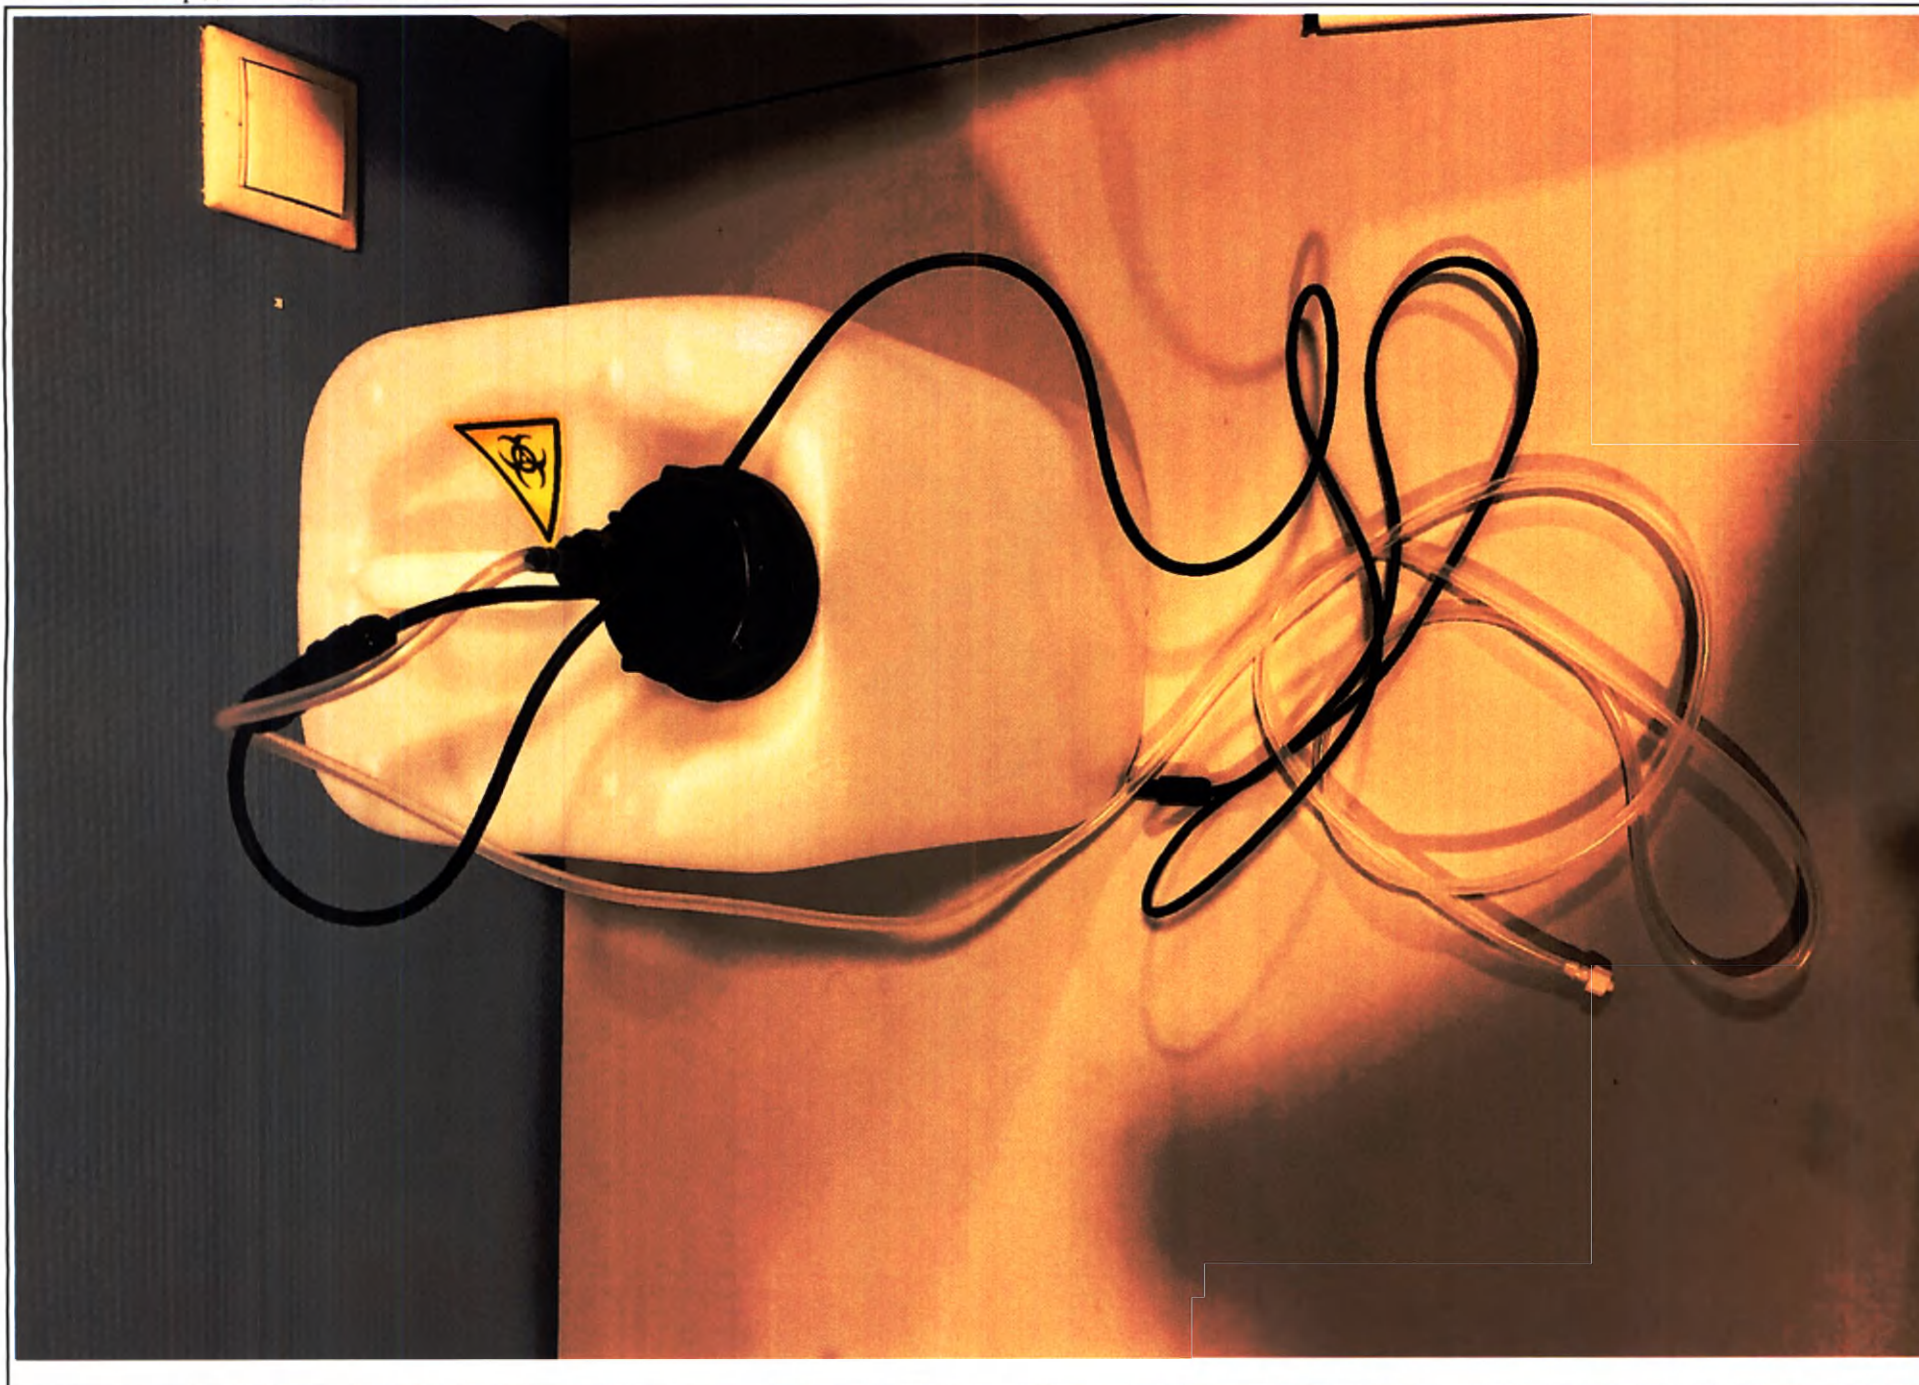

14. Контейнер для использованных сегментов для разведения САРІ 3




15. Принадлежности для подключения внешнего контейнера для отходов, в составе

15.1 трубочка;

15.2 датчик наполнения;

15.3 винт для крепления.

15.1 трубочка

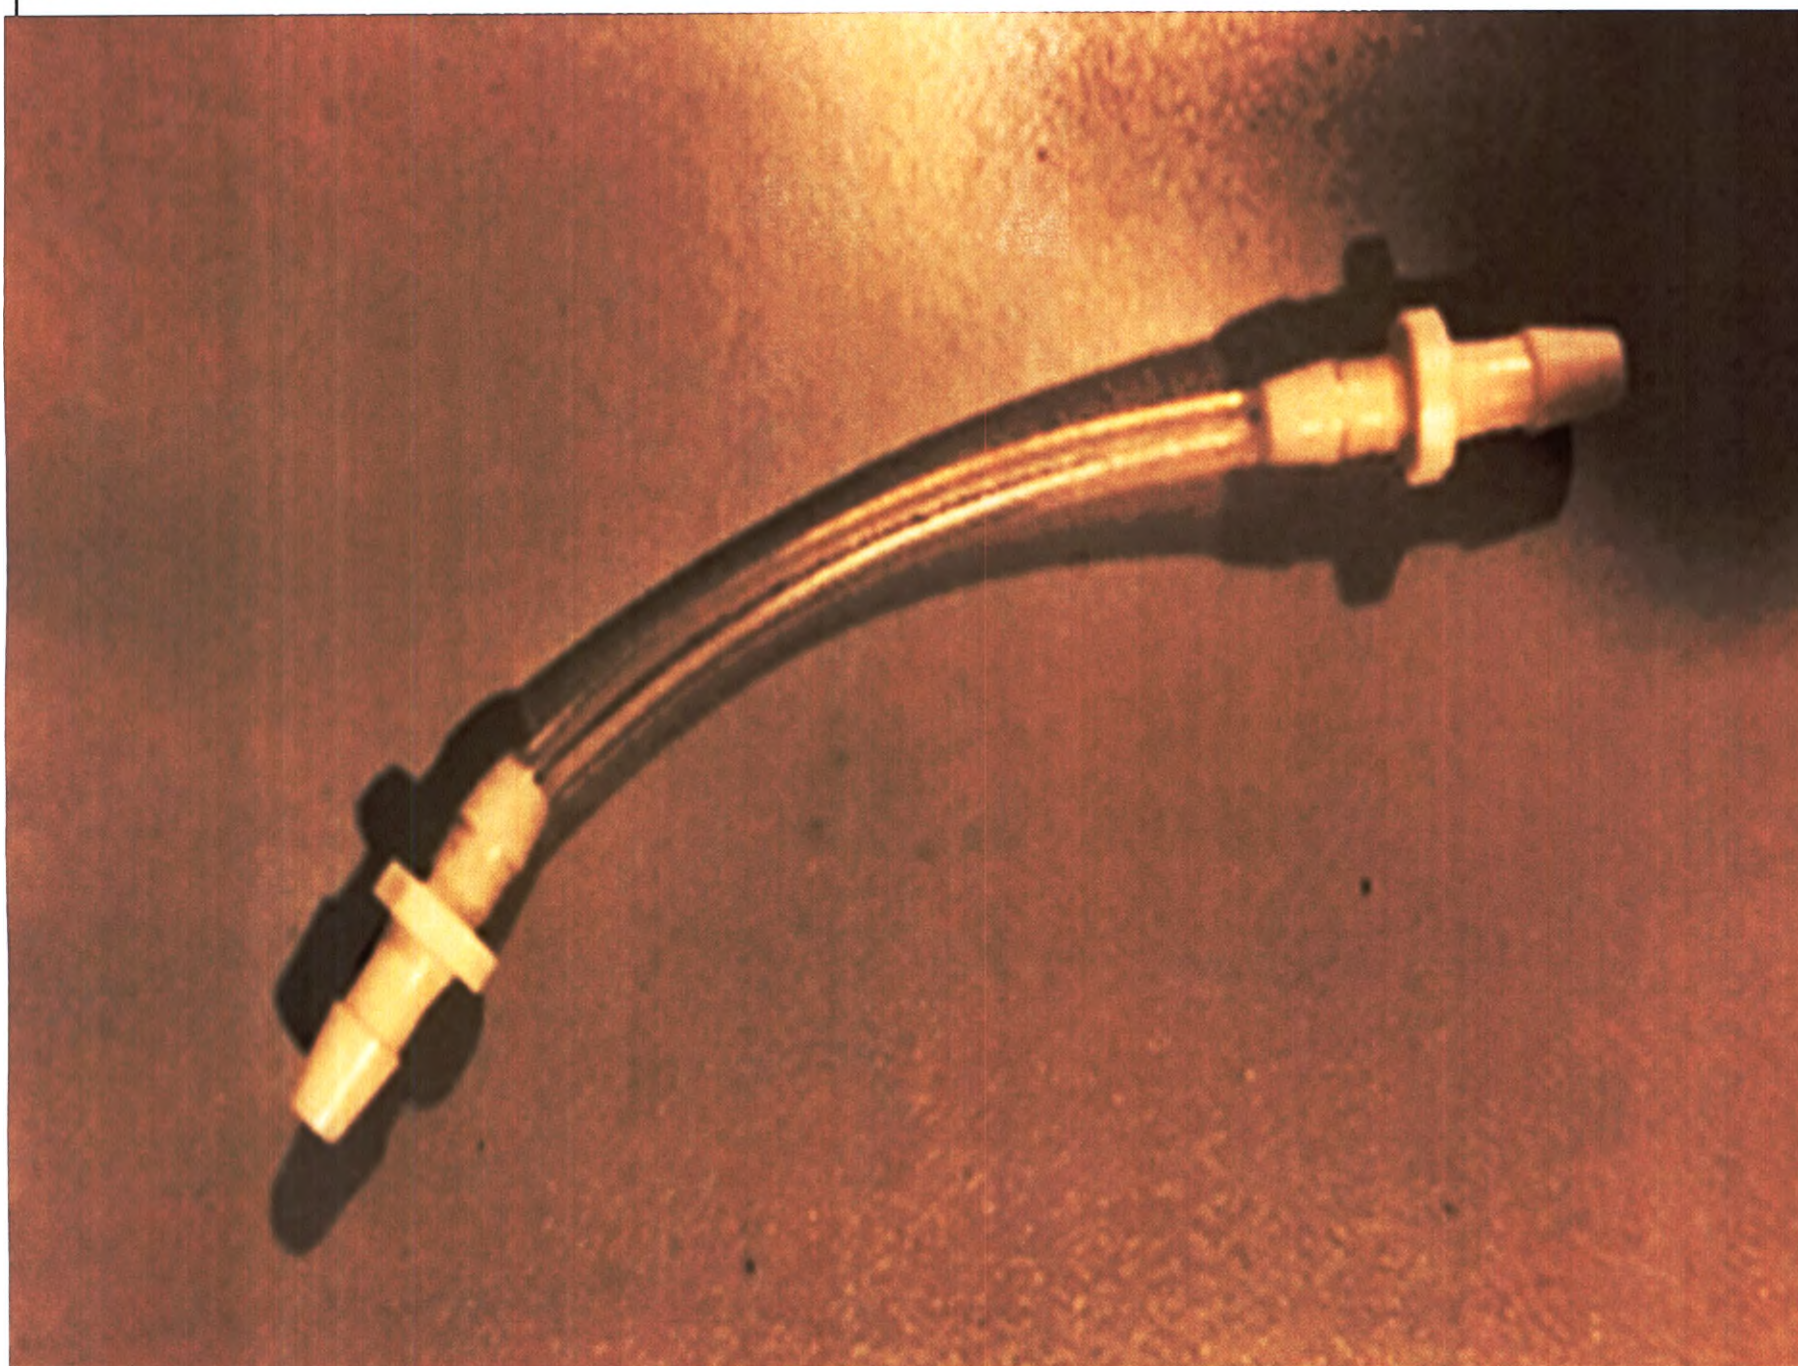

15.2 датчик наполнения



15.3 винт для крепления




16.1 элемент для сегментов металлический направляющий;

16.2 винт;

16.3 пластина для крепления.

16.1 элемент для сегментов металлический направляющий

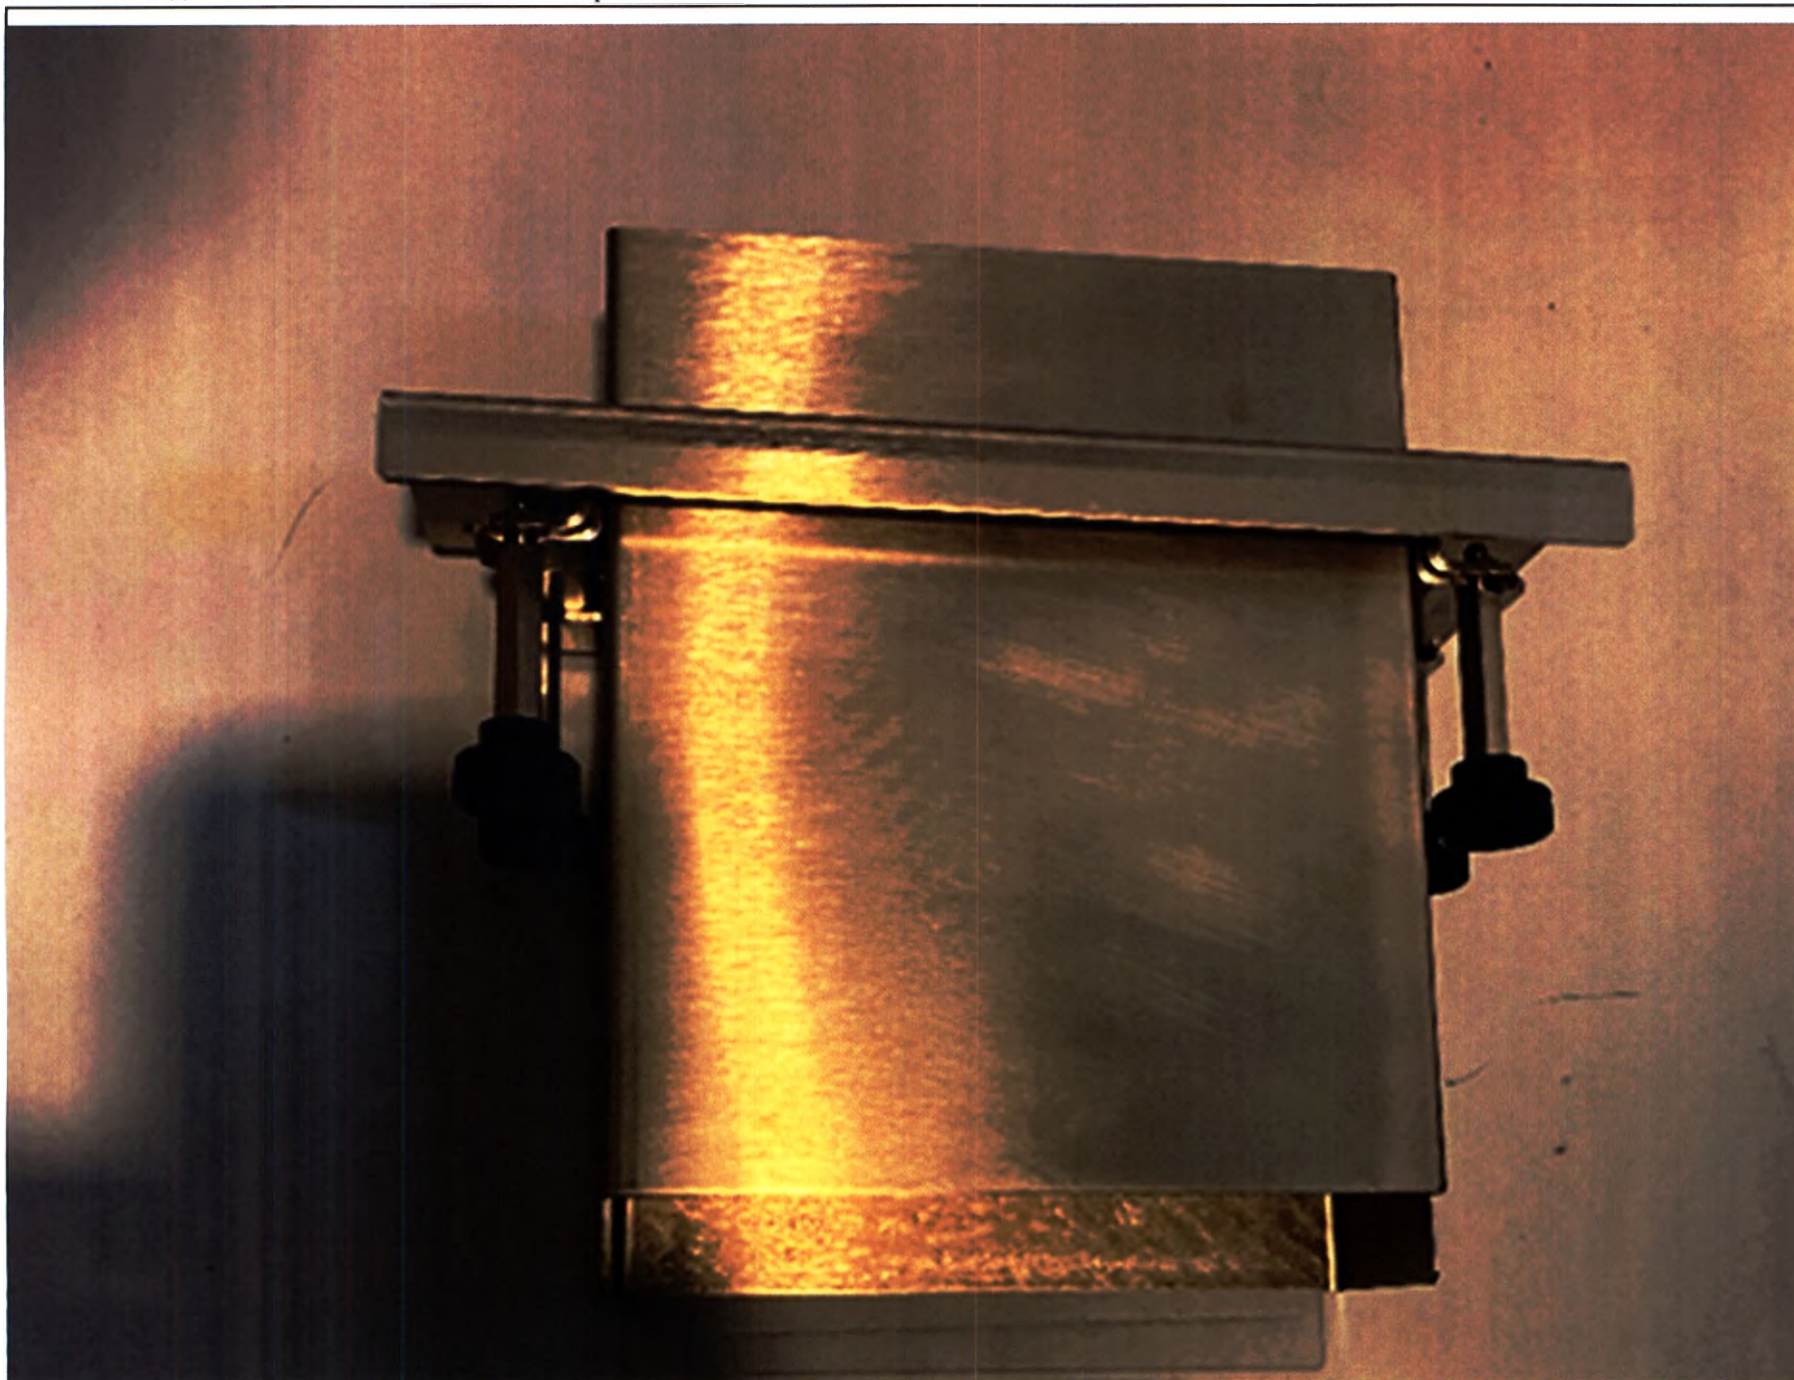




16.3 пластина для крепления



17. Крышка быстрого подсоединения

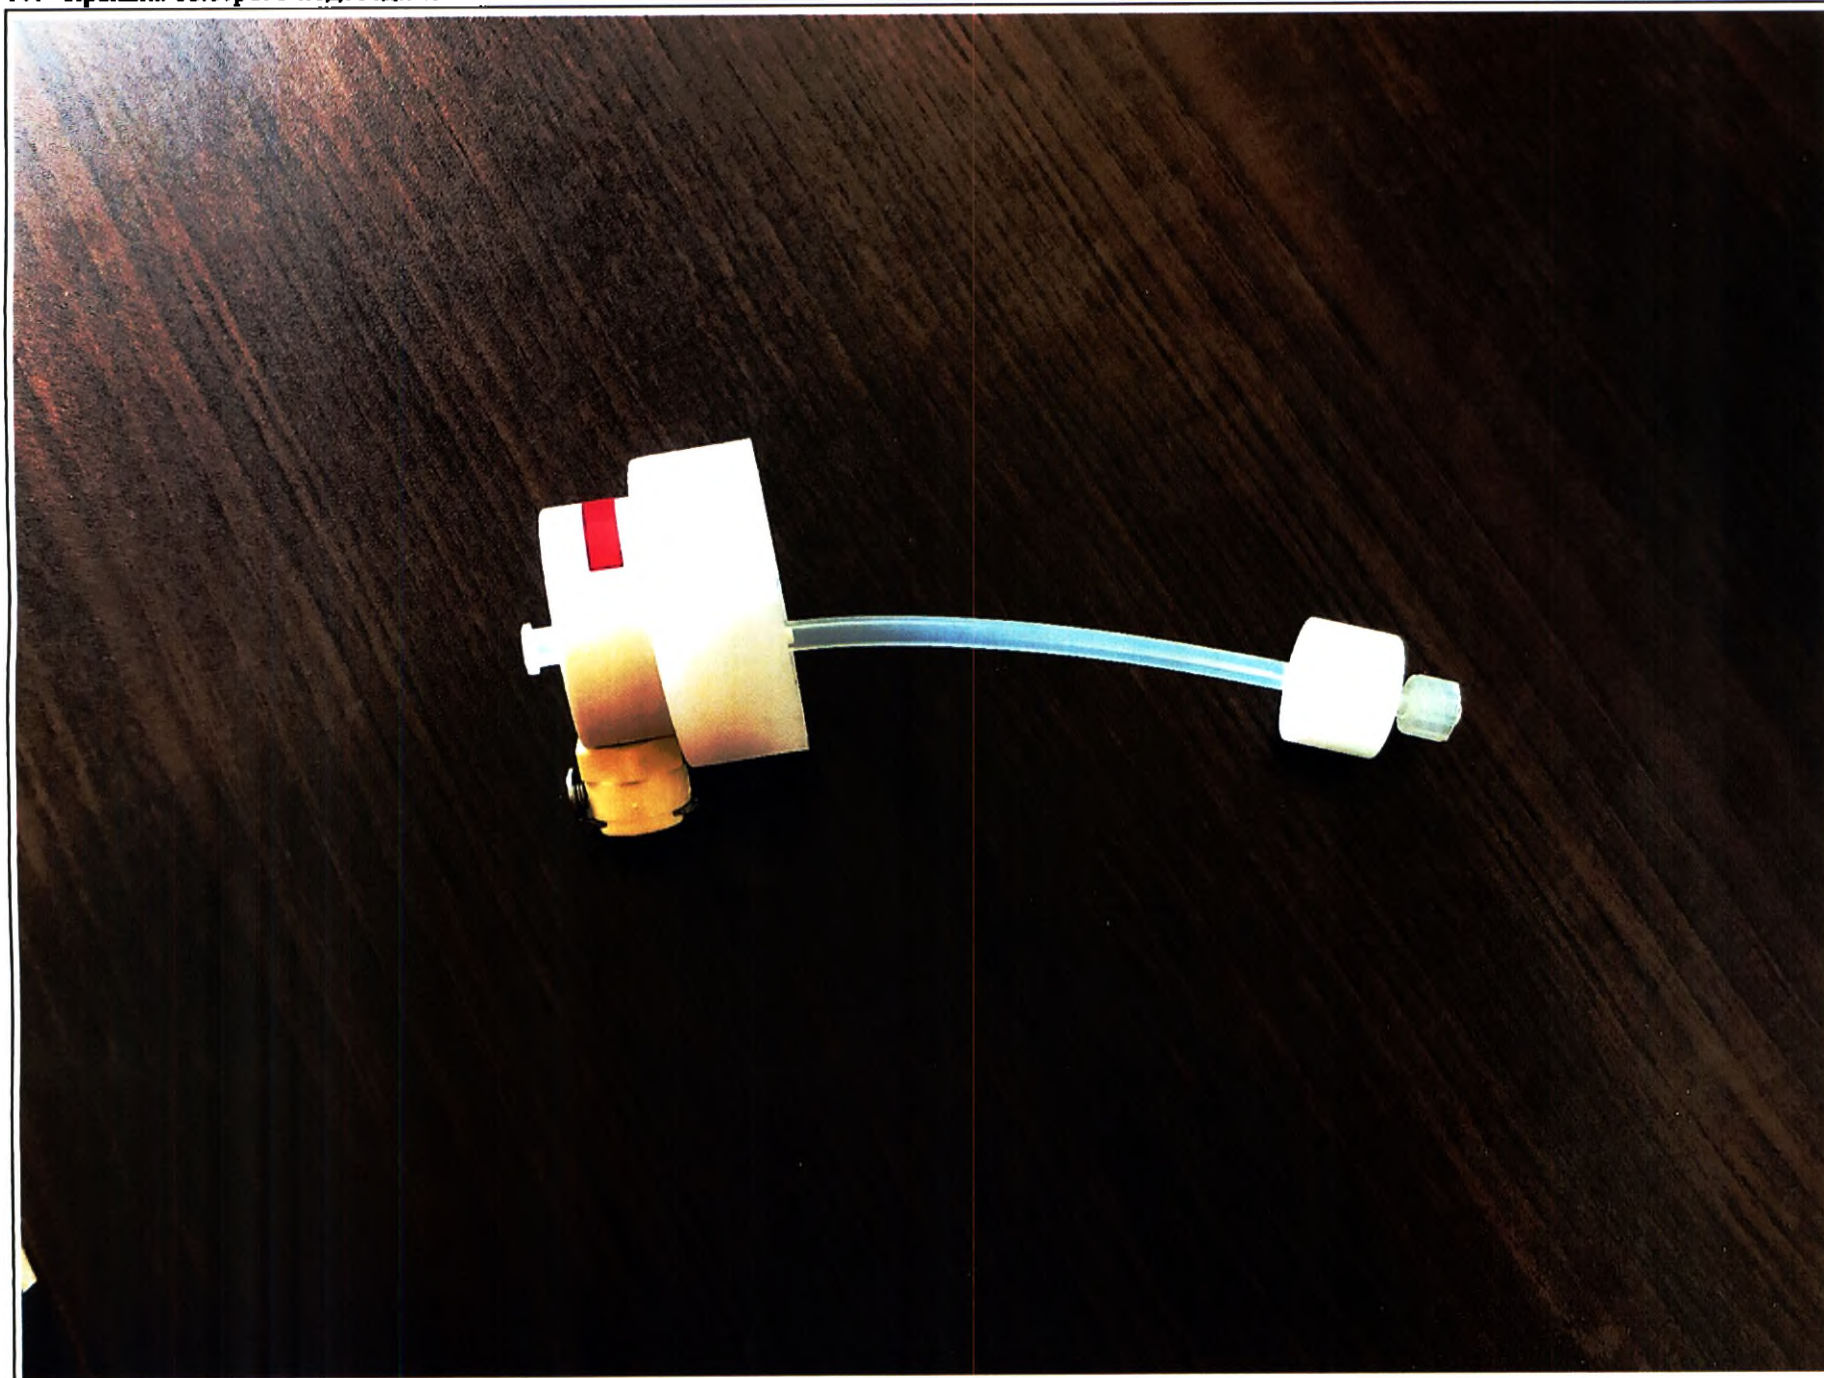


18. Наклейка с RFID-кодом для контейнера для воды



19. Наклейка с RFID-кодом для контейнера для отходов





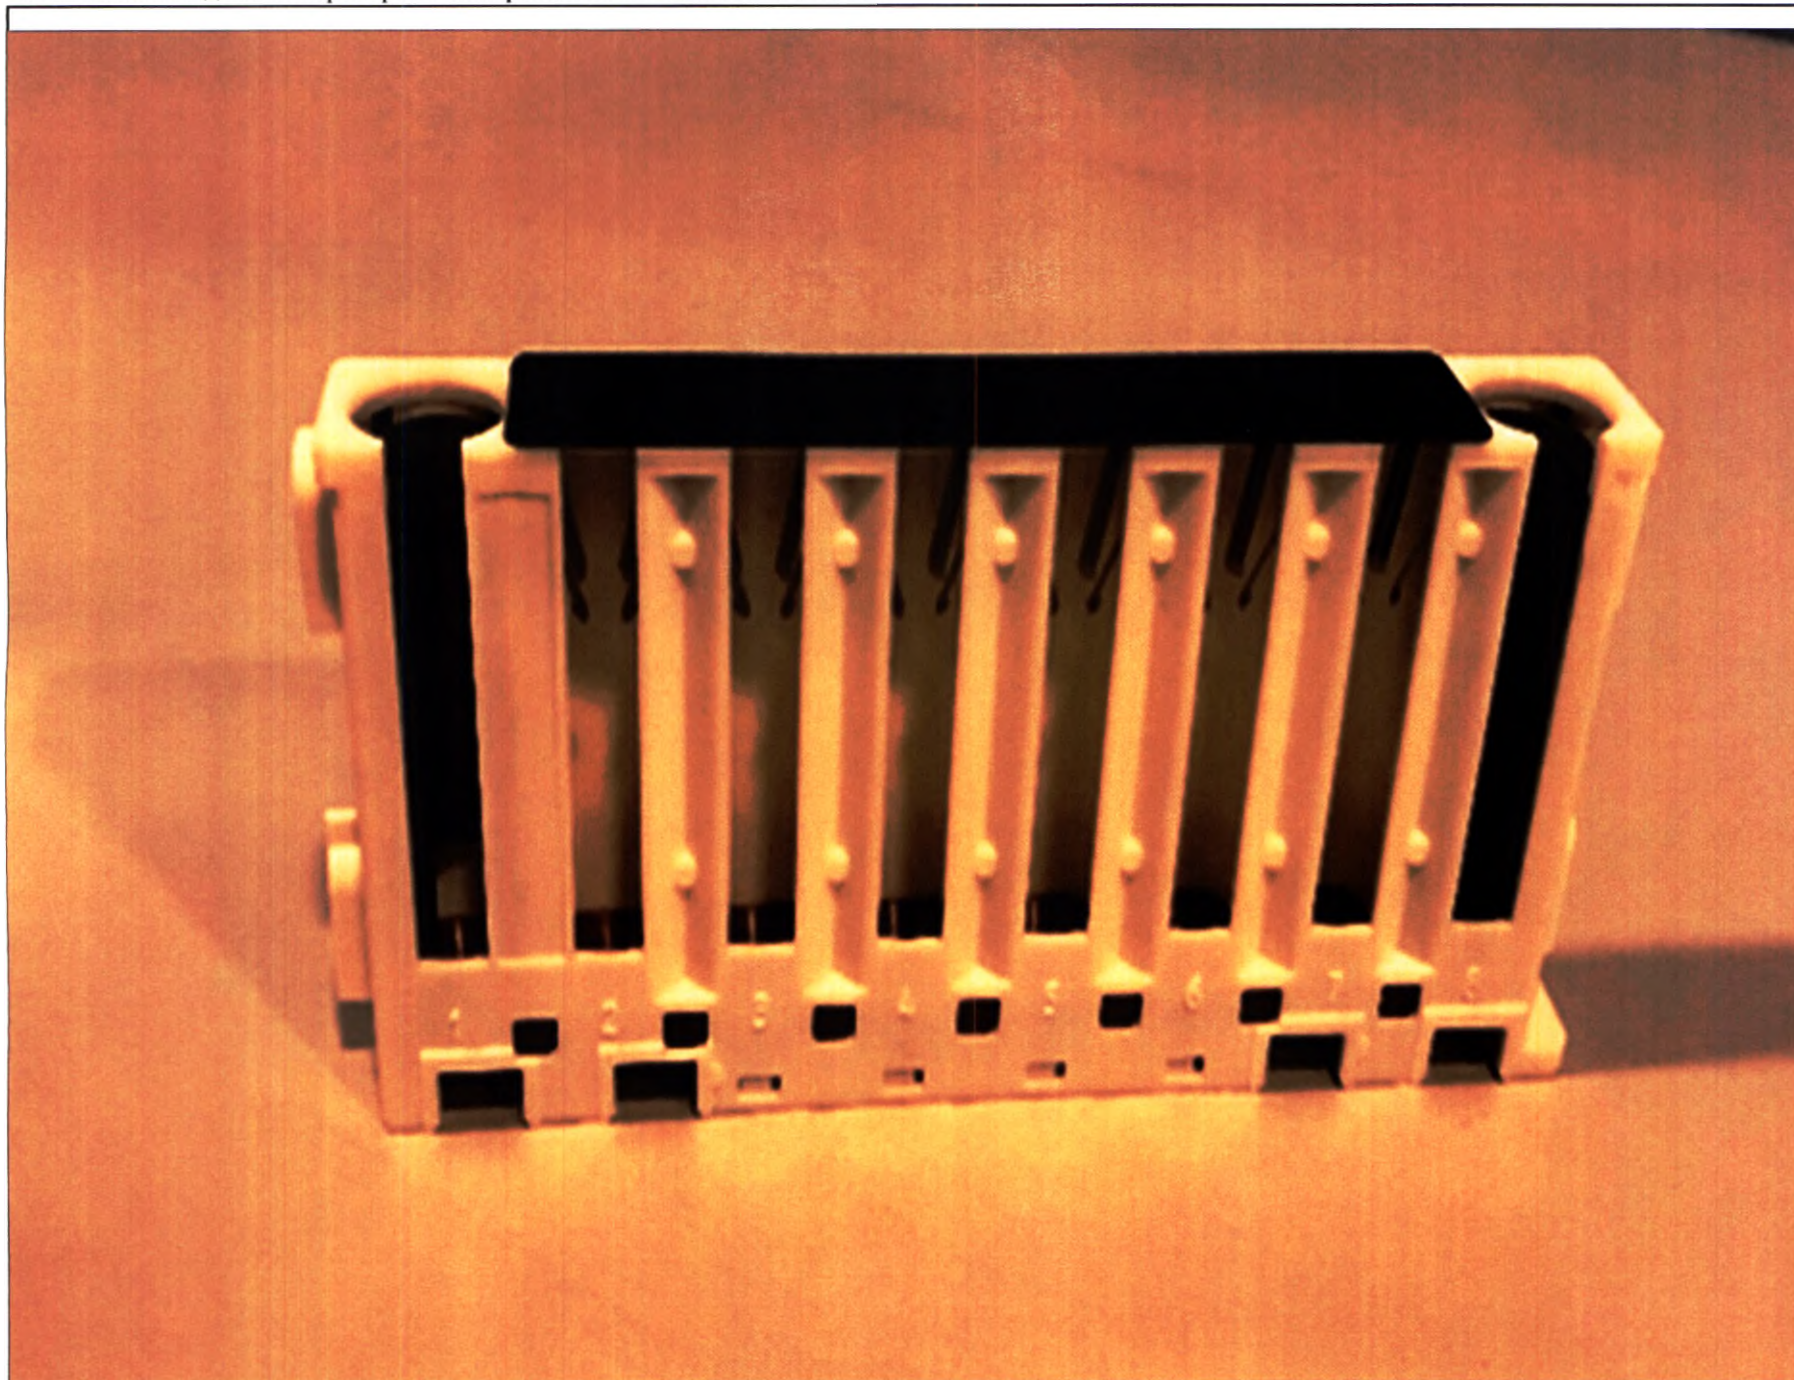




23. Штатив для образцов капиллярной крови CAPILLARYS 3 & MC





24. Штатив для образцов с малым объемом CAPILLARYS 3 & MC




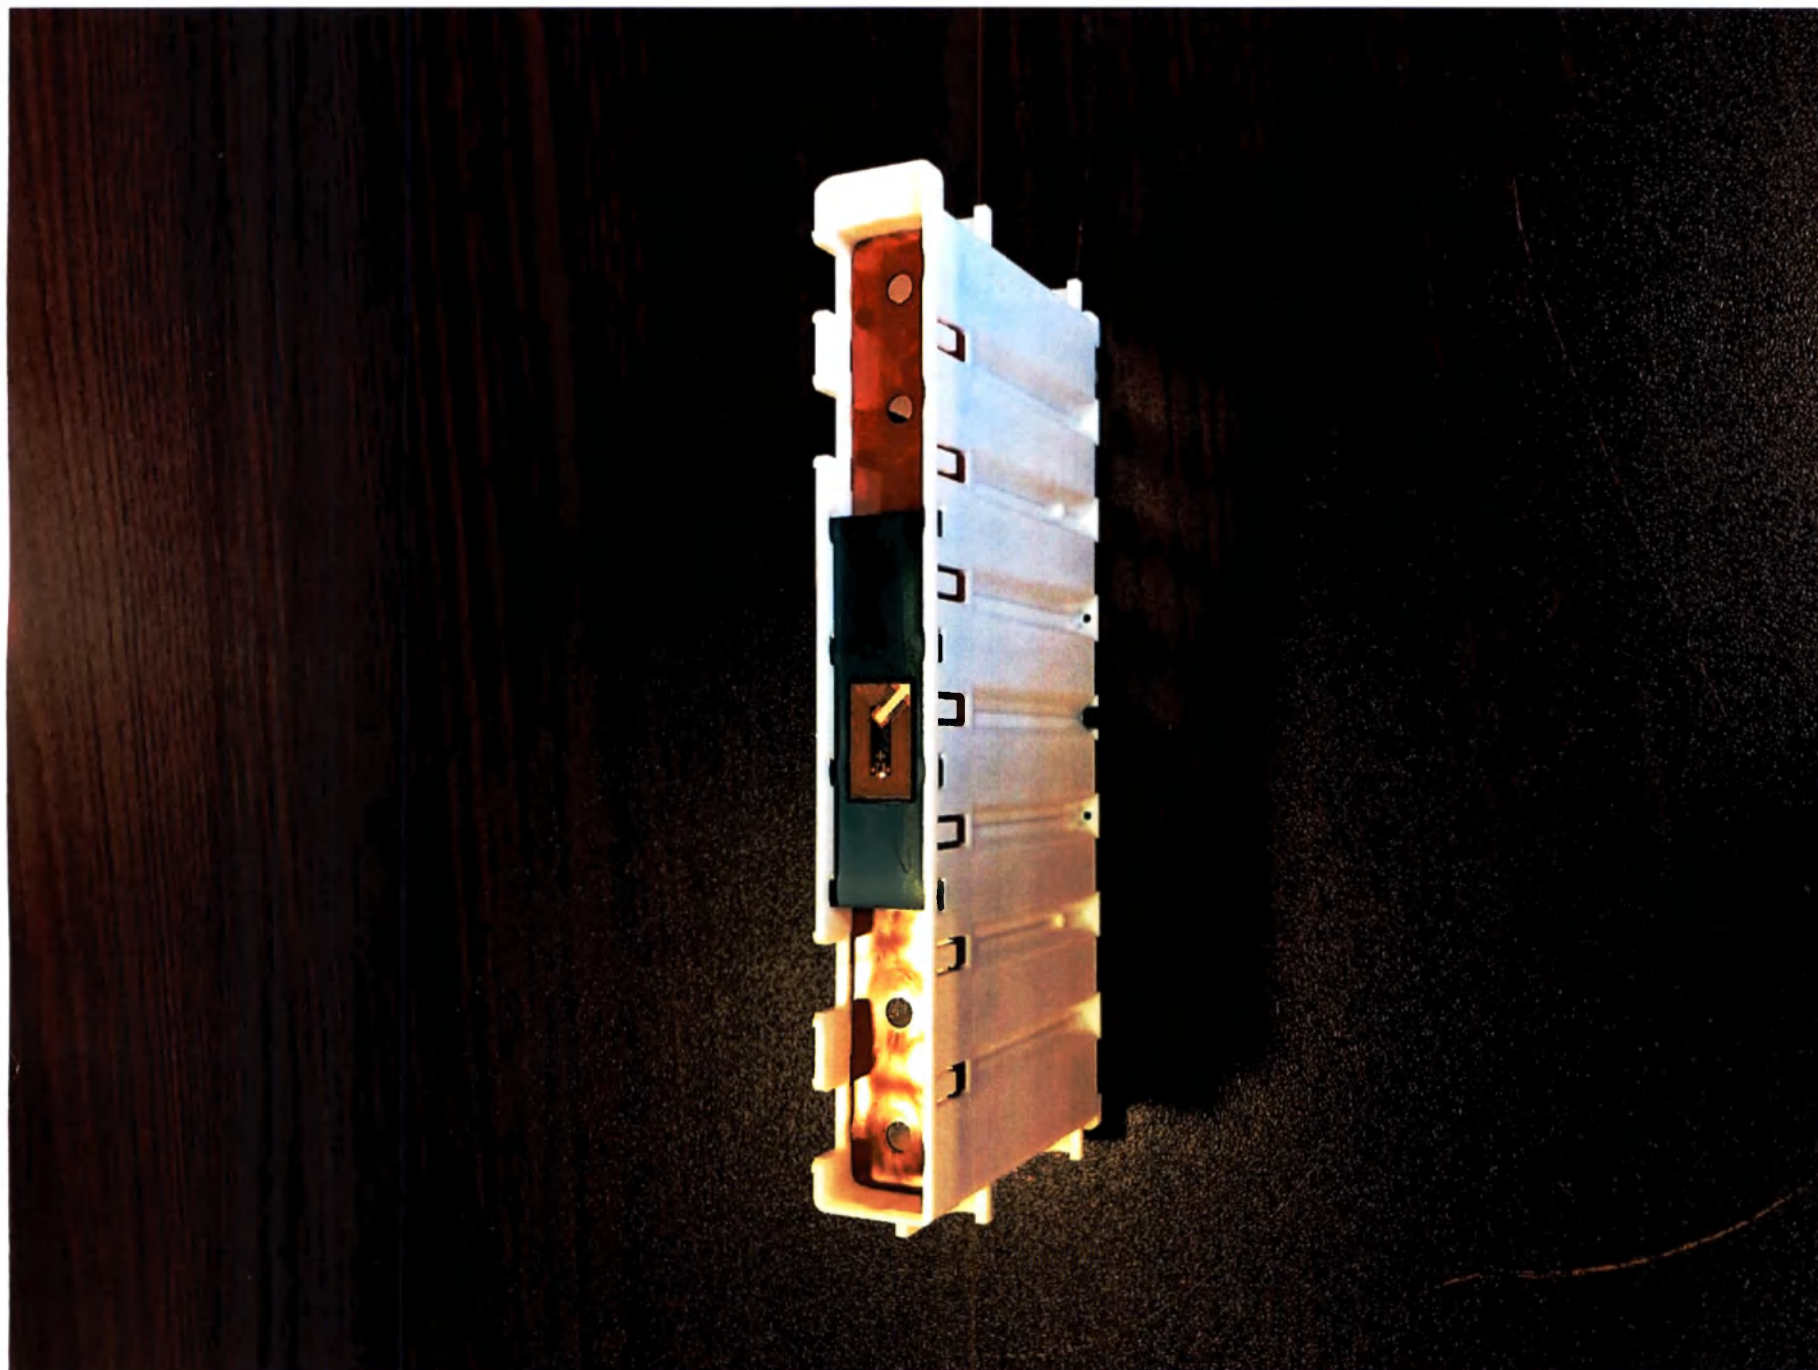

25. Штатив переключения CAPILLARYS 3 & MC для методики PROTEIN(E) 6

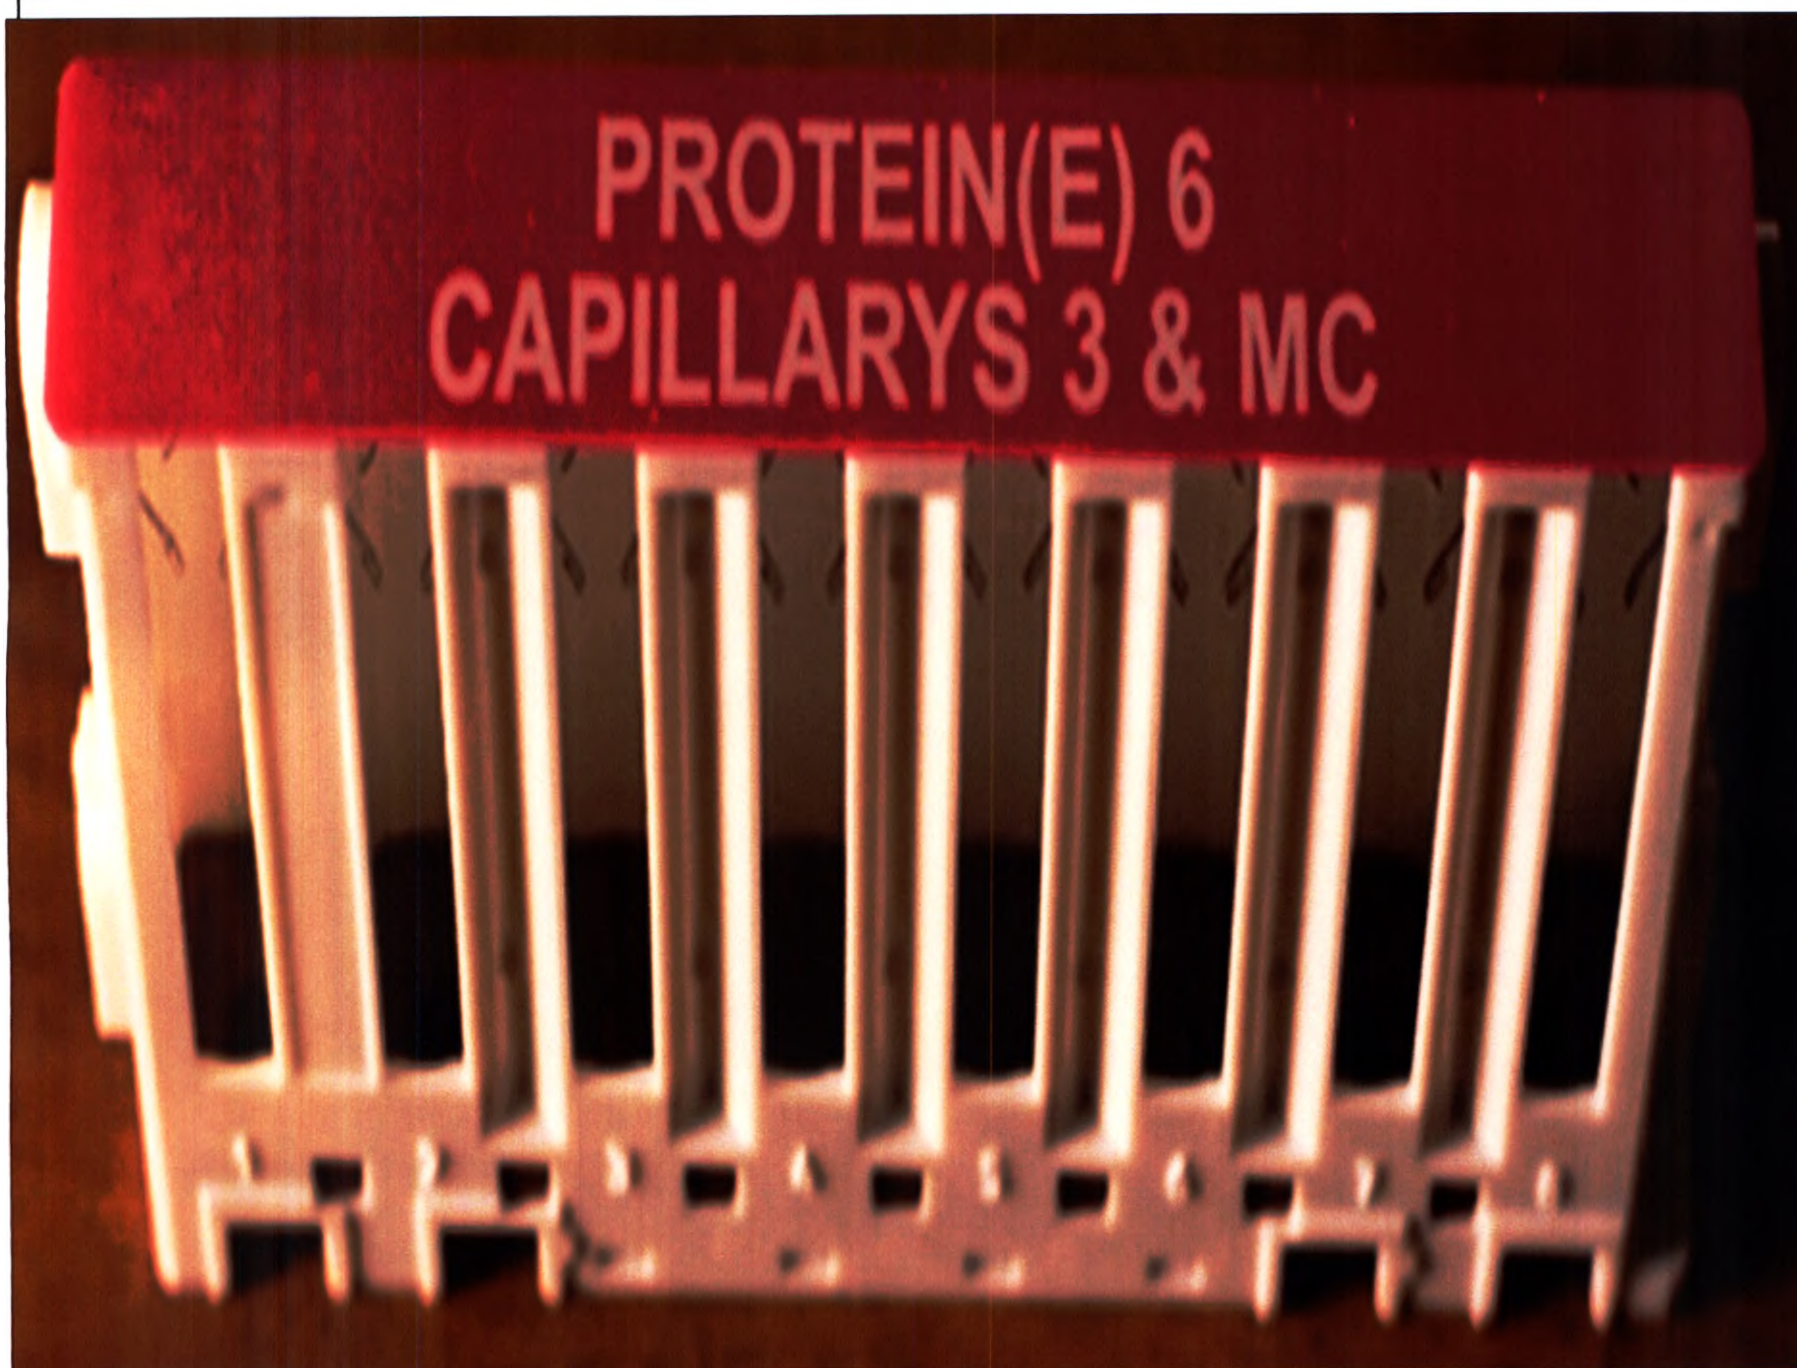

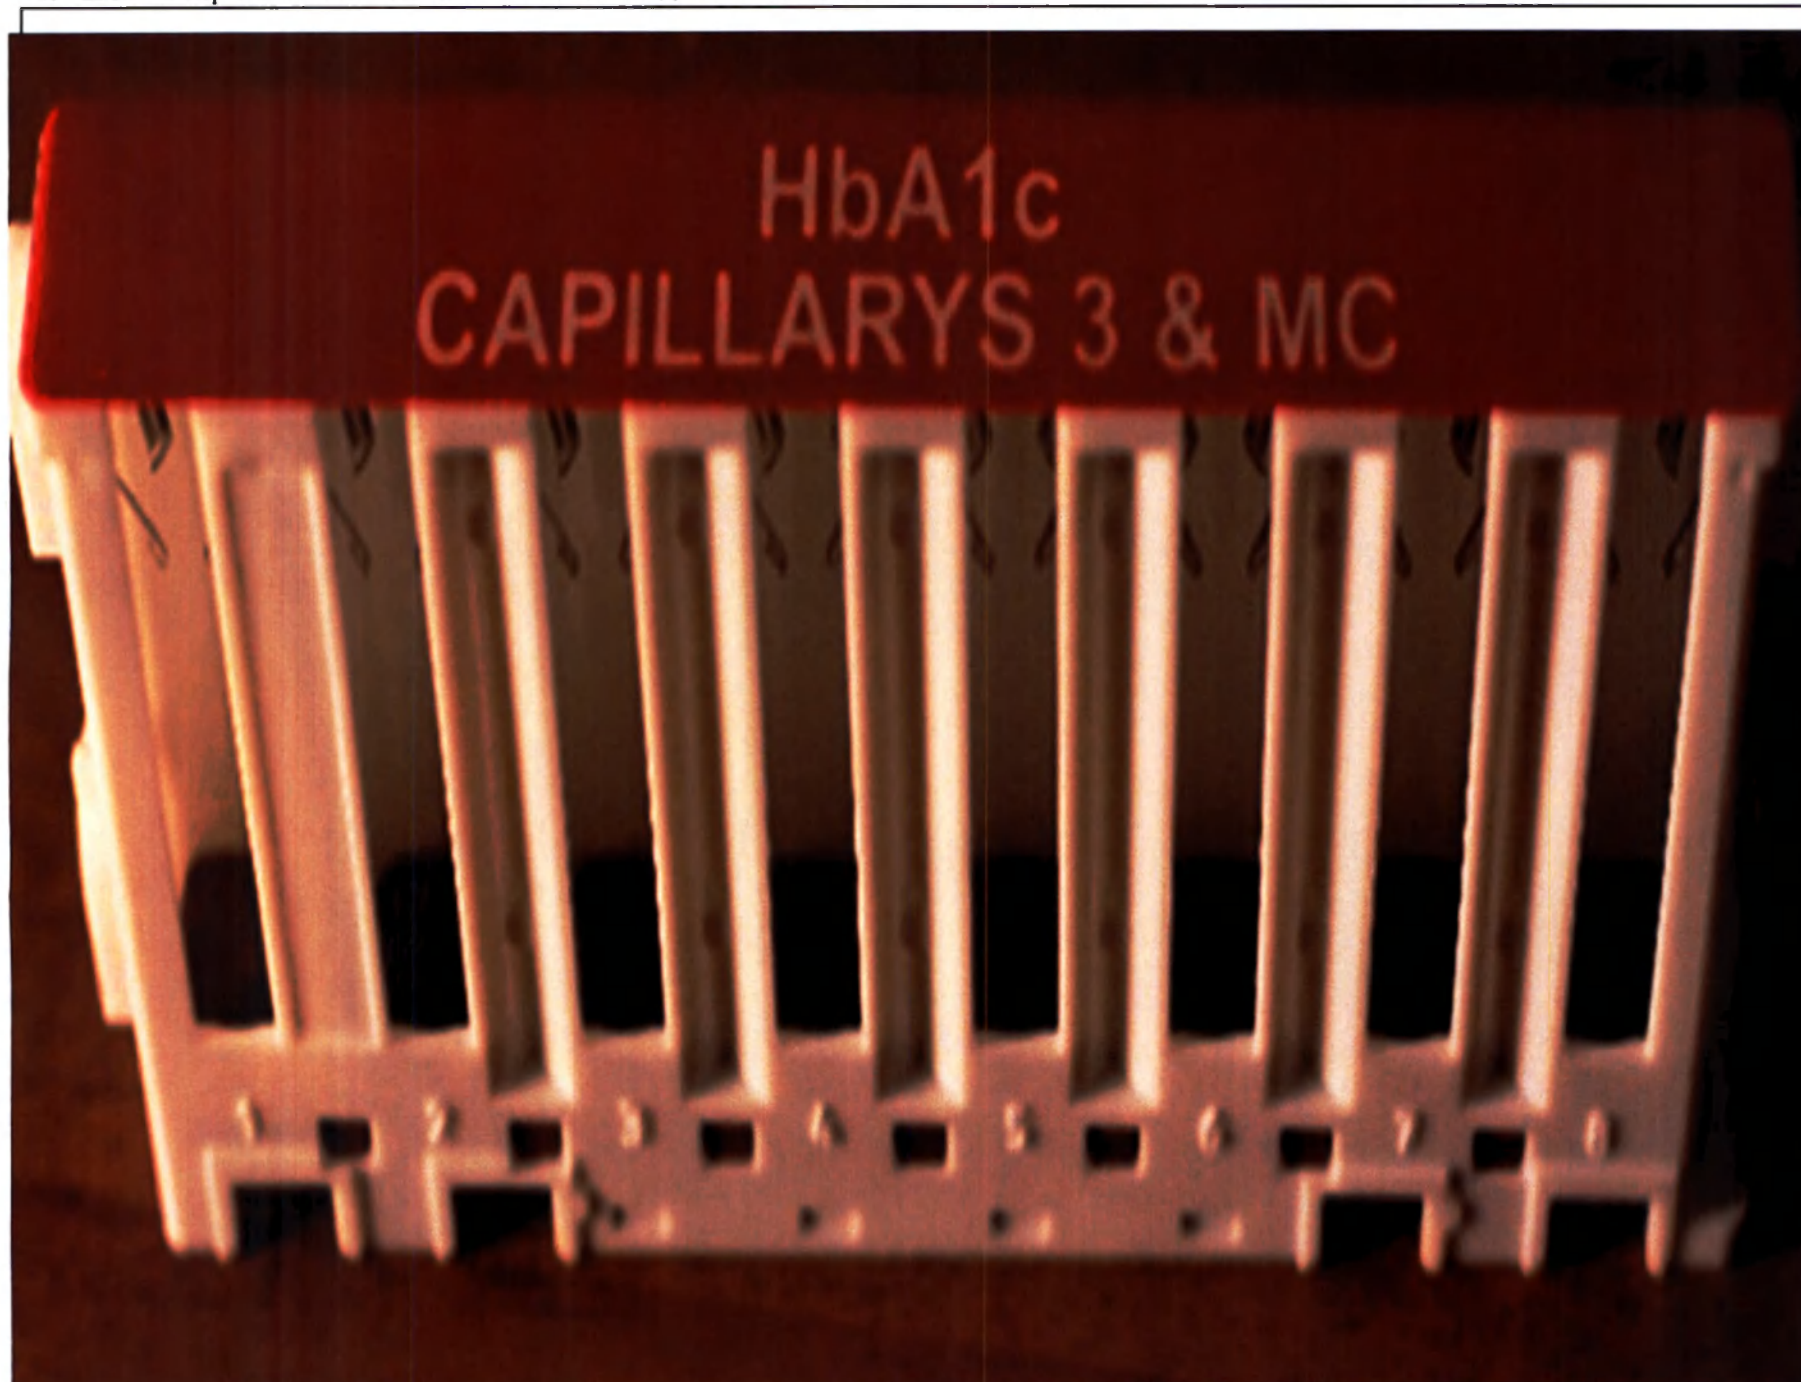


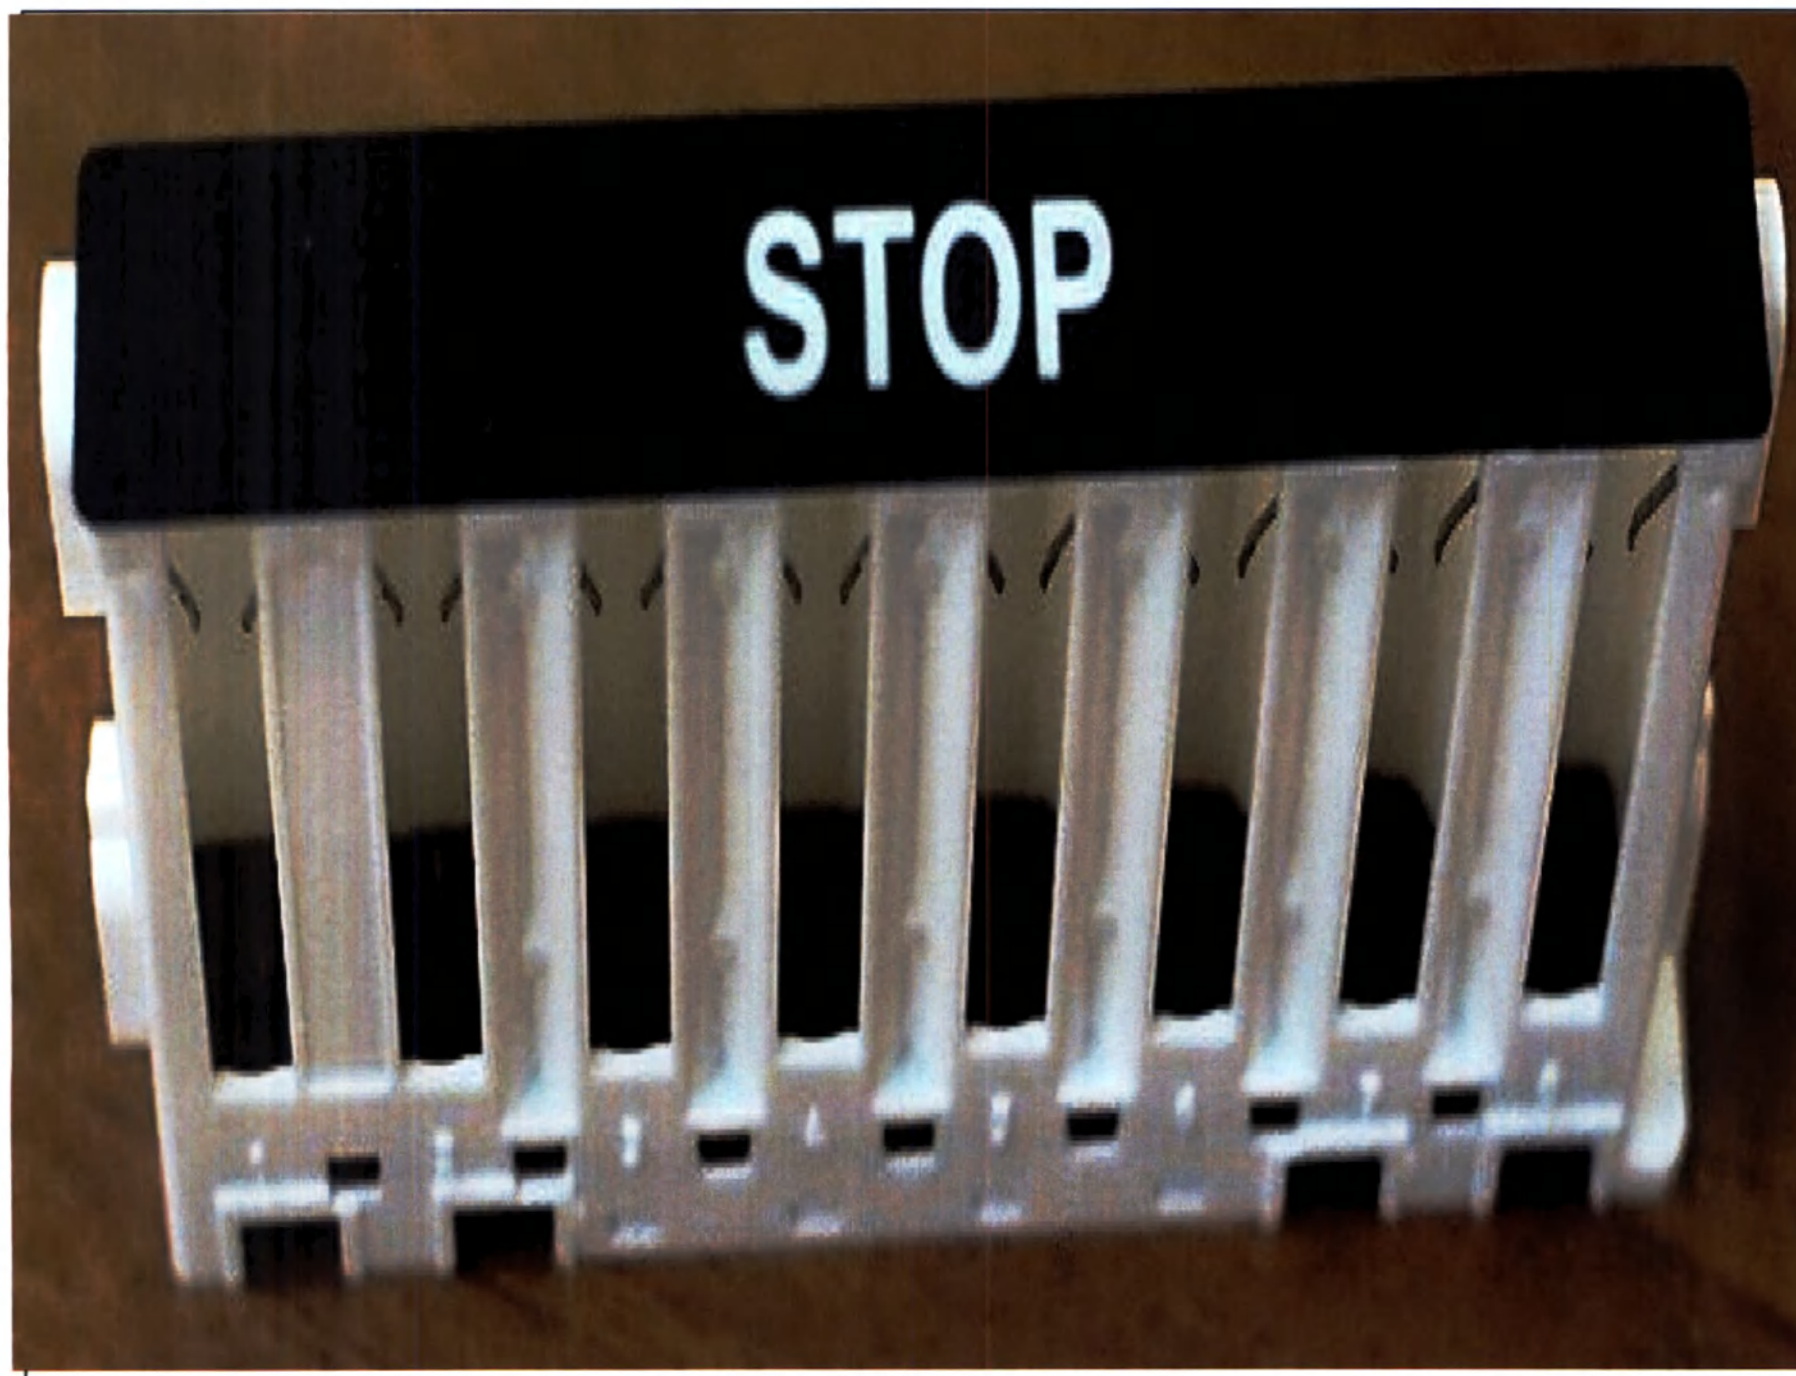


Пример RFID-этикетки на штативе




28. Загрузчик образцов CAPILLARYS 3

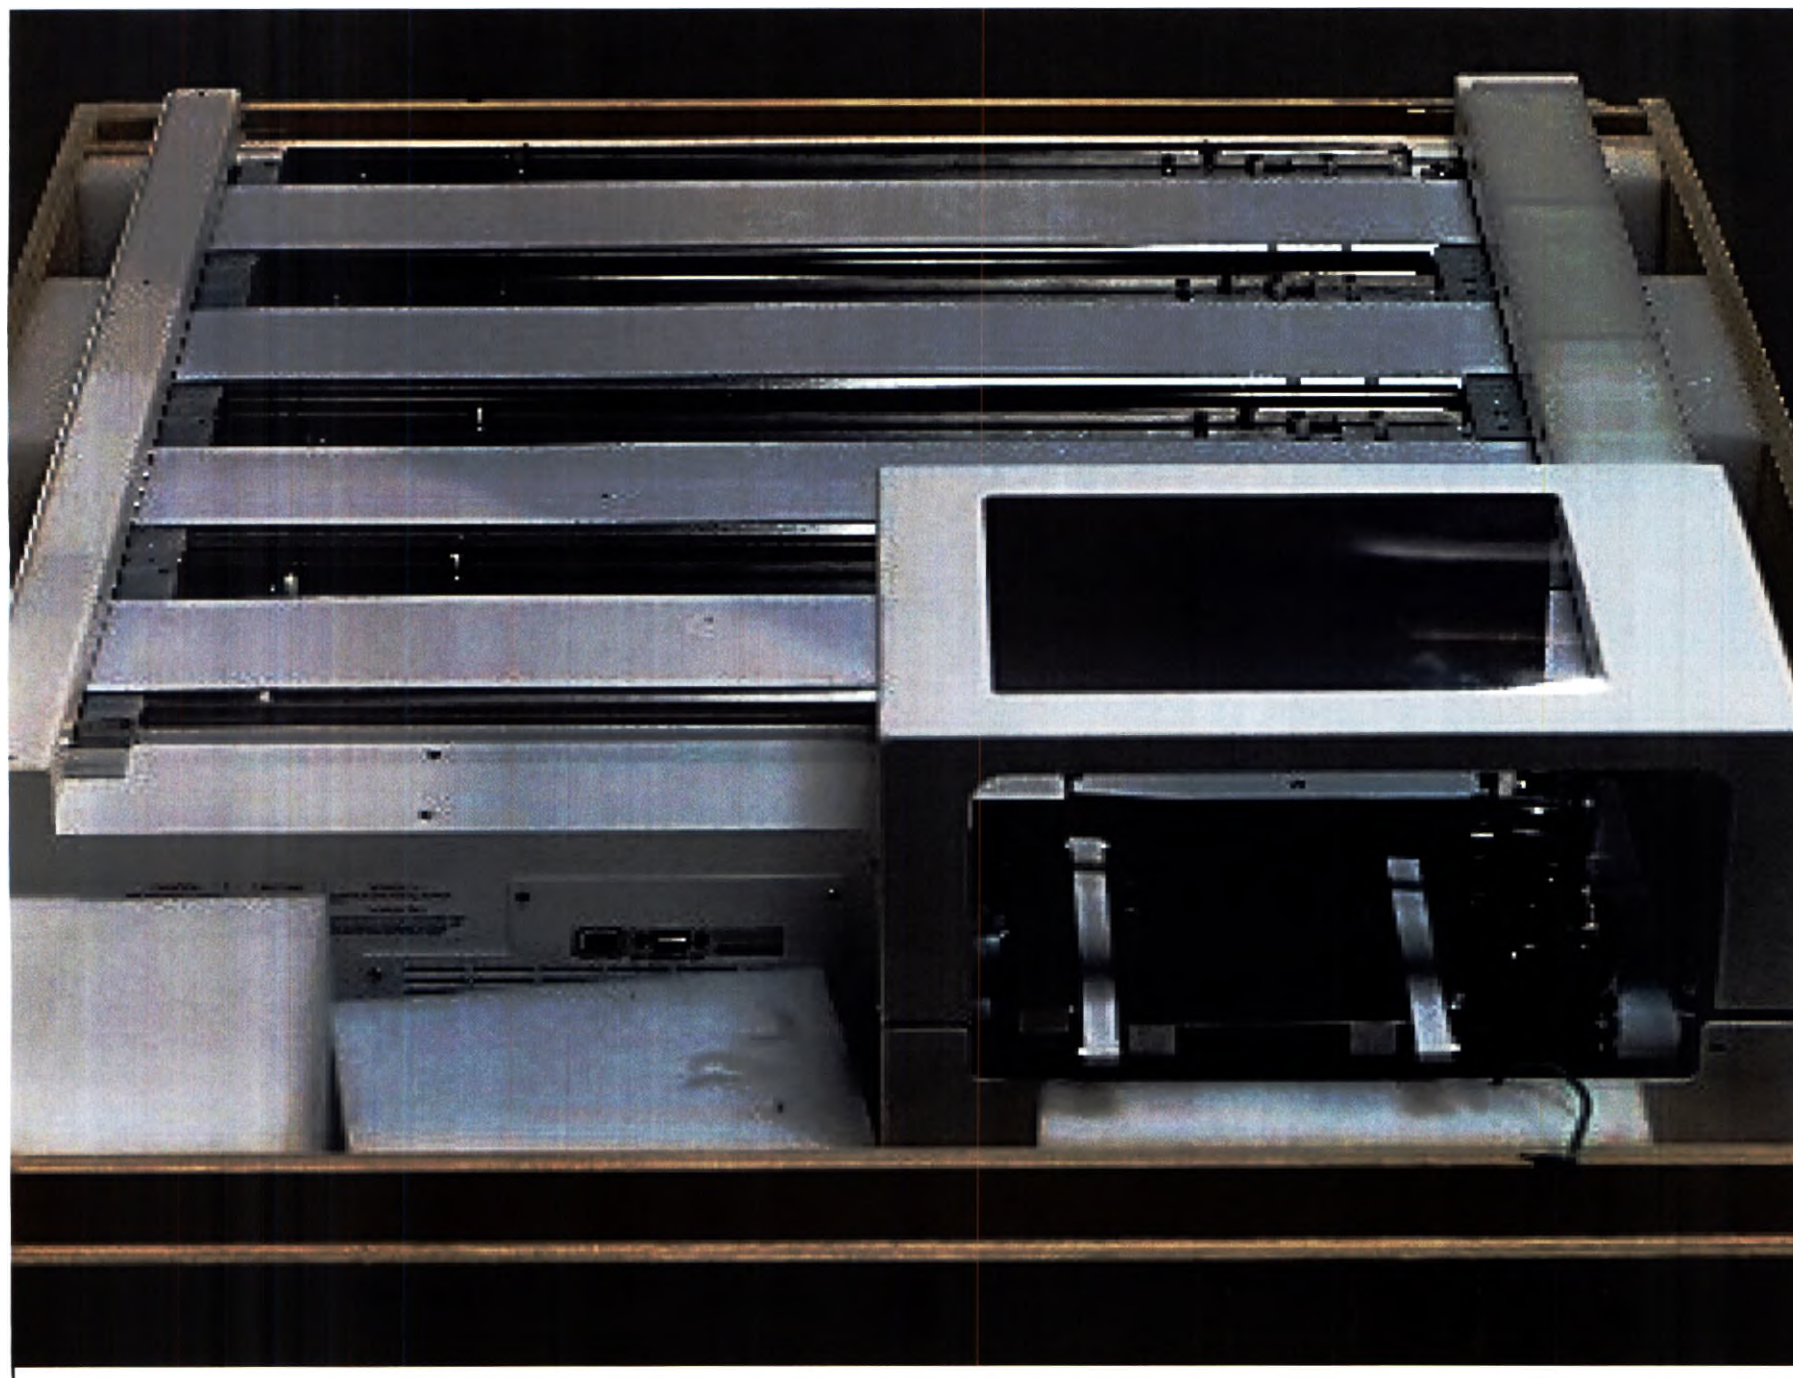


29. Конвейер штативов CAPILLARYS 3

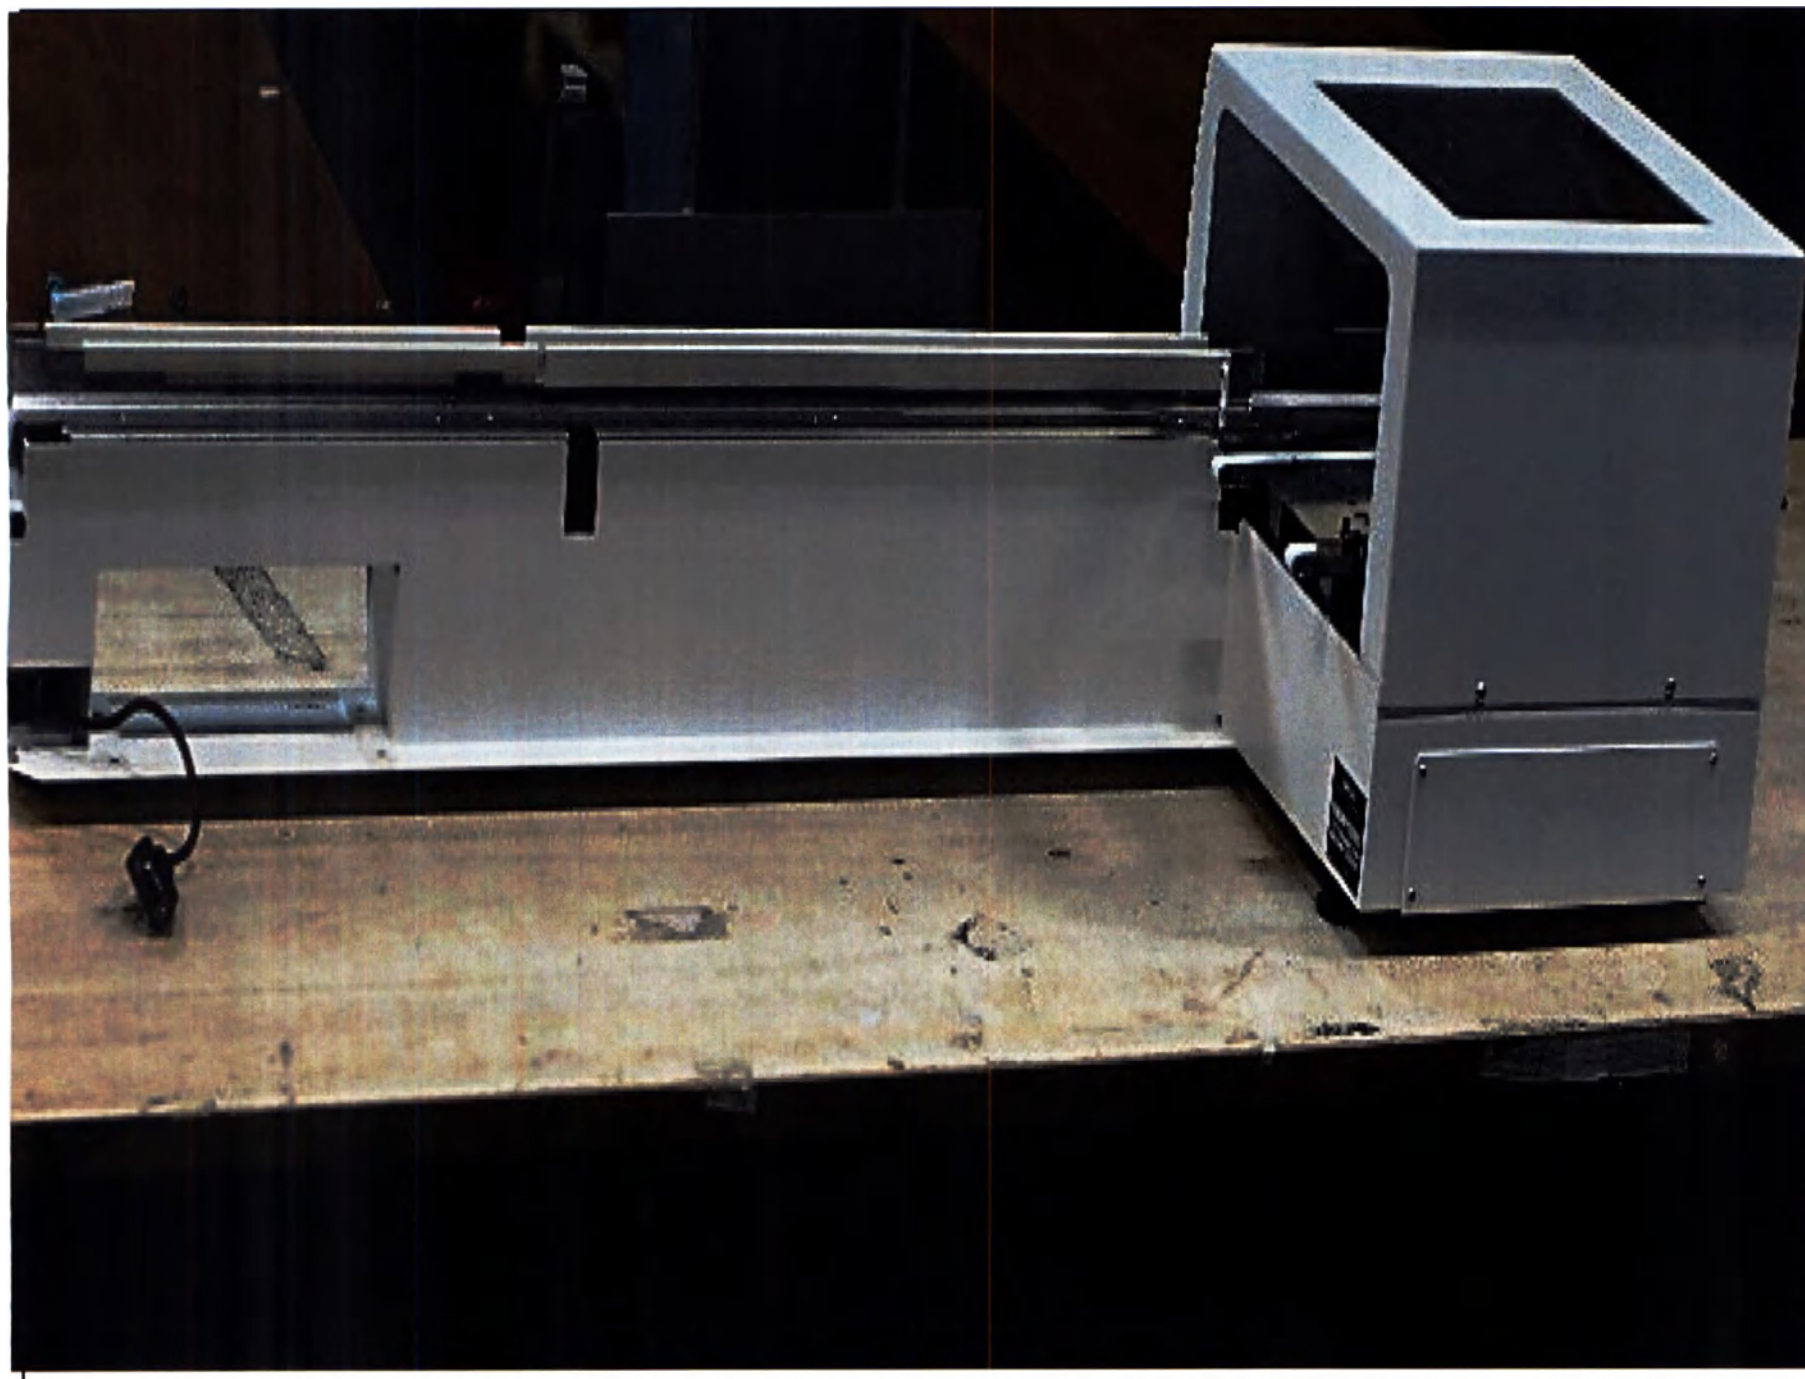


30. Резервуар анодный

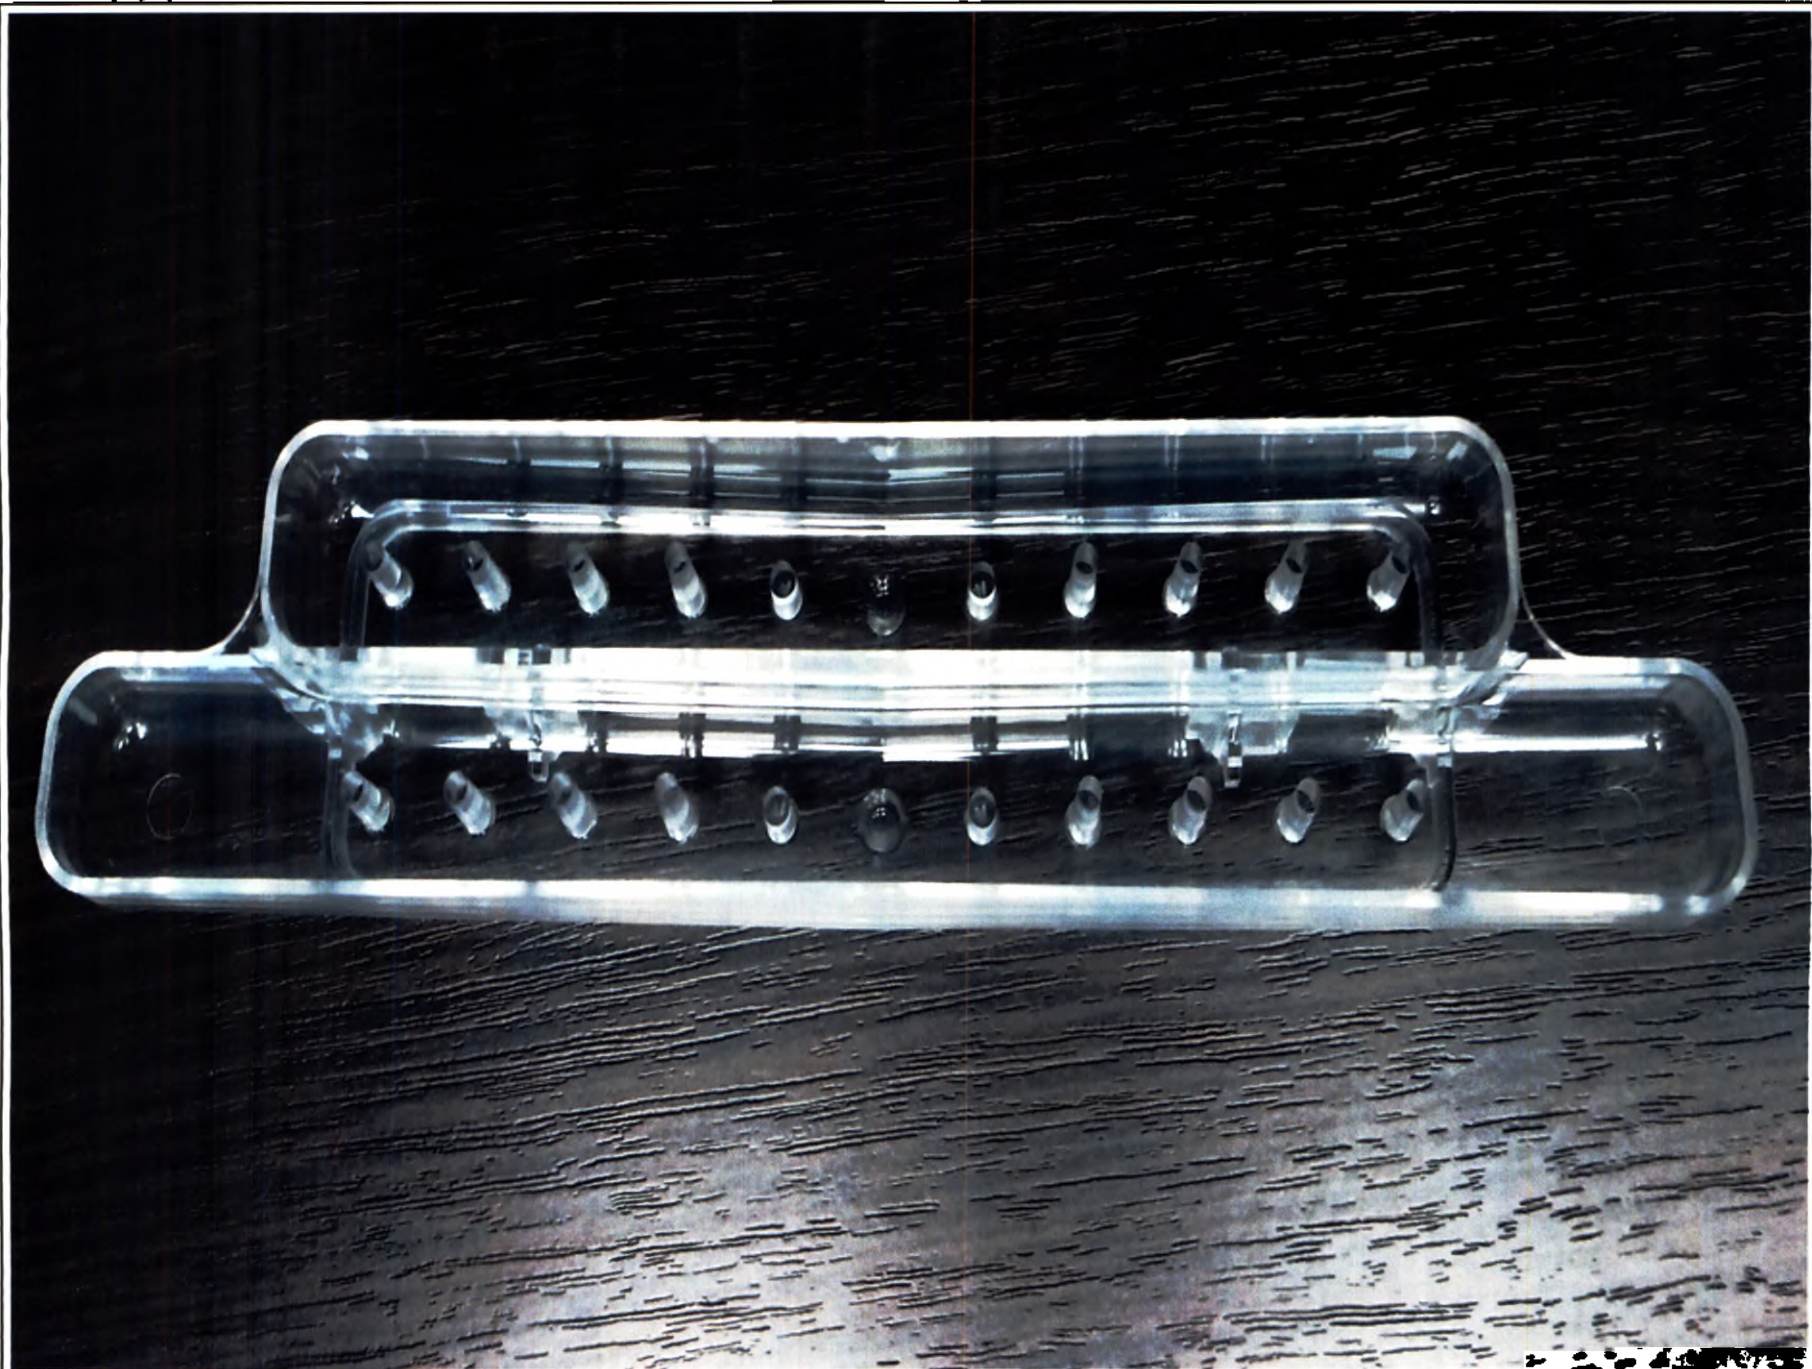


31. Пробирка с крышкой для контролей

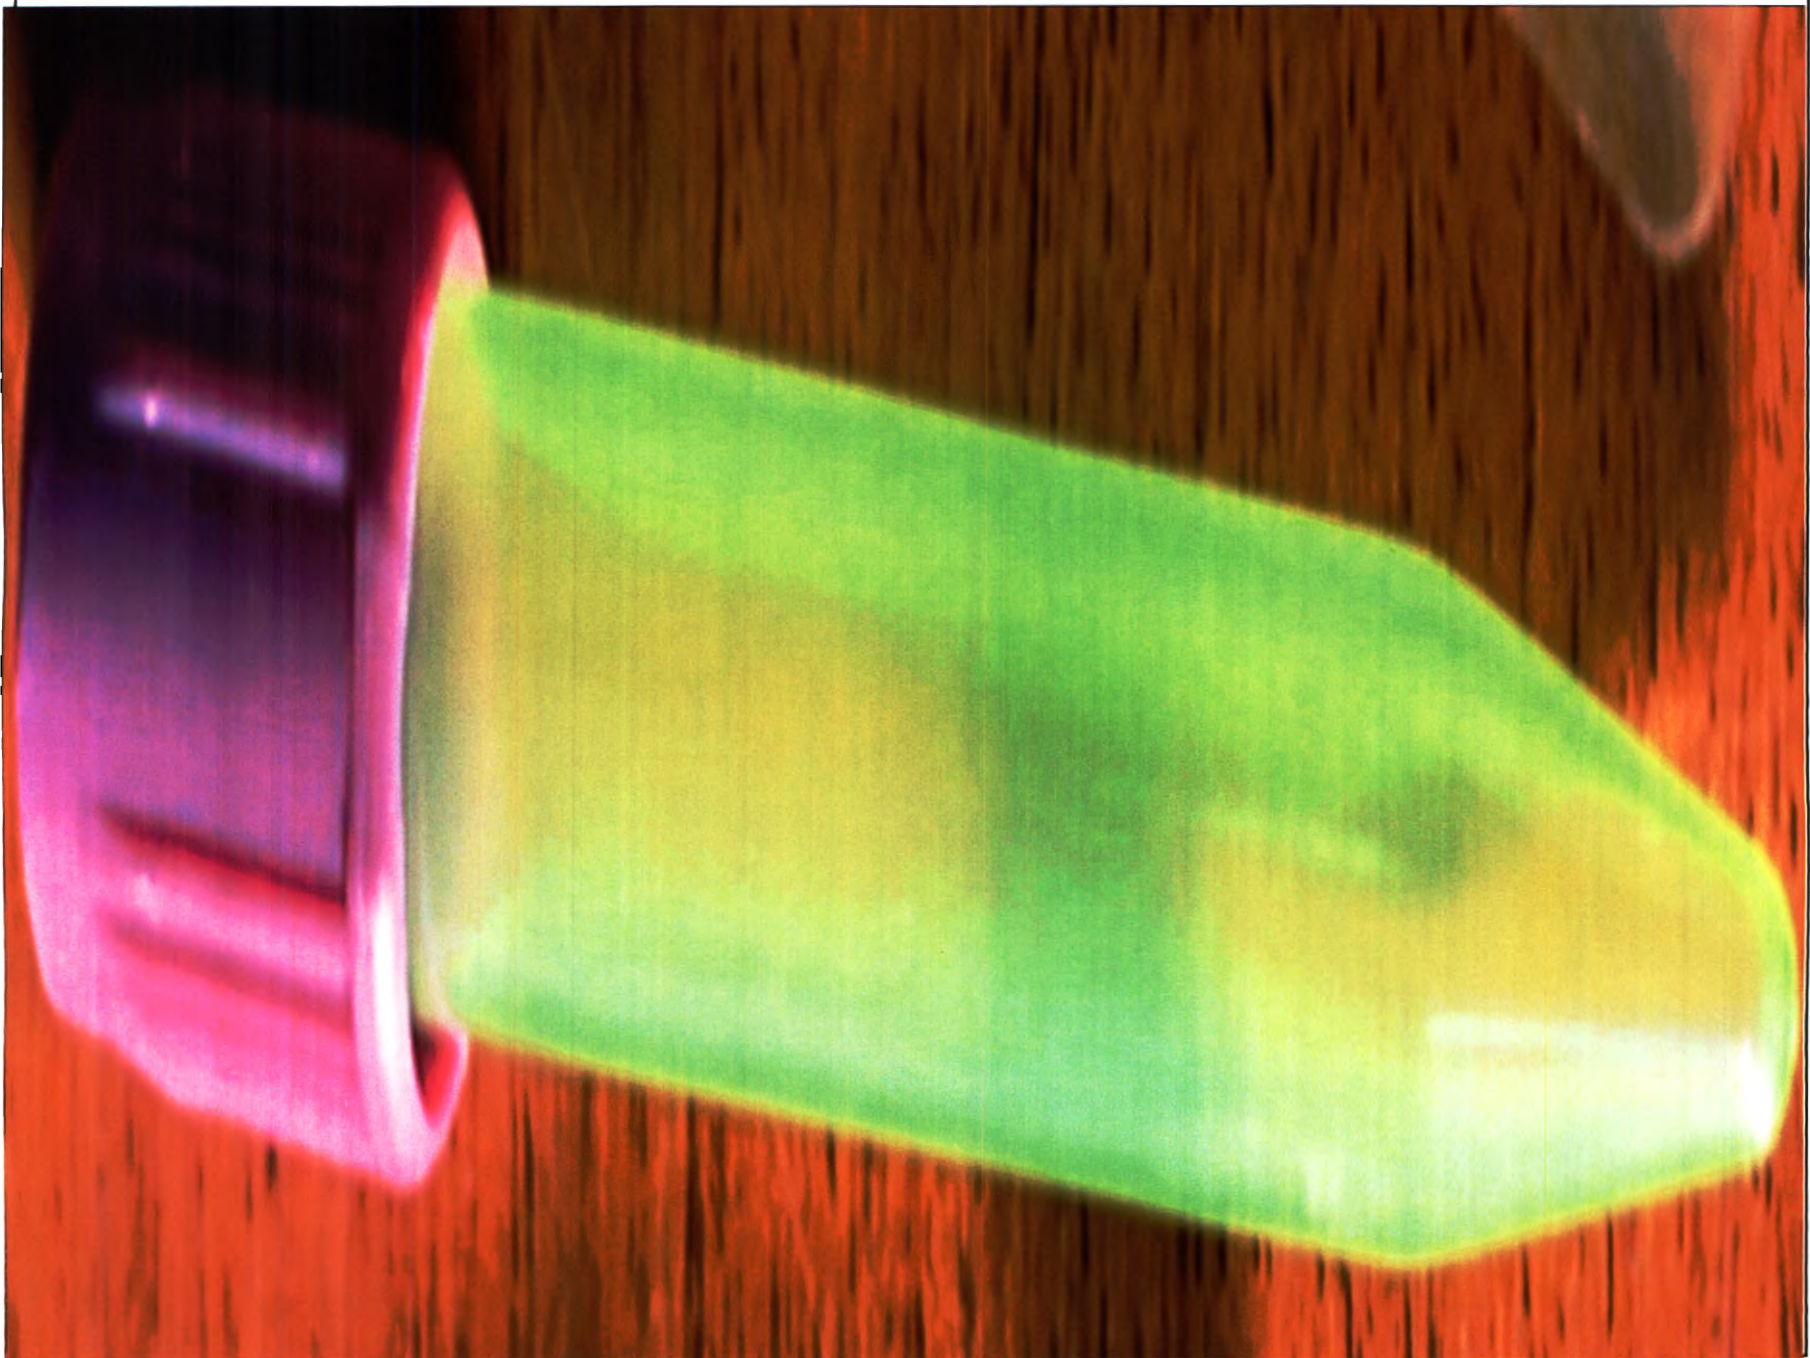

32. Сегмент для разведения САРІ 3

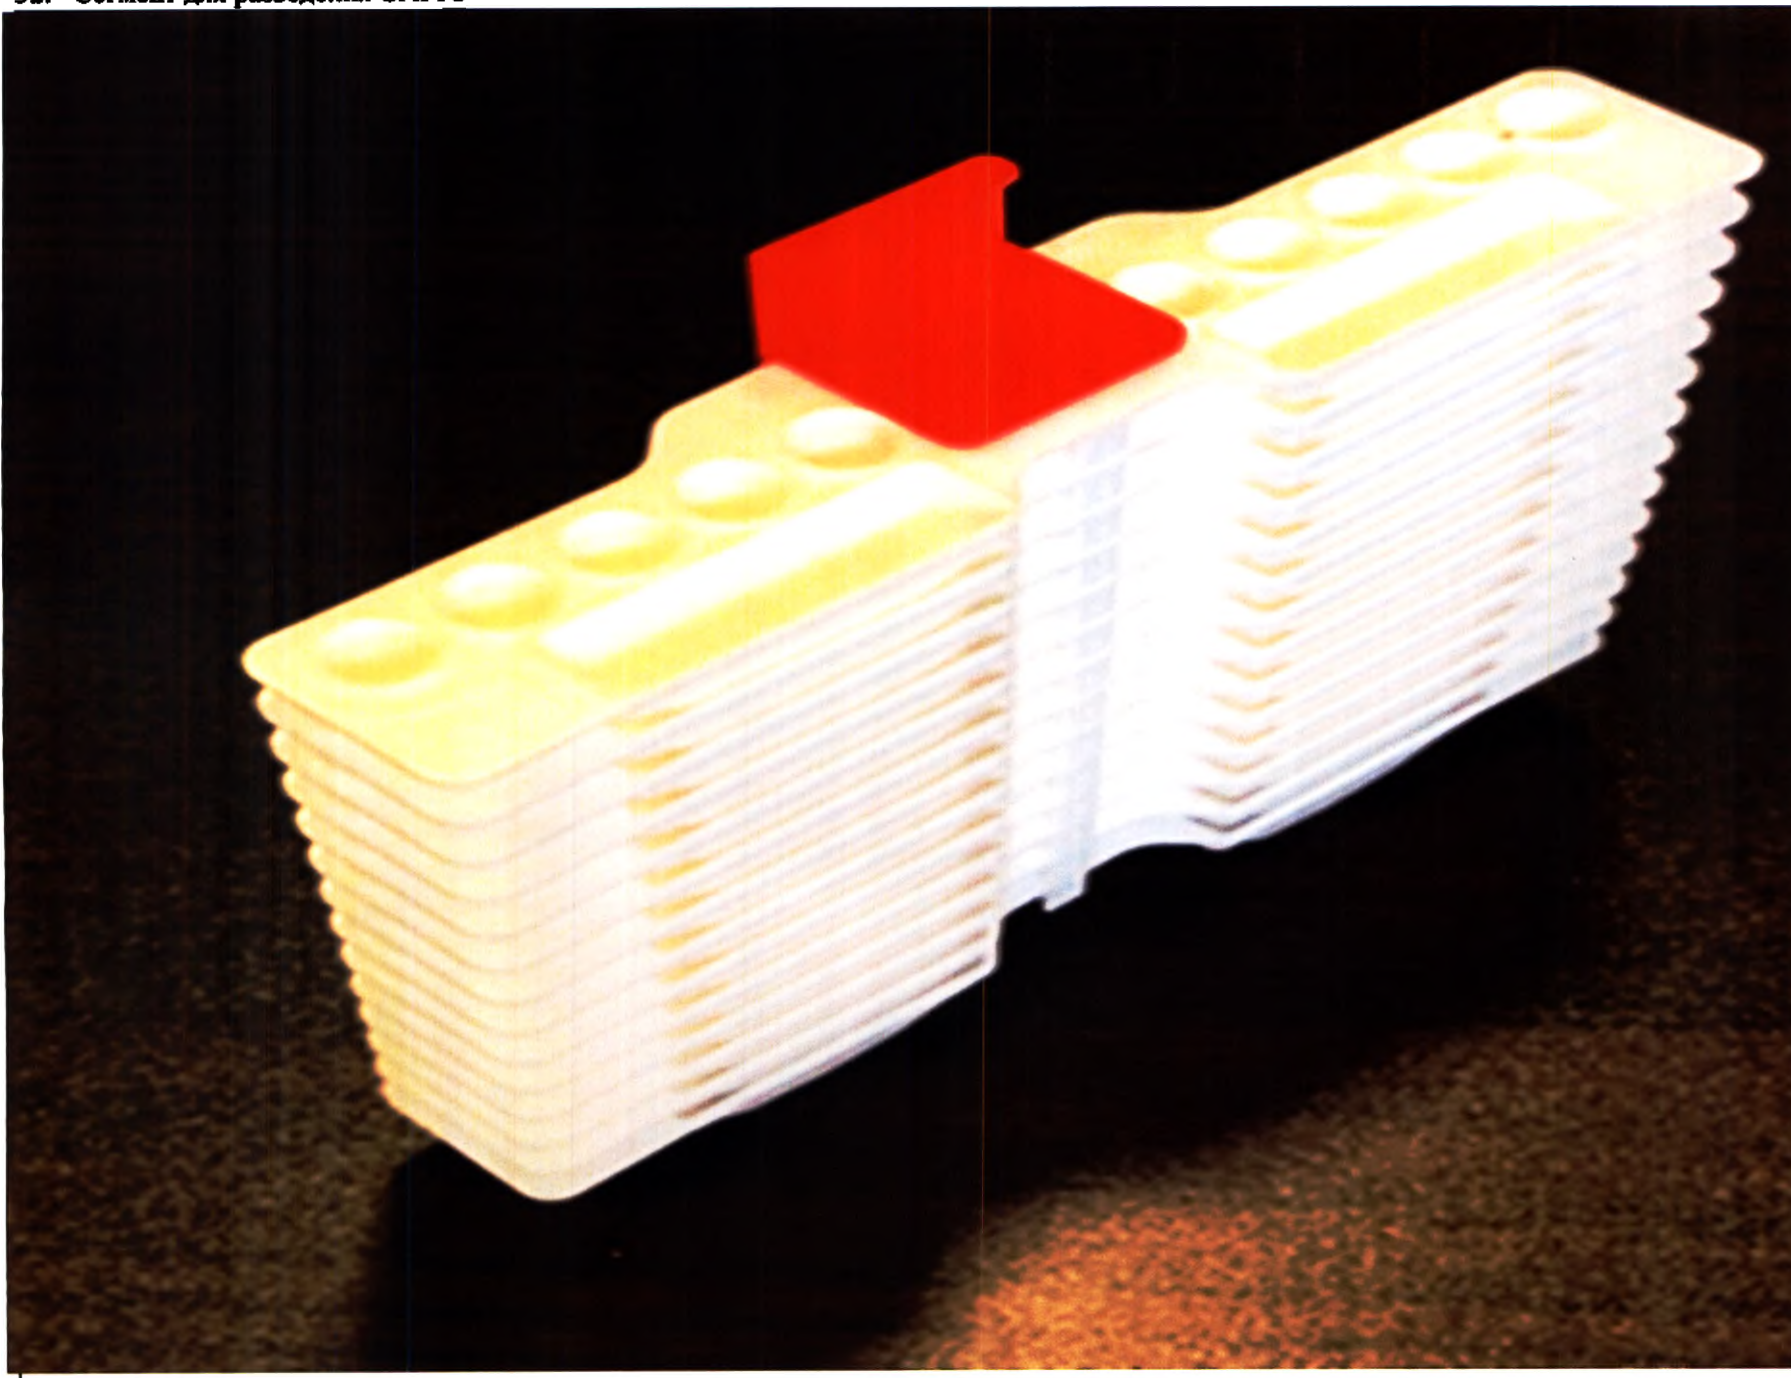

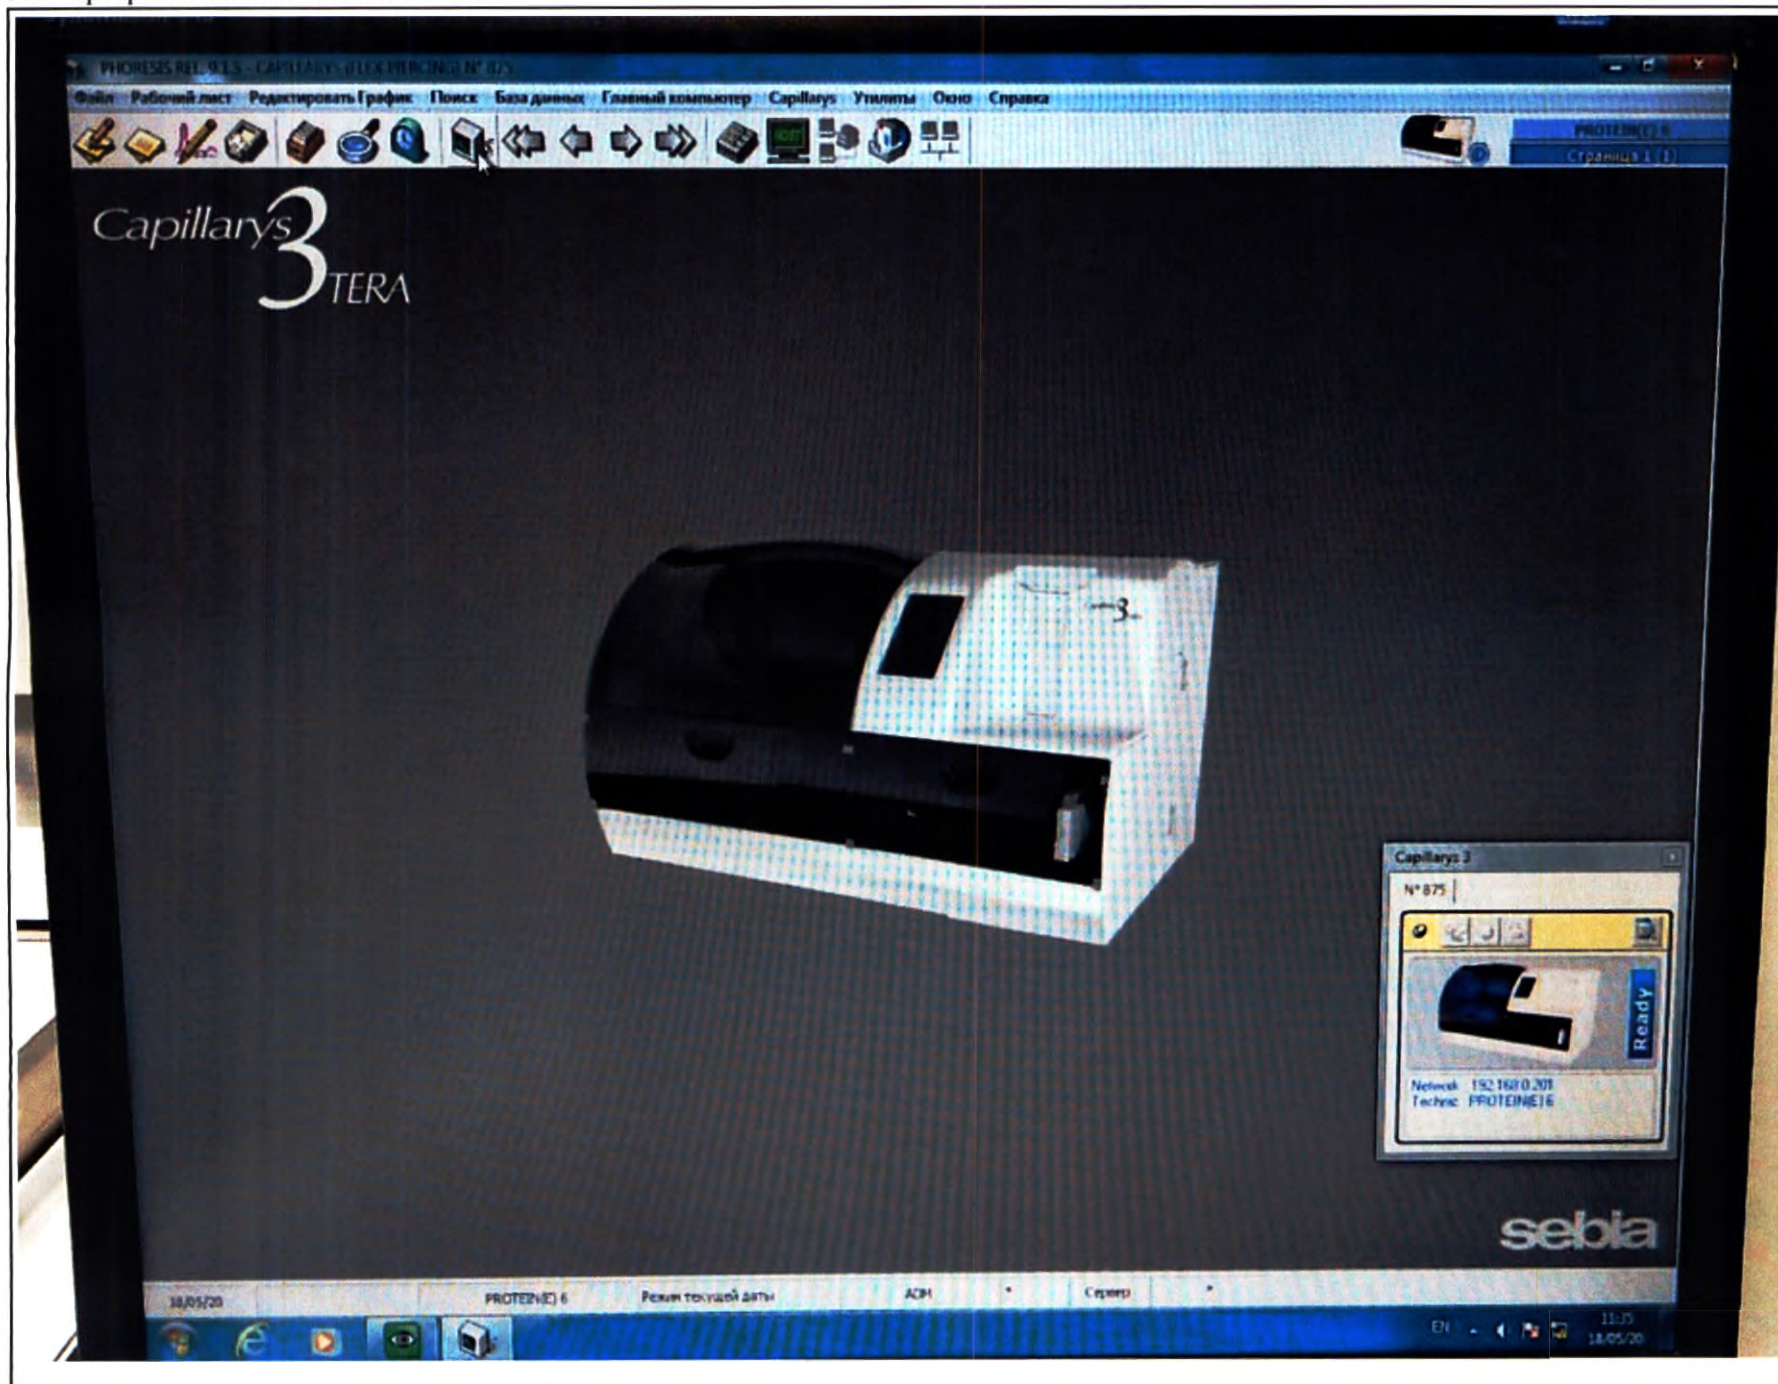

34. Фильтр для реагентов




35 Игла-пробоотборник для прокалывания крышек





36. Картридж с капилляром для денситометрии

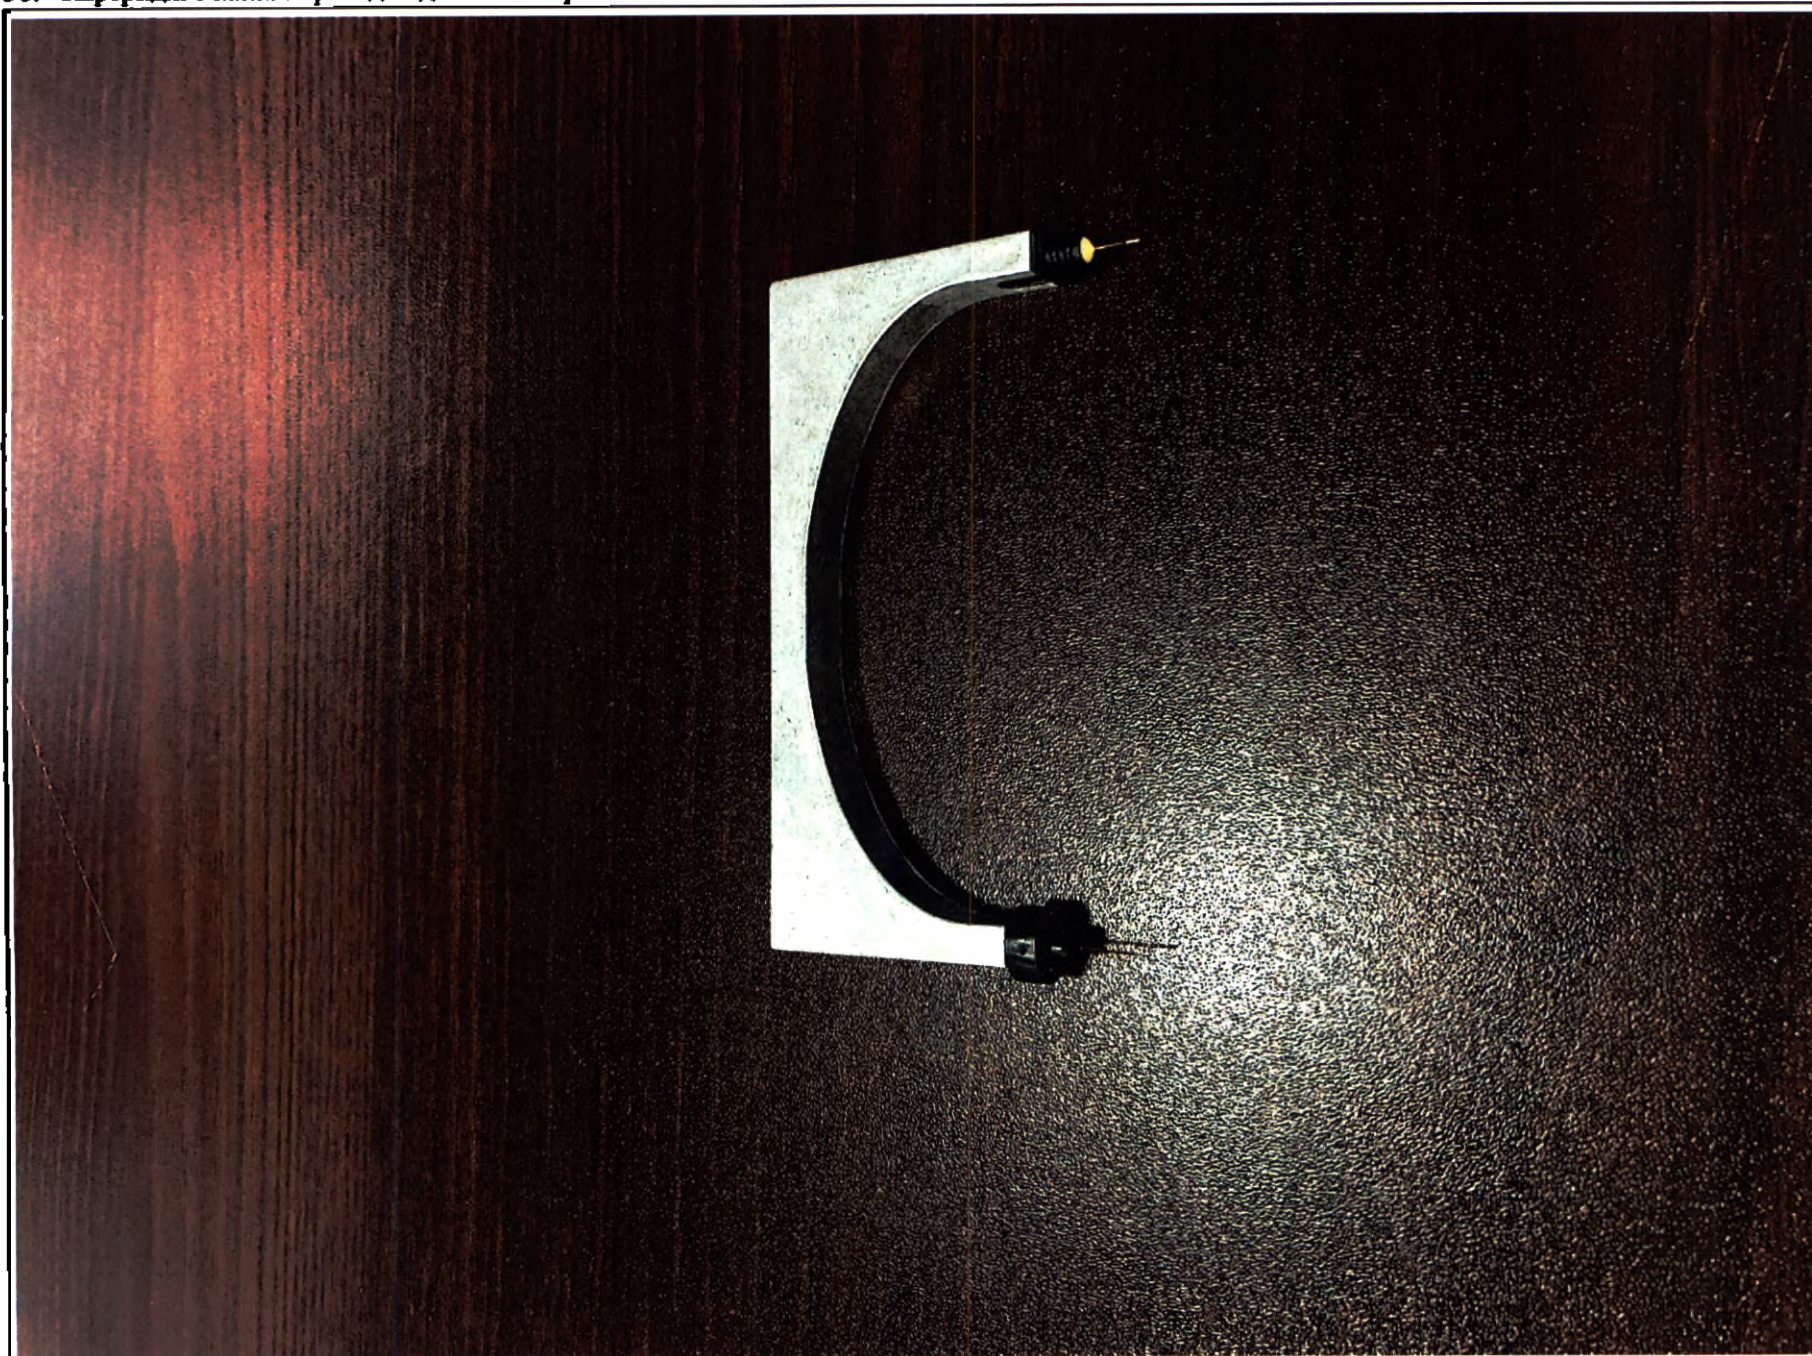





37. Набор для технического сопровождения приборов CAPILLARYS 3, в составе

- 37.1 фильтр воздушный;**
- 37.2 трубочка силиконовая**
- 37.3 дозатор**
- 37.4 клапан 8-ходовой;**
- 37.5 клапан 6-ходовой;**
- 37.6 шайба дозатора металлическая;**
- 37.7 О-кольцо для крышки быстрого подсоединения;**
- 37.8 смазка для О-колец крышки;**
- 37.9 контейнер для отходов внутренний;**
- 37.10 контейнер для промывочного раствора.**


38.1 фильтр воздушный



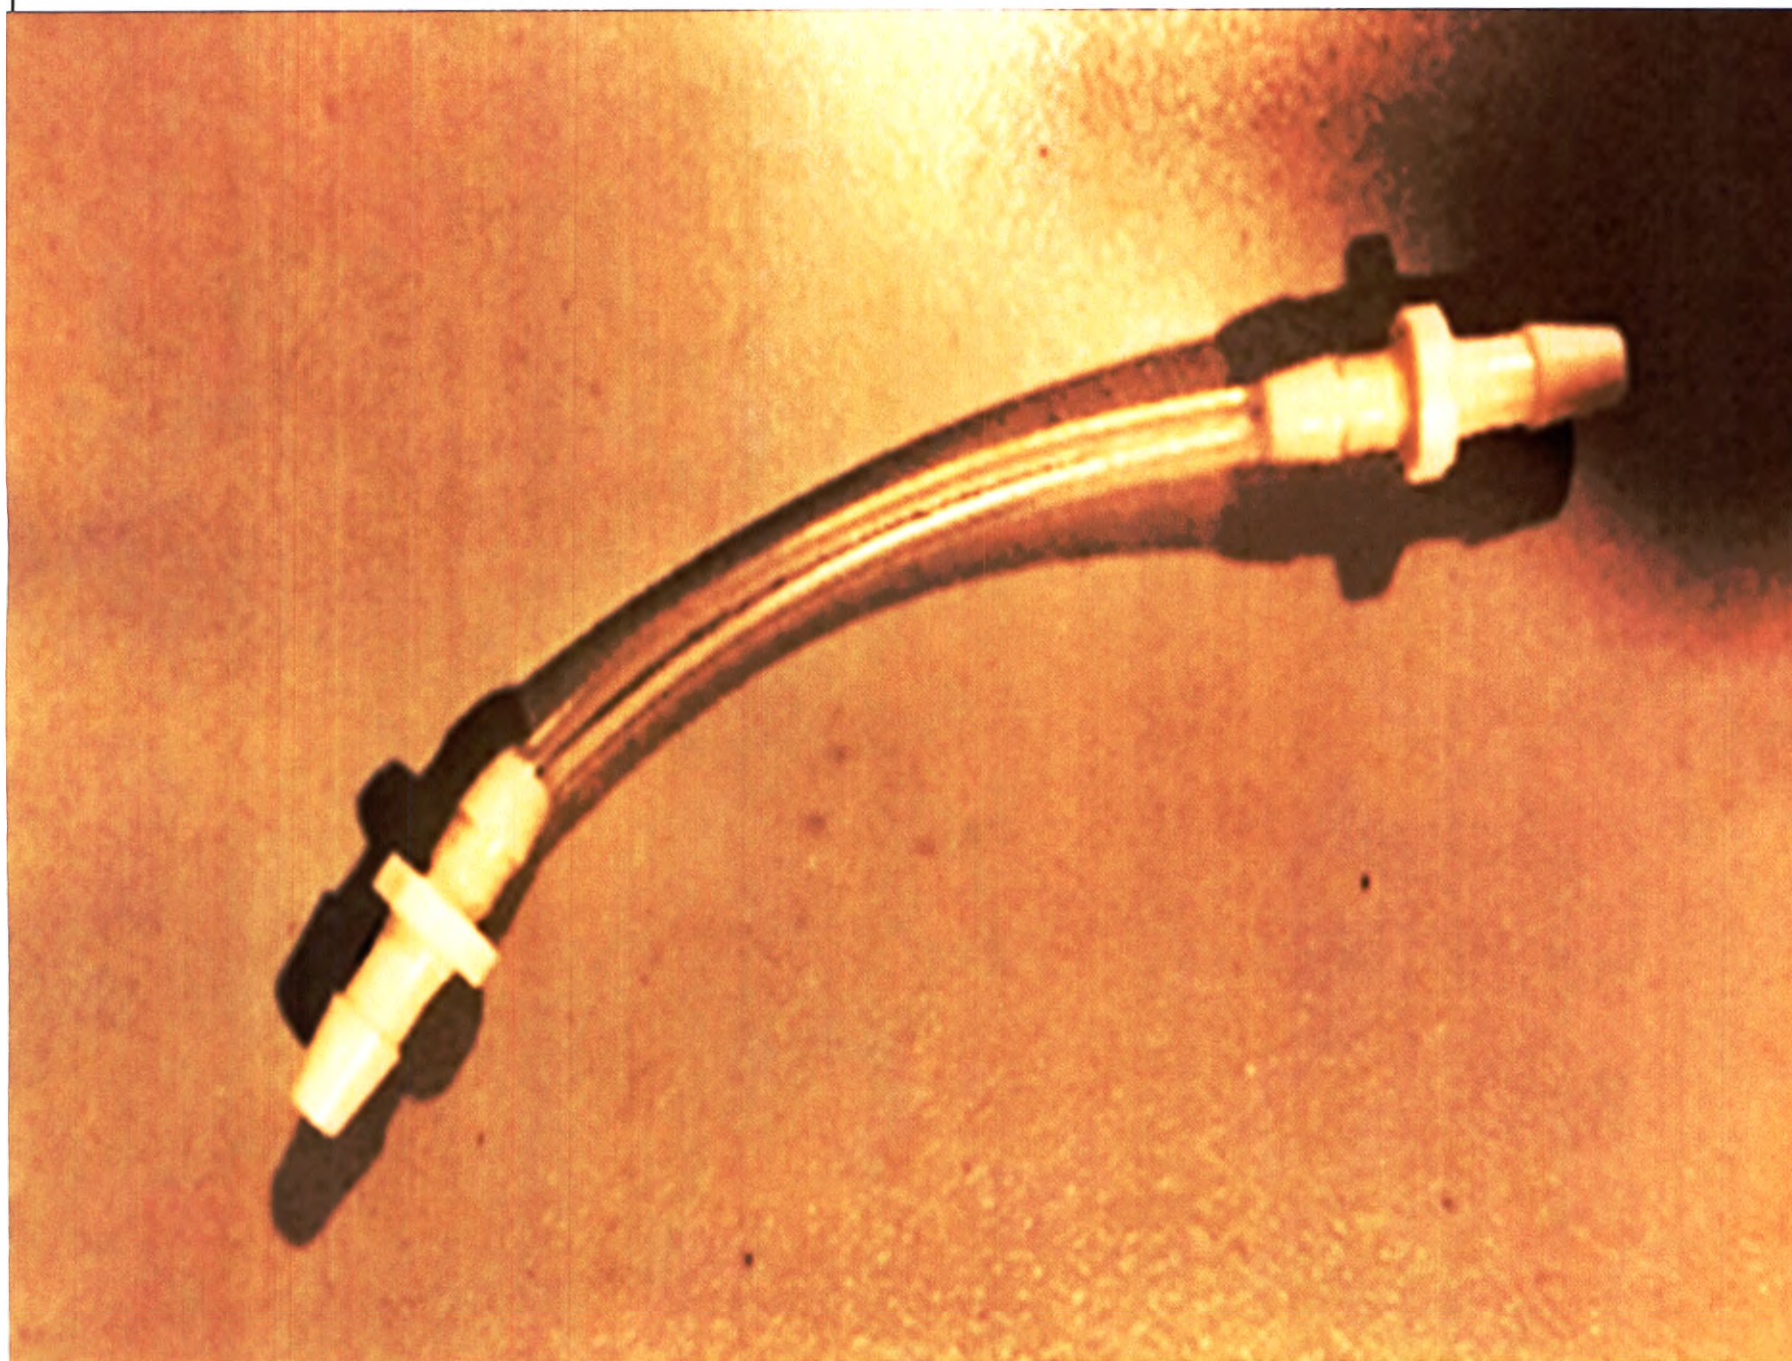

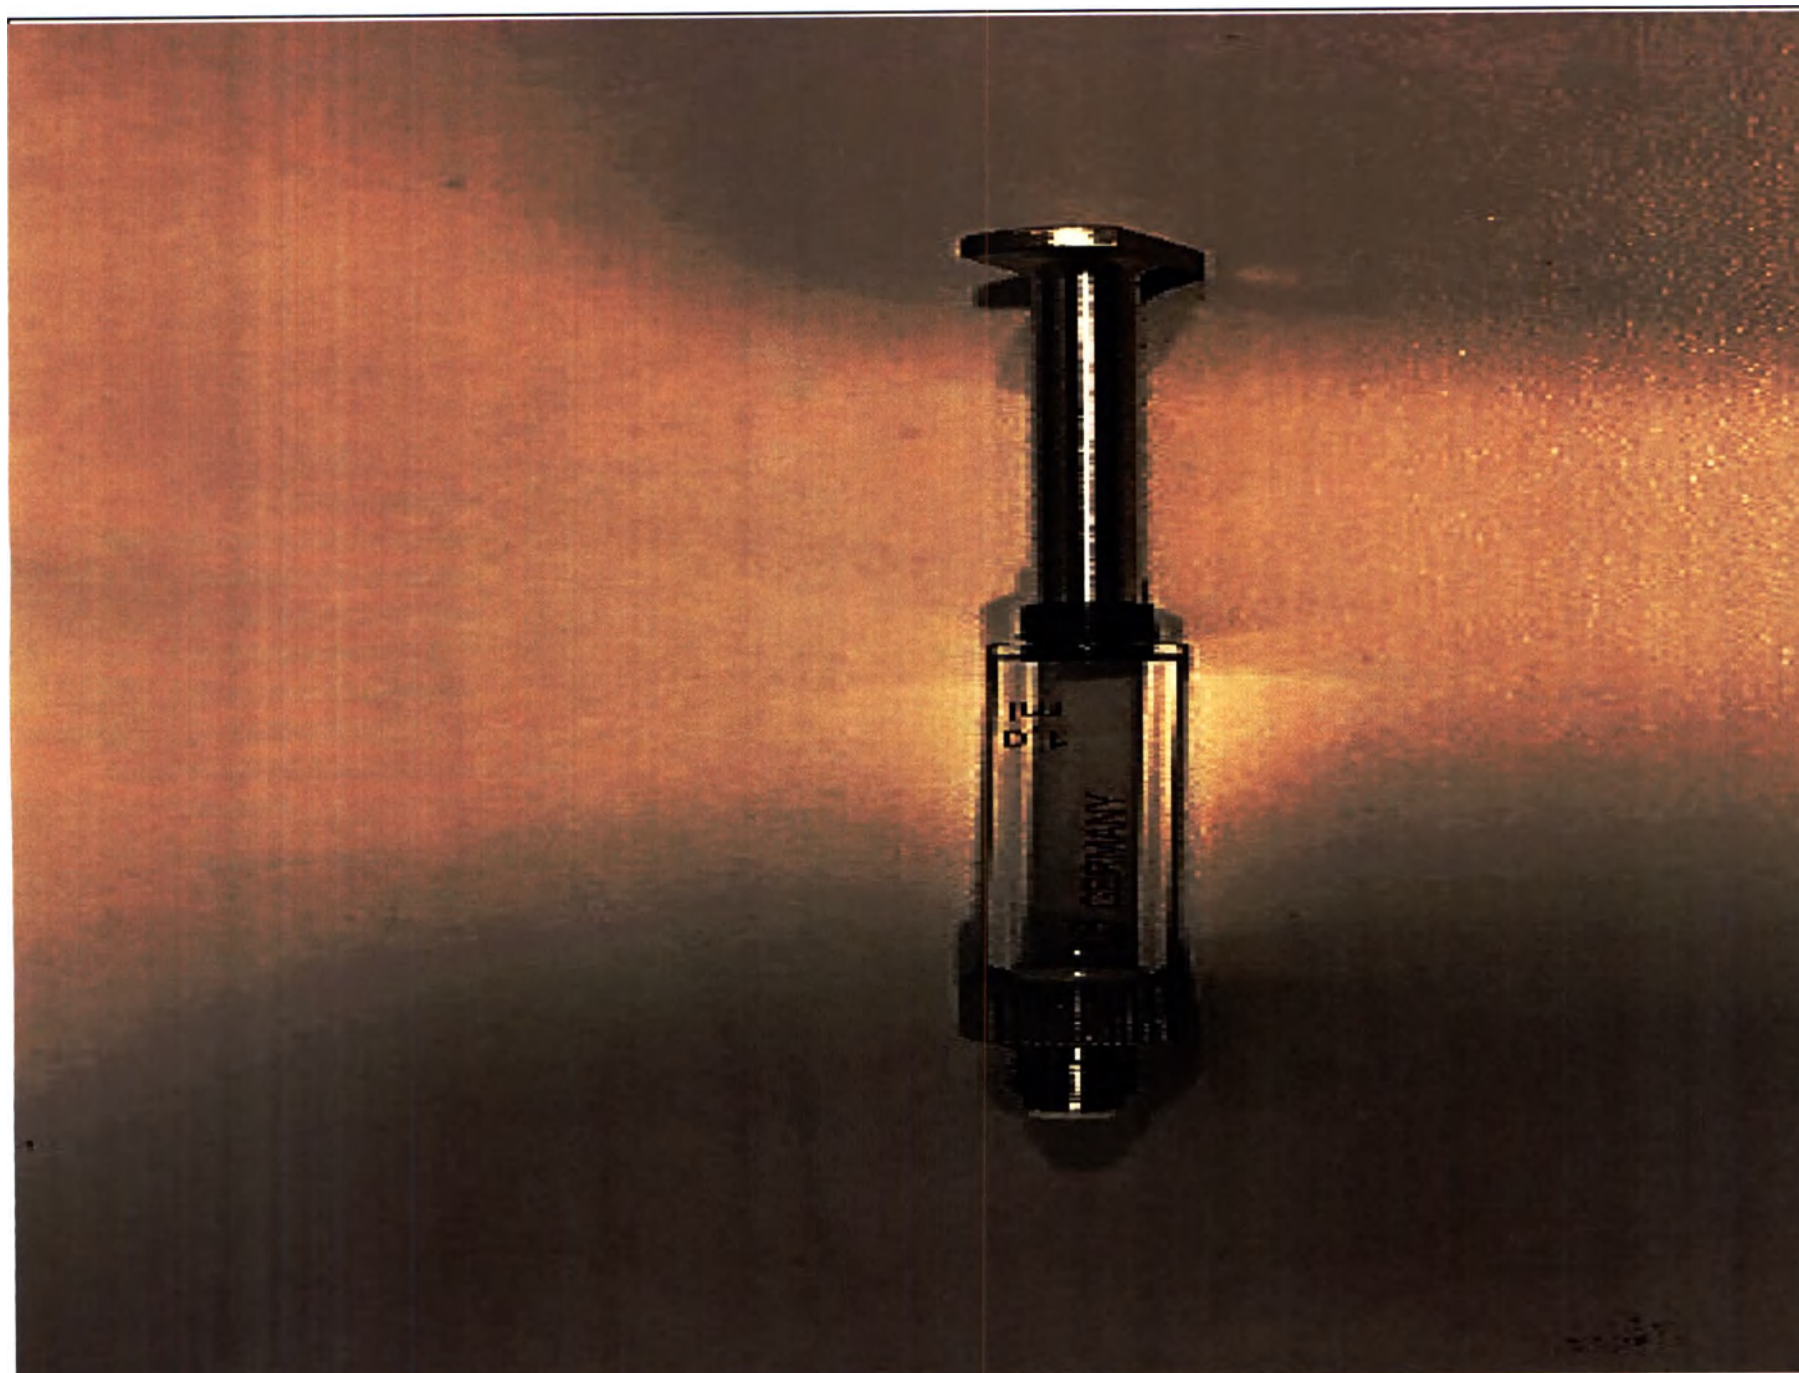


38.4 клапан 8-ходовой

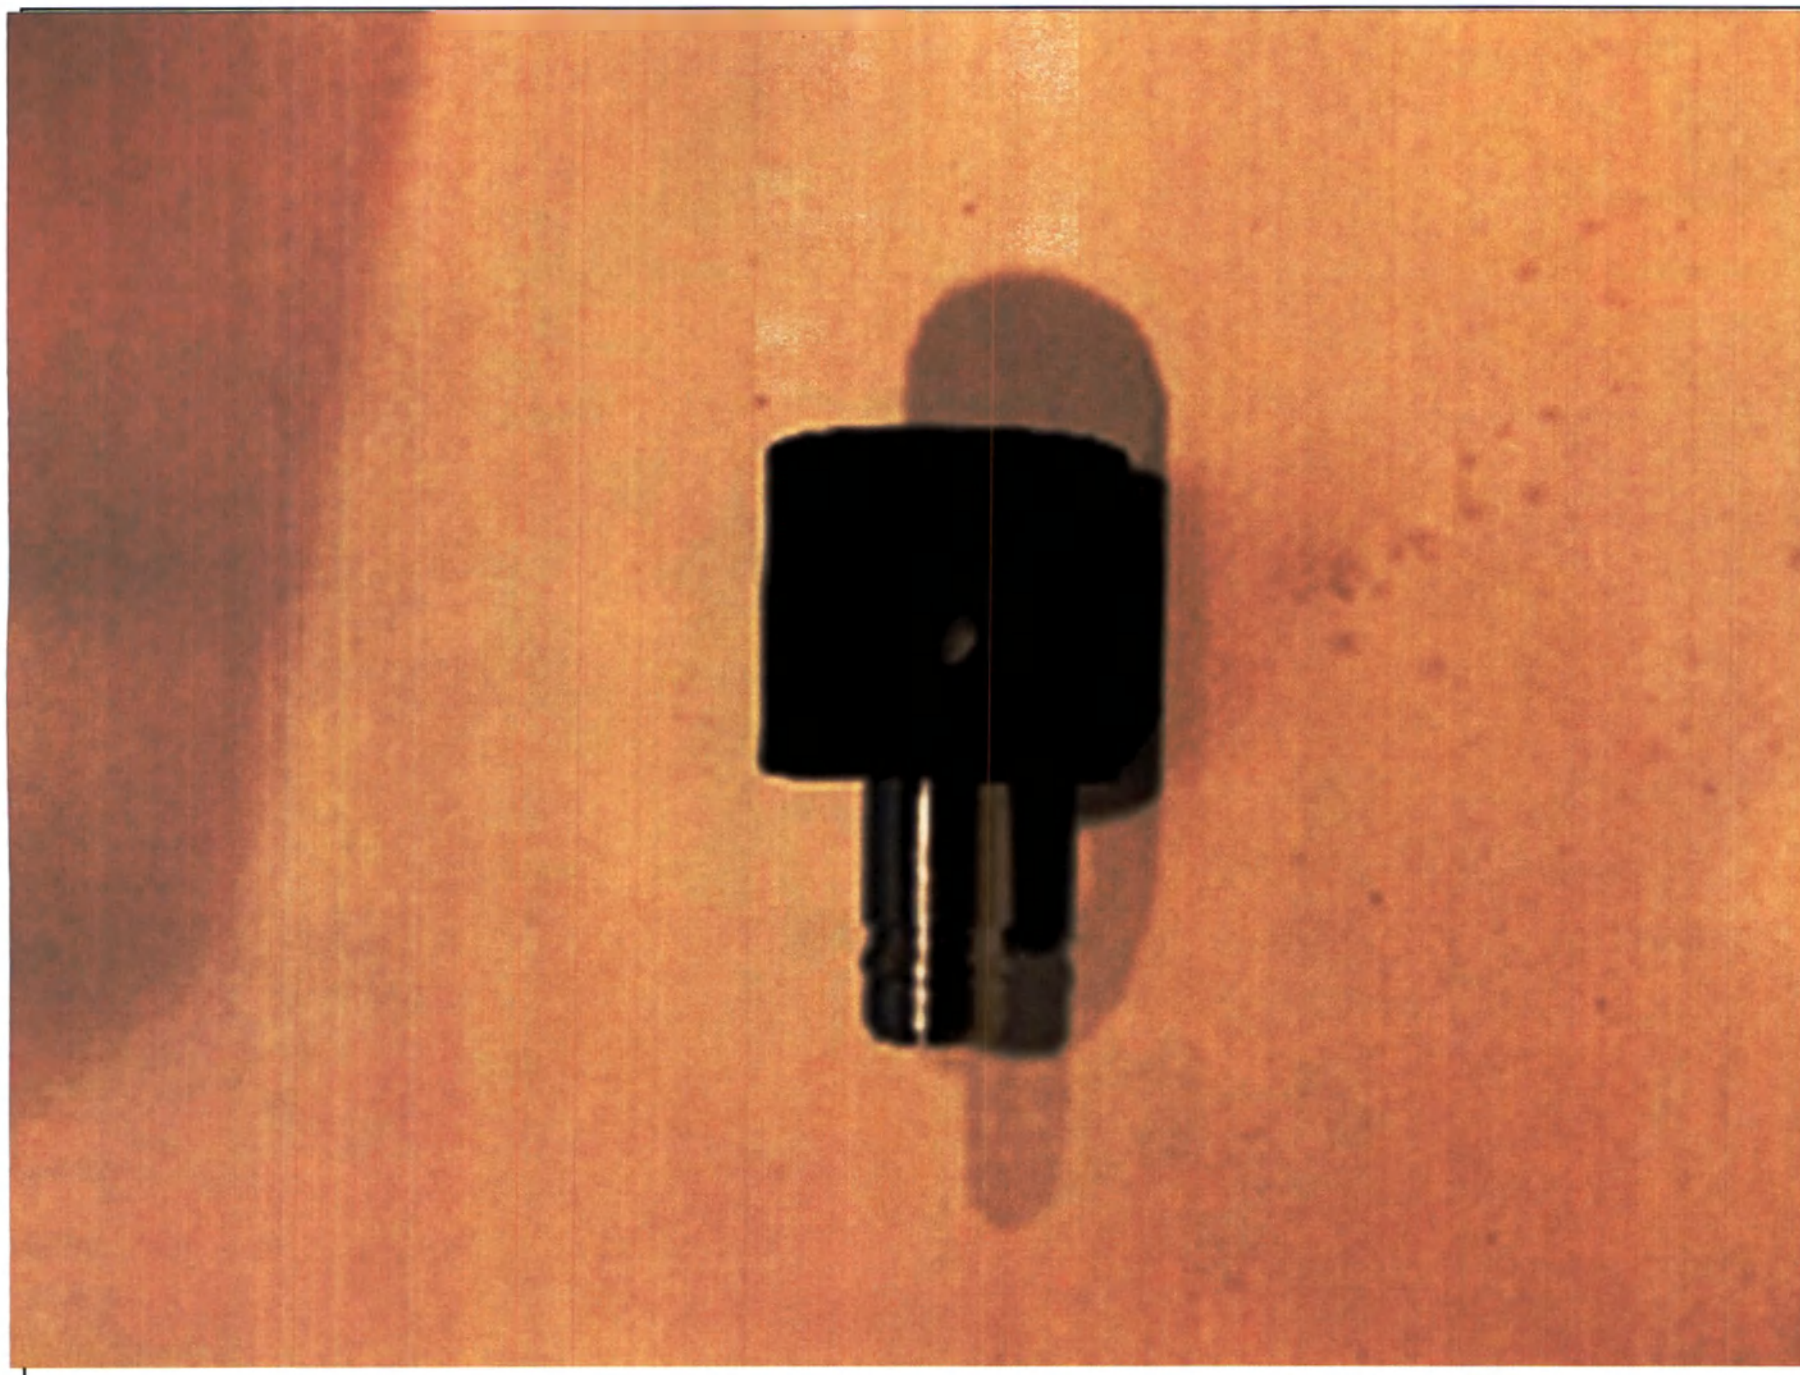


38.5 клапан 6-ходовой



38.6 шайба дозатора металлическая

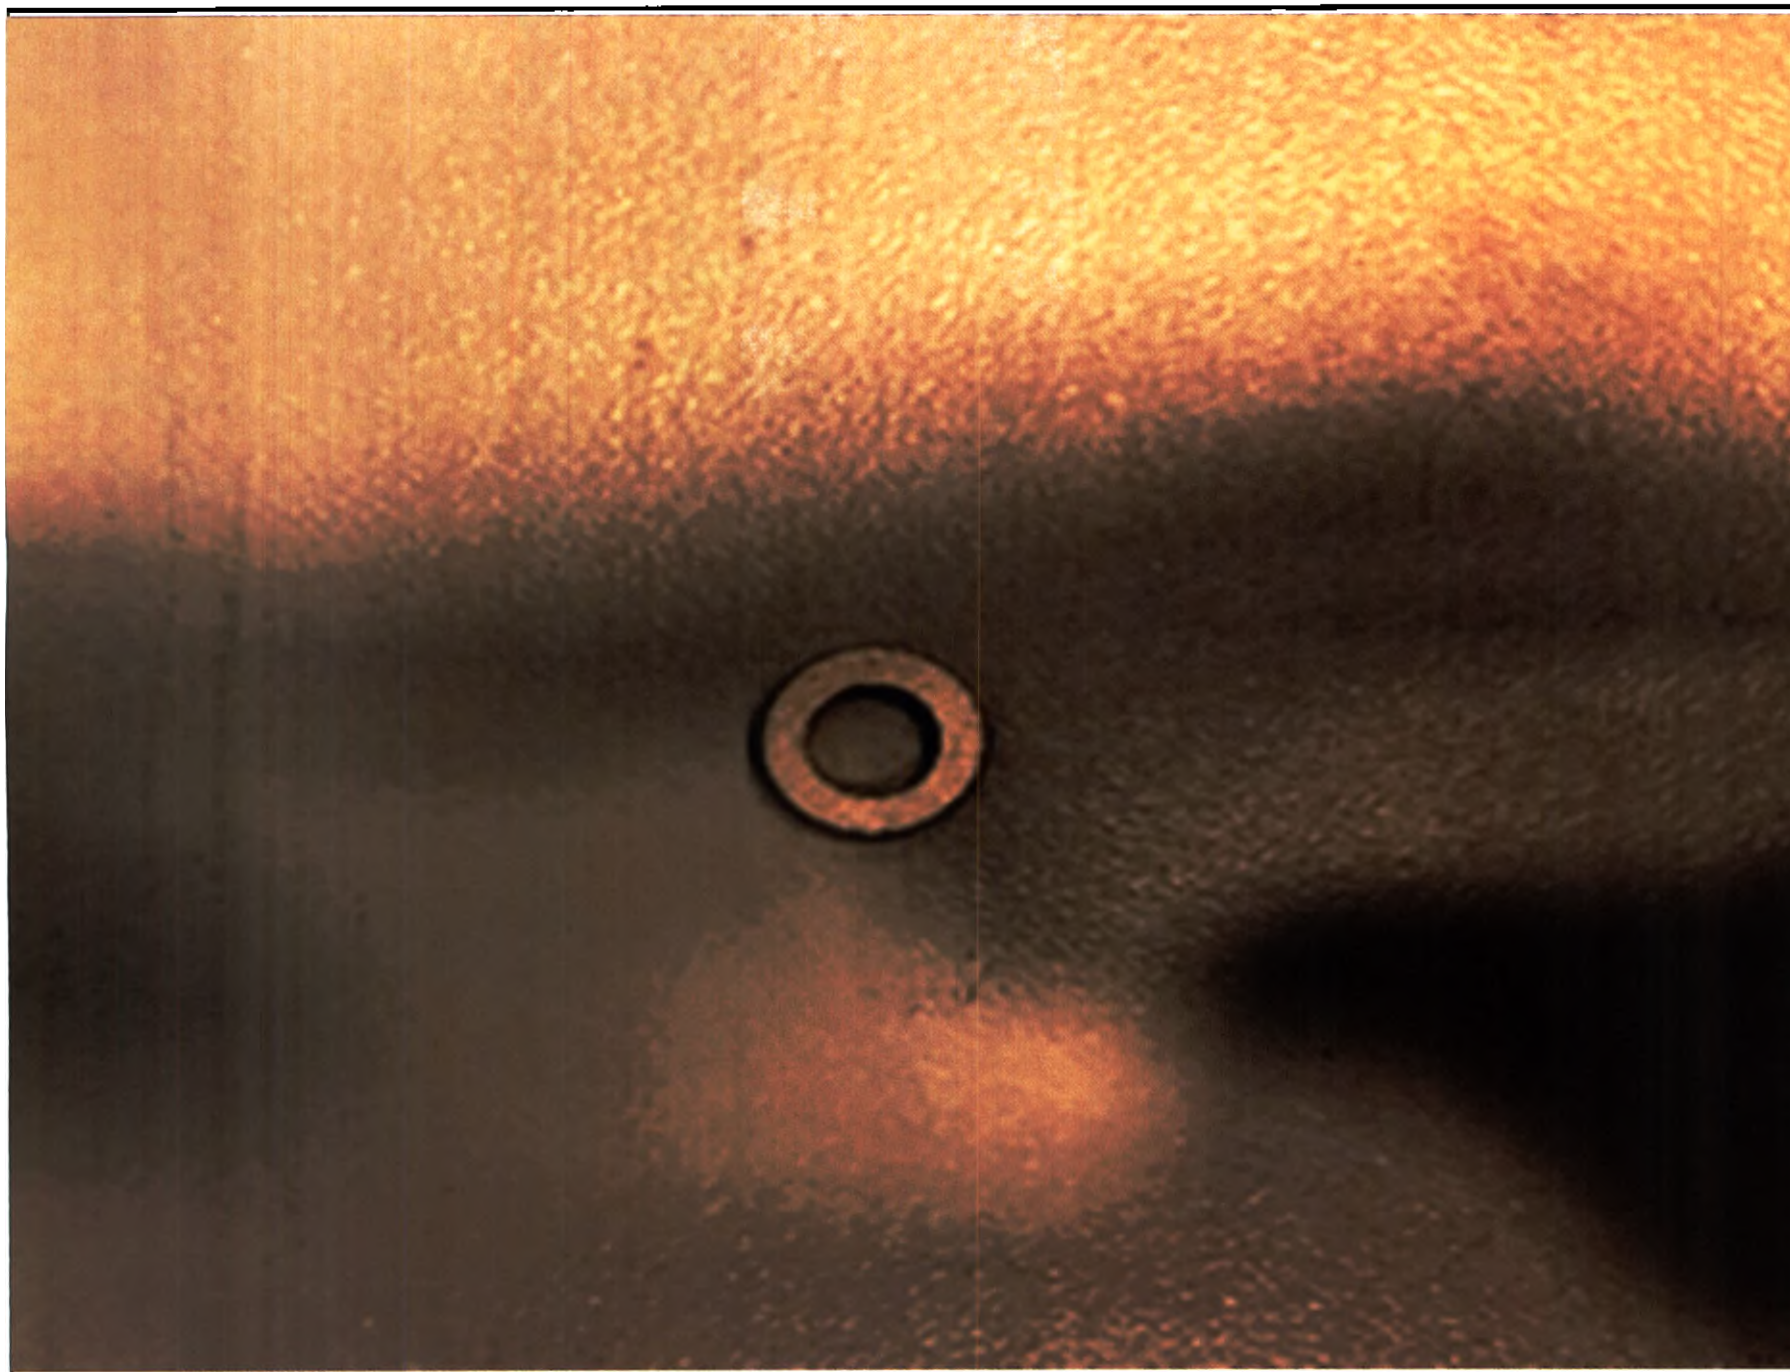

38.7 O-кольцо для крышки быстрого подсоединения

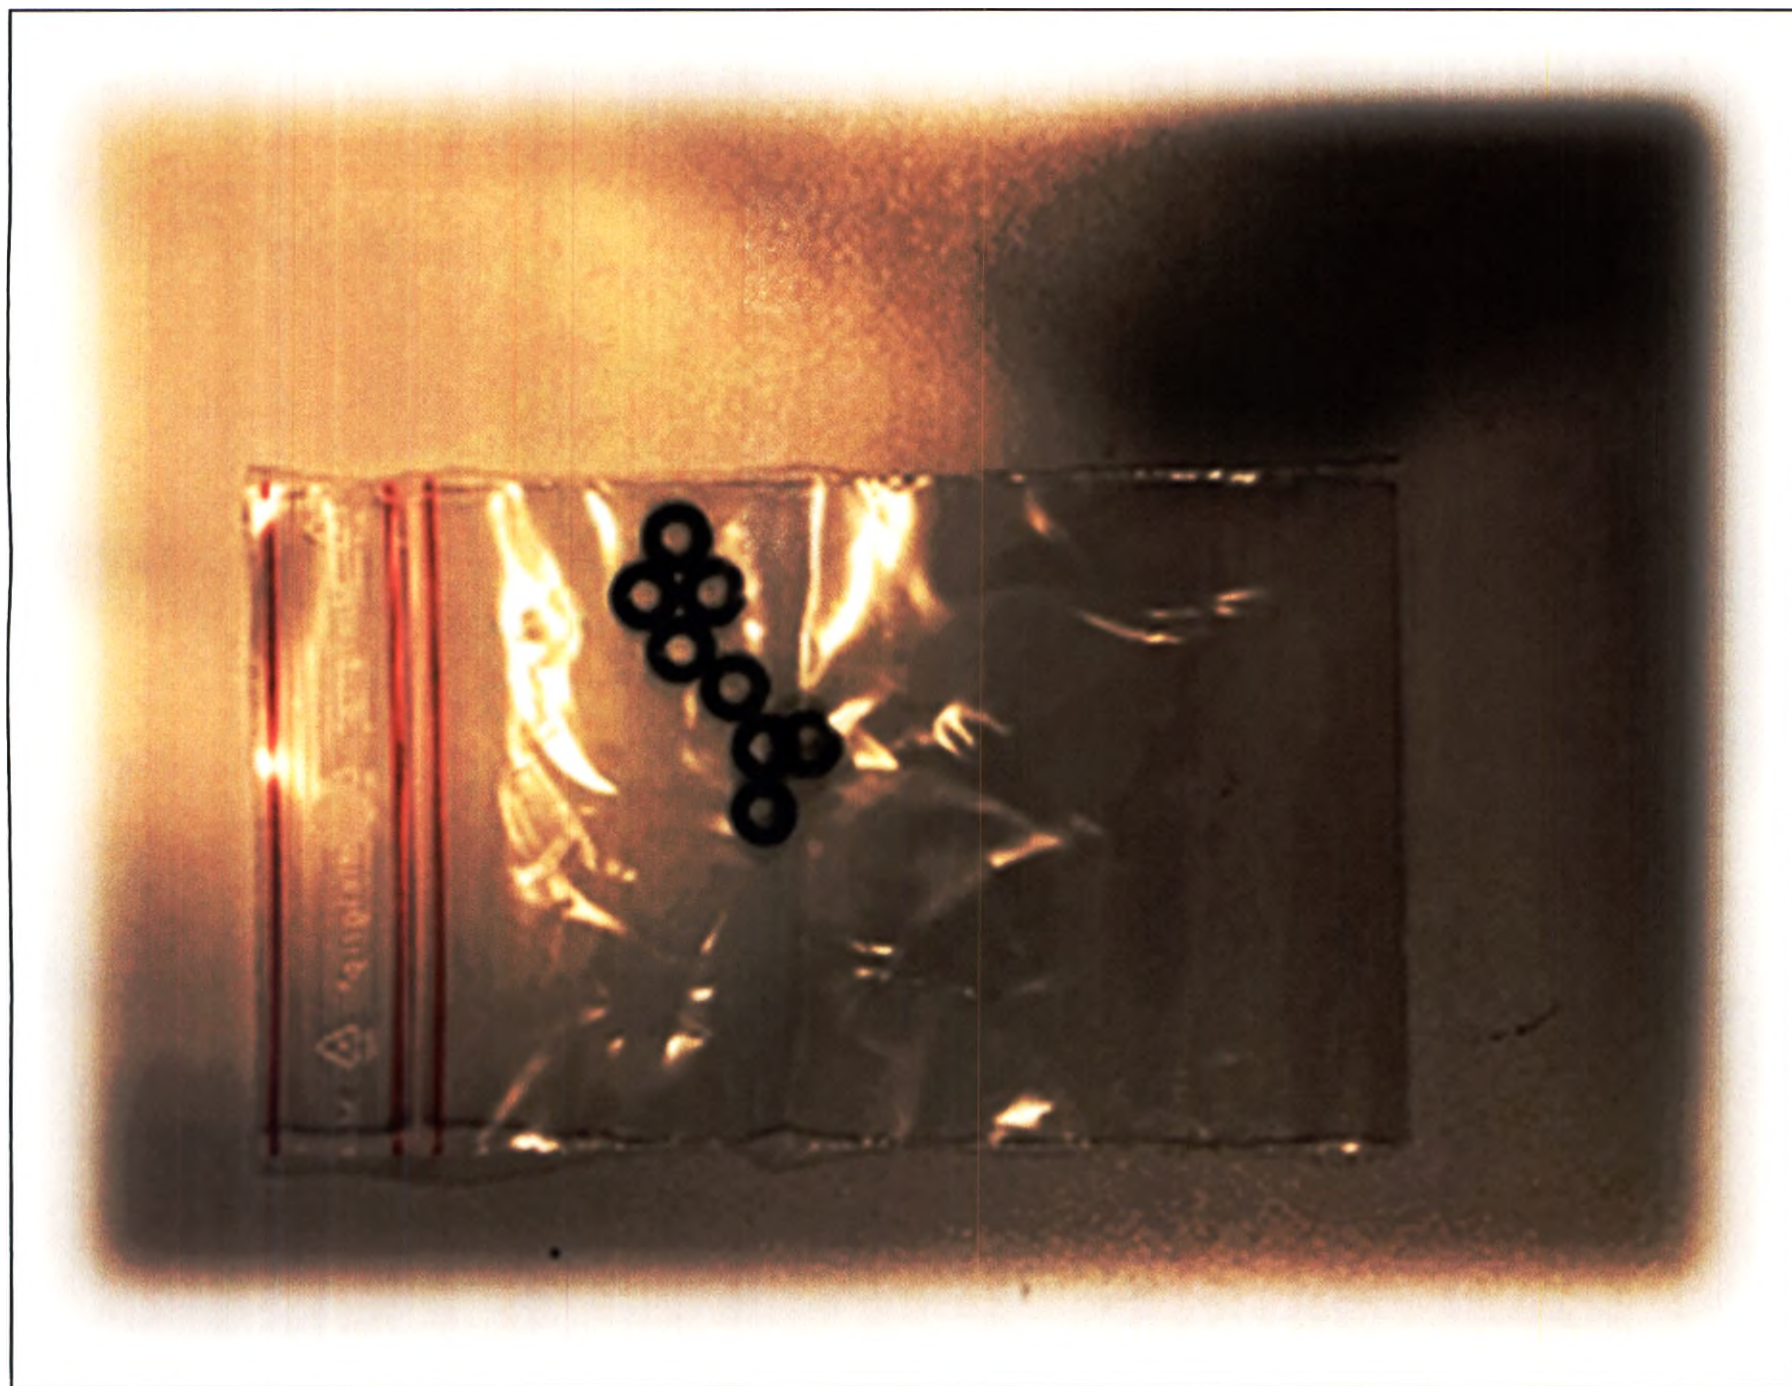





38.10 контейнер для промывочного раствора



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
116 ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Илатов С.Б.
Илатов С.Б.

