

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Миндрей Медикал Рус»

По доверенности  
от 26.08.19  
Сырова Н.В.  
Син Чэнь  
2020 г.




#### ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса  
иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL  
для диагностики in vitro, лоты 2020060211, 2020070121, 2020070122

1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020060211»:

- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgM - 2 шт

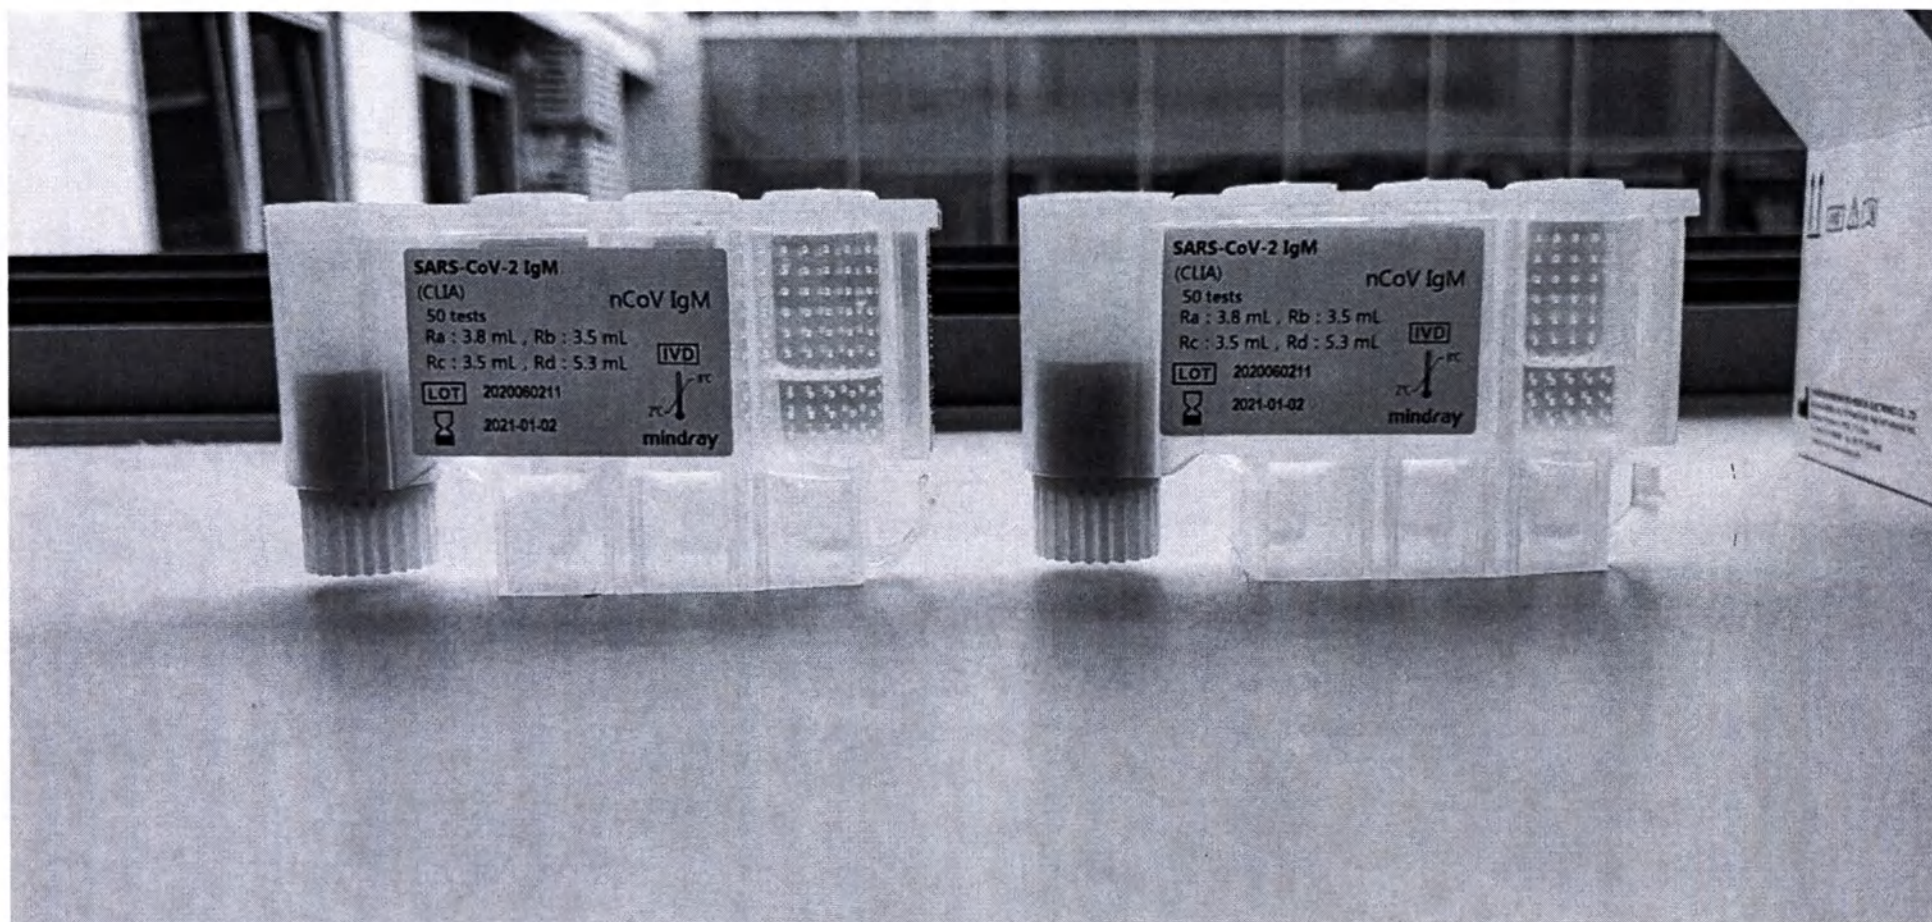


калибратор SARS-CoV-2 IgM (C0), уровень 0 – 1 шт

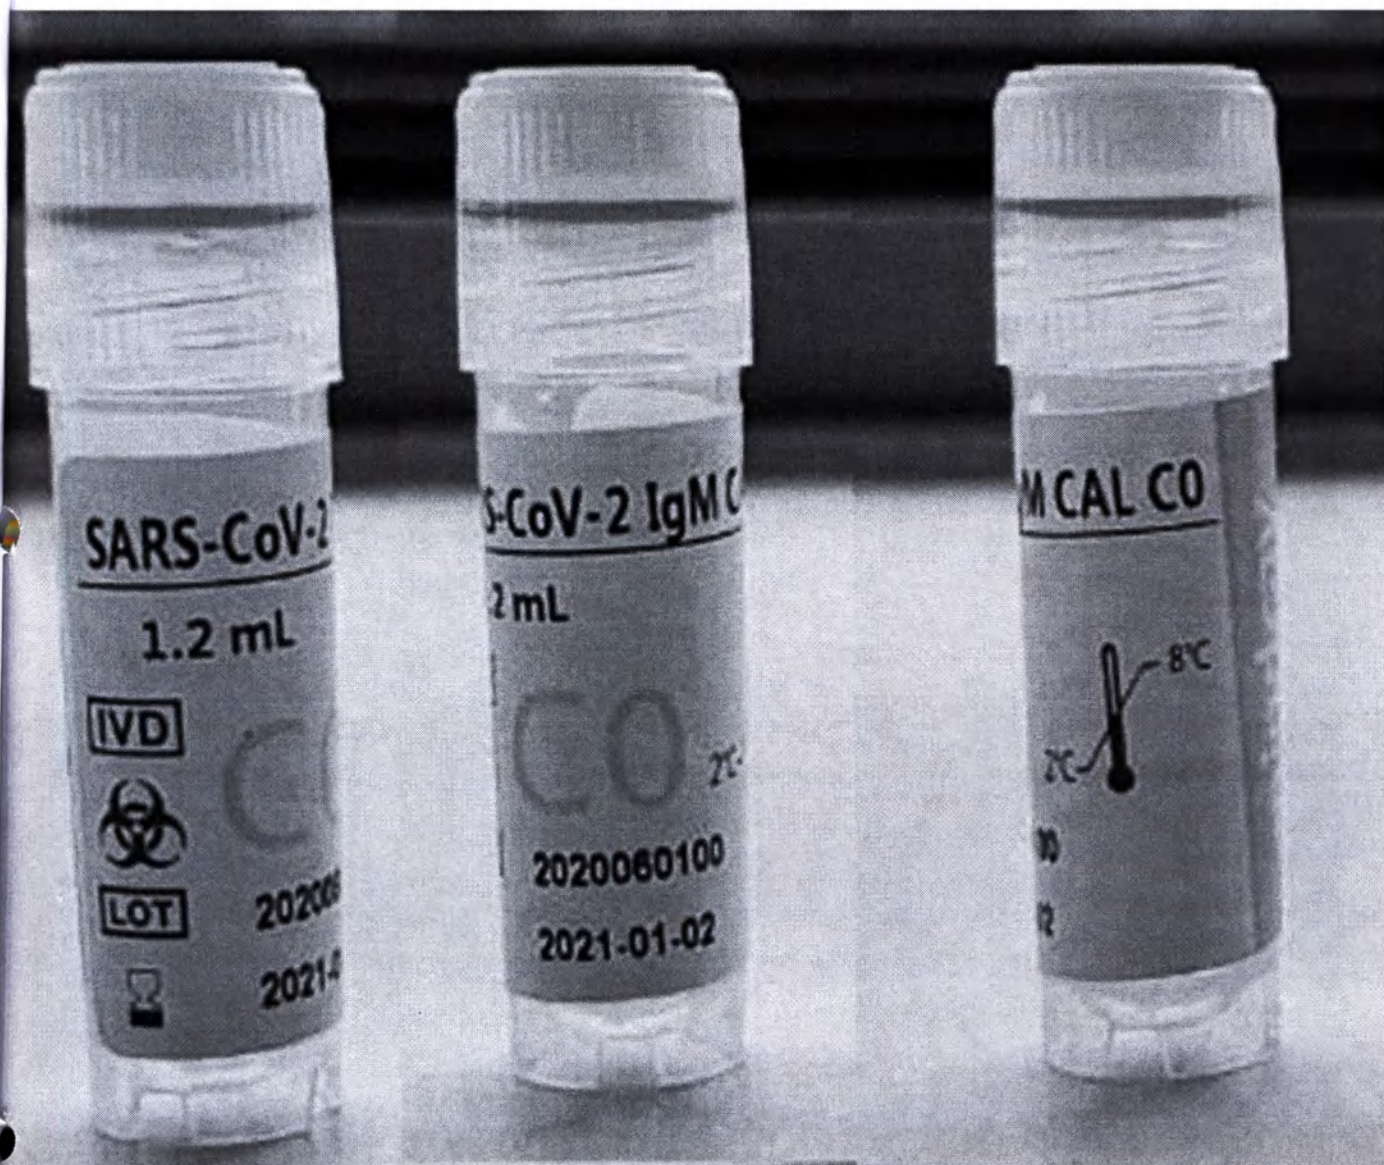

- Калибратор SARS-CoV-2 IgM (C1), уровень 1 – 1 шт;



Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020060211»

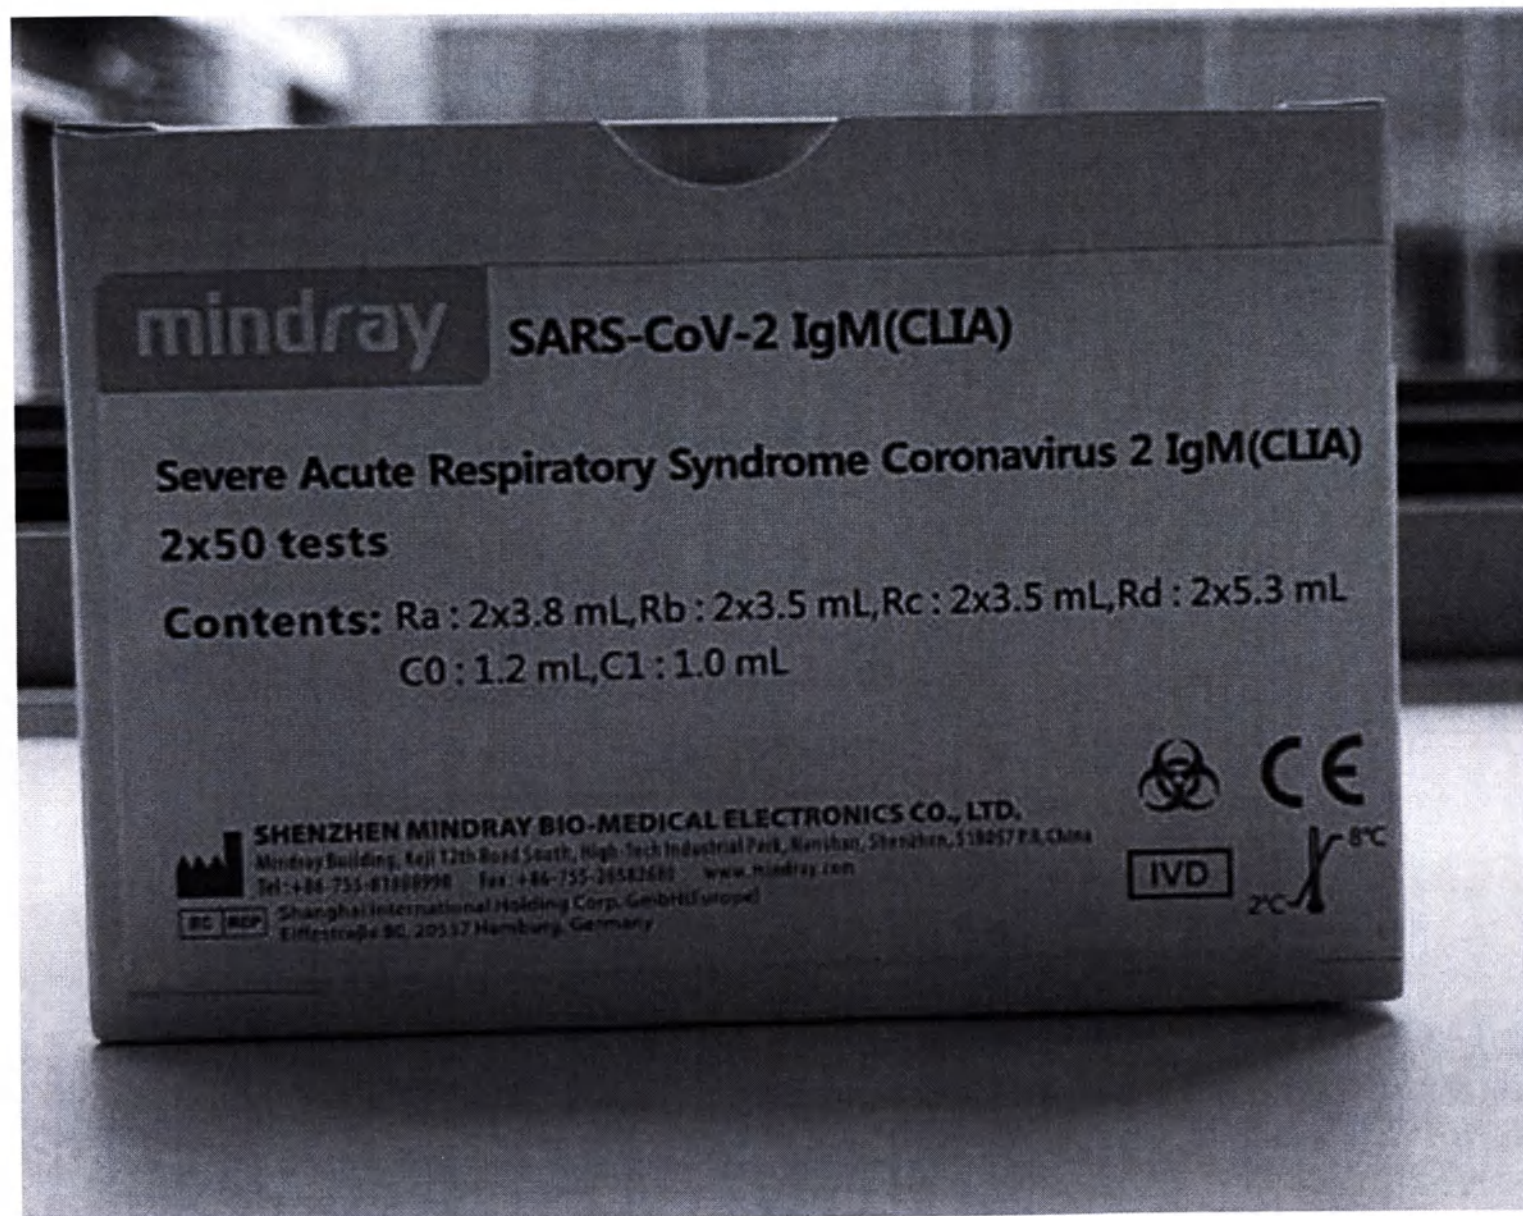

**mindray**

**SARS-CoV-2 IgM(CLIA)**



**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgM(CLIA)**

**2x50 tests**

**REF**

**SARS-CoV-2 IgM121**

**P/N: 105-019873-00**

**LOT**

**2020060211**




**2021-01-02**



**PL3202006021100969**

047-035128-00 (1.0)


2. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020070121»:  
- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgM - 2 шт

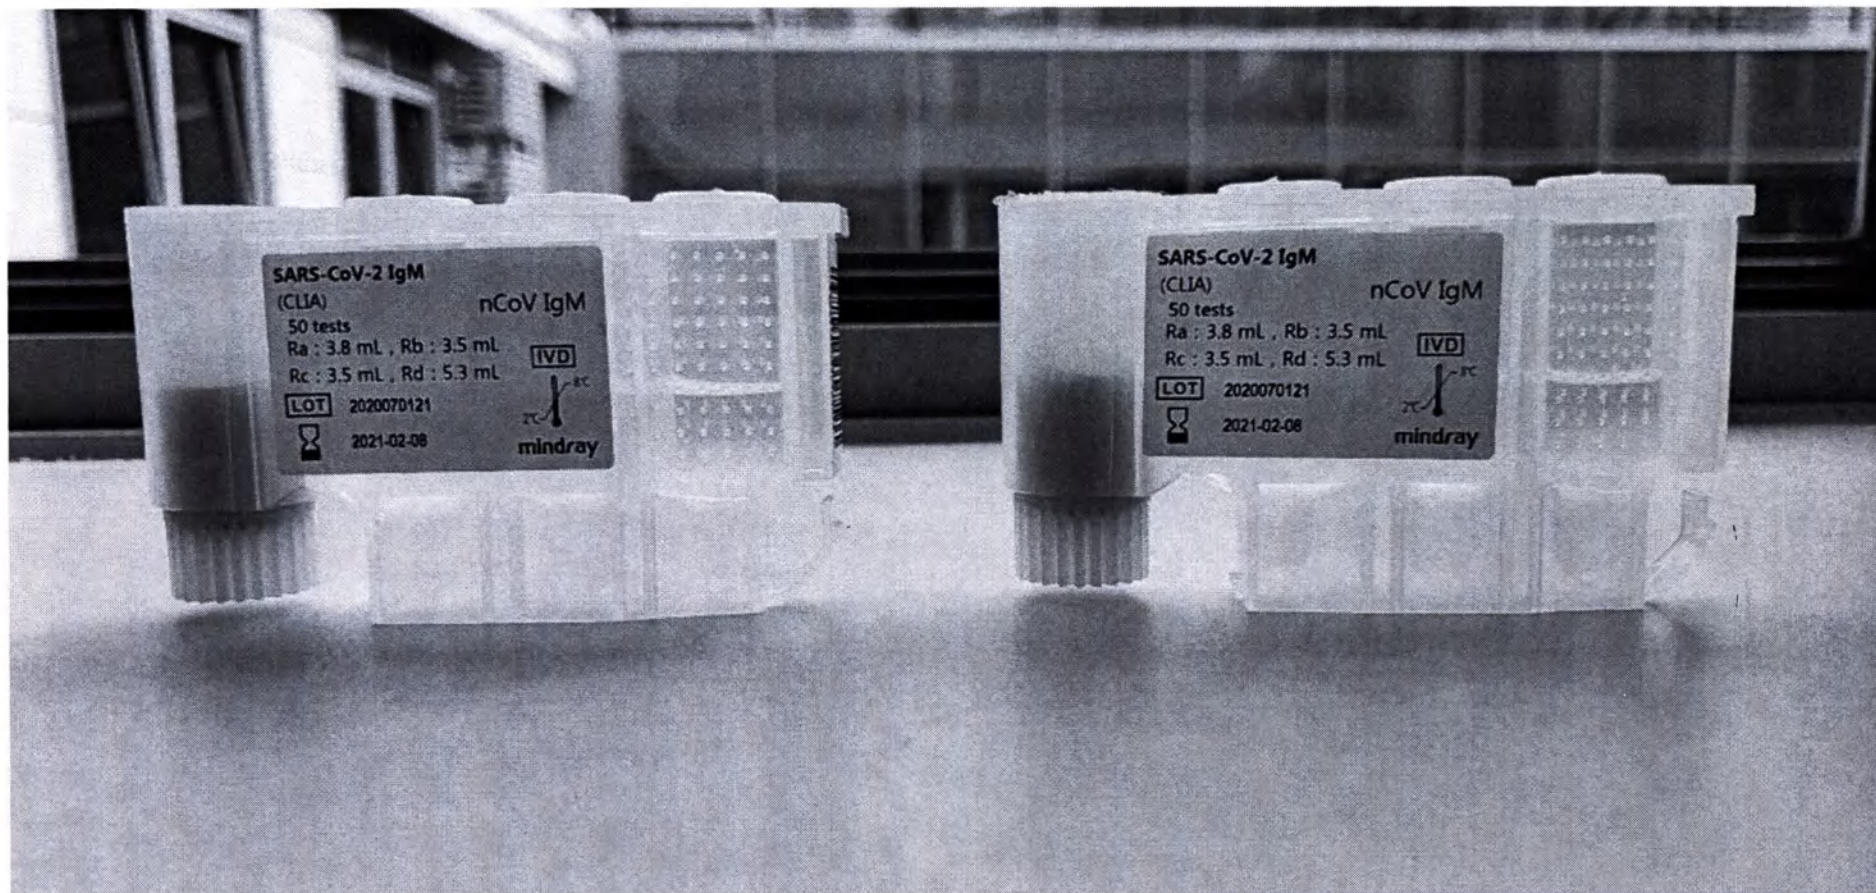


Калибратор SARS-CoV-2 IgM (C0), уровень 0 – 1 шт




- Калибратор SARS-CoV-2 IgM (C1), уровень 1 – 1 шт;

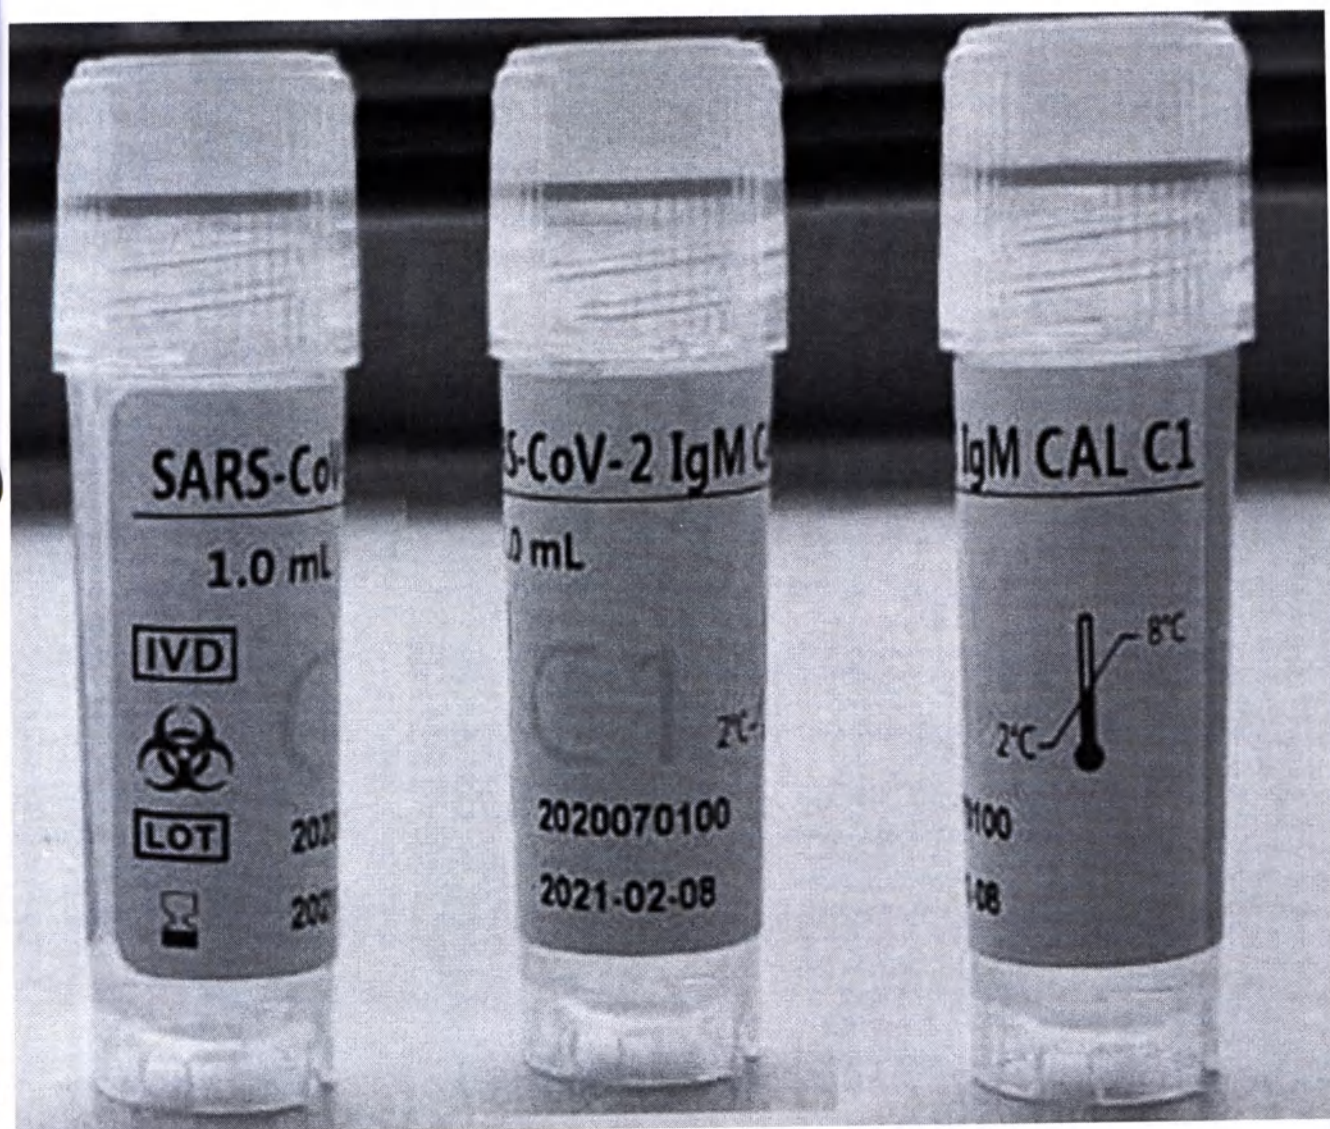


Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020070121»

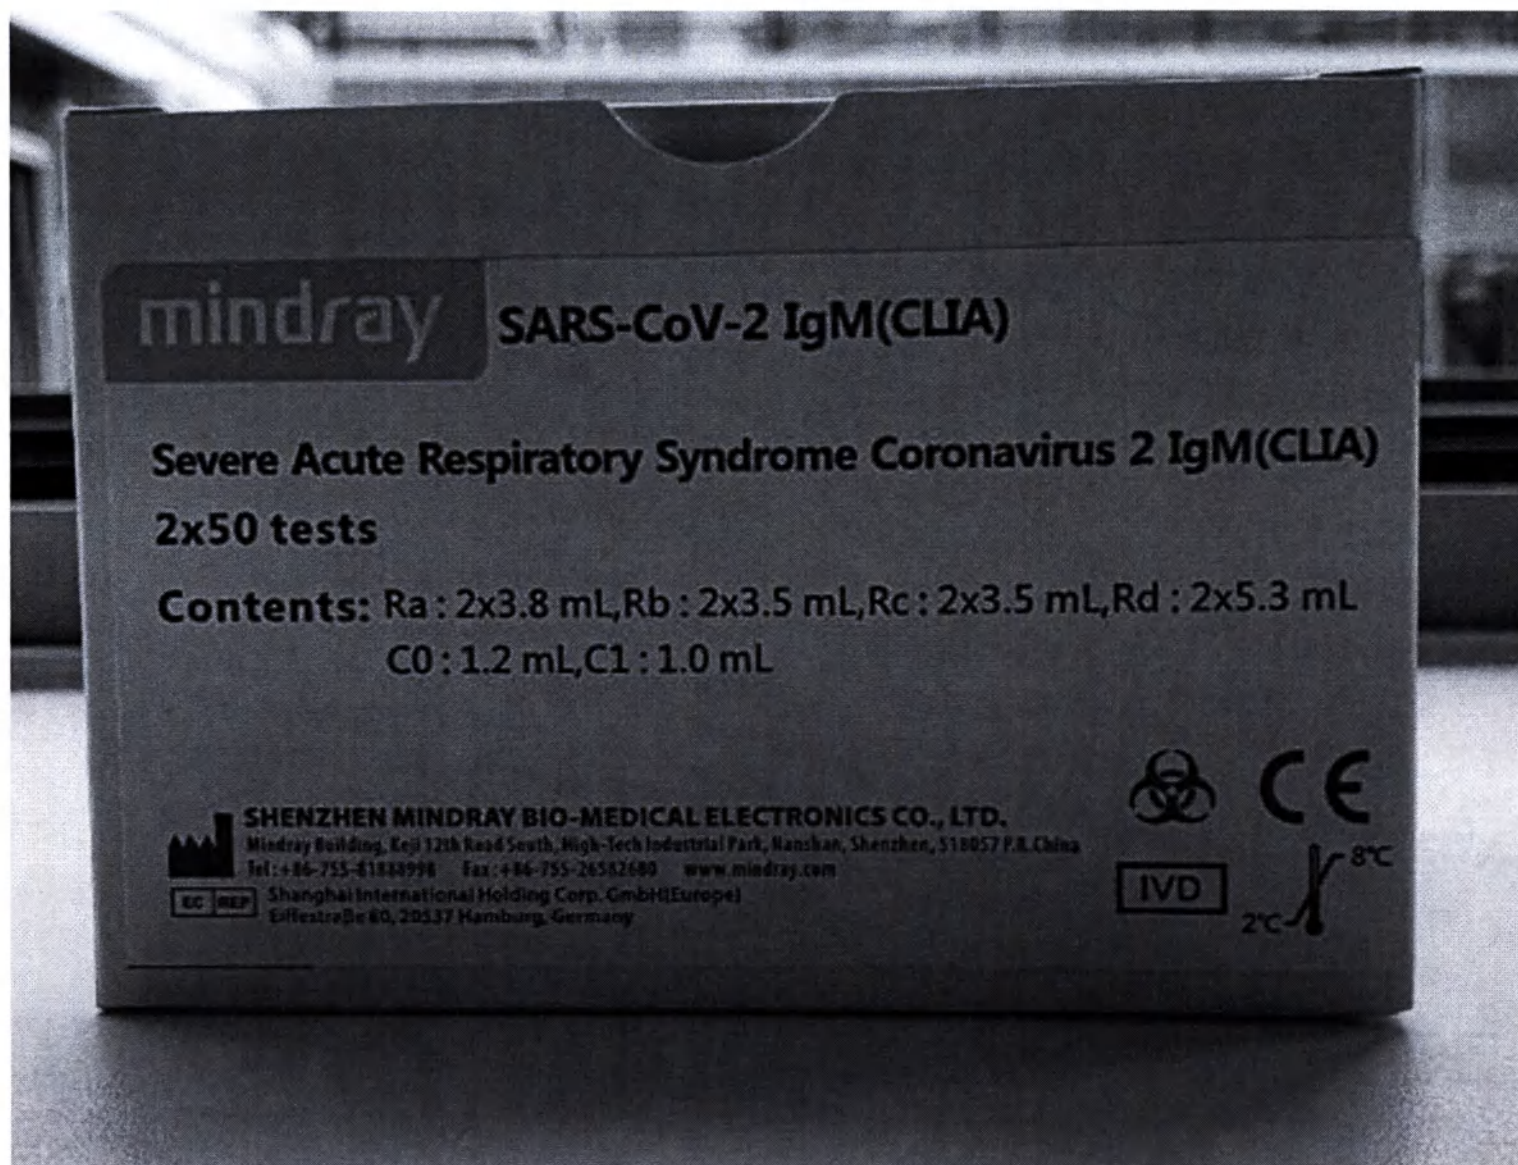

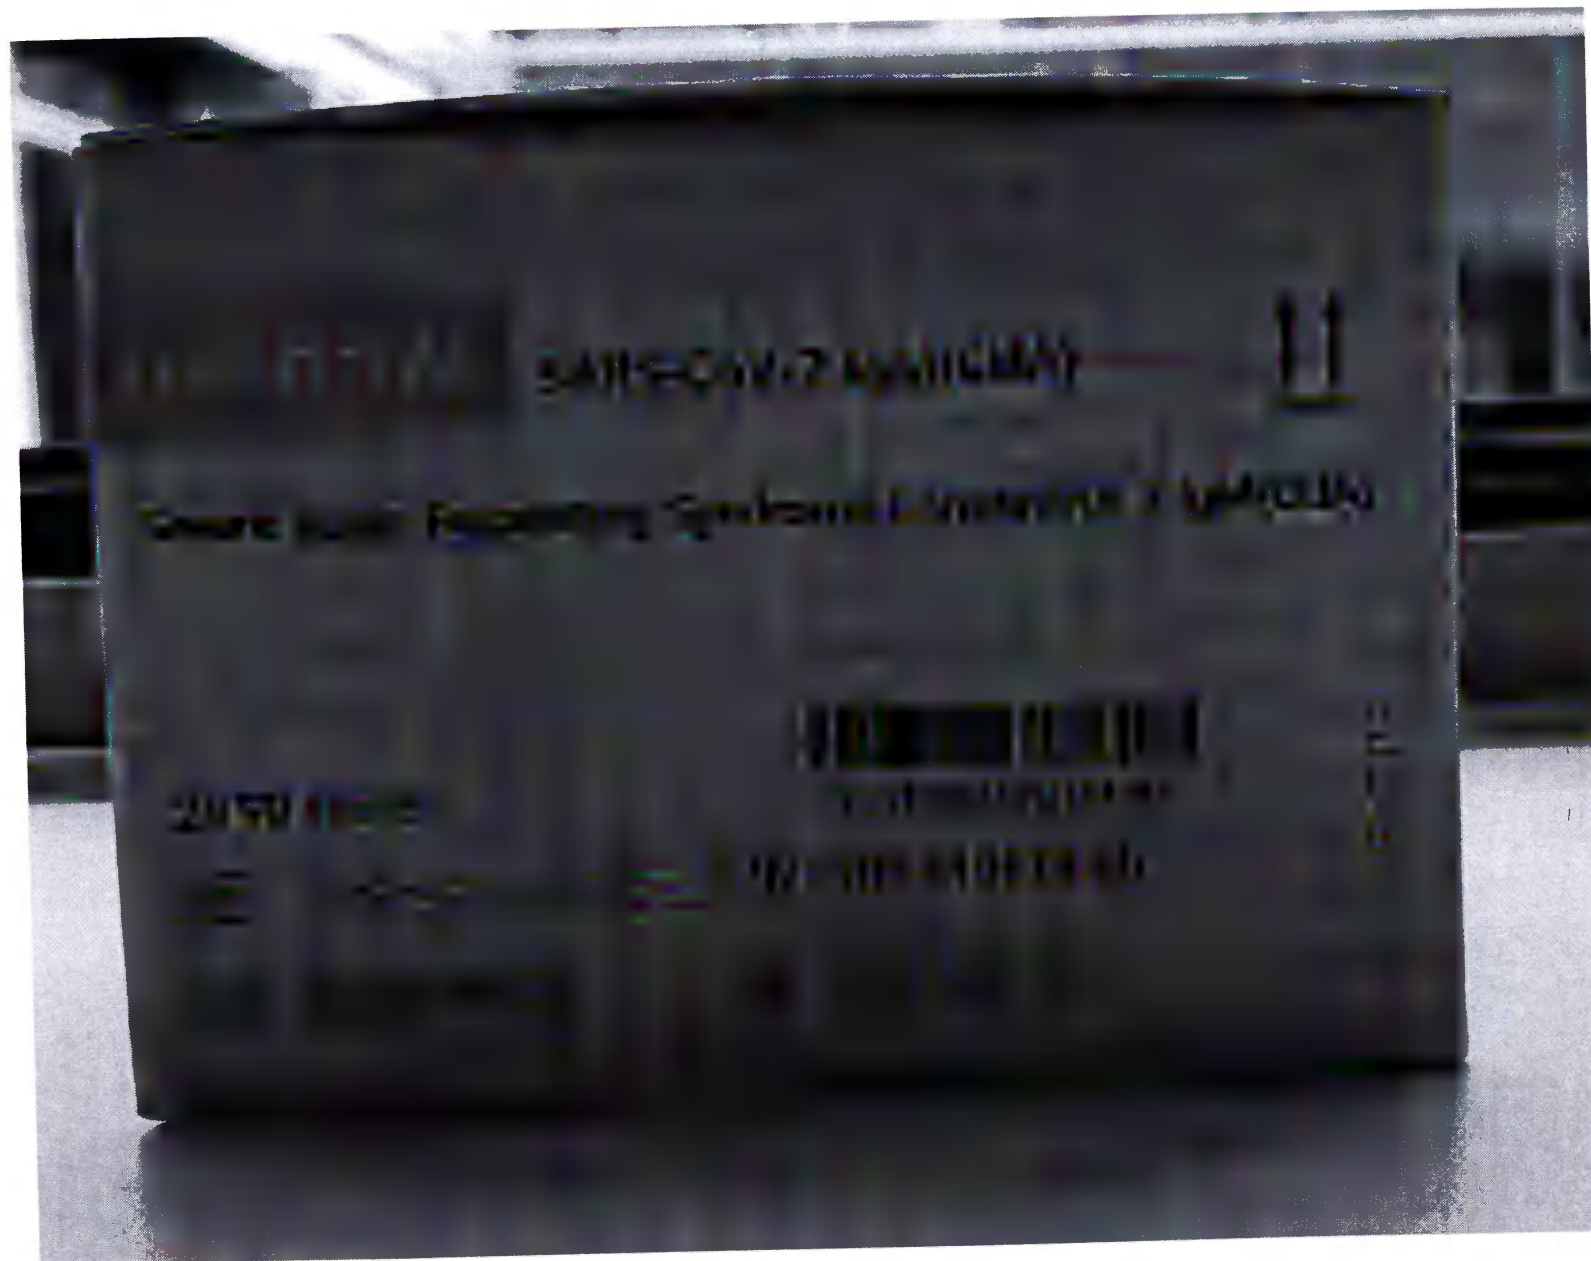

3. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020070122»:


- Кассета с реагентами SARS-CoV-2 IgM - 2 шт

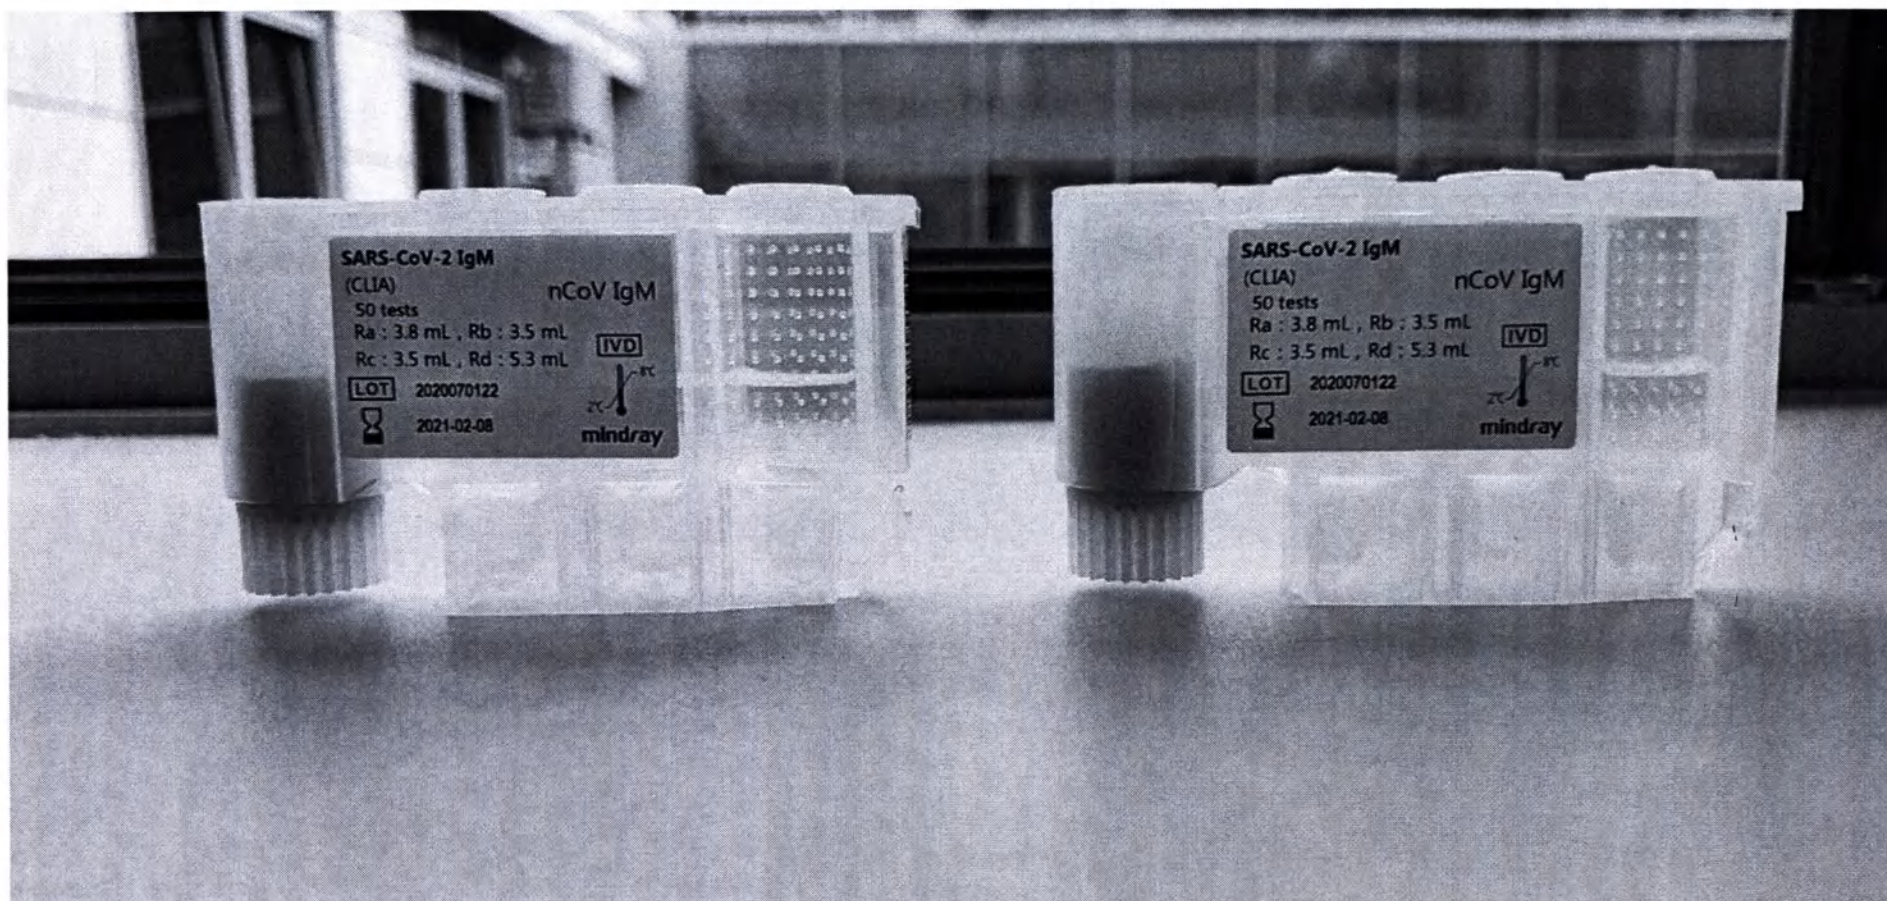


- Калибратор SARS-CoV-2 IgM (C0), уровень 0 – 1 шт



- Калибратор SARS-CoV-2 IgM (C1), уровень 1 – 1 шт;

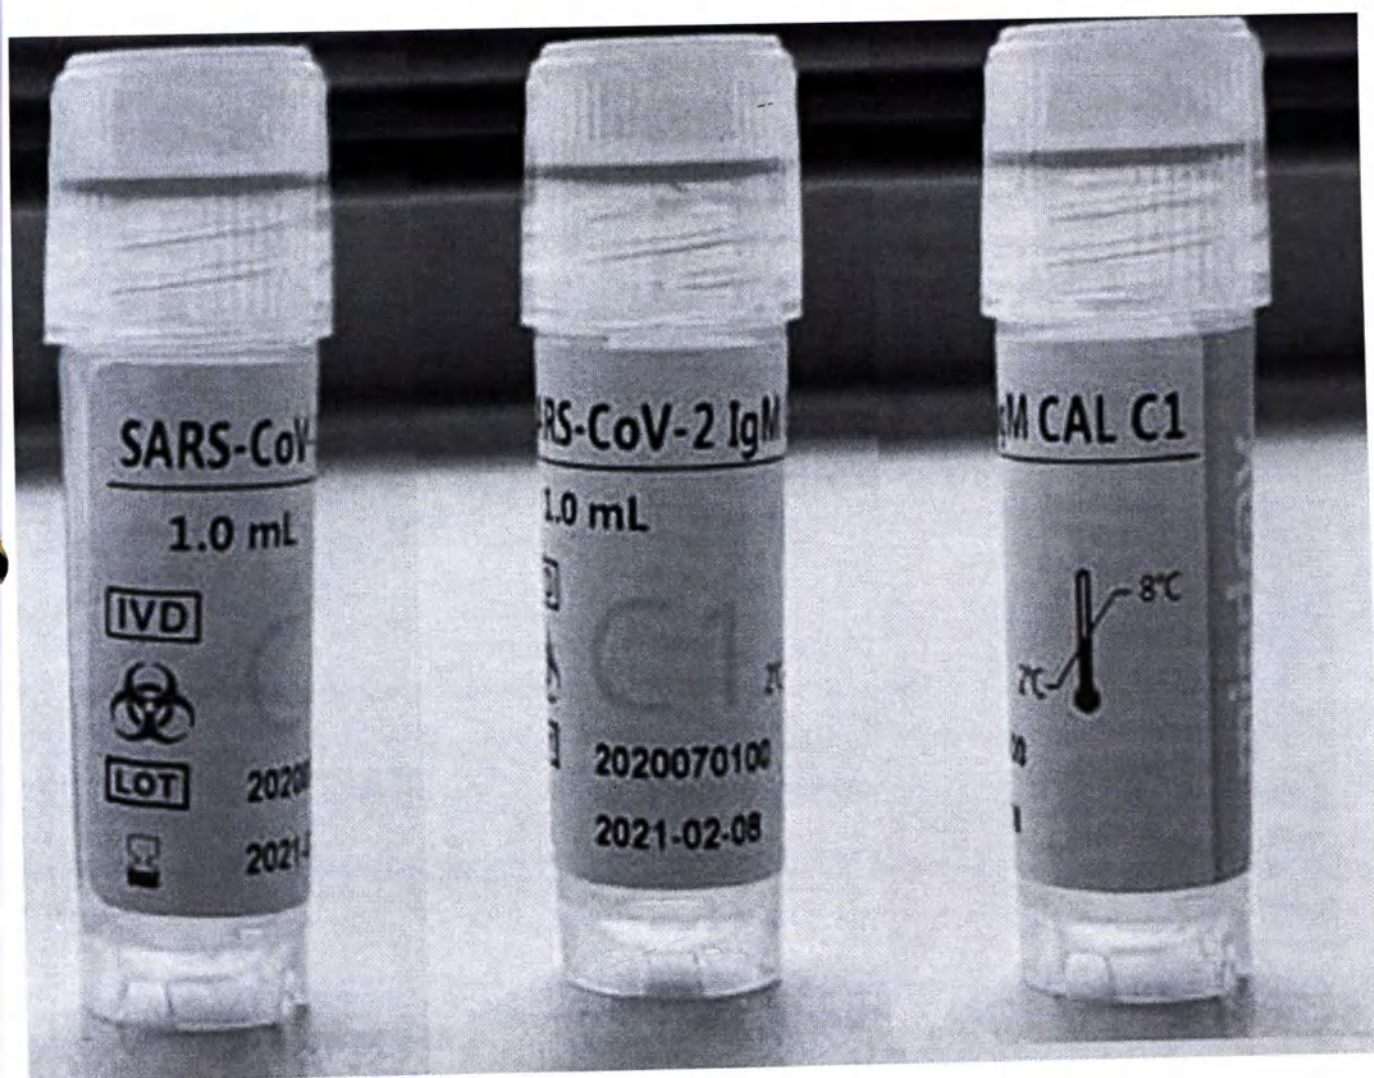


Маркировка упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения антител IgM к штамму SARS-CoV-2 коронавируса иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, лот 2020070122»

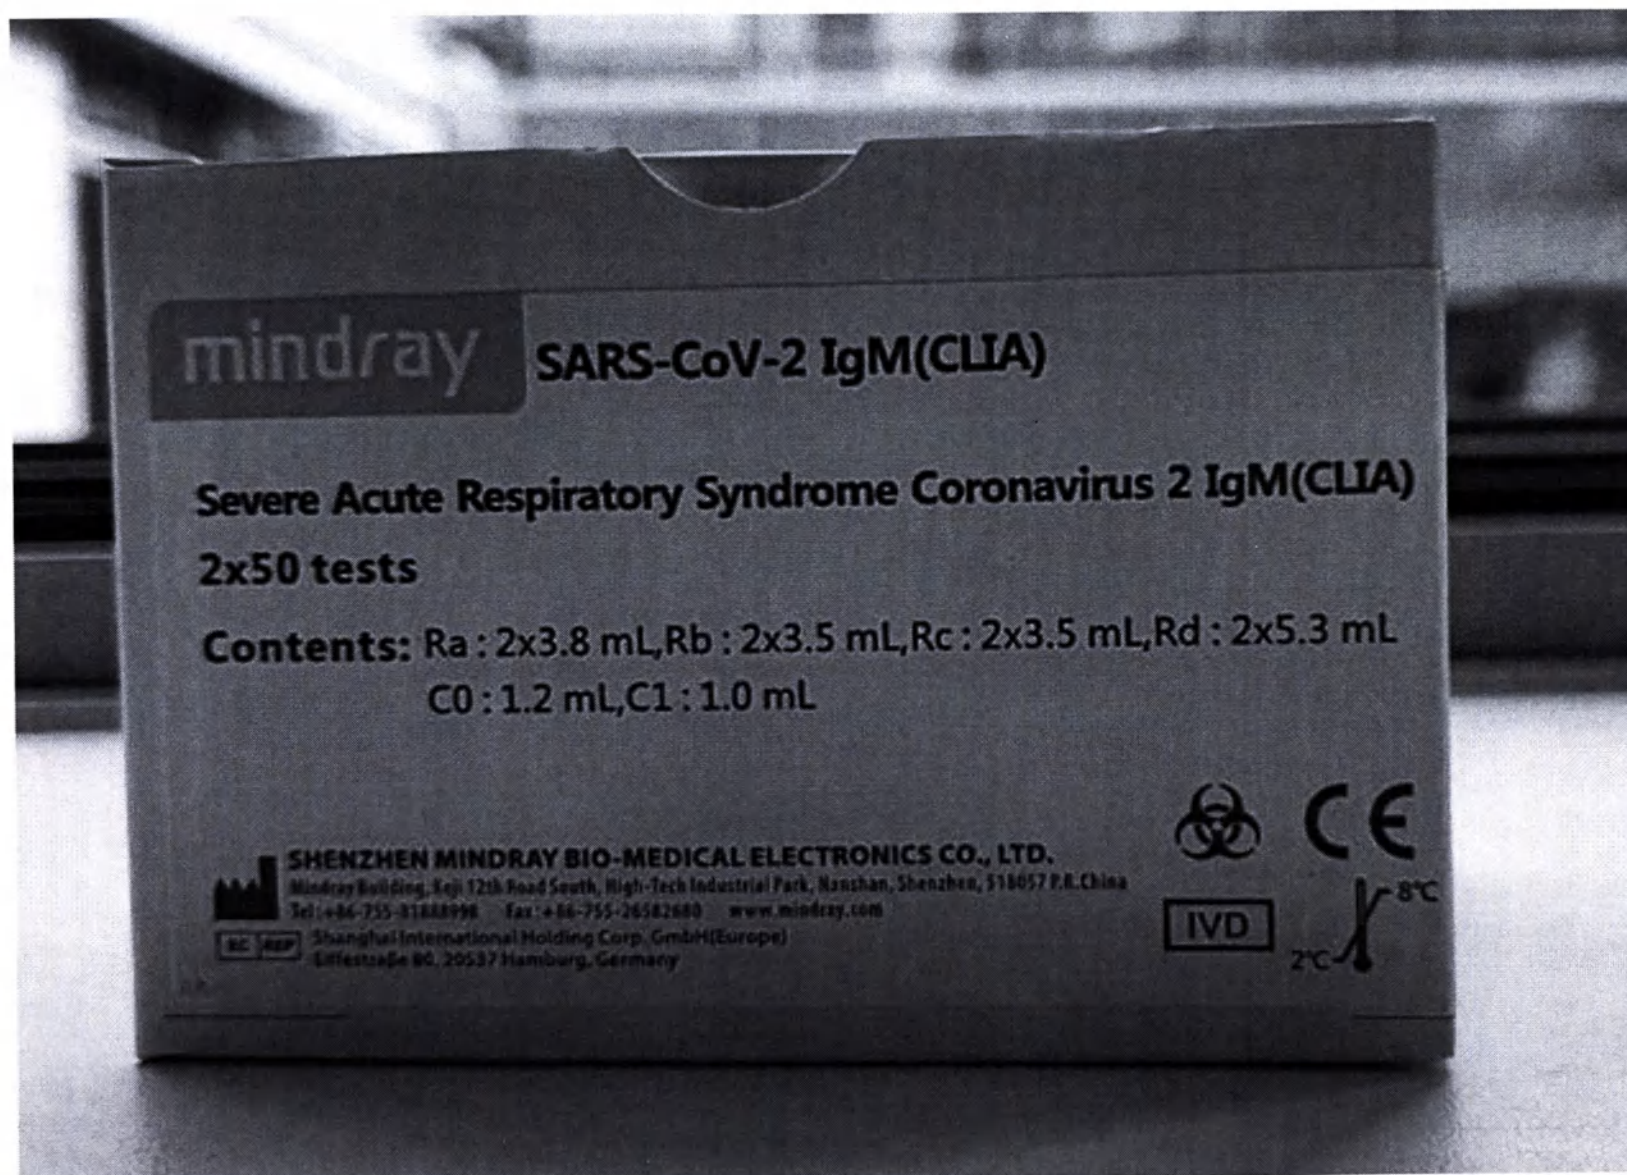


**mindray**

**SARS-CoV-2 IgM(CLIA)**



**Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 IgM(CLIA)**

**2x50 tests**



PL3202007012203207



SARS-CoV-2 IgM121

**P/N: 105-019873-00**



**2020070122**



**2021-02-08**

047-035128-00 (1.0)

16.08.2018

