



9. Приложение 3:

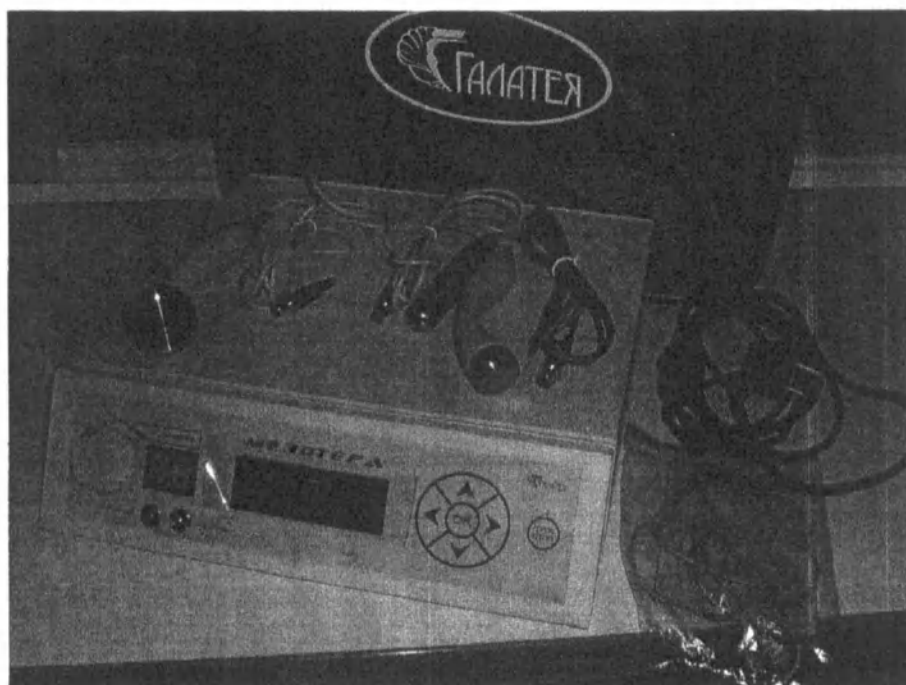

Аппарат короткоимпульсной электротерапии МЕЗОТЕРА
Общий вид
Фото 1

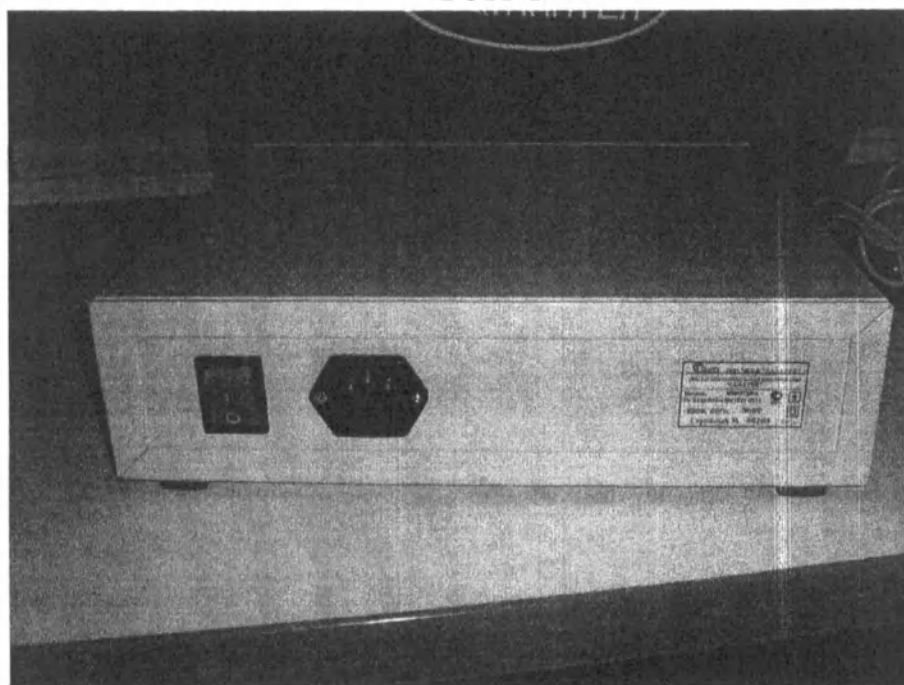

Аппарат короткоимпульсной электротерапии МЕЗОТЕРА
Задняя панель
Фото 2

Акт приемочных технических испытаний

№ 047/ПТИ-12

от 22.03.2012 г. на 5 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России