


Фотографические изображения

**Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки
лиганда-1 белка программируемой смерти в in vitro диагностике к
иммунотейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark**


Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1
елка программируемой смерти в in vitro диагностике к иммунотейнерам
автоматическим серии Ventana BenchMark: фото общего вида




Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в *in vitro* диагностике к иммуногистохимическому автоматическому устройству серии Ventana BenchMark: дозатор с реагентом

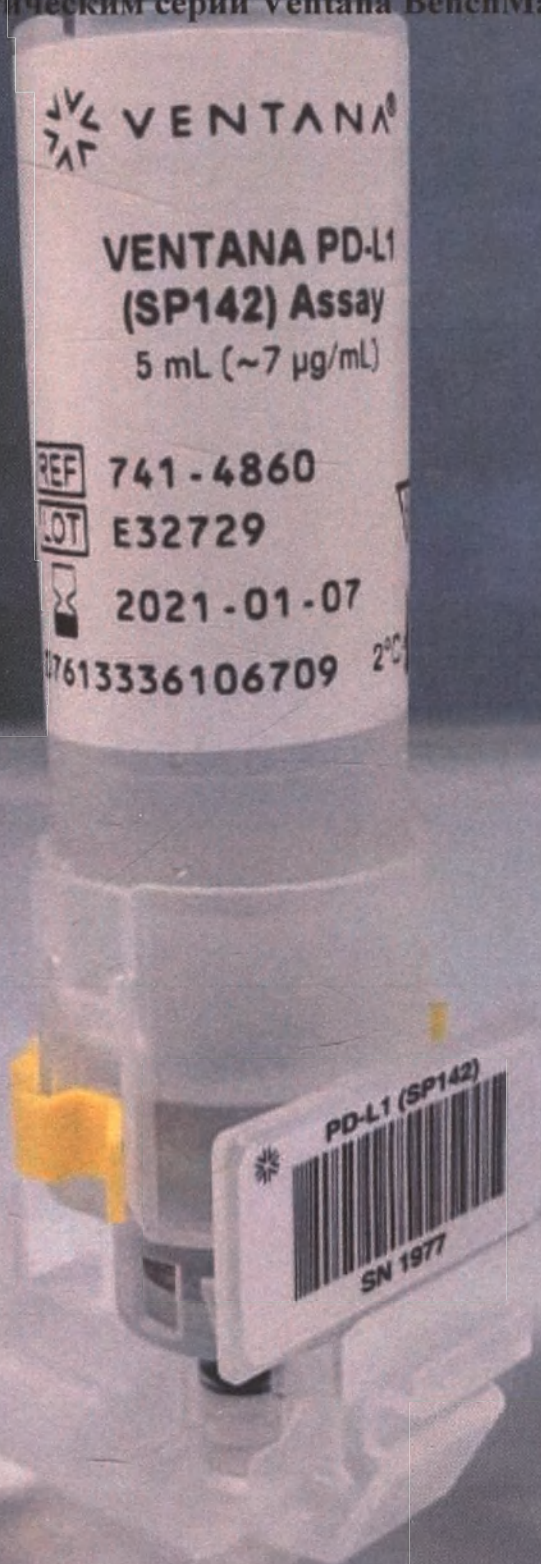

Реагент Ventana SP142 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в *in vitro* диагностике к иммуноштейнеру автоматическим серии Ventana BenchMark: дозатор с реагентом

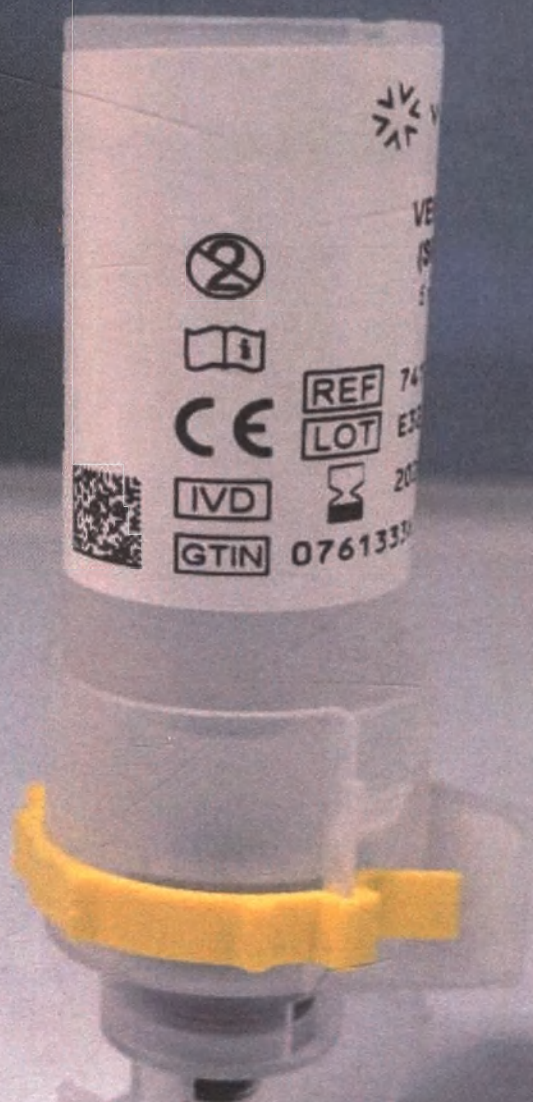

Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в *in vitro* диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: дозатор с реагентом

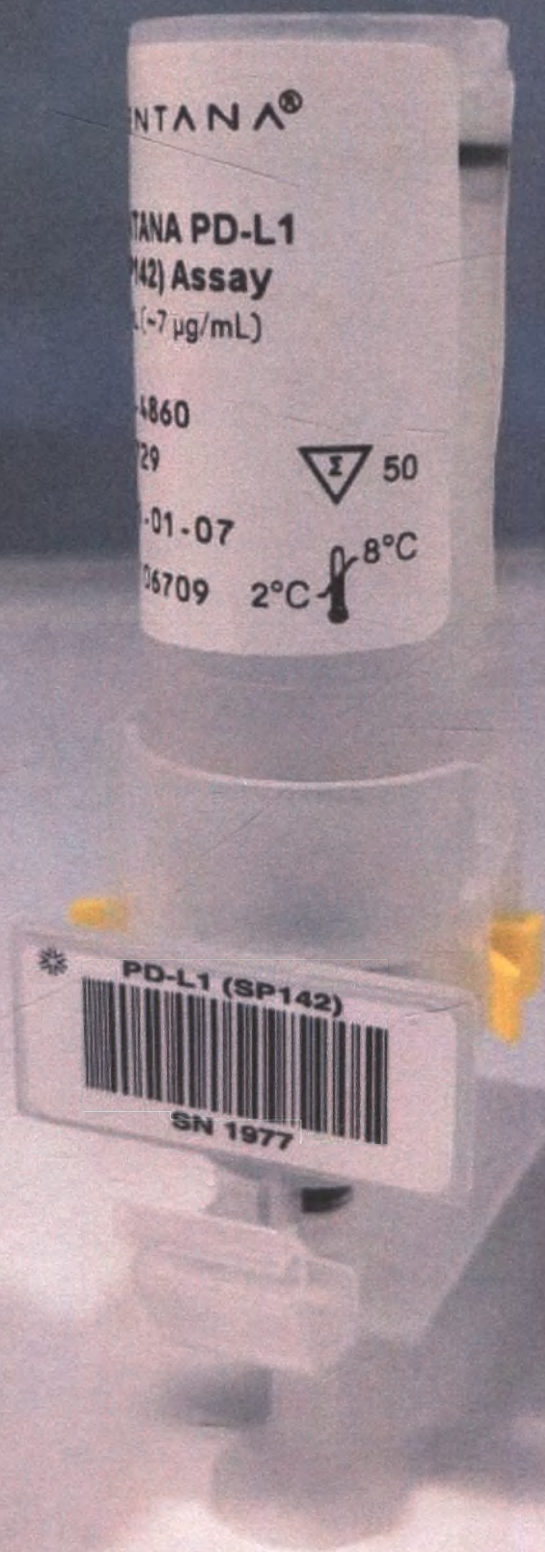

Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: маркировка



VENTANA®

VENTANA PD-L1
(SP142) Assay
5 mL (~7 µg/mL)

REF

741-4860

GTIN

07613336106709

LOT

E32729



2019-01-08



2021-01-07



IVD

(240) 08008540001 -Roche #



Rx Only



50



2°C



8°C



741-4860E32729 0150



VENTANA®

Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: маркировка



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany




www.ventanamed.com

Made in USA



VENTANA

Реагент Ventana PD-L1 (SP142) Assay для иммуногистохимической оценки лиганда-1 белка программируемой смерти в *in vitro* диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: маркировка

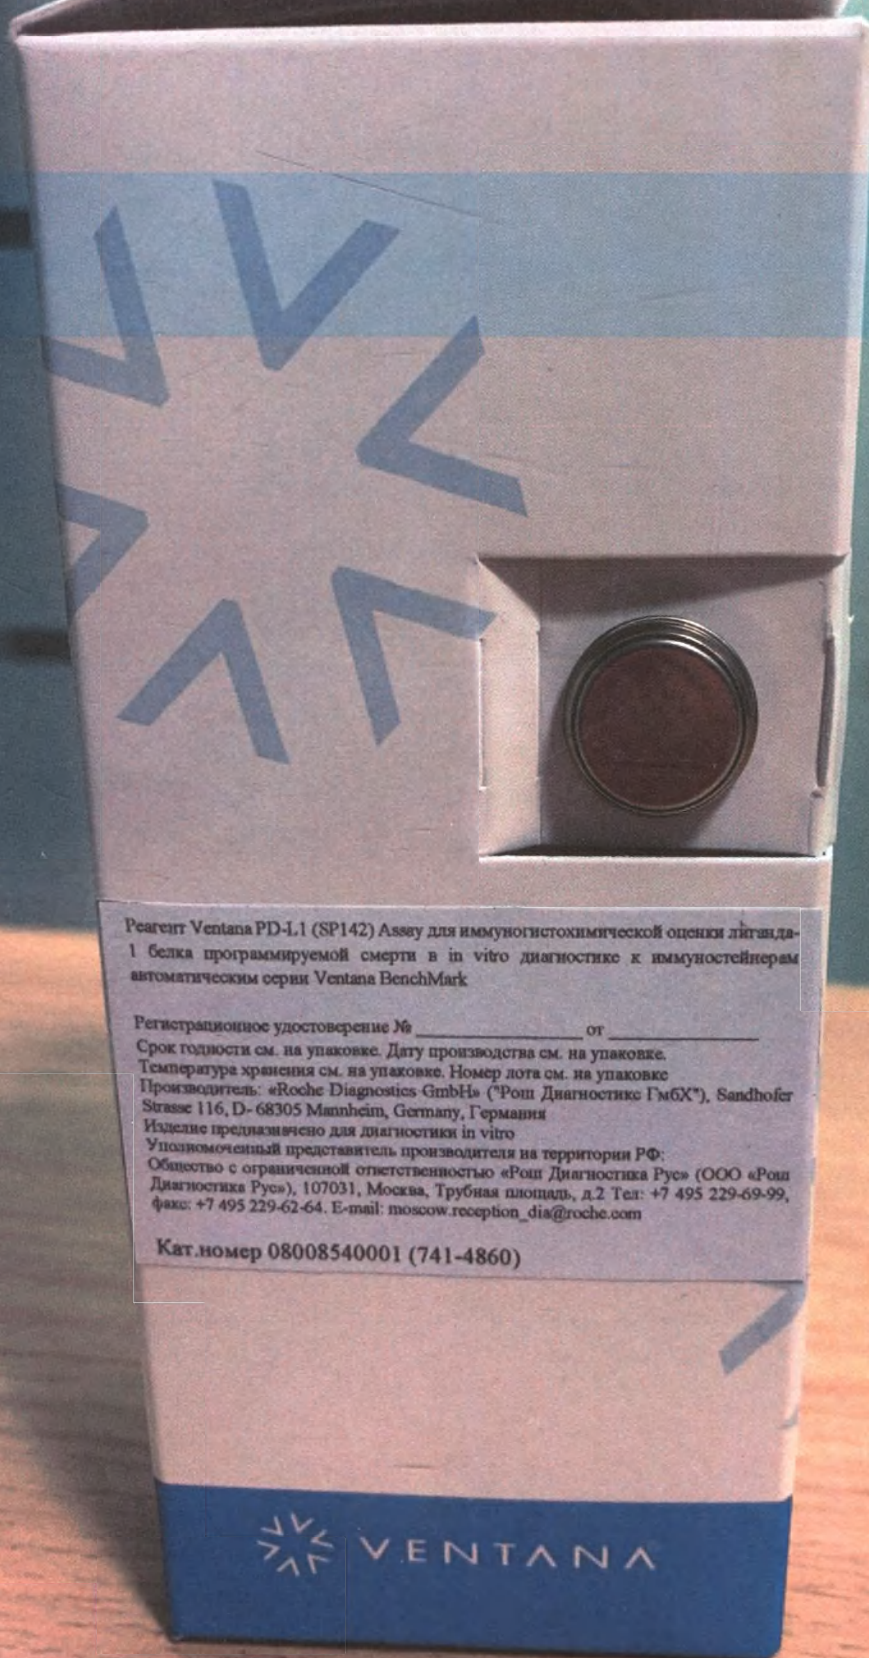

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
Швасель листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018