


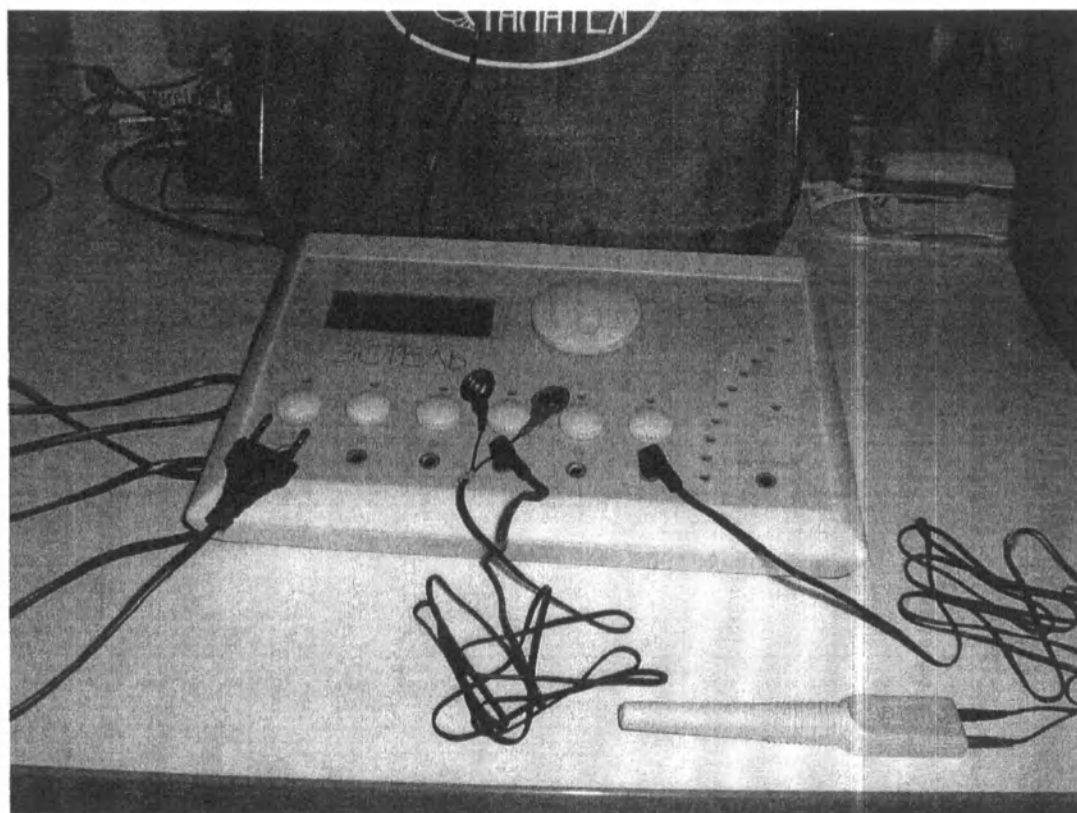


Аппарат комплексной миодермотерапии ЭСТЕЛЬ «Галатея» с принадлежностями

Фото 2

Приложение 2

Принадлежности:

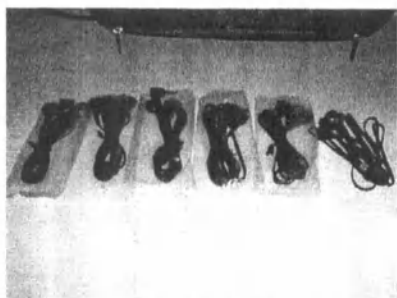

- кабель для подключения электродов для миостимуляции (6 шт.);

Протокол технических испытаний № 004/ЭБ-12

от 17.01.2012 г. на 38 листах

Настоящий протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Не допускается частичная или полная перепечатка настоящего протокола без разрешения
ИЛЦ ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России