

Руководитель отдела качества
и корпоративных технологий



Медведева И.Б.
2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения высокочувствительного С-реактивного белка на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein (Atellica CH hsCRP))



Рисунок 1 Набор реагентов для определения высокочувствительного С-реактивного белка на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein (Atellica CH hsCRP)): общий вид изделия

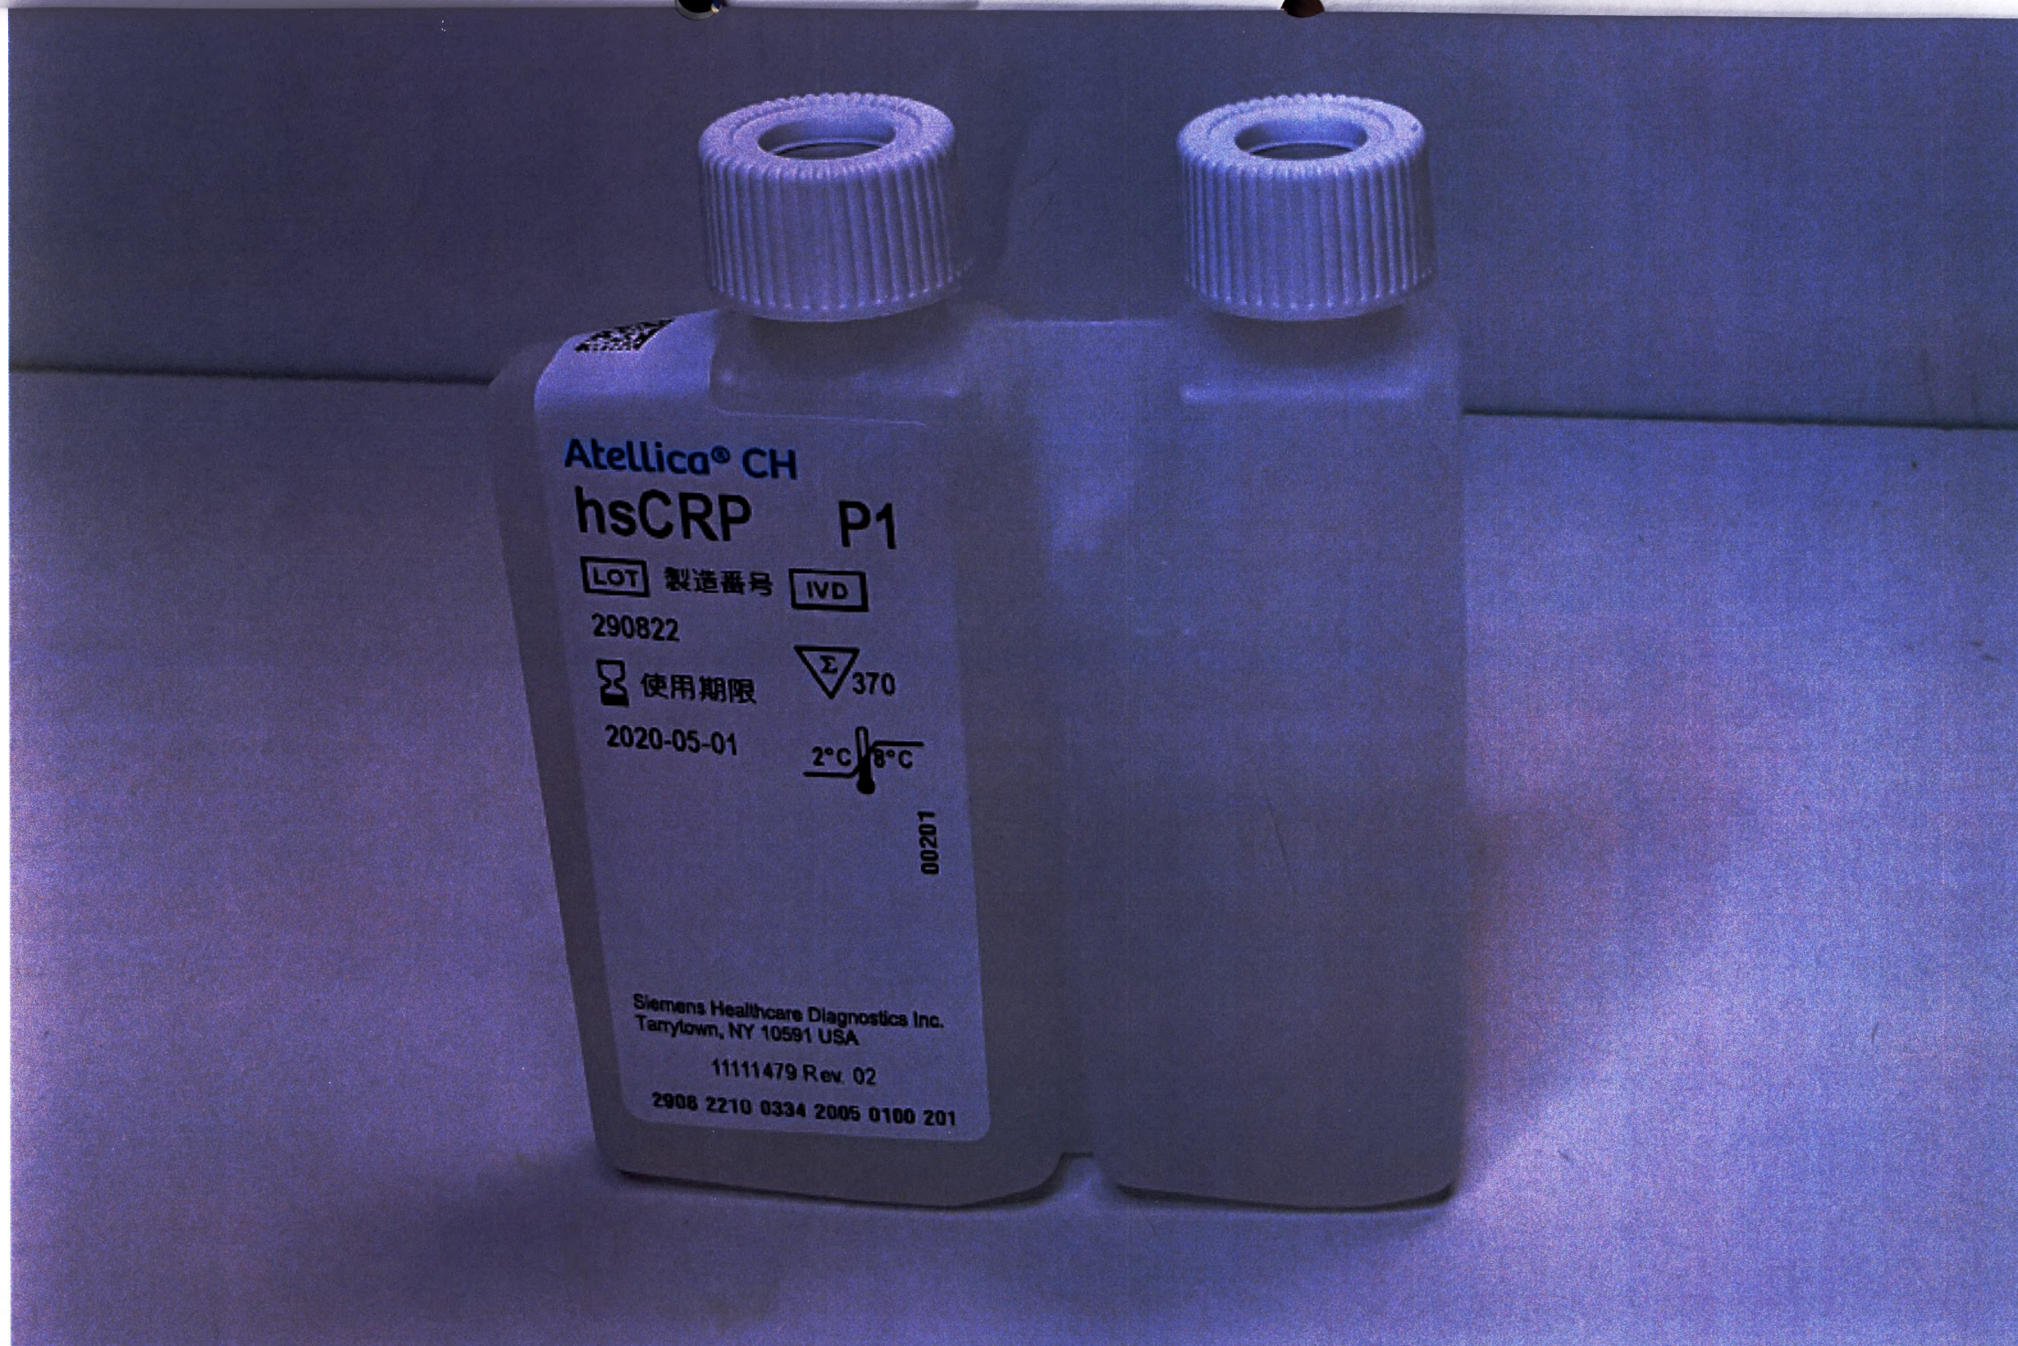


Рисунок 2 Набор реагентов для определения высокочувствительного С-реактивного белка на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH High Sensitivity C-Reactive Protein (Atellica CH hsCRP)): пакет с реагентами, общий вид, упаковка 1

Atellica® CH
hsCRP P2

LOT 製造番号 IVD

280839

使用期限

2020-04-01

Σ 370

2°C 8°C

00331

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

11111480 Rev. 02

2808 3920 0334 2004 0100 331

Всего прошито и пронумеровано 4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

