



Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Упаковка: 30 тестов / набор

Срок годности: 01.02.2019

Дата выпуска: 02.2019

Полн. АД:



30 тестов / набор

IV 21.30.35.004.1800000-2019
РФ 18
Иркутская область, Иркутск, ул. Космонавтов, 23
Тел./факс: 8 (395) 500-00-00
www.biotrace.ru

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Для учреждений здравоохранения
Каталожный номер комплекта: 1311

Для проведения диагностики in vitro + набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Бю Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №1

Состав:
тест-кассета: 30 шт.
пробирки с крышкой-каплевницей и удерживателем для забора образца кала:
содержащая буферный раствор: 30 шт.
палит для пробирки с образцом: 30 шт.
этикетка для маркировки пробирок: 30 шт.
инструкция по применению: 1 шт.

Серийный номер: 01
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

TU 21.20.23-003-15580960-2019

РФ №

Исполнитель: ООО «Бю Софт»
РФ, 109367, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-66-84
www.biofocus.ru



30 ТЕСТОВ / НАБОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека
«Бю Трейсер Скрытая кровь в кале»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов-тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека («Бю Трейсер Скрытая кровь в кале») предназначена для диагностики скрытой крови в кале человека. Тест-система предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографических тестов (ИХТ) с целью выявления скрытой крови в кале человека. Тест-система предназначена для использования в лабораториях, оснащенных оборудованием для проведения иммунохроматографических тестов (ИХТ) с целью выявления скрытой крови в кале человека.

Для проведения диагностики in vitro + набор 30 тестов

Получение результатов тестирования

Профессиональный результат тестирования

Время тестирования

Время тестирования

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета

Бю Трейсер Скрытая кровь в кале


* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серийный номер: 01

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Исполнитель: ООО «Бю Софт»
РФ, 109367, Москва, Тимирязевская ул., д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-66-84
www.biofocus.ru

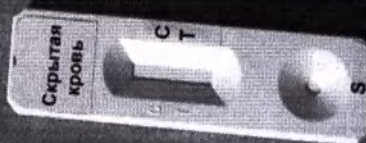

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать.
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием.

Комплект №1

Состав
- тест-кассета: 30 шт.
- пробирка с колпачком-напильником и стаканом для забора образца кала:
поддерживающий буферный раствор: 30 шт.
- планшет для пробирки с образцом: 30 шт.
- этикетки для микропроцессорных пробирок: 30 шт.
- инструкция по применению: 1 шт.

Серия номер: 01
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

TU 21.20.23-003-15560960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



30 тестов / набор

НАЗНАЧЕНИЕ
Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека» (далее - «Тест-система») предназначен для проведения диагностики in vitro. Набор реагентов «Тест-система» предназначен для проведения диагностики in vitro. Набор реагентов «Тест-система» предназначен для проведения диагностики in vitro.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов «Тест-система» предназначен для проведения диагностики in vitro. Набор реагентов «Тест-система» предназначен для проведения диагностики in vitro. Набор реагентов «Тест-система» предназначен для проведения диагностики in vitro.

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

Био Трейсер Скрытая кровь
В кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать.

Серия номер: 01
Дата выпуска: 02.2019

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Диагностика калопромеатографическая для
обнаружения скрытого кровотечения из
кишечного отдела человеческого гематокина
в кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать.
Пожароопасно, читайте инструкцию по применению перед использованием

Классификатор ТБД

- Основа:
 - паста-кассета: 30 шт
 - пробирки с каловой имитацией и стерильными для сбора образцов кала: 30 шт
 - использованные образцы растений: 30 шт
 - пакет для пробирок с образцами: 30 шт
 - аппарат для газировки пробирок: 30 шт
 - инструкция по применению: 1 шт

Серия: 01
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

ТУ 21-20-23-003-15580960-2019
ТУ №
Роспотребнадзор № 04.04.2019
Тел. 8 (495) 900-85-84
www.biotrace.ru



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Био Трейсер
ДЛЯ ТРЕЙСЕР СКАРИТ И ДРУГИХ

Для проведения диагностики в кале
Тест-кассета


Био Трейсер Скрытая кровь в кале


Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать



Серия: 01
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

Исследования: 001-004
Инструкция: 001-004
Всего: 001-004
Всего: 001-004

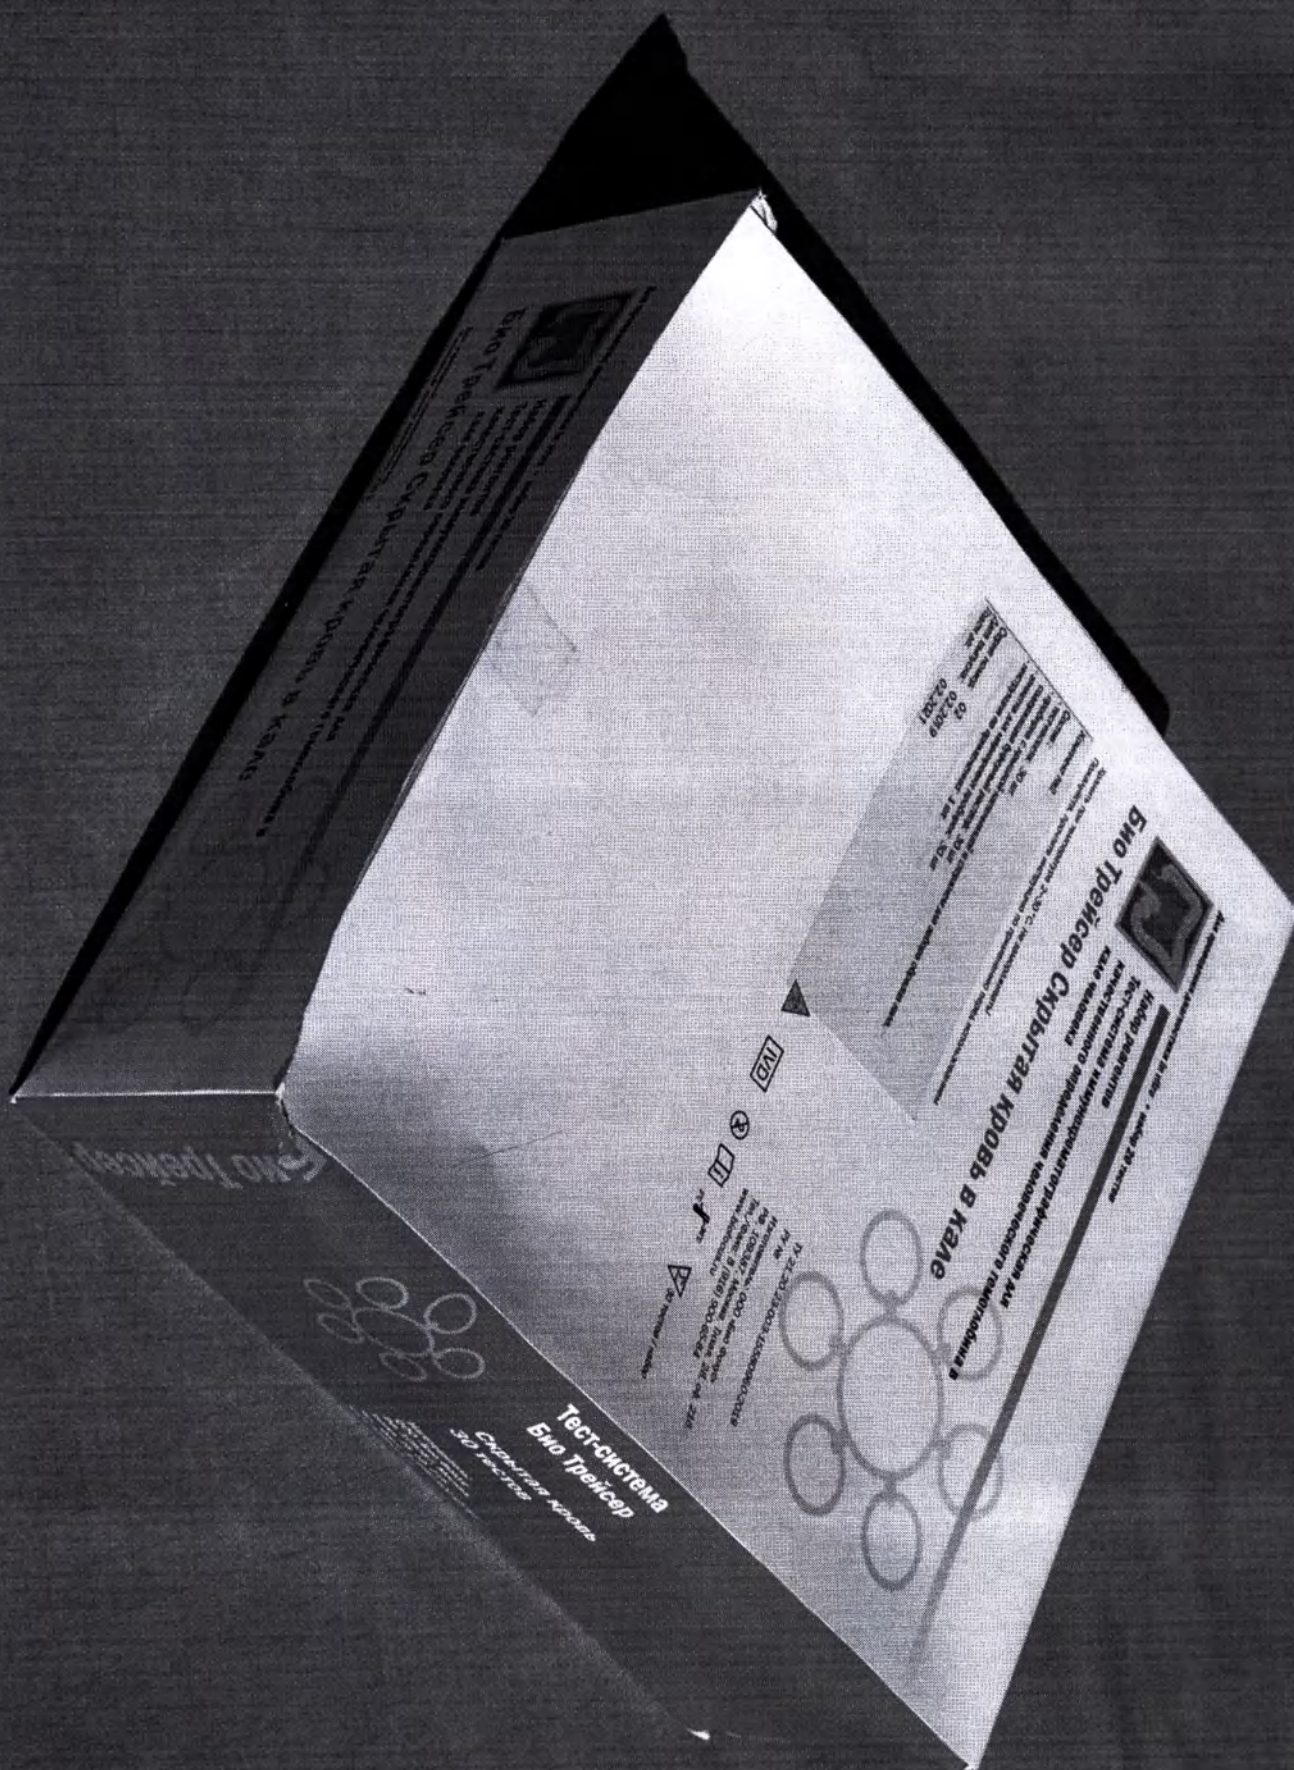



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

Бюро Трейсер Скрытая кровь в кино



Скрытая кровь 30 тестов

Изготовитель:
ООО «Бие Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.bietyocus.ru


Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов
Био Трейсер Скрытая кровь в кале
 Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения человеческого гемоглобина в
 кале человека



Био Трейсер Скрытая кровь в кале



Инструкция по применению
 02.2019
 02.2019
 02.2019

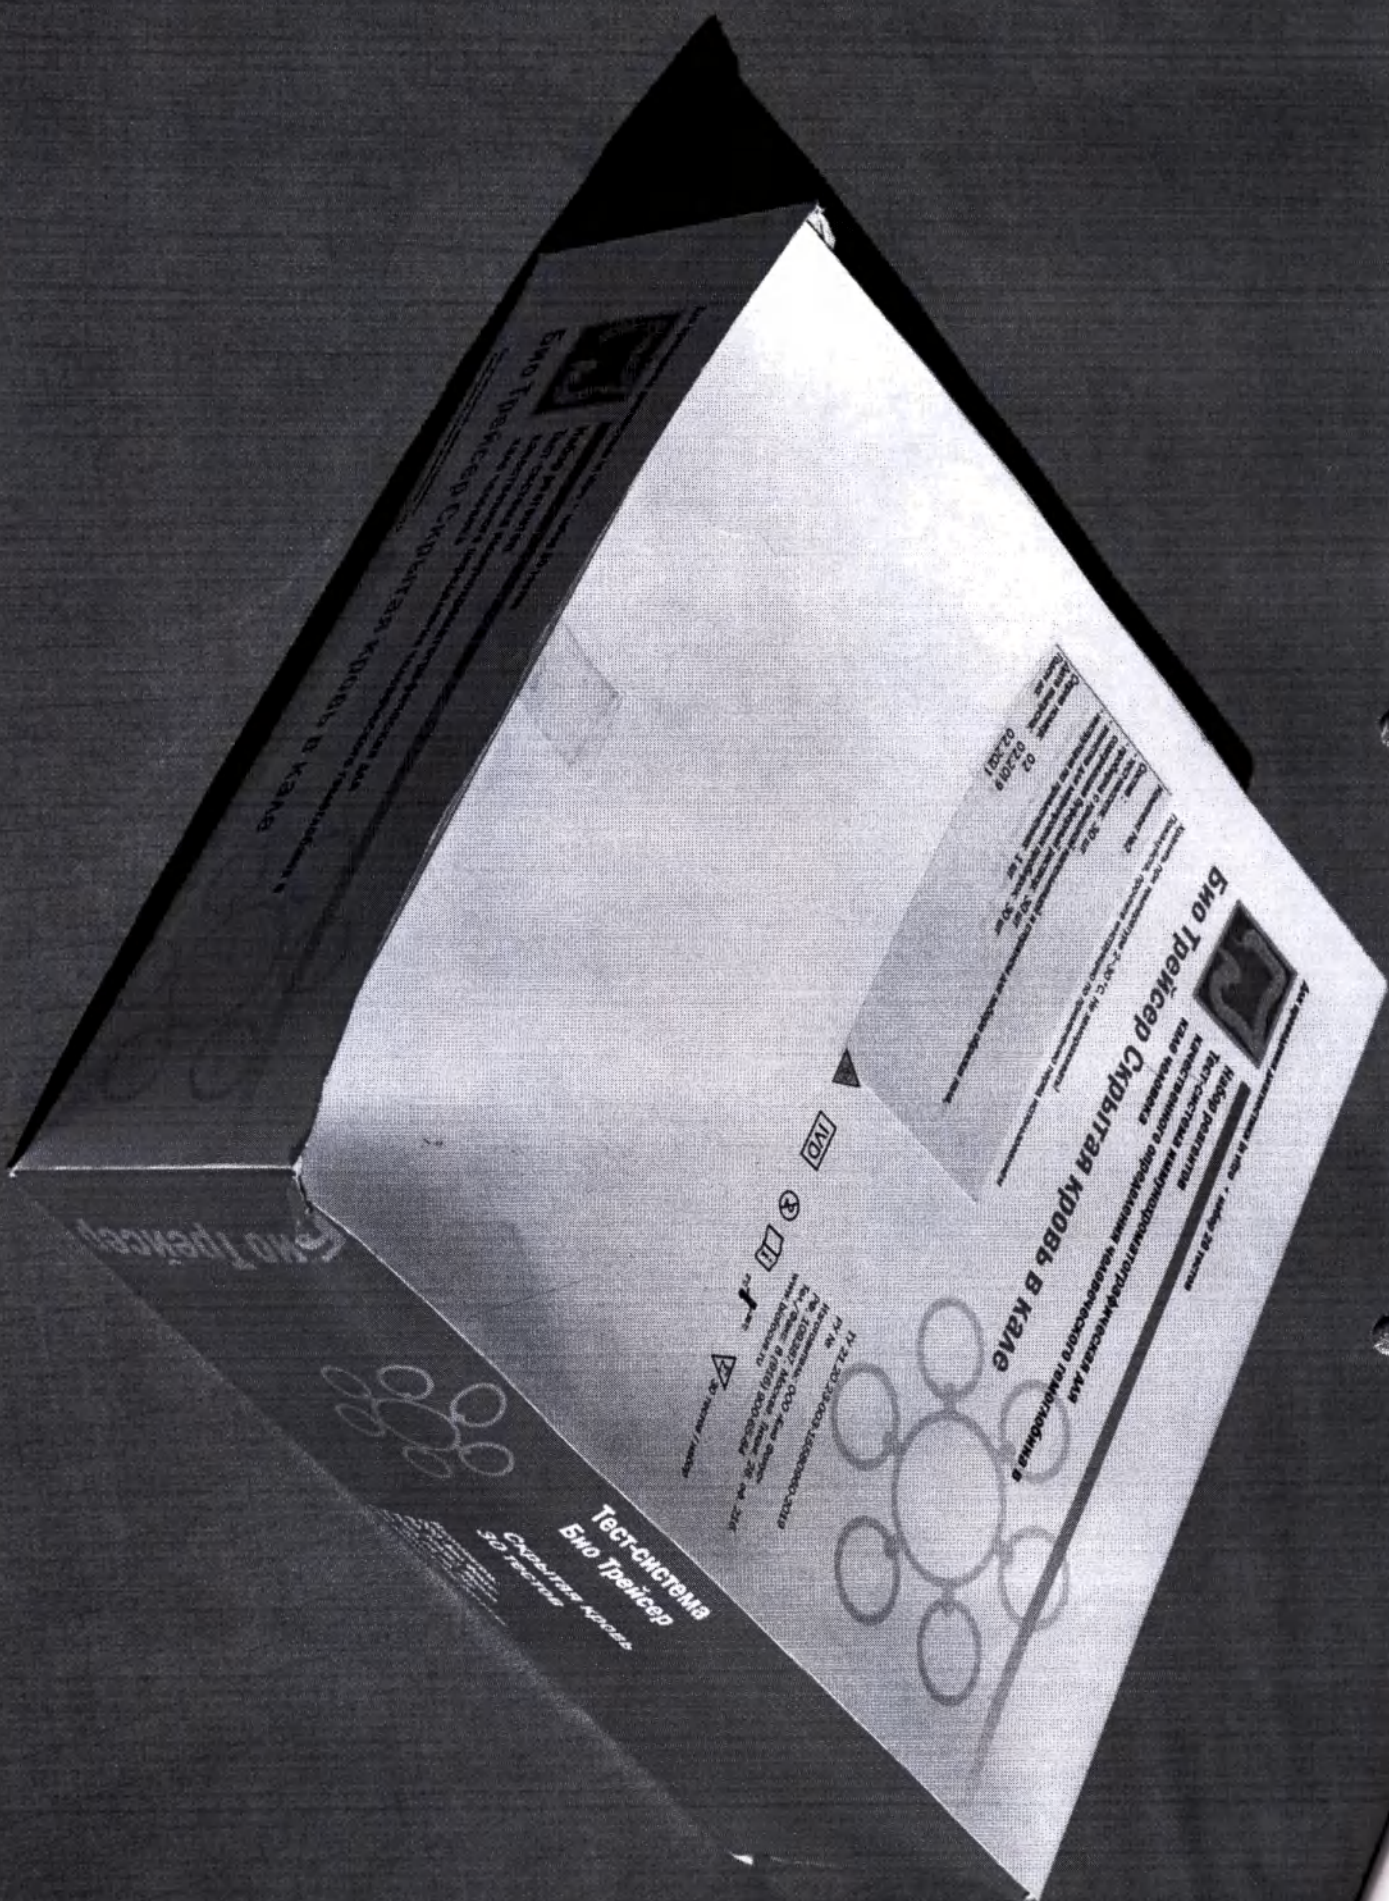


Срок годности: 02/2019
Срок годности: 02/2019
Срок годности: 02/2019

Био Трейсер
Тест-система
Скрытая кровь в кале

ИЗВЕСТНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
В течение 20 лет
Исследования
Исследования
Исследования

Тест-система
Био Трейсер
Скрытая кровь
50 testline



Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать.
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Kowalewski Nr2

Coastal:

Rectal volume: 30 ml

* Профили с красной напыленной и шероховатой поверхностью для лучшего сцепления с бетоном.

Содержимое буферного раствора: 30 шт

инструкция по применению: 1 шт.

1991

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Depth: 02
Area: 03 3010

Годен до:	02.2019
Годен до:	03.2019

022021

TX 74 20 23 003 15580980-2019

19 21
22 23

Maximum: 000,000,000

РФ, 109387, Москва, Индия, 2

TEL/FAX: 8 (916) 900-65-84



30 листов / набор

Для проверки качества
Тест-кассета

ТЭСТ-КВООСТЕ

Тест-кассета
Био Трейсер Скрытая кровь

Био Трейсер Сирокет
100% Не замораживать

Тест-кассета

Био Трейсер Скрытая кровь
в кассе

* Хранить при температуре 2-10 °С. Не замораживать.

Copyright © 2007 by John Wiley & Sons, Inc.

02-2019

1992

The undersigned, ERIC GALT, hereby
 certifies that the above information is true and correct.
 The undersigned is the owner of the
 above described property.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Утвержденный протокол ООО «Блокус»
 от 02.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего протокола является определение содержания скрытой крови в кале с помощью тест-системы «Био Трейсер Скрытая кровь в кале».

Данный протокол предназначен для использования в лабораториях, оснащенных тест-системой «Био Трейсер Скрытая кровь в кале».

Материалы и реактивы:

- Тест-система «Био Трейсер Скрытая кровь в кале»
- Сыворотка крови
- Вода дистиллированная

Методика проведения исследования:

1. Подготовка реактивов.

2. Подготовка образца.

3. Проведение исследования.

4. Интерпретация результатов.

5. Оформление результатов.

Для проведения диагностики in vitro • набор 20 тестов



Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения человеческого гемоглобина в
 кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале




Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!
 Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:
 - тест-кассеты: 30 шт.
 - пробирки с кристаллической и стерильной для забора образца кала,
 содержащая буферный раствор: 30 шт.
 - этикетки для маркировки пробирок: 30 шт.
 - инструкция по применению: 1 шт.

Серия номер: 02
 Дата выпуска: 02.2019
 Годов. до: 02.2021

ТУ 21.20.23-003-15560960-2019
 РУ №
 Изготовитель: ООО «Блокус»
 РФ, 105387, Москва, Троицк, 28, оф. 218.
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
 www.bloocus.ru

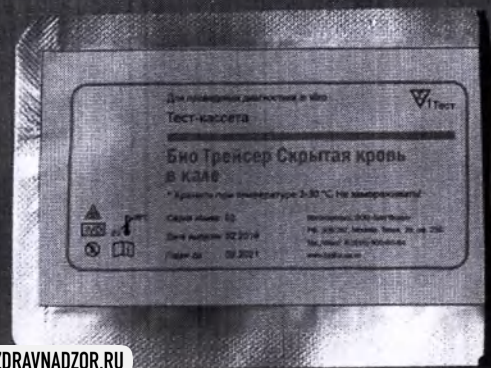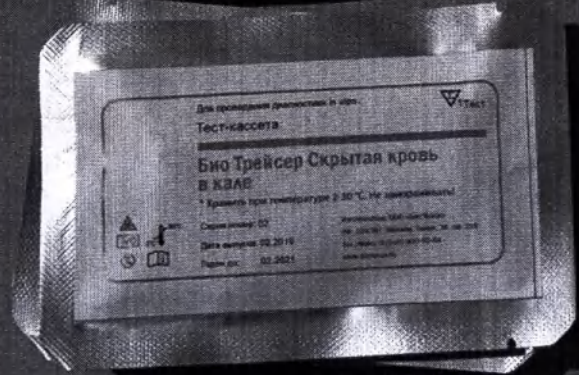

Для проведения диагностики in vitro • набор 20 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:

- тест-кассеты: 30 шт
- пробирка с крышкой-капельницей и стерильным для забора образца кала,
- содержащая буферный раствор: 30 шт
- этикетка для маркировки пробирок: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 02
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

TU 21.20.23-003-15580960-2019
РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тиньков, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



30 тестов / набор

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Информация о товаре
 Инструкция по применению
 Сертификат соответствия
 Декларация о соответствии
 Техническое описание
 Упаковка и хранение
 Гарантийные обязательства
 Контактная информация

Бино Тренсер Скрытая кровь в каве
 ТЕСТ-КАССЕТА

Для проведения исследования in vitro

Хранить при температуре 2-30 °C. Не замораживать

Серия номер: 03
 Дата выпуска: 02.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019



Информация о товаре
 Инструкция по применению
 Сертификат соответствия
 Декларация о соответствии
 Техническое описание
 Упаковка и хранение
 Гарантийные обязательства
 Контактная информация

Бино Тренсер Скрытая кровь в каве
 ТЕСТ-КАССЕТА

Для проведения исследования in vitro

Хранить при температуре 2-30 °C. Не замораживать

Серия номер: 03
 Дата выпуска: 02.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019
 Рег. №: 109987, Москва, 28.06.2019

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать.
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием.

Комплект №1

Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- пробирка с крышей-капельницей и стержнем для забора образца кала:
- содержащая буферный раствор: 30 шт
- пакет для пробирки с образцом: 30 шт
- этикетка для маркировки пробирок: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021



IVD



30 тестов / набор

ТУ 21.20.23-003-15580960-2019

РУ №

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 125357, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

кале человека

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в

Набор реагентов

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «БИО-ФОРУС»
Лавров К. В.
08.01.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов
«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека»
«Био Трейсер Скрытая кровь в кале»


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека» «Био Трейсер Скрытая кровь в кале» предназначен для быстрого выявления скрытой гемоглобина, содержащегося в образцах кала человека и кала животных, при помощи иммунохроматографического метода (ИХМ) и для быстрой диагностики кровотечения в пищеварительном тракте.

Для правильного применения набора реагентов необходимо:

- Для качественной лабораторной диагностики.
- Для лабораторий: ветеринарные, общепрофильные, урологических.
- Для профессионального уровня диагностики и профилактики.
- Для клинической лабораторной диагностики, медицинской лабораторий.

Описание набора реагентов, прилагаемое к набору реагентов.

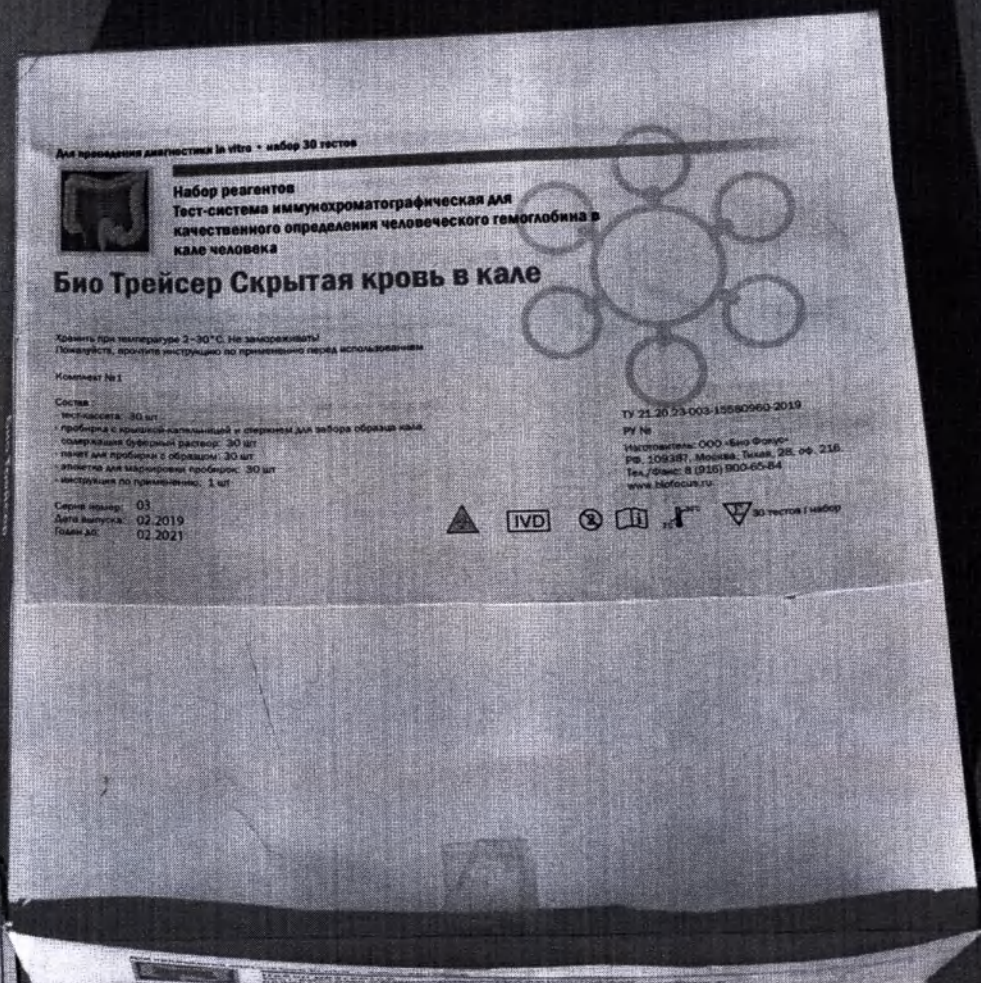

Для проведения исследования в vitro - набор 20 тестов



**Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека**

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Содержит 20 тестовых карт, 20 шт. (10 шт. в упаковке, 10 шт. в запасе)

Количество: 20 шт.

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.


Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

Срок годности: 24 мес.

ИЗДАНИЕ 2019
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
№ 1 (2019)
Место издания: Москва, Россия
Год издания: 2019
Тираж: 1000 экз.



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Результат	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Проверка качества реагентов. Для этого необходимо провести тестирование на контрольных образцах. Если результат положительный, то реагенты пригодны для использования. Если результат отрицательный, то реагенты необходимо заменить.


2. Подготовка образца. Образец кала необходимо поместить в специальный контейнер и тщательно перемешать. Затем необходимо взять небольшое количество образца и поместить его на тестовую карту.

3. Проведение теста. Тестовую карту необходимо поместить в специальный контейнер и подождать 10-15 минут. После этого необходимо проверить результат. Если результат положительный, то в кале обнаружен гемоглобин. Если результат отрицательный, то гемоглобин не обнаружен.

4. Хранение реагентов. Реагенты необходимо хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

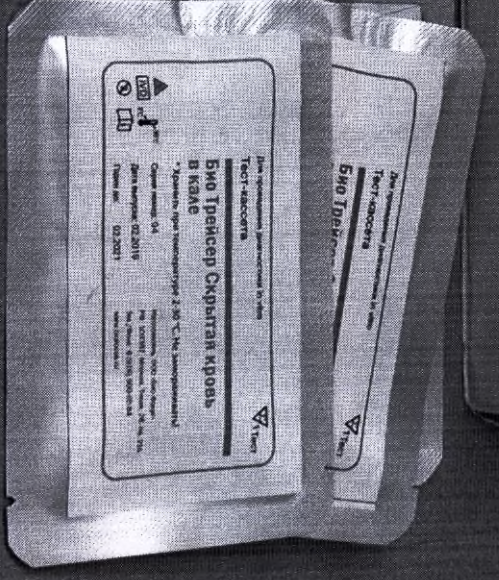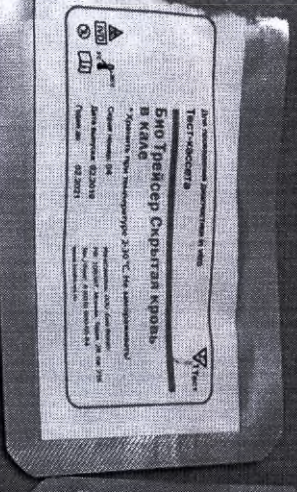


Для проведения диагностики in vitro



Тест-кассета

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!




Серия номер: 04

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

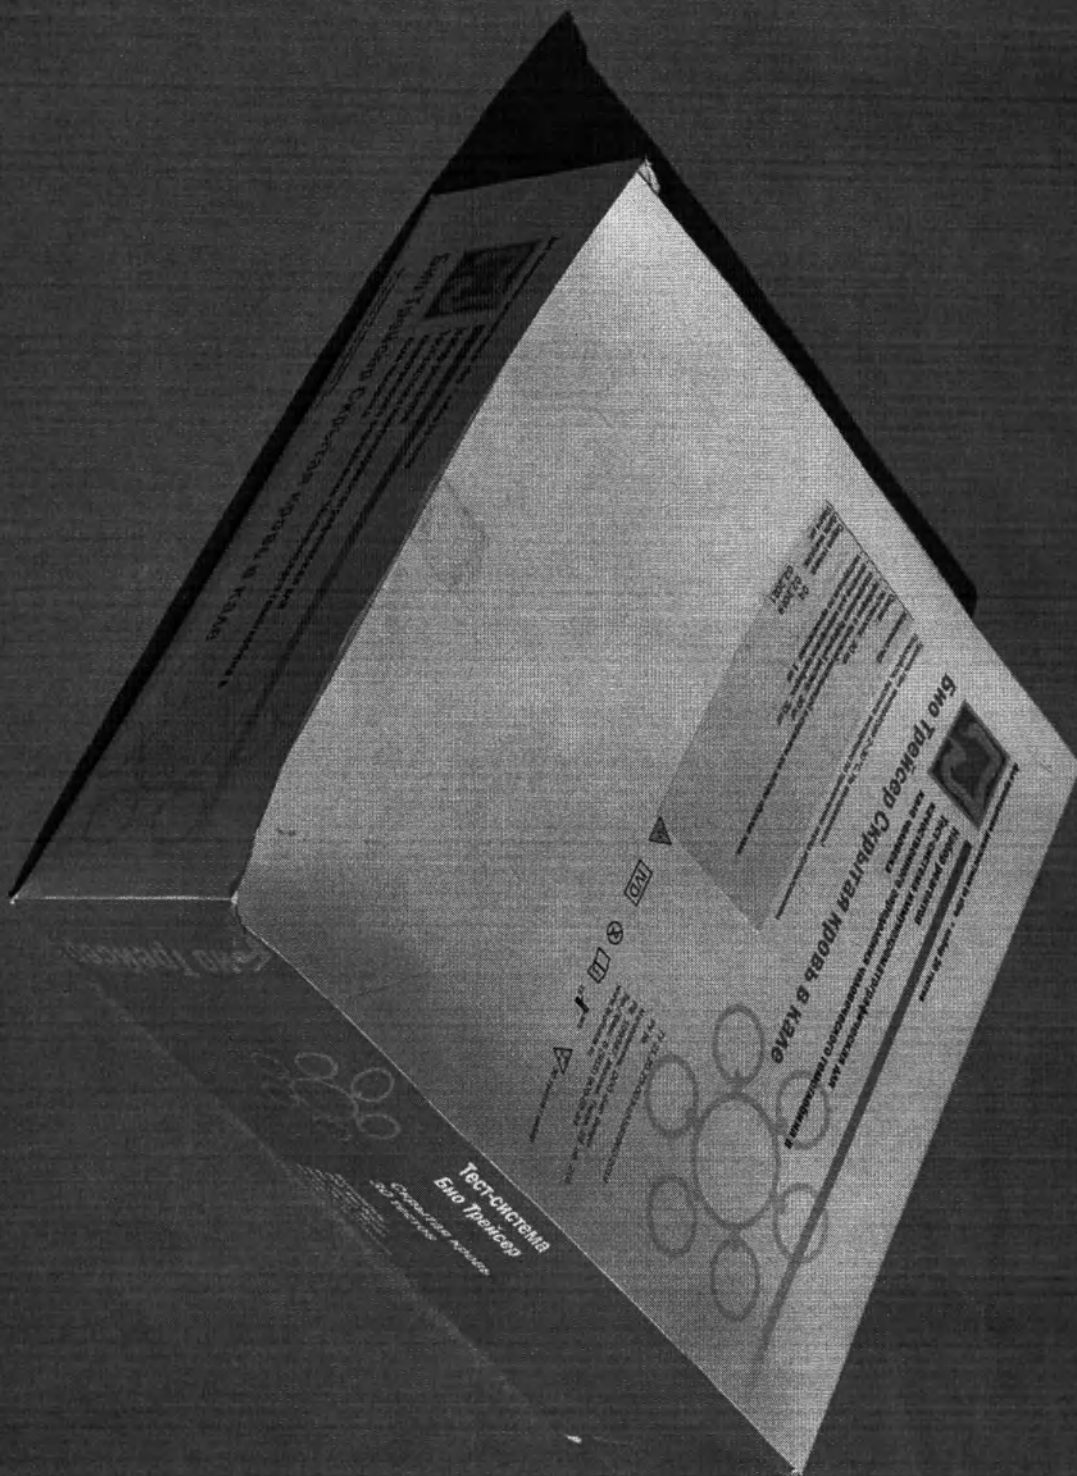

Для проведения диагностики in vitro - набор 20 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Комплект №2

Состав:

- тест-полоски: 30 шт
- пробирка с крышкой-капельницей и стерильным для забора образца кала, содержащая буферный раствор: 30 шт
- этикетки для маркировки пробирок: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 04
Дата выпуска: 02.2019
Годен до: 02.2021

ТУ 21.20.23-003-15580960-2019
Р/У №

Изготовитель: ООО «Био Трейсер»
ИП, 109387, Москва, Тульская, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.bio-trace.ru



30 тестов / набор

Для проведения диагностики in vitro - набор 20 тестов



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1313

Серия номер: 05

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

TV 21.20.23-004-15580980-2019


РУ №:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека.
Био Трейсер Скрытая кровь в кале

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для выявления скрытой крови в кале человека. Тест-система предназначена для использования в лаборатории.
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека.
Био Трейсер Скрытая кровь в кале

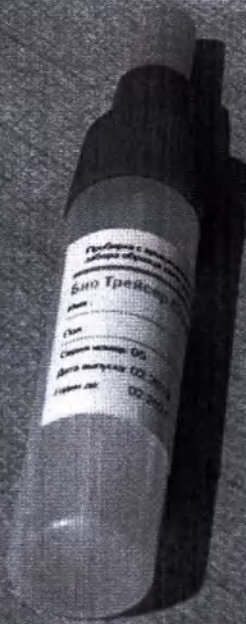

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета



Био Трейсер Скрытая кровь в кале


* Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 05

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Троицкая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

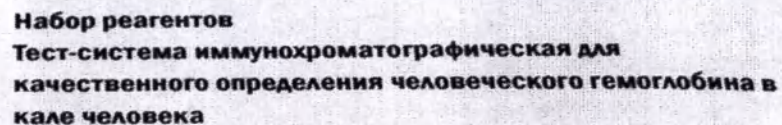

Хранить при температуре 2–30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1313

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор 1981/82

...и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, не составляющей государственной тайны, содержащей информацию о частной жизни граждан, исключив ее из перечня сведений, не подлежащих раскрытию и опубликованию. Публикация в печати, в средствах массовой информации, в сети Интернет и на иных общедоступных ресурсах информации, содержащей сведения, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, не допускается.

НАМАЧЕРНИ

Наименование: Тест-система для определения наличия антител к вирусу гепатита С (антитела к HCV) в сыворотке крови человека.

Скрытая кровь

C
T

S

Для проведения диагностики in vitro
Тест-кассета

**Био Трейсер Скрытая кровь
в кале**

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать

Серия номер: 05

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-
www.biofocus.ru

2. Введена в оборот: 17.06.2019г.

Анализирована продукция, соответствующая требованиям, установленным в Едином государственном реестре лекарственных средств (ЕГРЛС) от 17.06.2019г.


УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 ООО «Био Фокус»
 Москва, К/П
 125080 Москва 2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов
 «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека»
 «БиоТрейсер Скрытая кровь в кале»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека» «БиоТрейсер Скрытая кровь в кале» предназначен для выявления скрытой крови в кале человека. Для этого необходимо нанести на тест-кассету образец кала. Результат определяется по изменению цвета тест-полоски.

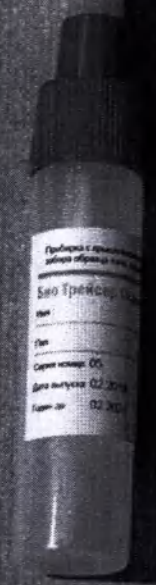

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов
 Тест-система иммунохроматографическая для
 качественного определения человеческого гемоглобина в
 кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале


Комплект №3

Состав :

- тест-кассета: 1 шт
- пробирка с крышечкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета



Био Трейсер Скрытая кровь в кале

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!

Серия номер: 05
 Дата выпуска: 02.2019
 Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
 РФ, 109387, Москва, Тучков, 26, оф. 216
 Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Icons: IVD, 20°C, 30°C, and a book icon.



УТВЕРЖДАЮ
Специальный директор ВНИОБЮФКУС
Котлов К.Н.
02.02.2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Набор реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека»
«БиоТрейсер Скрытая кровь в кале»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека» «БиоТрейсер Скрытая кровь в кале» предназначен для экспресс-диагностики скрытой крови в кале человека. Система предназначена для использования в лабораторных условиях.

Для проведения диагностики in vitro

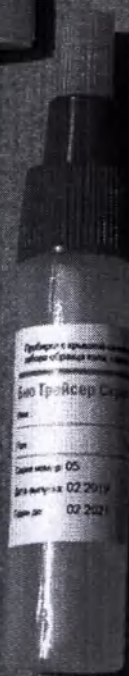

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1313

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета



Био Трейсер Скрытая кровь в кале

* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: 05

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Вятка, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1313

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения человеческого гемоглобина в кале человека - Био Трейсер Скрытая кровь в кале, предназначен для использования в качестве тест-системы для определения наличия человеческого гемоглобина в кале человека.

Скрытая
кровь

C
T

S

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета

Био Трейсер Скрытая кровь
в кале

* Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Серия номер: 08

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Исполнитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая,
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-88
www.biofocus.ru

2. Введенно в действие 17.06.2019г.

Полученная в установленном порядке лицензия на осуществление медицинской деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Био Фокус»
Котлов К.В.
2019 г. 06.06.2019г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения наличия скрытой крови в кале человека

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест-система предназначена для качественного определения наличия скрытой крови в кале человека.

Для проведения диагностики in vitro




Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения человеческого гемоглобина в
кале человека

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- пробирка с крышечкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

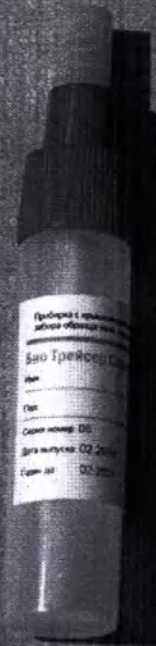

Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета

Био Трейсер Скрытая кровь в кале

* Хранить при температуре 2-30 °C. Не замораживать!




Серия номер: 06

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

История науки и техники

1

S

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листов

Генеральный директор
«БЛО ФОКУС» Козлов К.В.