


Фотографические изображения медицинского изделия

Видеопроцессор, модель EOS-B-01, в составе

Видеопроцессор, модель EOS-B-01

Упаковка.

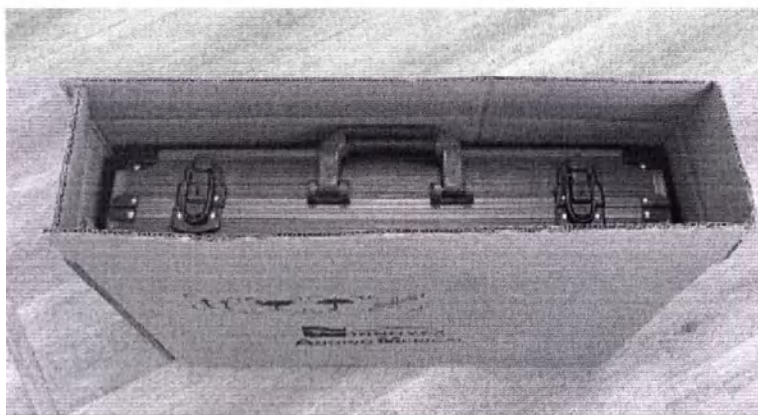


Маркировка.

INNOVEX
ANQING MEDICAL

Video Processor

Input Voltage / Eingangsspannung / Tension d'entrée / Tensione di
ingress / Entrada de tensão / Voltagem de entrada / قوتی دوچن یرمهللا لخدیا /
Giriş voltajı : 5V $\equiv$ 2A

REF EOS-B-01 LOT 180909EOS SN 0001 2018-09-29 QTY 1



Shanghai AnQing Medical Instrument Co., Ltd.
Room 202, 2nd Floor, No.7 Building, 150 Callun Road,
Zhangjiang High-Tech Park, 201210 Shanghai, CHINA




EC REP Emergo Europe
Prinsessegracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands


CE 0197

PP-CR-107-08 REV A/2


Видеопроцессор. Общий вид.

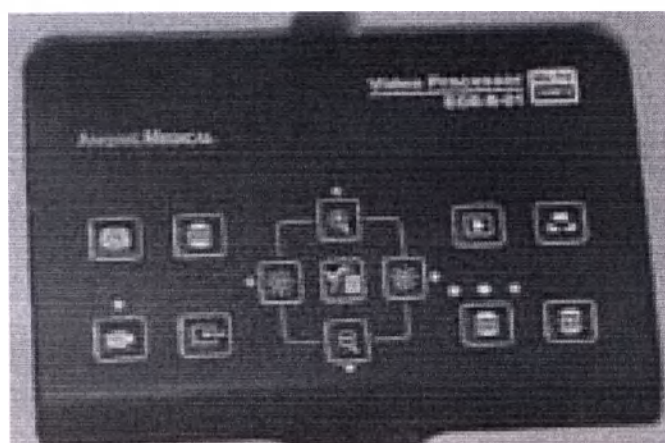


Педаль ножная. Общий вид.

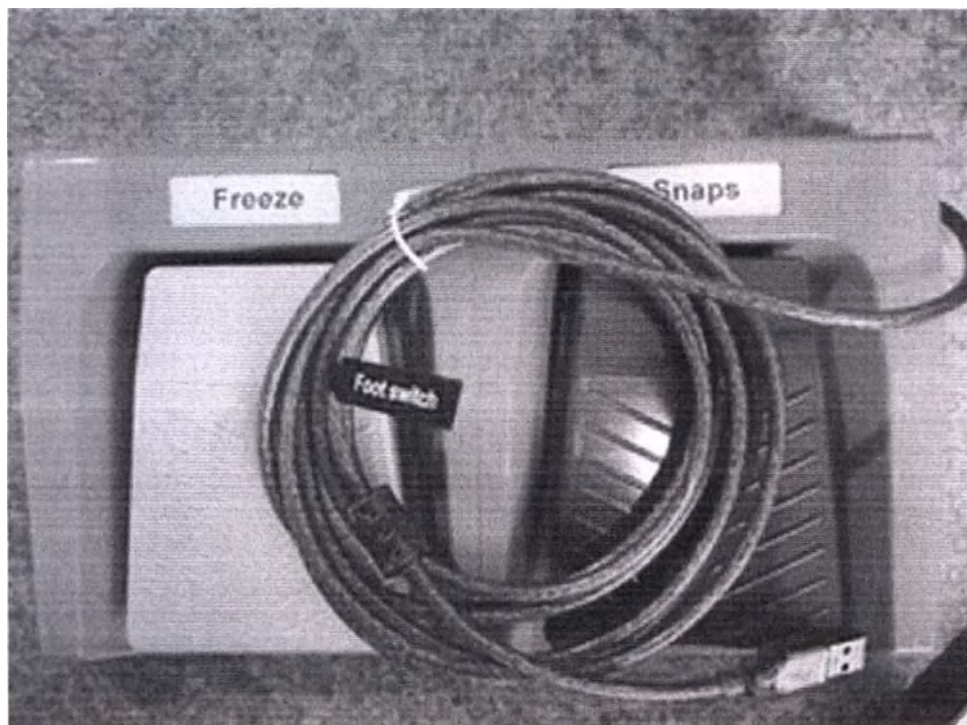


Адаптер питания. Общий вид.

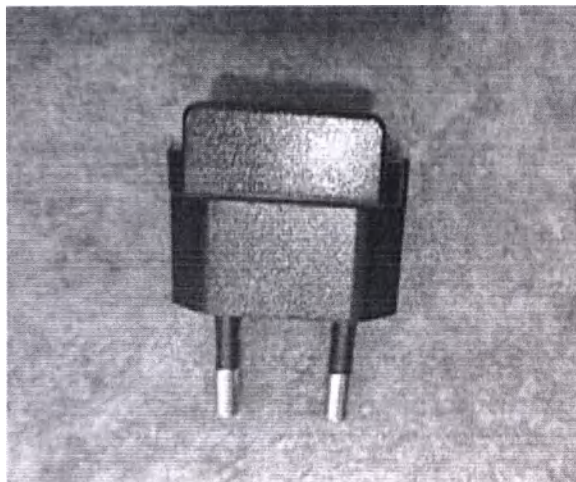


Кабель для передачи данных. Общий вид.

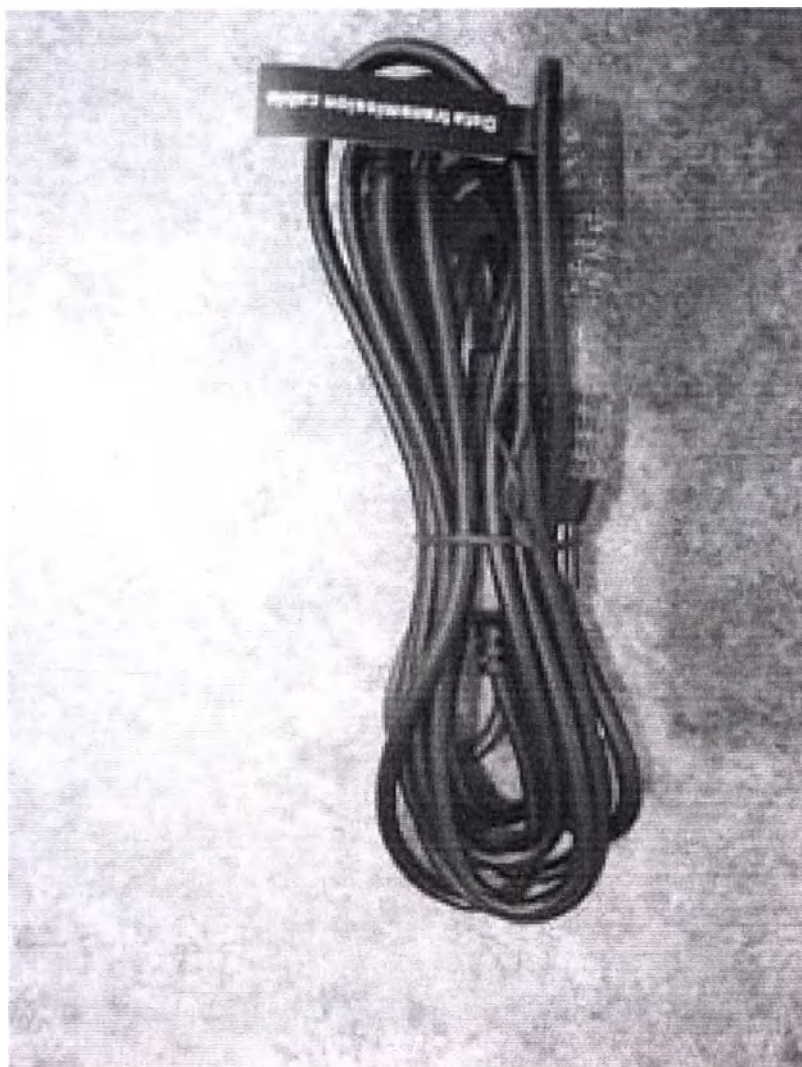

Кабель USB соединительный. Общий вид.

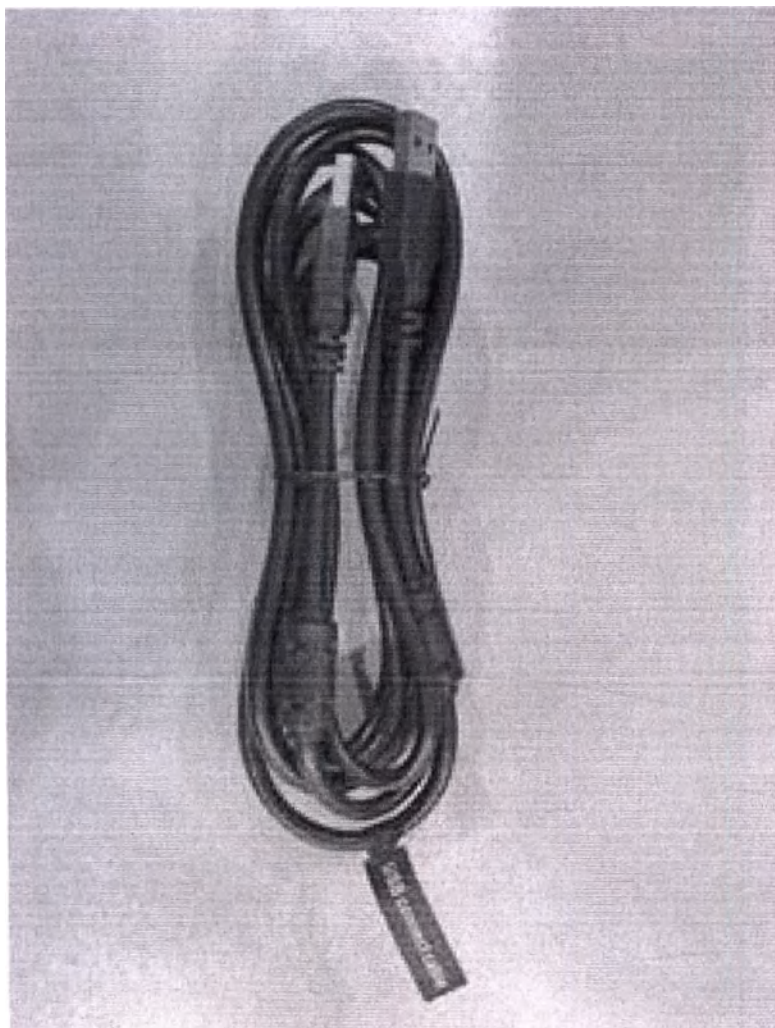


Разъем HDMI-DVI. Общий вид.

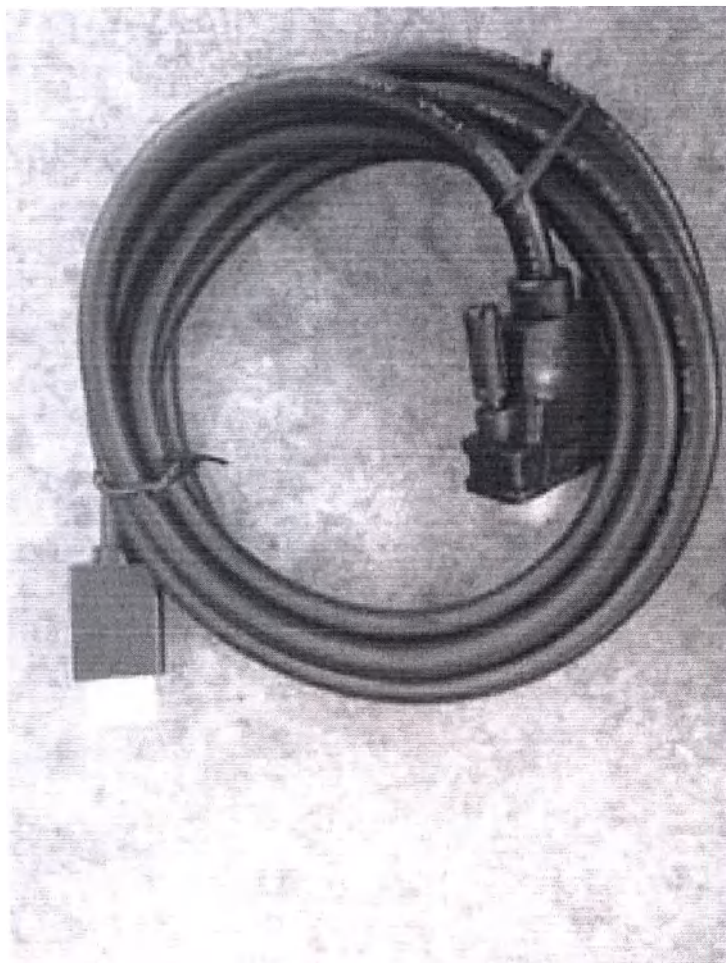

HDMI-кабель. Общий вид.



AV-кабель. Общий вид.

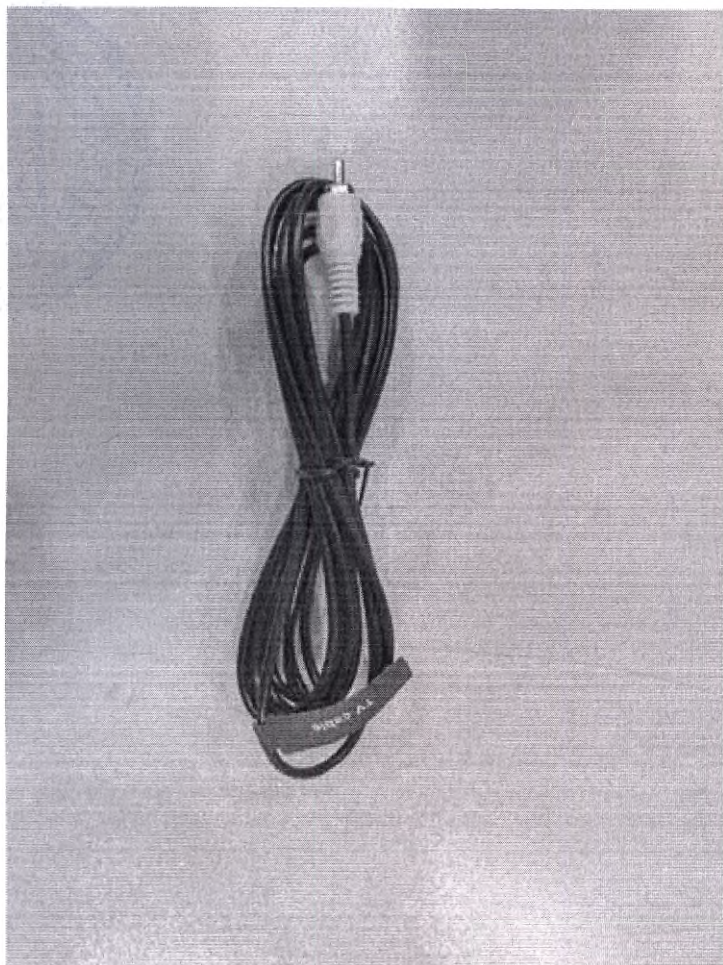

документов, прошу рассмотреть.
Всего _____ л.
Генеральный директор ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»
Захарченко Дмитрий Юрьевич _____



[Handwritten signature in blue ink]