

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «ИНТЕРЛАБ»


И.А. Павловский

18» мая 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Хроматограф жидкостный портативный "Близар CDT",


ТУ 26.51.53-003-14267540-2020

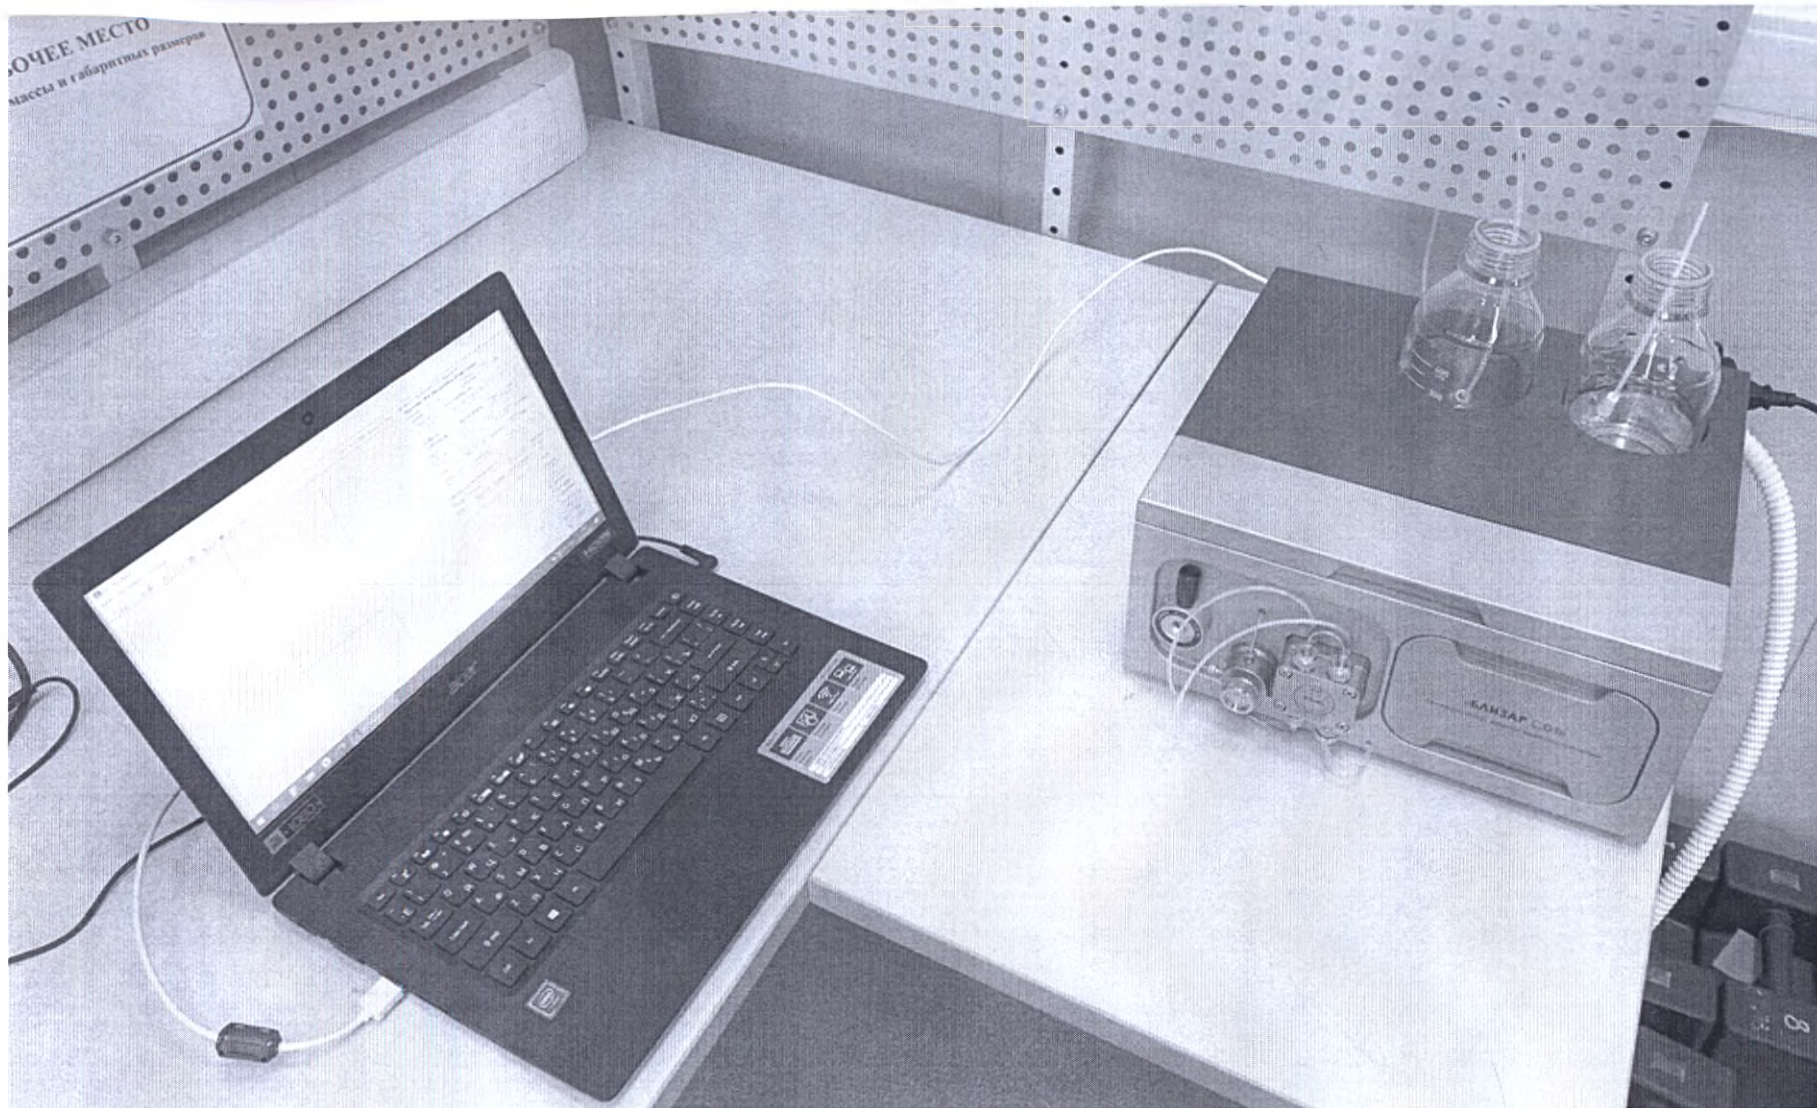

Фотографическое изображение 1 – Общий вид образца изделия Хроматограф жидкостный портативный «Близар CDT» (на фотографии Хроматограф жидкостный портативный «Близар CDT», USB-кабель, Бутыли для элюентов)




Фотографическое изображение 2 – Адаптер питания, USB-кабель, Шприц с разъемом Luer, 30 мл

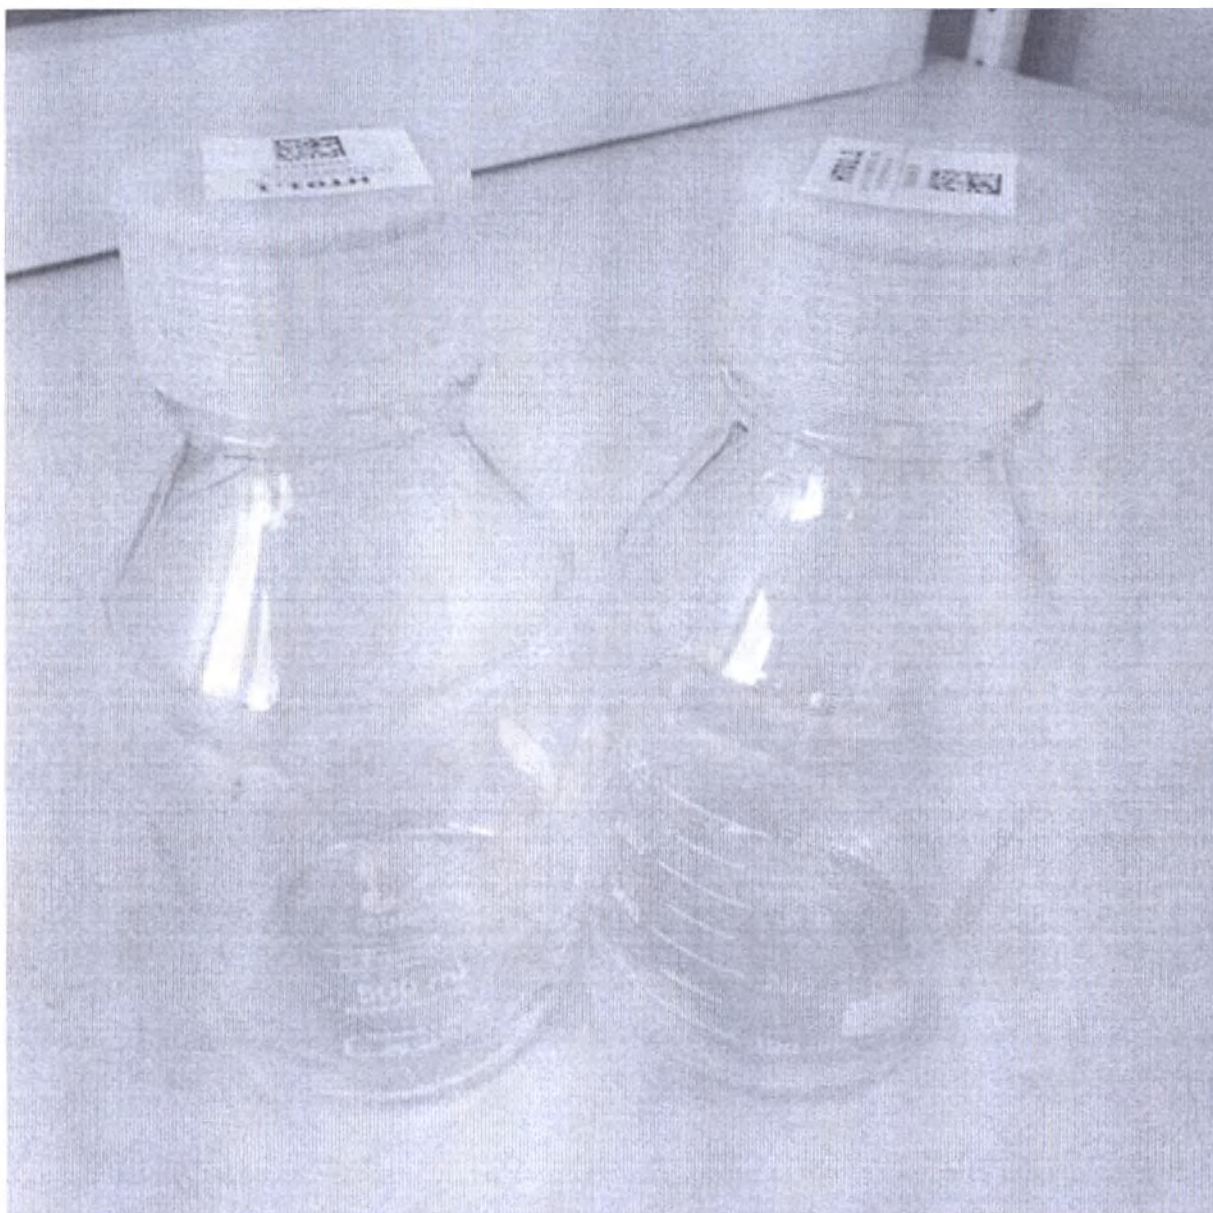


Фотографическое изображение 3 – Бутыль для элюентов




Фотографическое изображение 4 – Программное обеспечение «Флурен», Ключ активации ПО «Флурен» и Руководство по эксплуатации на Flash-накопителе

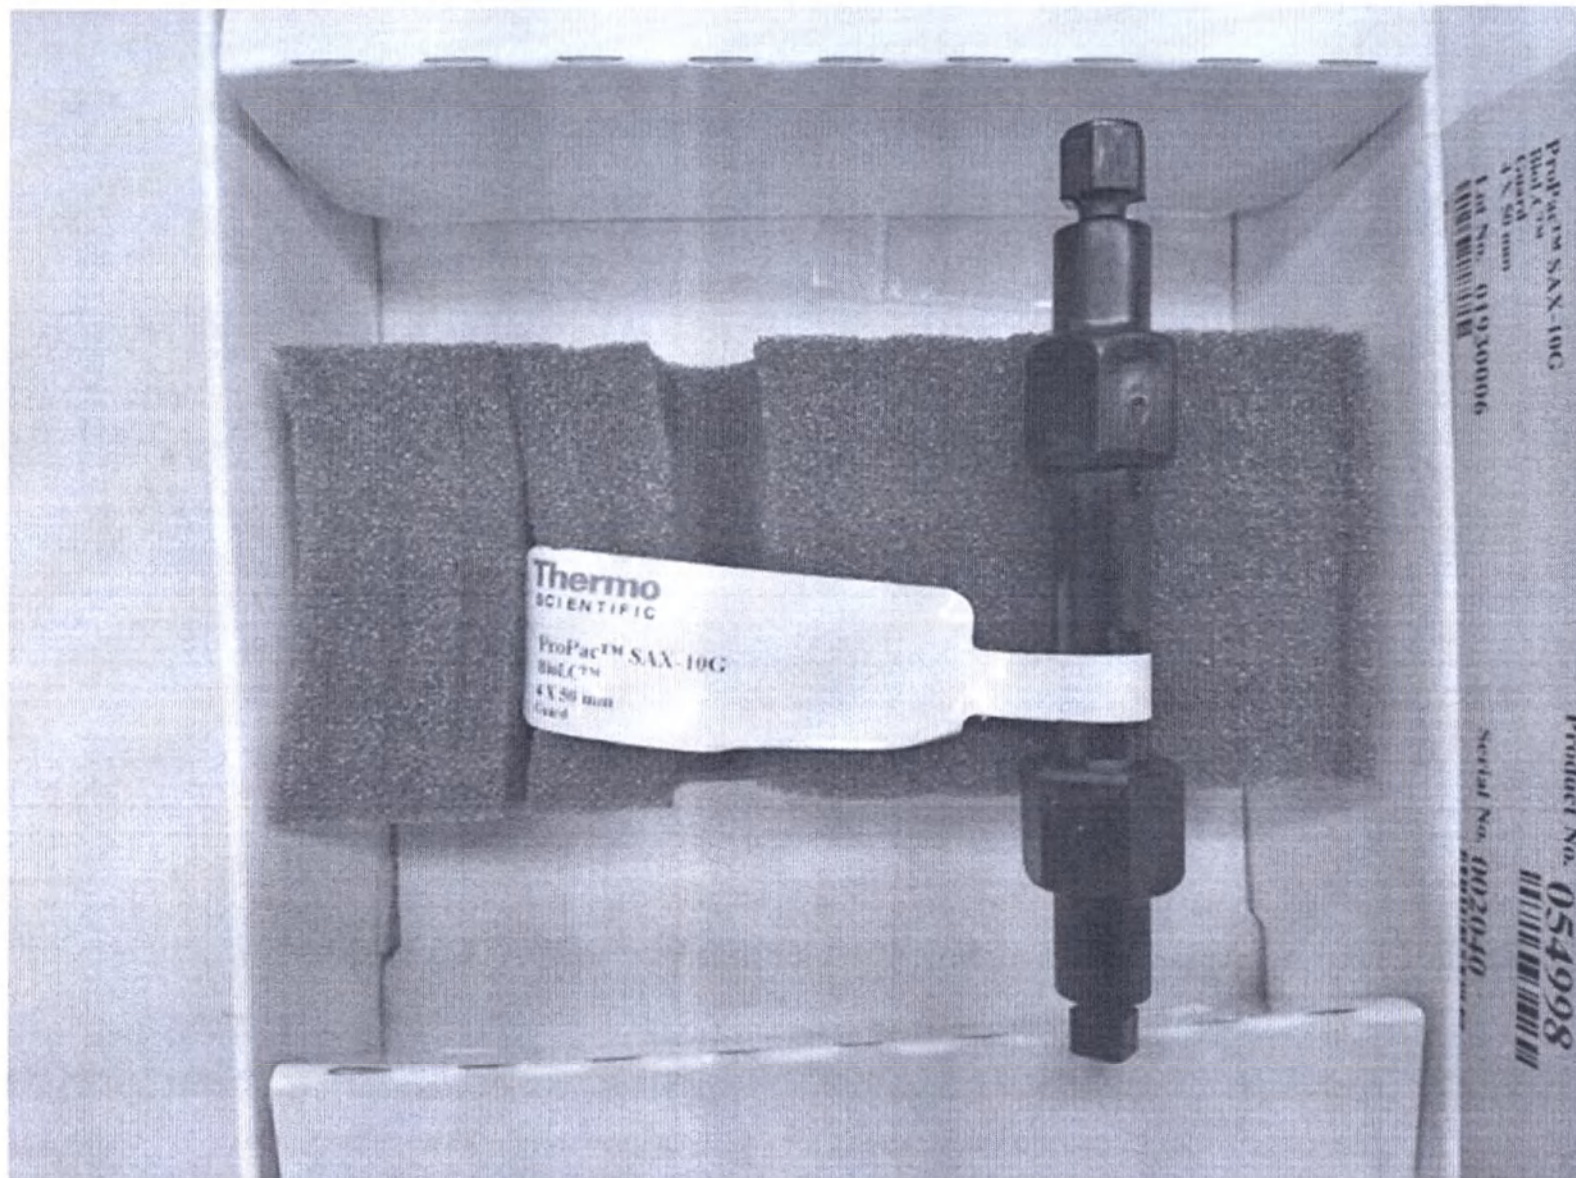


Фотографическое изображение 5 – Колонка аналитическая хроматографическая

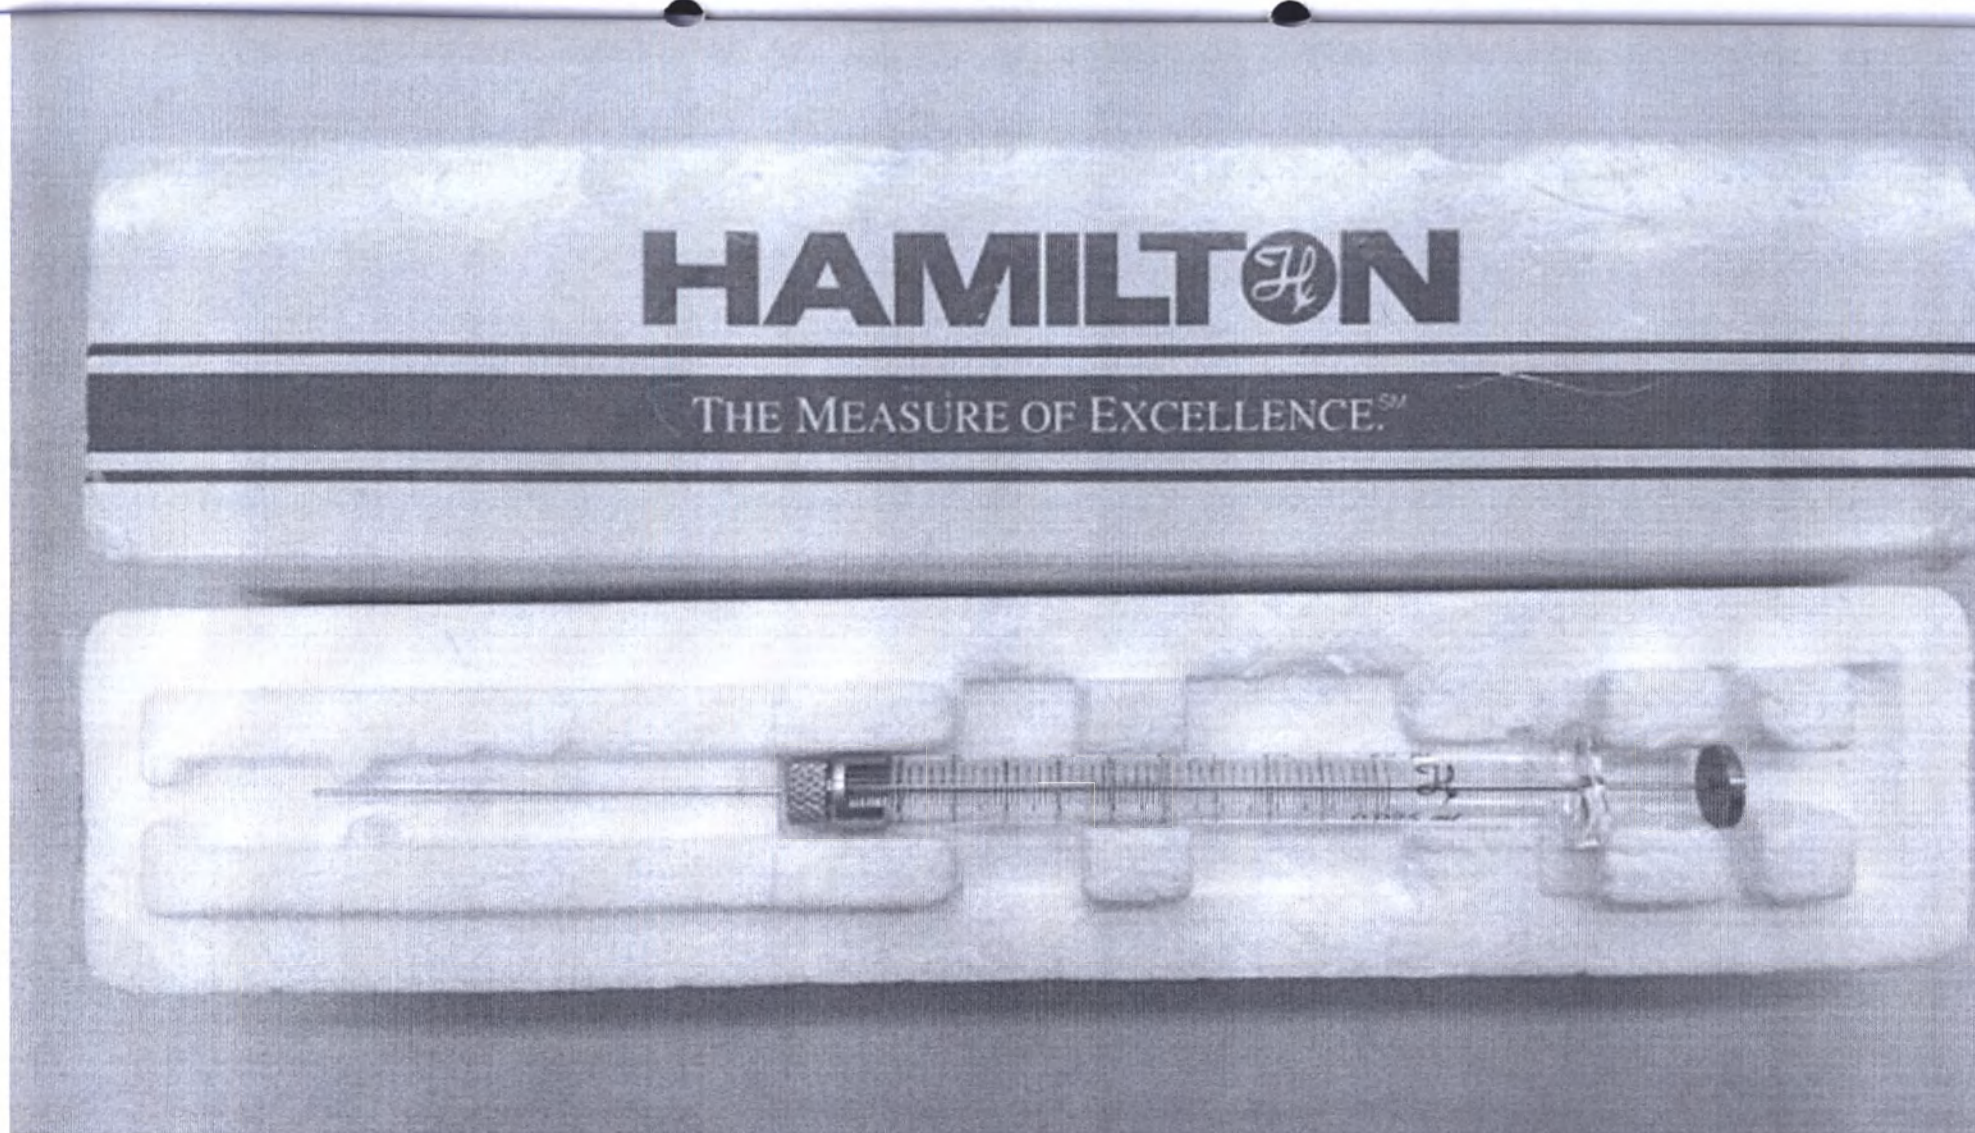


Фотографическое изображение 6 – Шприц для введения пробы, 25 мкл (Hamilton)

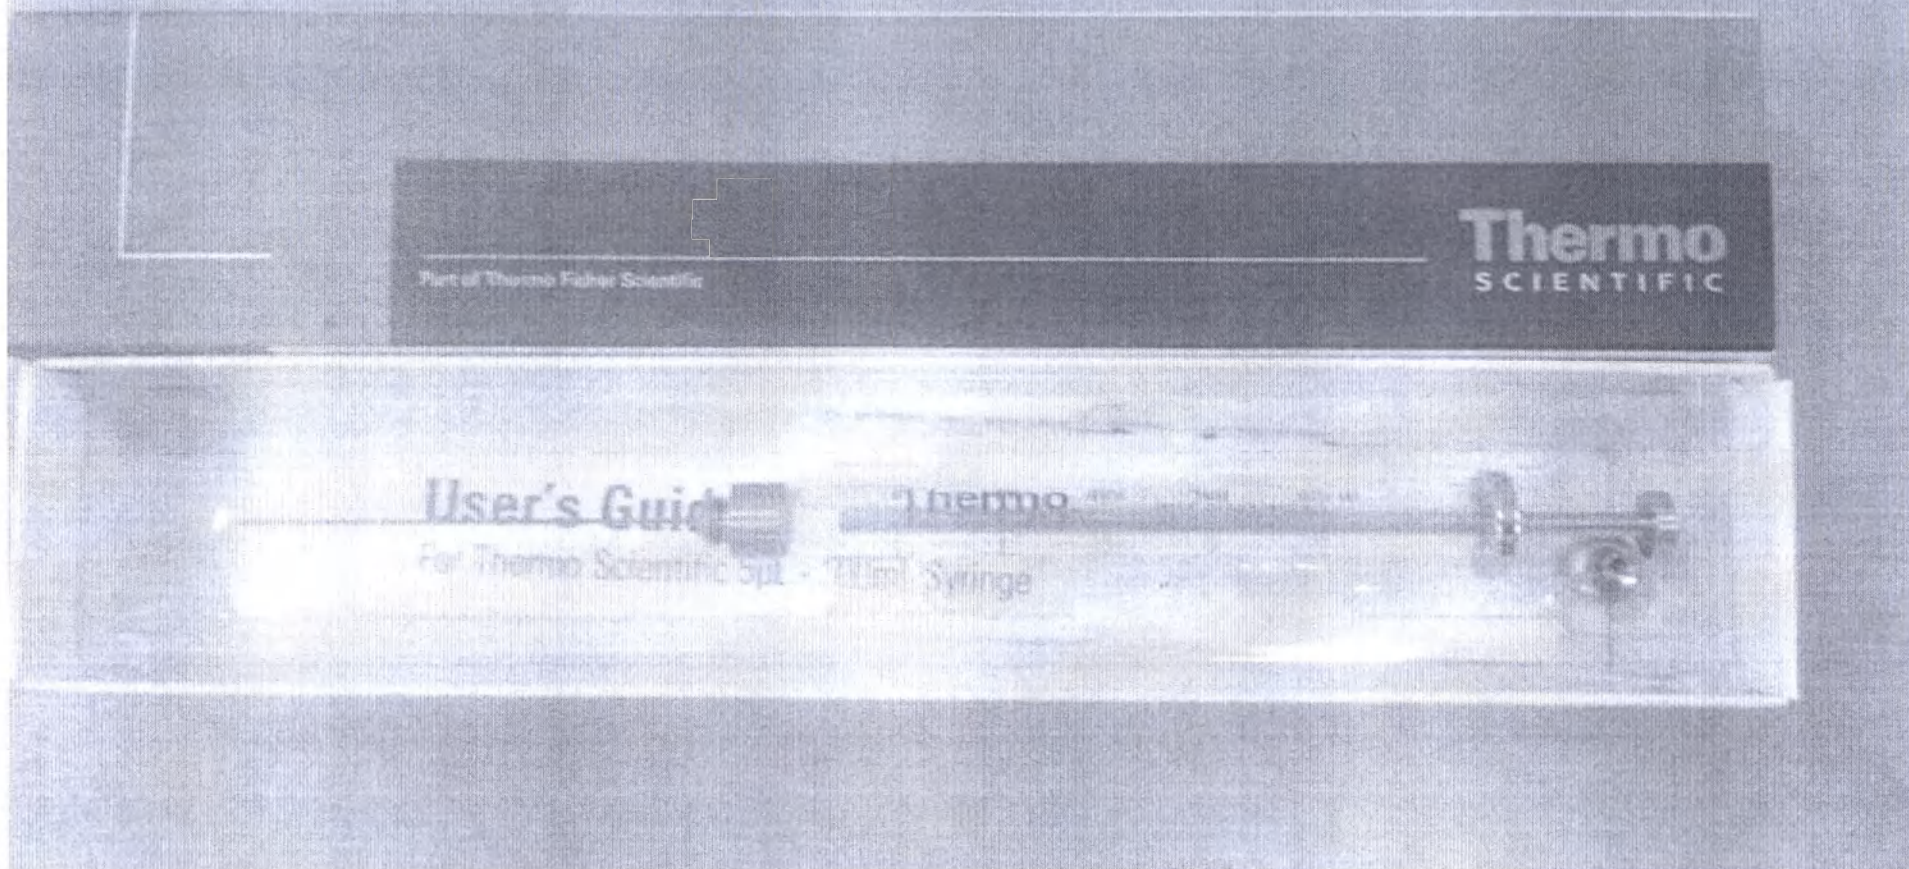


Фотографическое изображение 8 – Шприц для введения пробы, 25 мкл (Thermo Scientific)

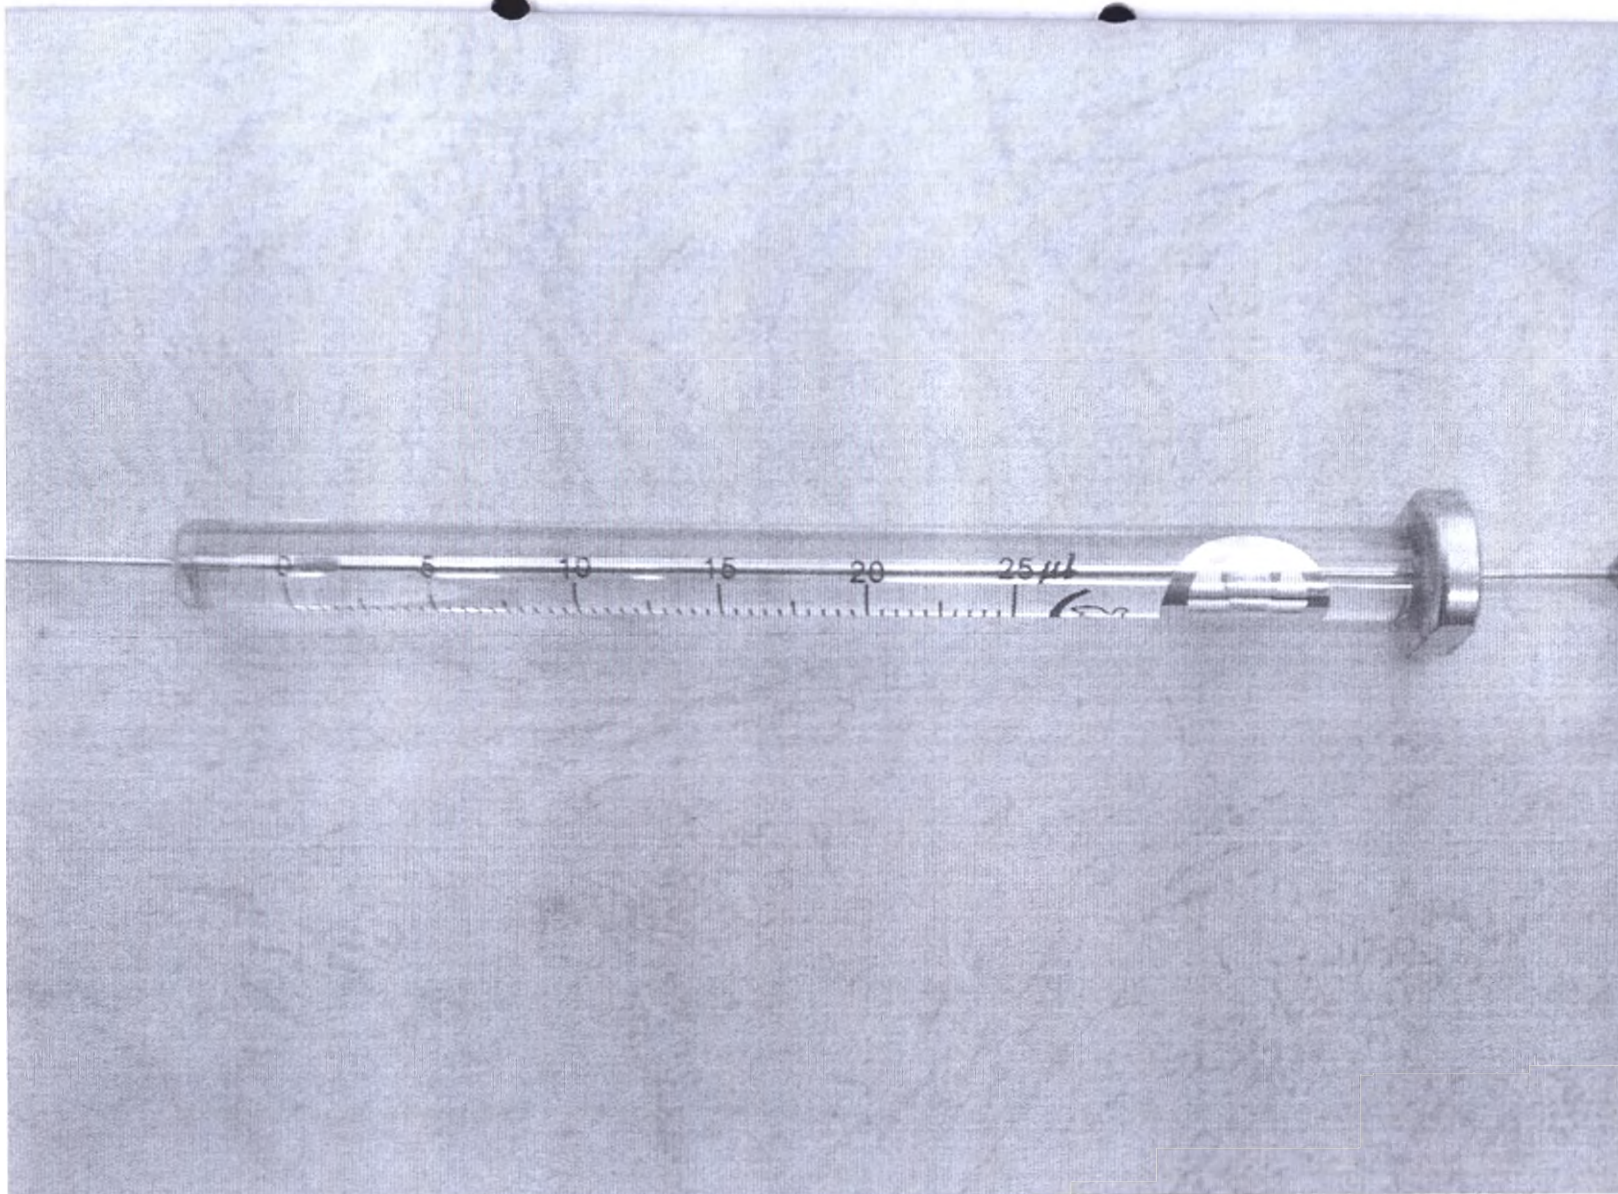


Фотографическое изображение 10 – Шприц для введения пробы, 25 мкл (Restek)

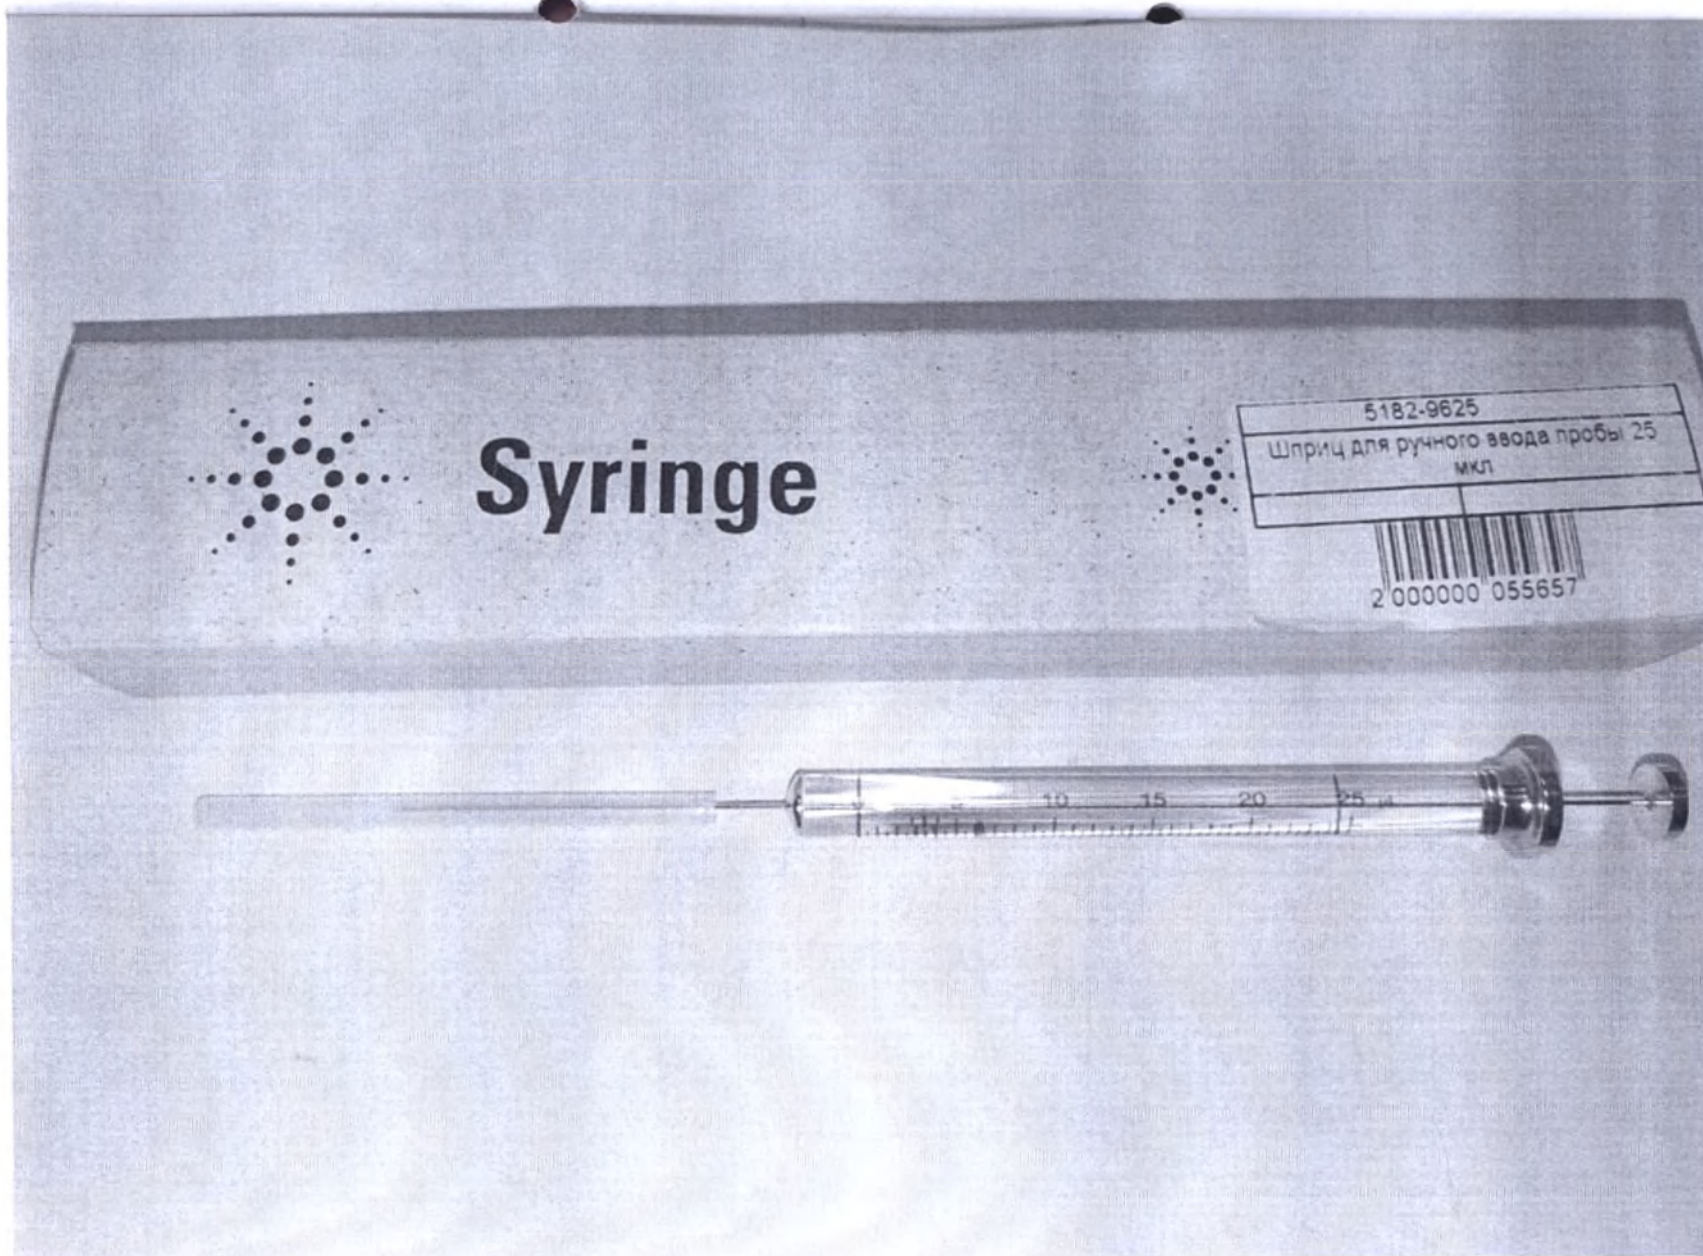


Фотографическое изображение 11 – Шприц для введения пробы, 25 мкл (Agilent Technologies)

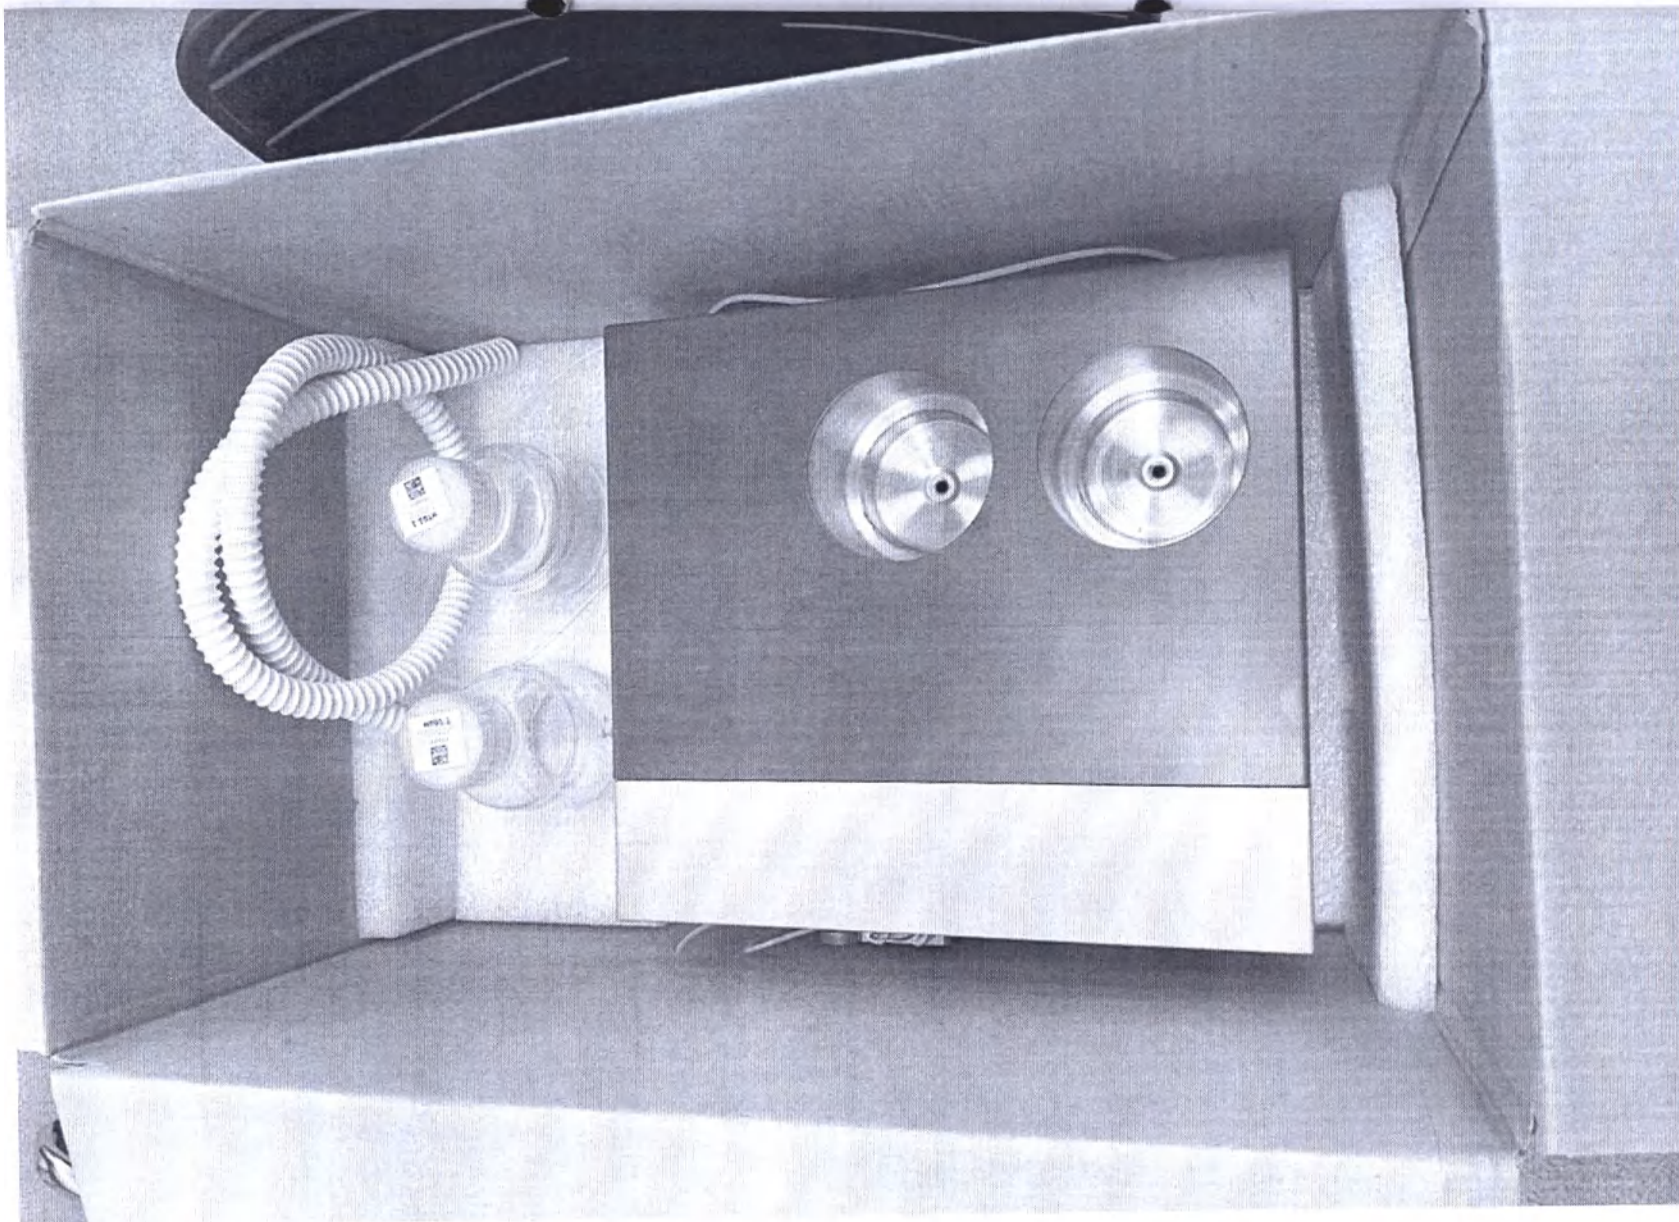

Фотографическое изображение 12 – Потребительская (транспортная) упаковка

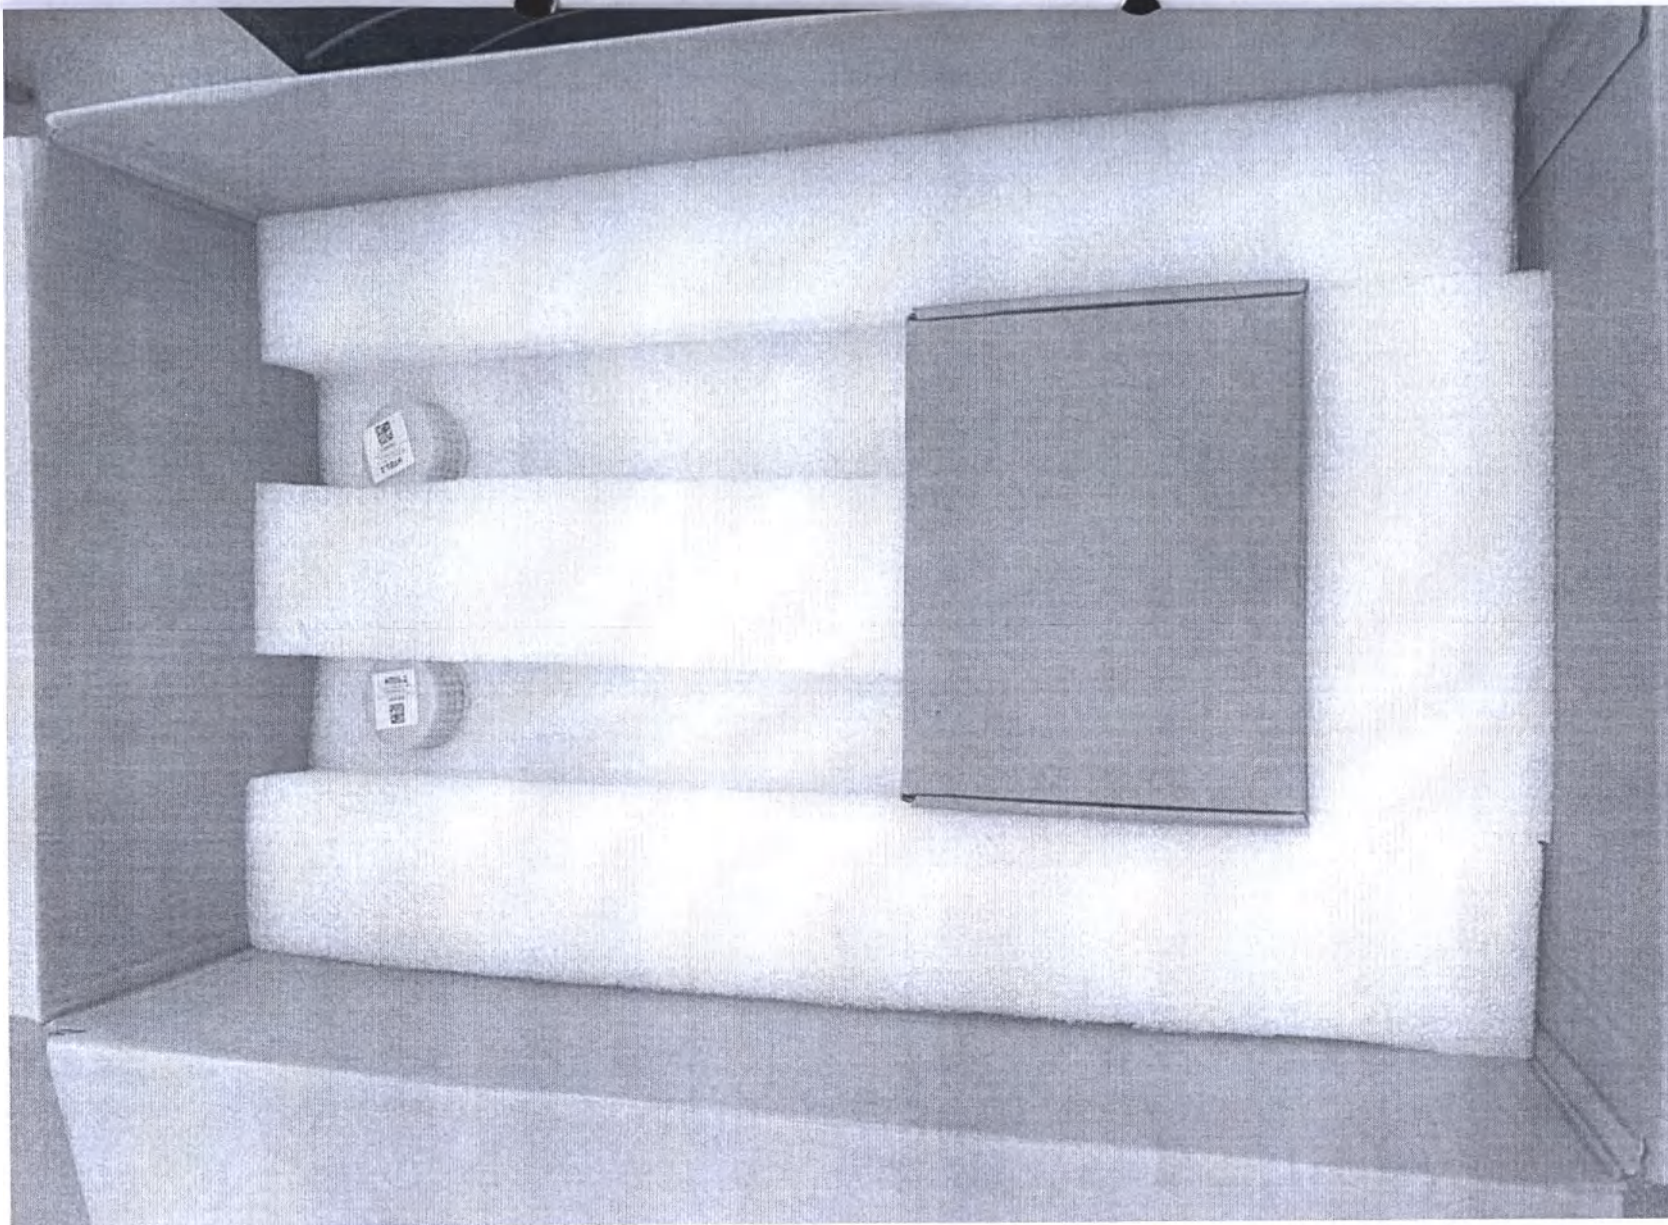

Фотографическое изображение 13 – Потребительская (транспортная) упаковка

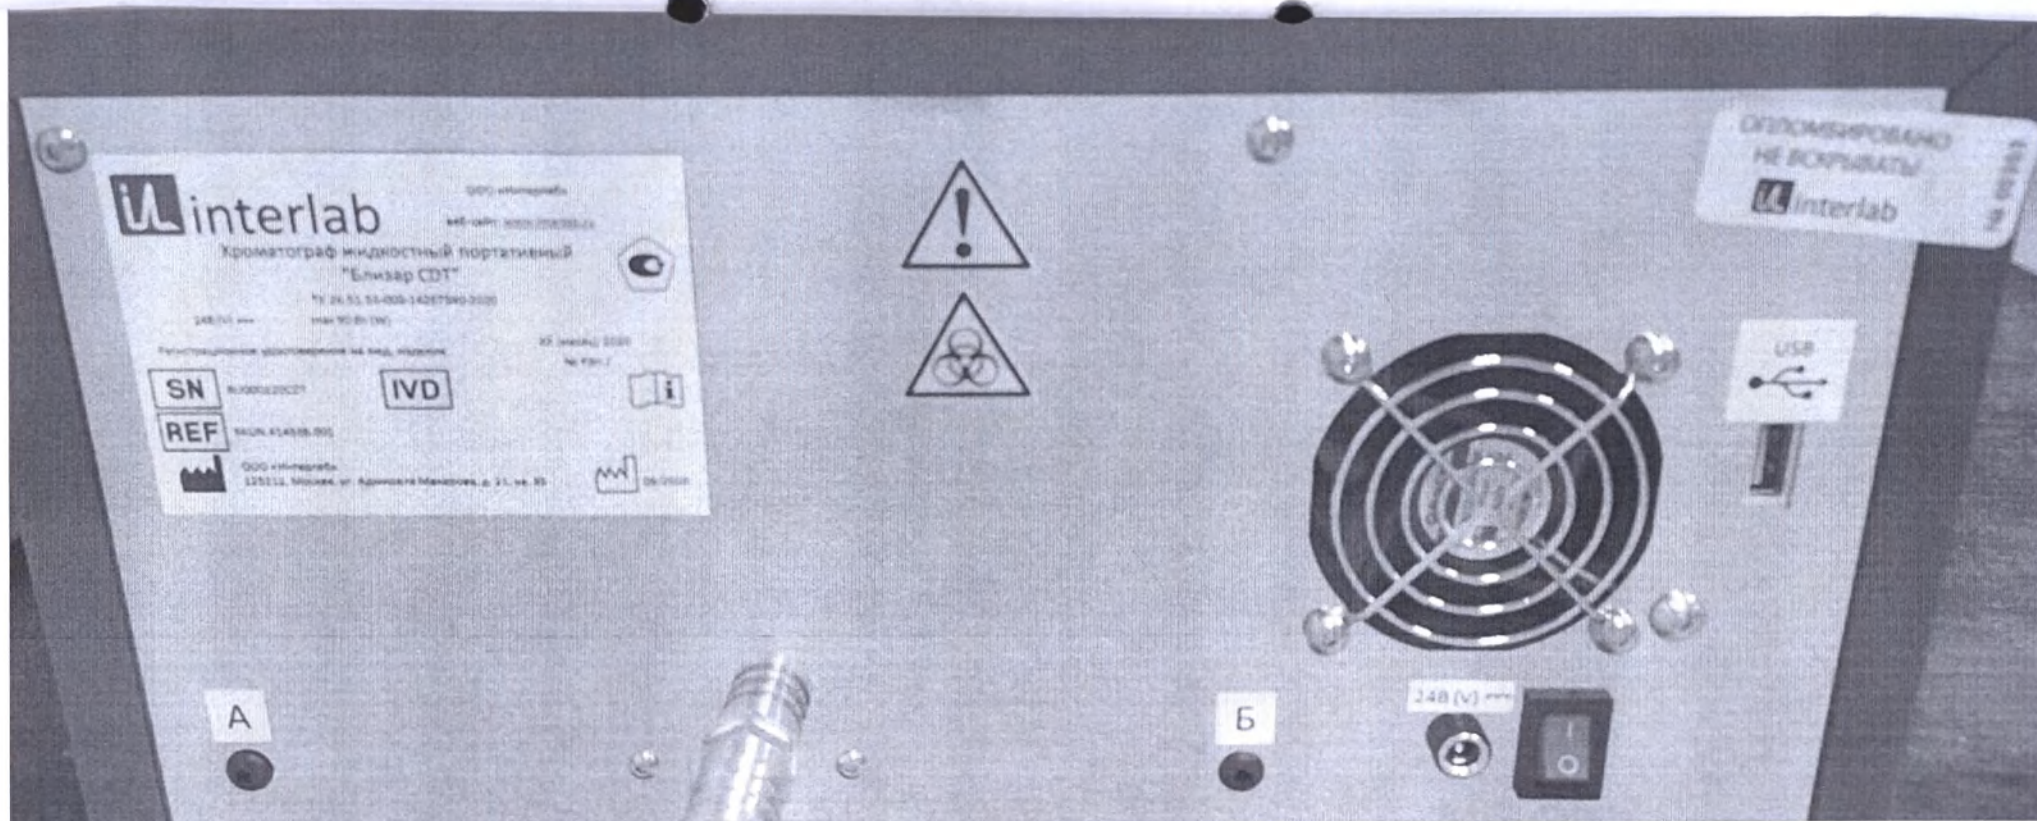

Фотографическое изображение 14 – Маркировка прибора



Фотографическое изображение 15 – Маркировка прибора

Хроматограф жидкостный портативный
"Близар CDT"

ТУ 26.51.53-003-14267540-2020



Грузополучатель:

Пункт назначения:

Предприятие-изготовитель: ООО Интерлаб

Юридический адрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 21, кв. 33

Упаковано: ММ/ГГ

Условия транспортирования и хранения: от +5°C до +40°C, при влажности не более 80%.

60 × 40 × 27 см

БРУТТО	КГ
НЕТТО	КГ

ООО ИНТЕРЛАБ
веб-сайт: www.interlab.ru
 interlab

Фотографическое изображение 15 – Маркировка транспортной упаковки

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор

Павловский И.А.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИНТЕРЛАБ»

Павловский И.А.

«18» мая 2020 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Хроматограф
жидкостный портативный "Близар CDT",**

ТУ 26.51.53-003-14267540-2020



ООО «Интерлаб»

веб-сайт: www.interlab.ru

Хроматограф жидкостный портативный
"Близар CDT"



ТУ 26.51.53-003-14267540-2020

24В (V) ---

max 90 Вт (W)

Регистрационное удостоверение на мед. изделие

XX (месяц) 2020

№ РЗН /



RU000120CDT



FAUN.414538.001



ООО «Интерлаб»

125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 21, кв. 33



09/2020

Рисунок 1 – Макет маркировки Хроматографа

Хроматограф жидкостный портативный
"Близар CDT"

ТУ 26.51.53-003-14267540-2020



Грузополучатель:

Пункт назначения:

Предприятие-изготовитель: ООО Интерлаб

Юридический адрес: 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 21, кв. 33

Упаковано: ММ/ГГ

Условия транспортирования и хранения: от +5°C до +40°C, при влажности не более 80%.

60 × 40 × 27 см

БРУТТО КГ
НЕТТО КГ

ООО ИНТЕРЛАБ

веб-сайт: www.interlab.ru




Рисунок 2 – Макет маркировки транспортной упаковки

ОПЛОМБИРОВАНО
НЕ ВСКРЫВАТЬ!

 interlab

№ 00304

Рисунок 3 – Макет пломбы средства измерения;



Рисунок 4 – Символ «Осторожно! Сверьтесь с Руководством по эксплуатации»



Рисунок 4 – Символ «Биологическая опасность»



Рисунок 4 – Символ «Внимание! Горячая поверхность»

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа

Генеральный директор



Павловский И.А.