

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2020 г.


М.П.




Фотографические изображения

**Набор реагентов для качественного определения антител IgM к
коронавирусу SARS-CoV-2 (2019-nCoV IgM (CLIA)) в сыворотке или
плазме крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном
анализаторе серии Maglumi для диагностики in vitro. Партии
2712001401, 2712001301**


Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd. («Шэньчжэнь Нью
Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., ООО»), Китай

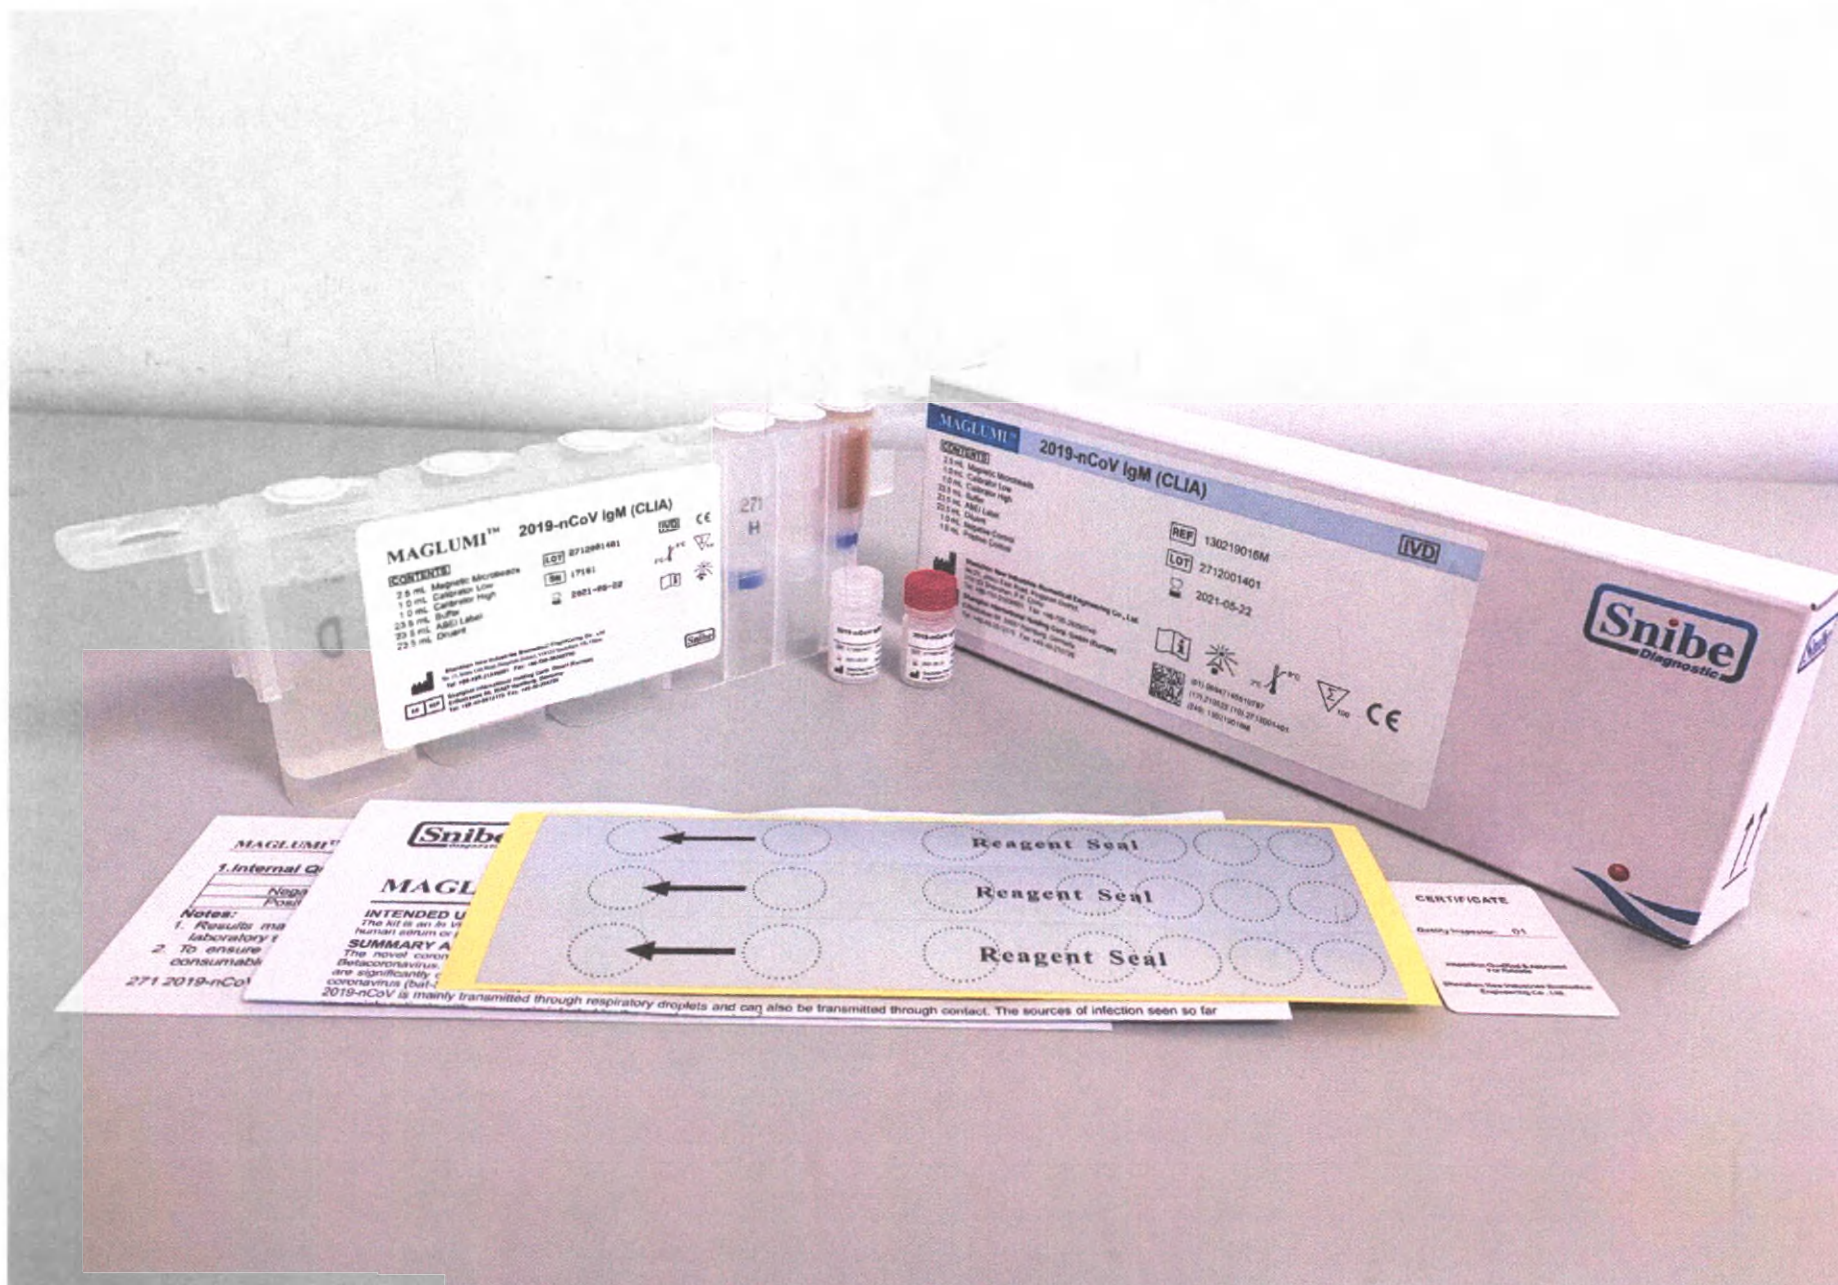

Общий вид МИ «Набор реагентов для качественного определения антител IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (2019-nCoV IgM (CLIA)) в сыворотке или плазме крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии Maglumi для диагностики in vitro. Партии 2712001401, 2712001301»

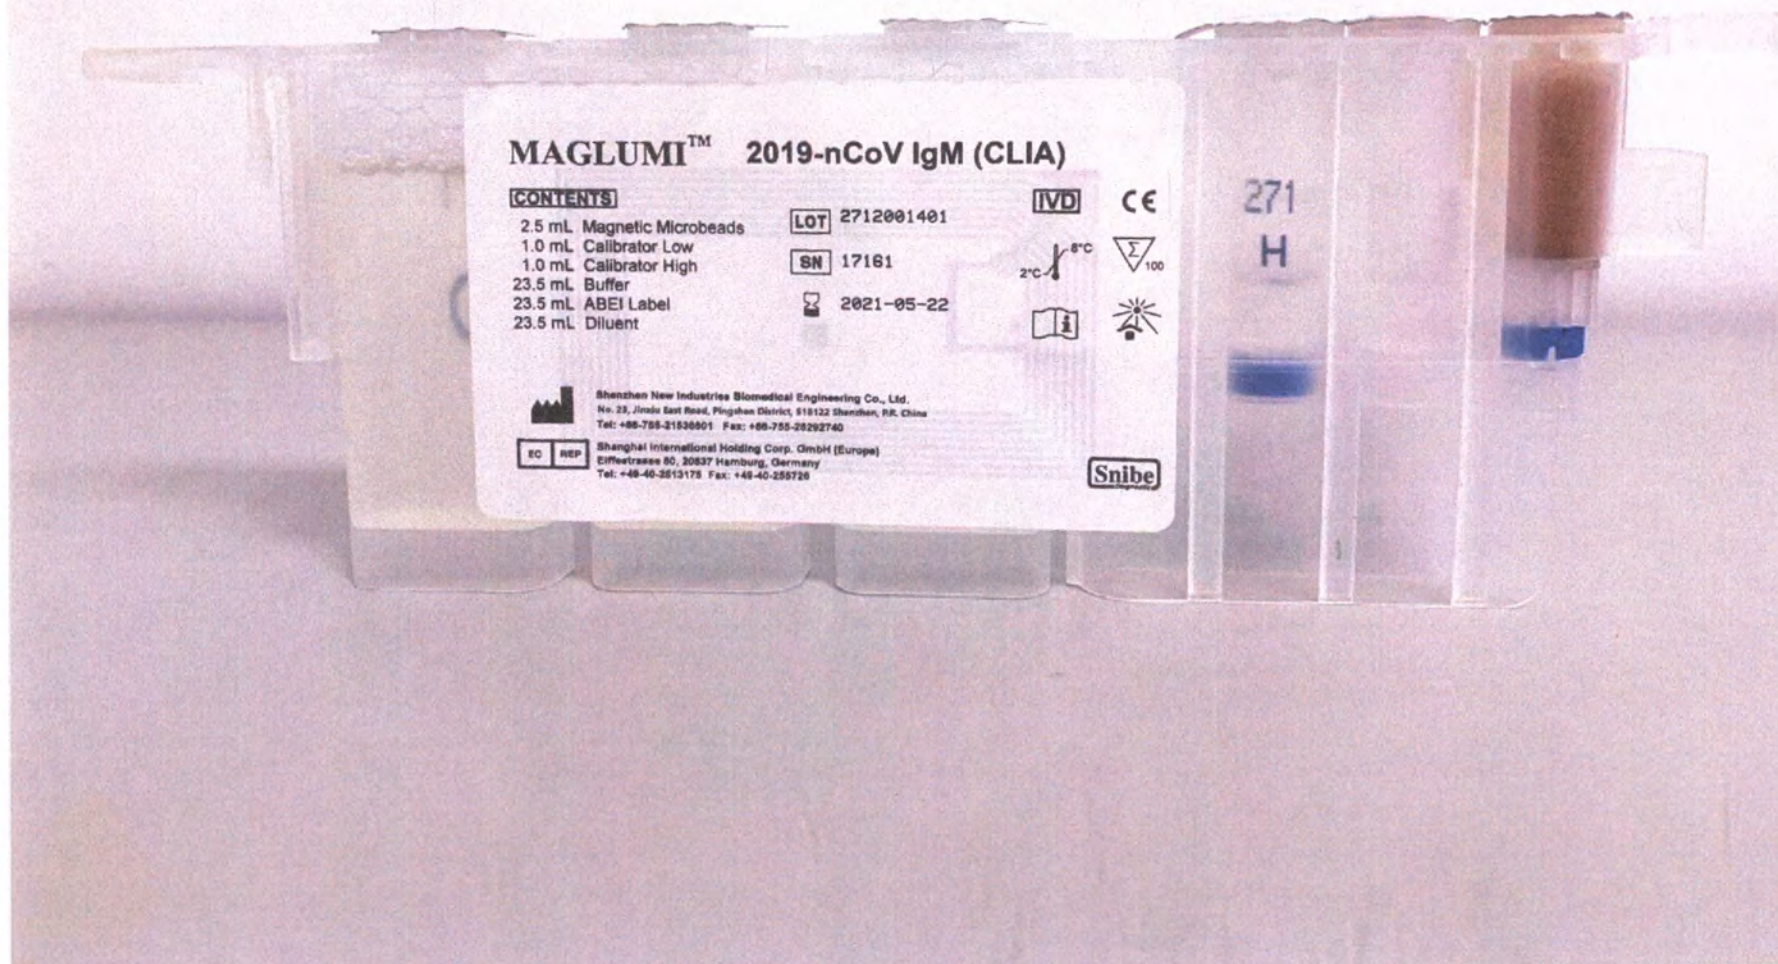

Общий вид картриджа

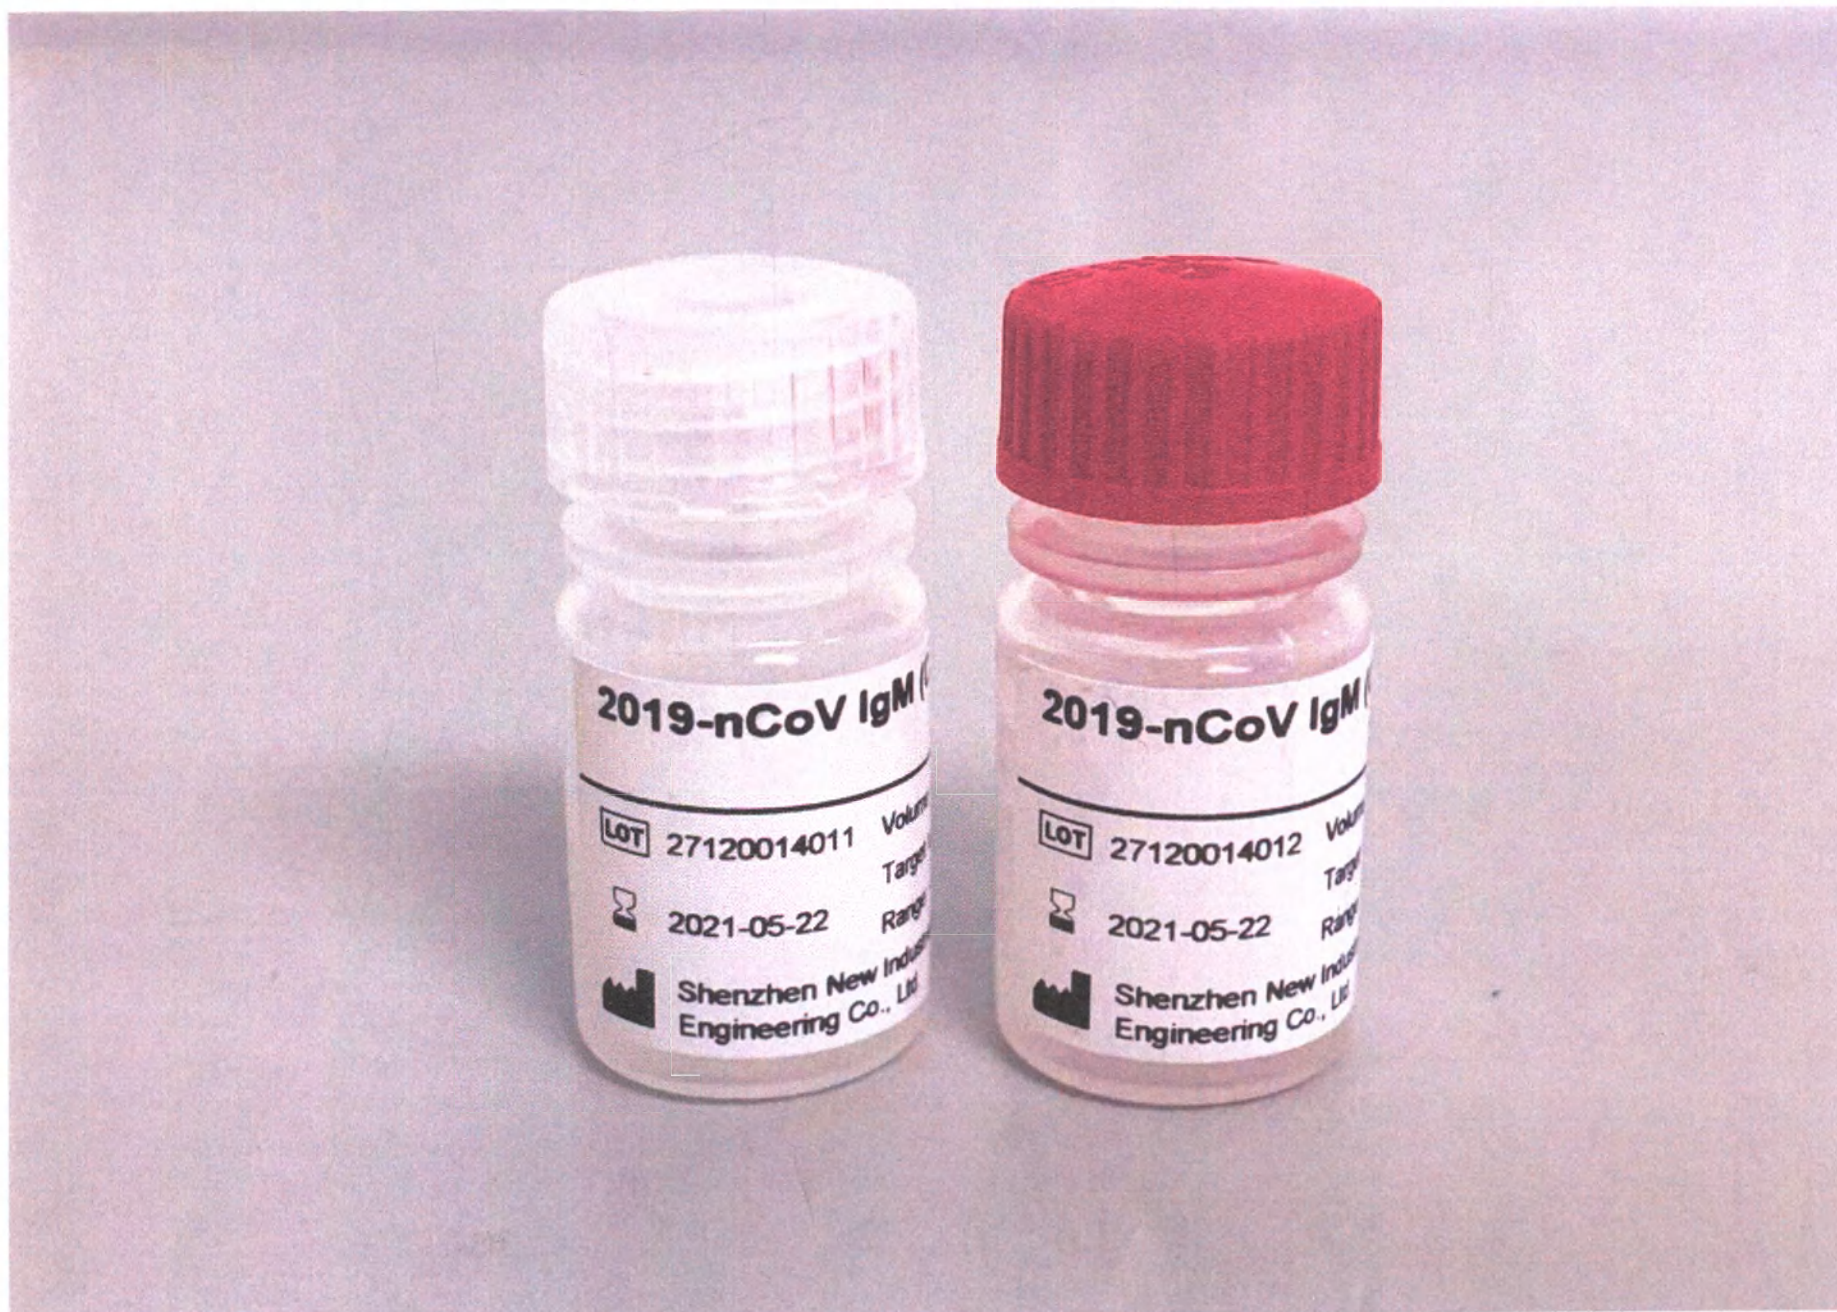


Общий вид: Материал контрольный положительный (control material positive) и Материал контрольный отрицательный (control material negative)



2019-nCoV IgM (CLIA)

MAGLUMI®
Negative Control

LOT 27120014011 Volume: 1.0 mL
2021-05-22 Target Value: /
Range: < 0.700 AU/mL




Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.




2019-nCoV IgM (CLIA)

MAGLUMI®
Positive Control

LOT 27120014012 Volume: 1.0 mL
2021-05-22 Target Value: 4.00 AU/mL
Range: 2.80- 5.20 AU/mL



Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.



Общий вид: Материал контрольный положительный (control material positive) и Материал контрольный отрицательный (control material negative)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 5 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

