

Фотографические изображения

Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody), производства «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Diagnostикс ГмбХ"), Германия


Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (общий вид)




Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике *in vitro* к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (маркировка)



Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике *in vitro* к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (маркировка)

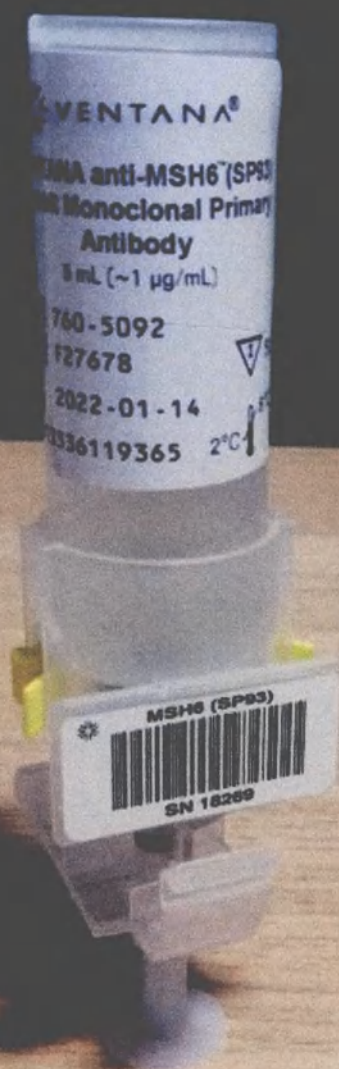


Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (маркировка)

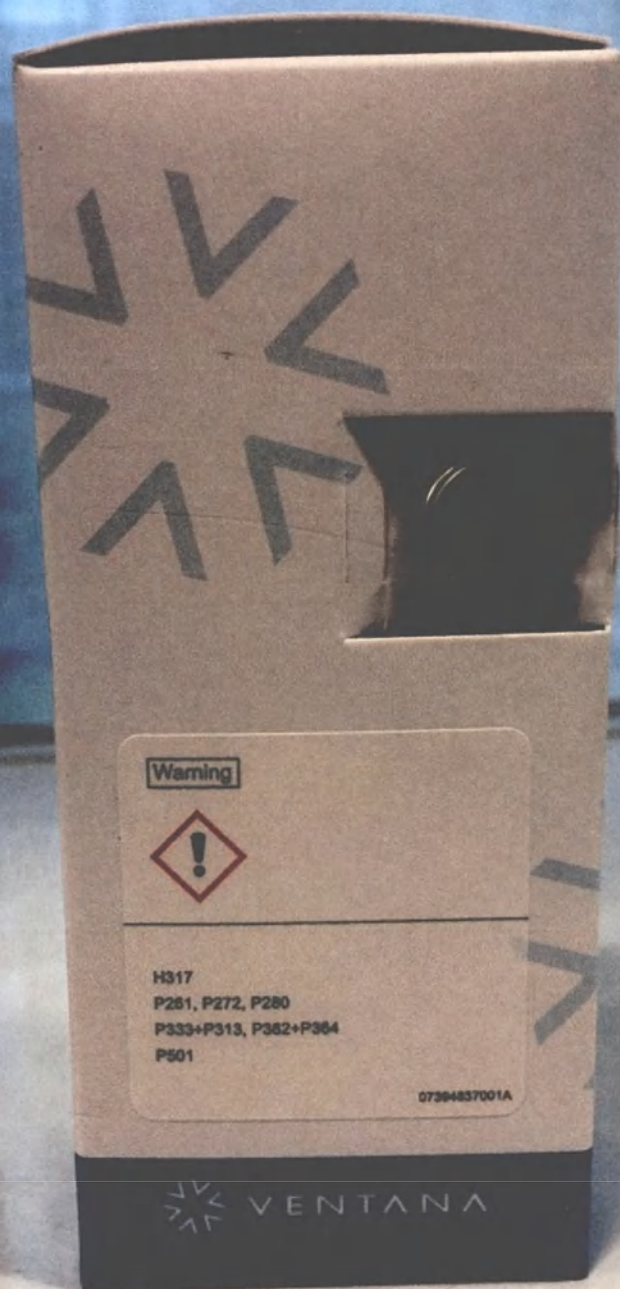

Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике in vitro к иммуностейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (маркировка)



Первичное кроличье моноклональное антитело для качественного обнаружения белка MSH6 иммуногистохимическим методом в диагностике in vitro к иммуноштейнерам автоматическим серии BenchMark (VENTANA MMR IHC Panel: VENTANA anti-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody) (маркировка)

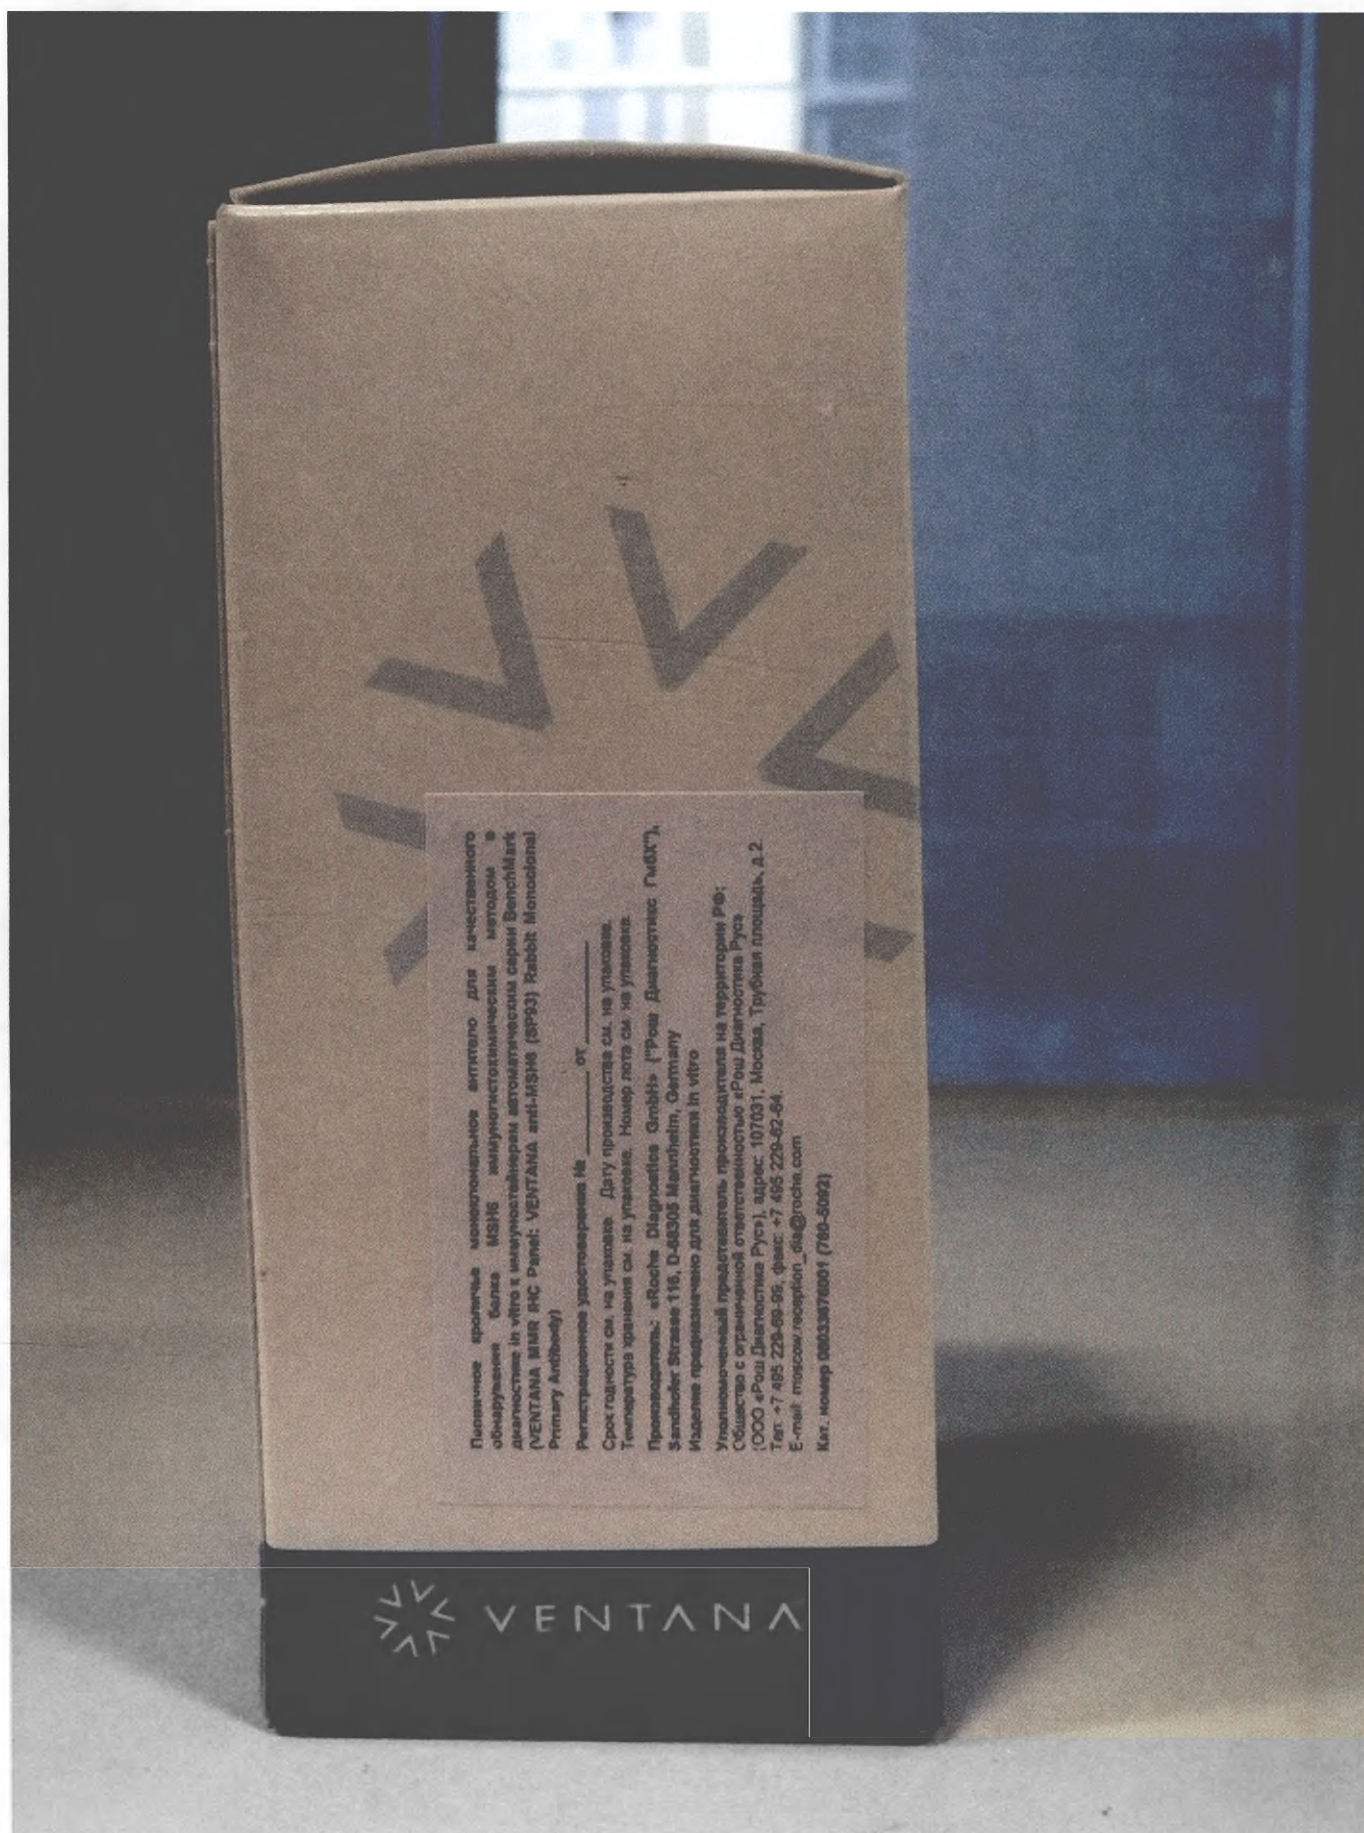

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
7 листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2018