

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»


Син Чэнь Син Чэнь
26.08.20
Син Чэнь 2020 г.
Mindray
Medical Rus

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ДЕТЕРГЕНТ С (DETERGENT С) ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ИММУНОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ СL ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO*

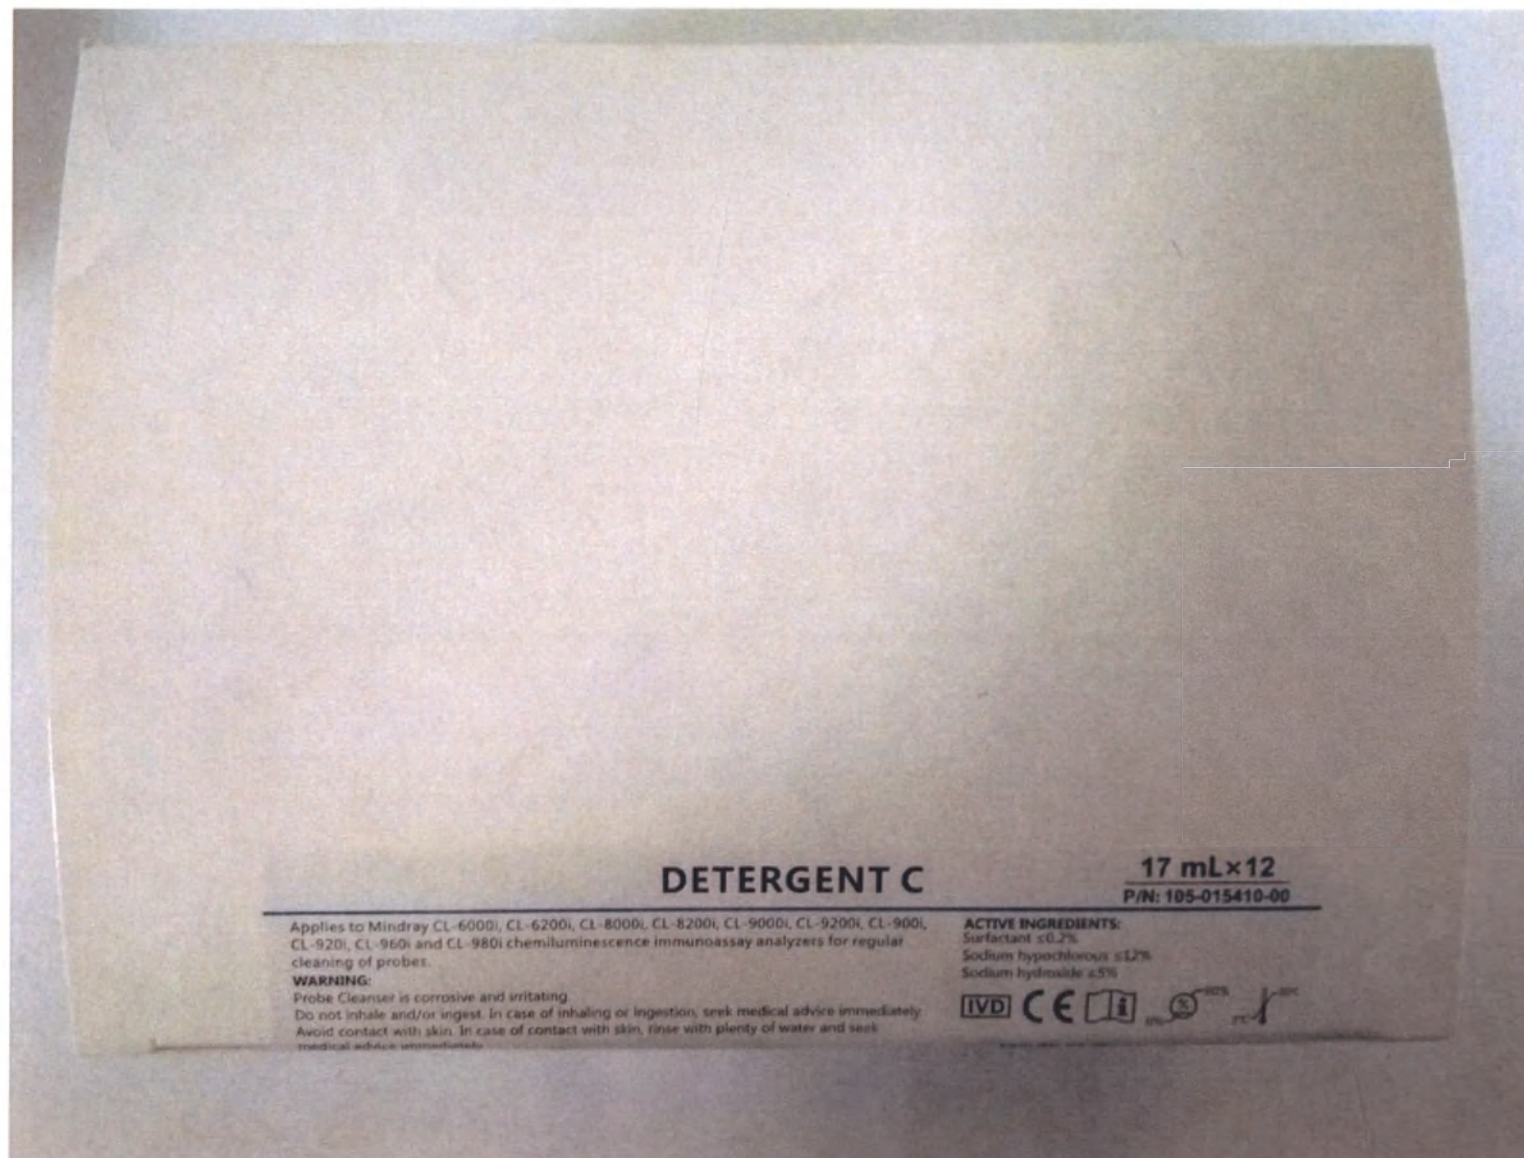


Рис.1 Картонная транспортная упаковка изделия Детергент С (Вид сверху)

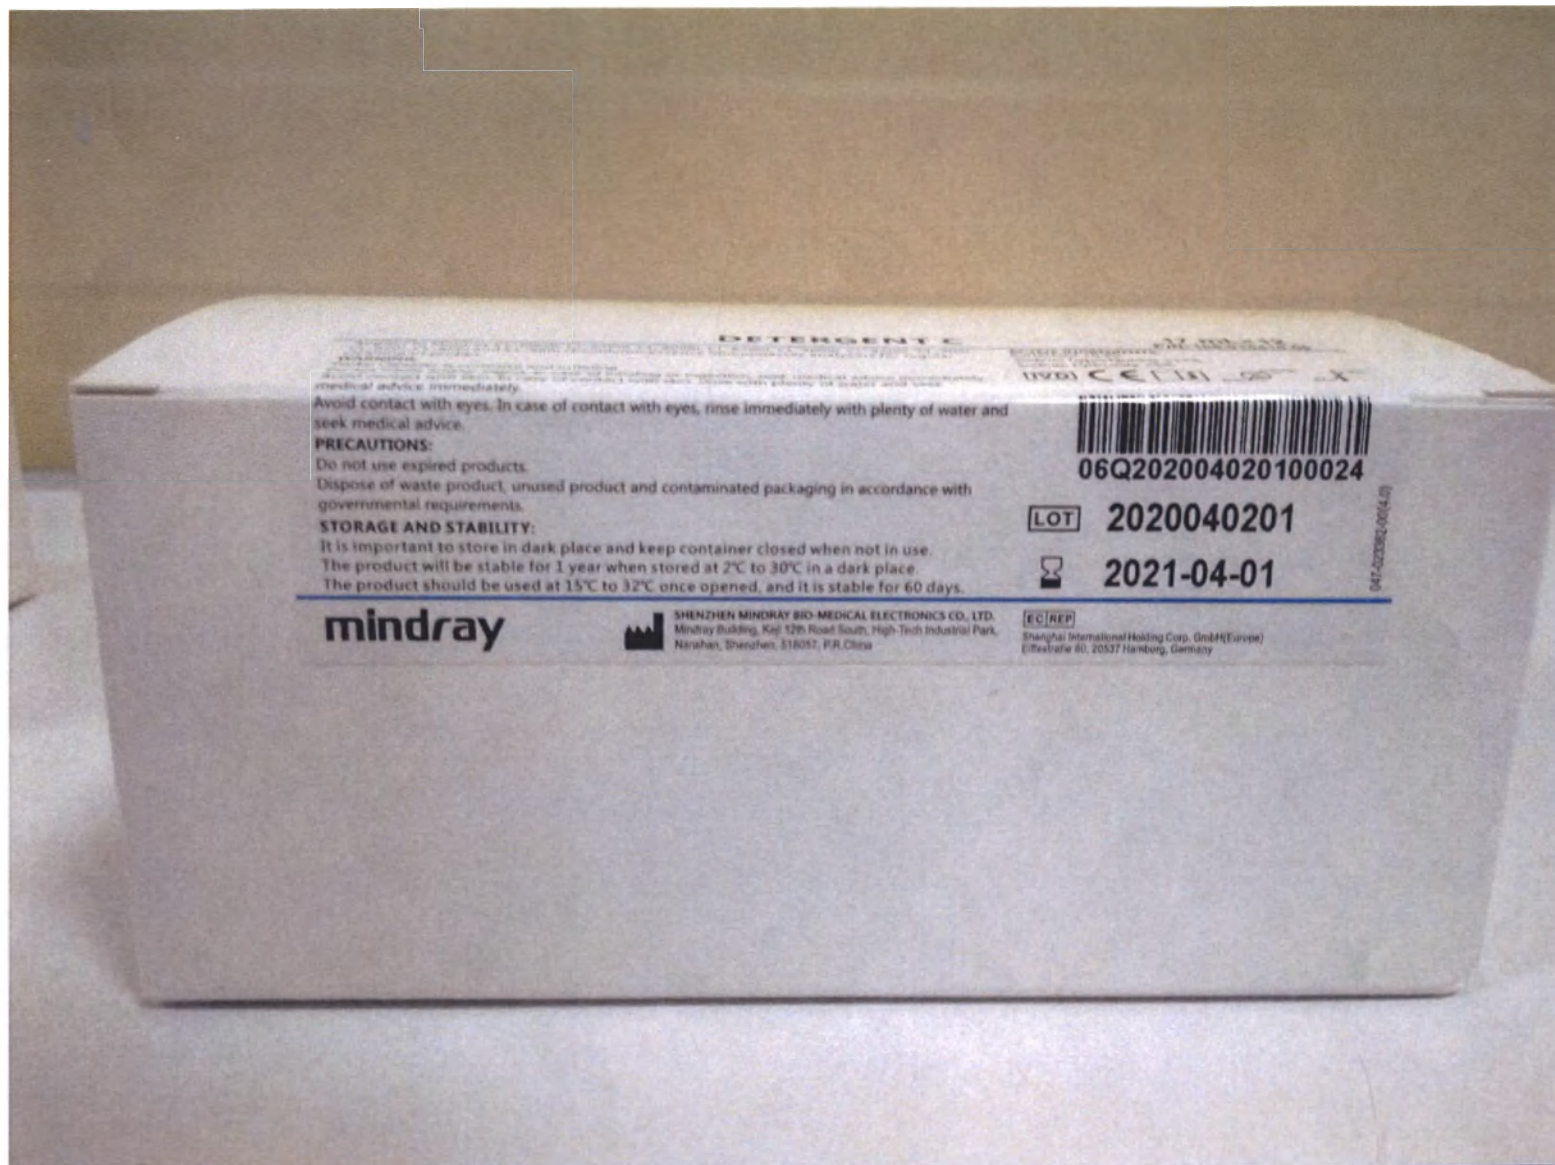


Рис.2 Картонная транспортная упаковка изделия Детергент С (Фронтальный вид)

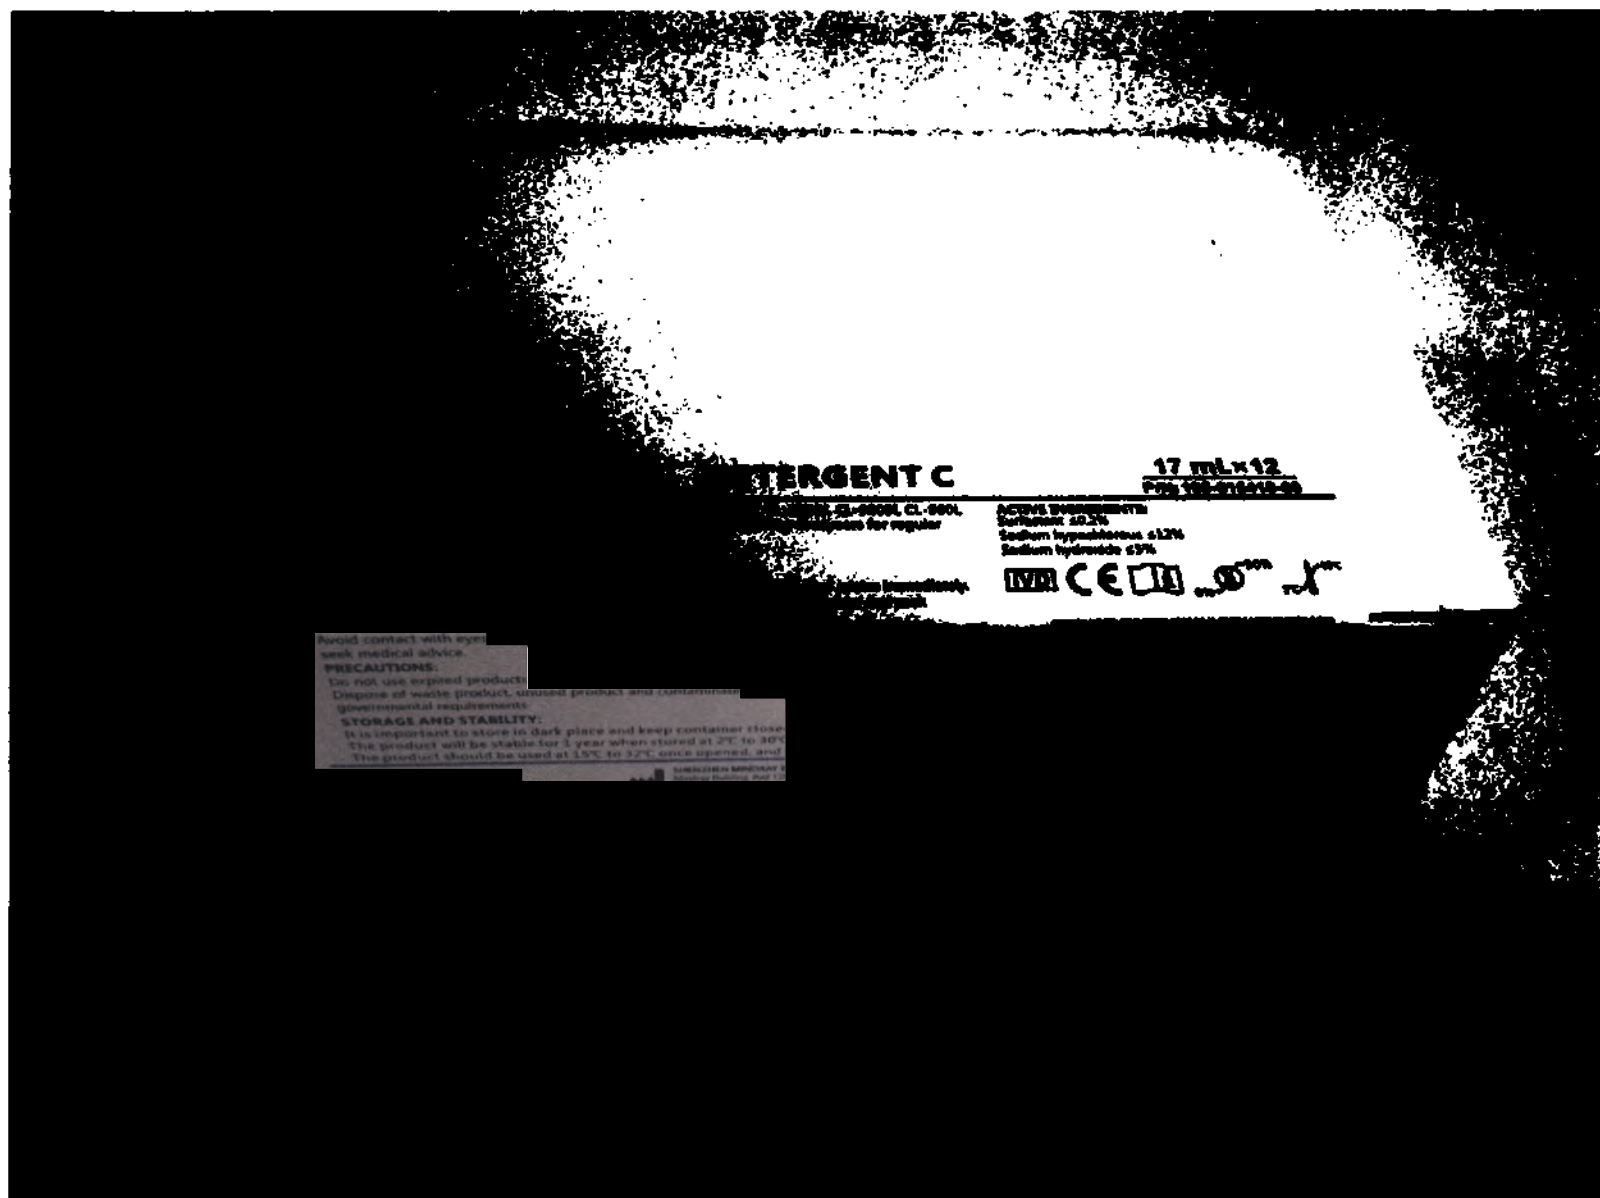


Рис.3 Маркировка наносимая на картонную транспортную упаковку изделия Детергент С

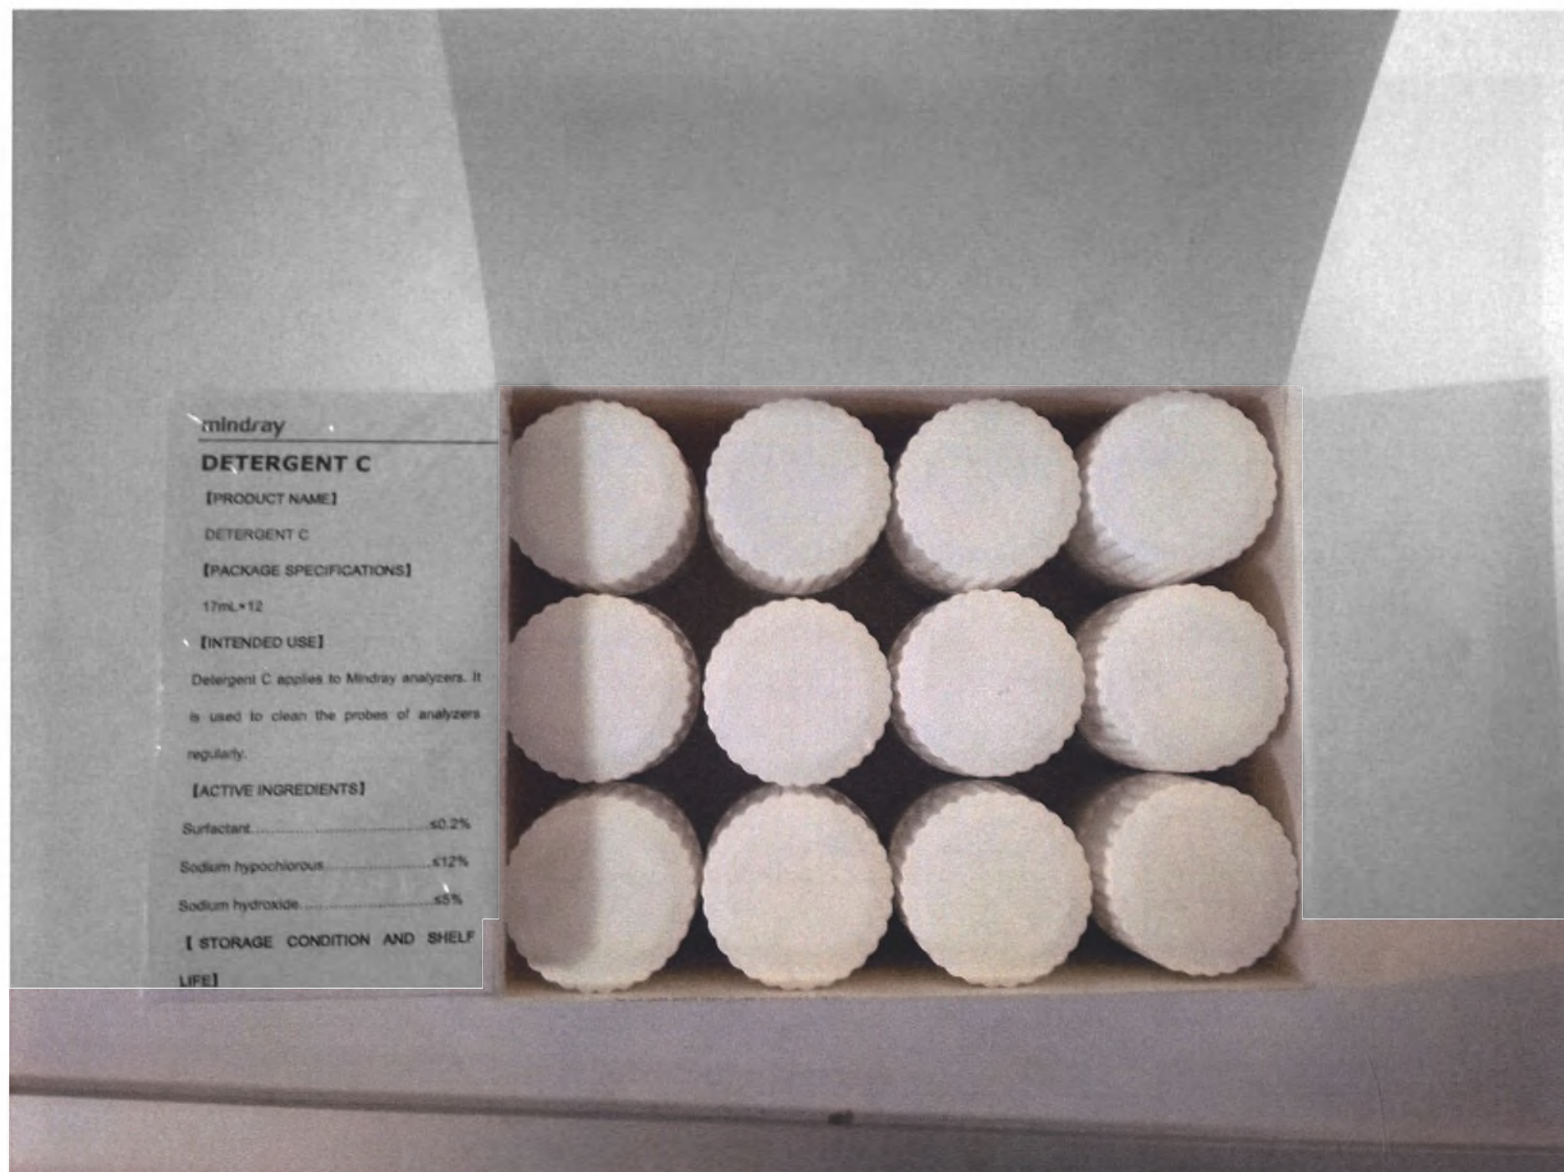


Рис.4 Комплектация изделия Детергент С

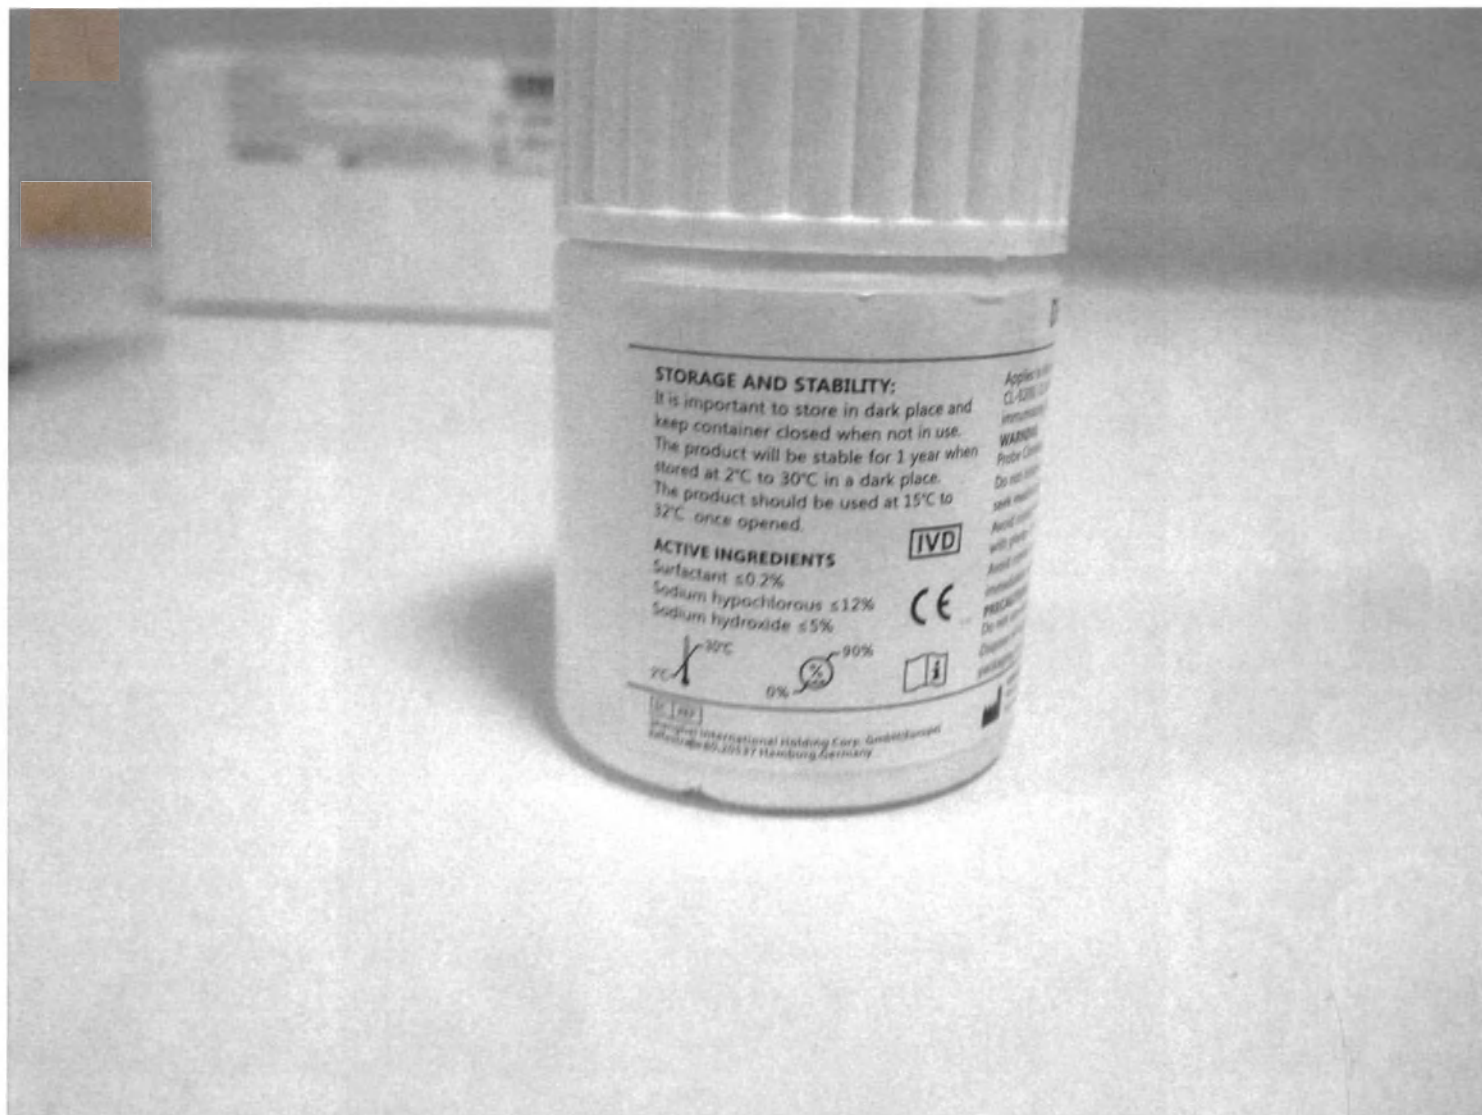


Рис.5 Маркировка флакона изделия Детергент С

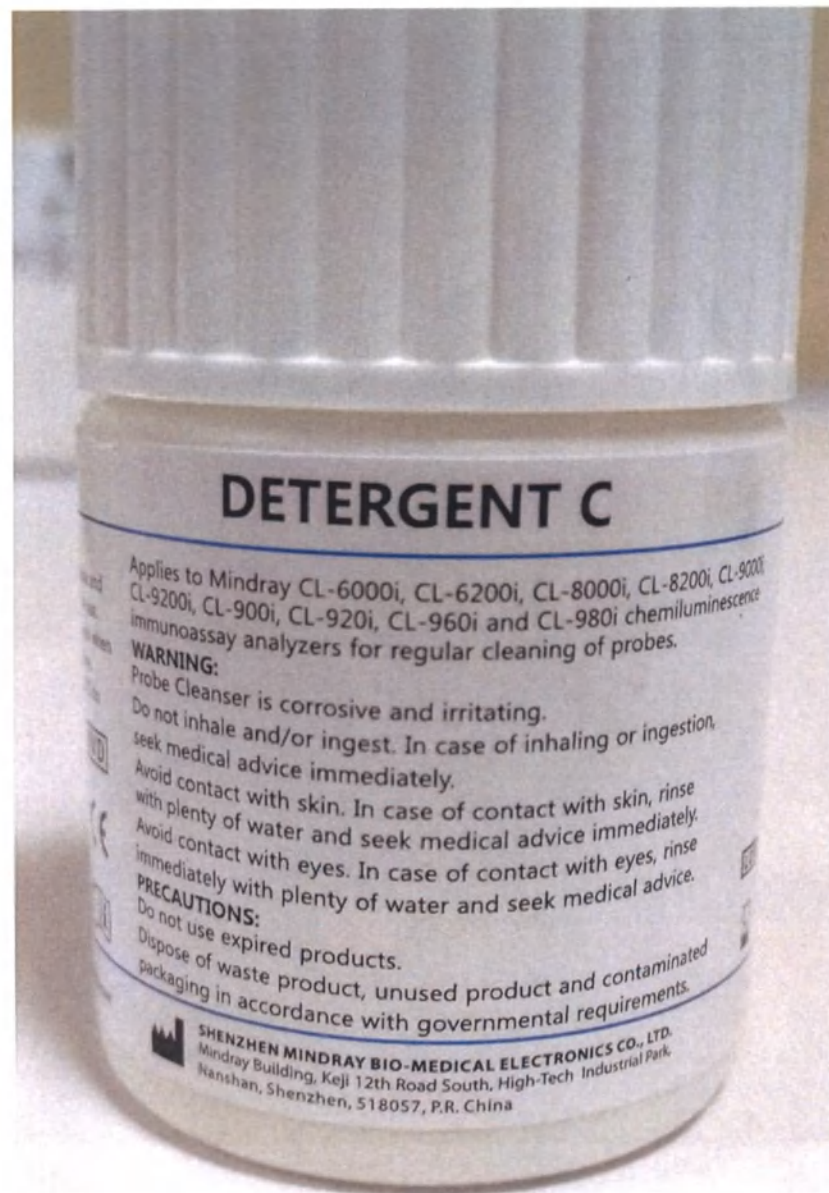


Рис.6 Маркировка флакона изделия Детергент С

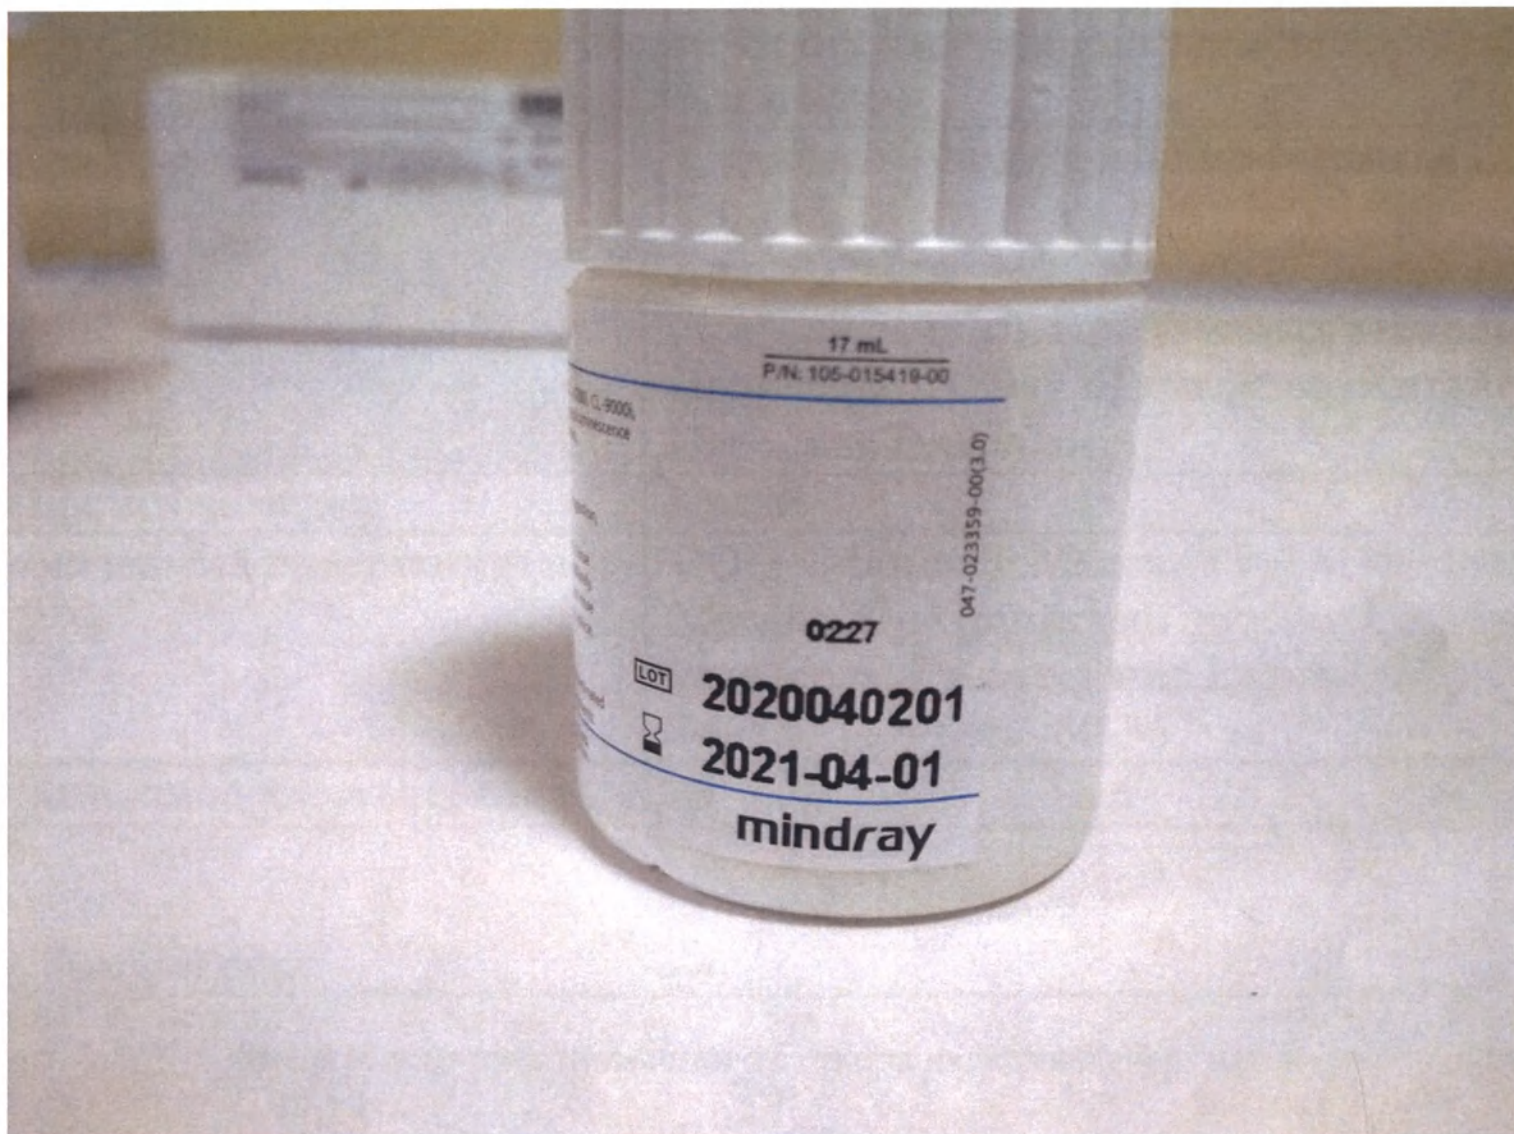


Рис.7 Маркировка флакона изделия Детергент С

Детергент С (Detergent C) для автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторов серии CL для диагностики <i>in vitro</i>	
Производитель	Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко. Лтд. Здание "Миндрей", Кеджи 12 Роуд Саут, Промышленный парк высоких технологий, Наньшань, 518057 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Страна происхождения:	Китай
Уполномоченный представитель в РФ:	ООО «Миндрей Медикал Рус», Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, антресоль 4, помещение I, ком.7, 11А Тел. +7 (499) 553-60-36
Регистрационное удостоверение	№ _____ от _____
 Апирогенно	

Рис.8 Макет русскоязычного стикера изделия Детергент С

