



Фотографические изображения
медицинского изделия

Контрольные растворы глюкозы и кетонов MediSense


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения
средств диагностики диабета
ООО «Эбботт Лэбораториз»

« 19 » ноября 2020 г.



Тямаева Л.А.

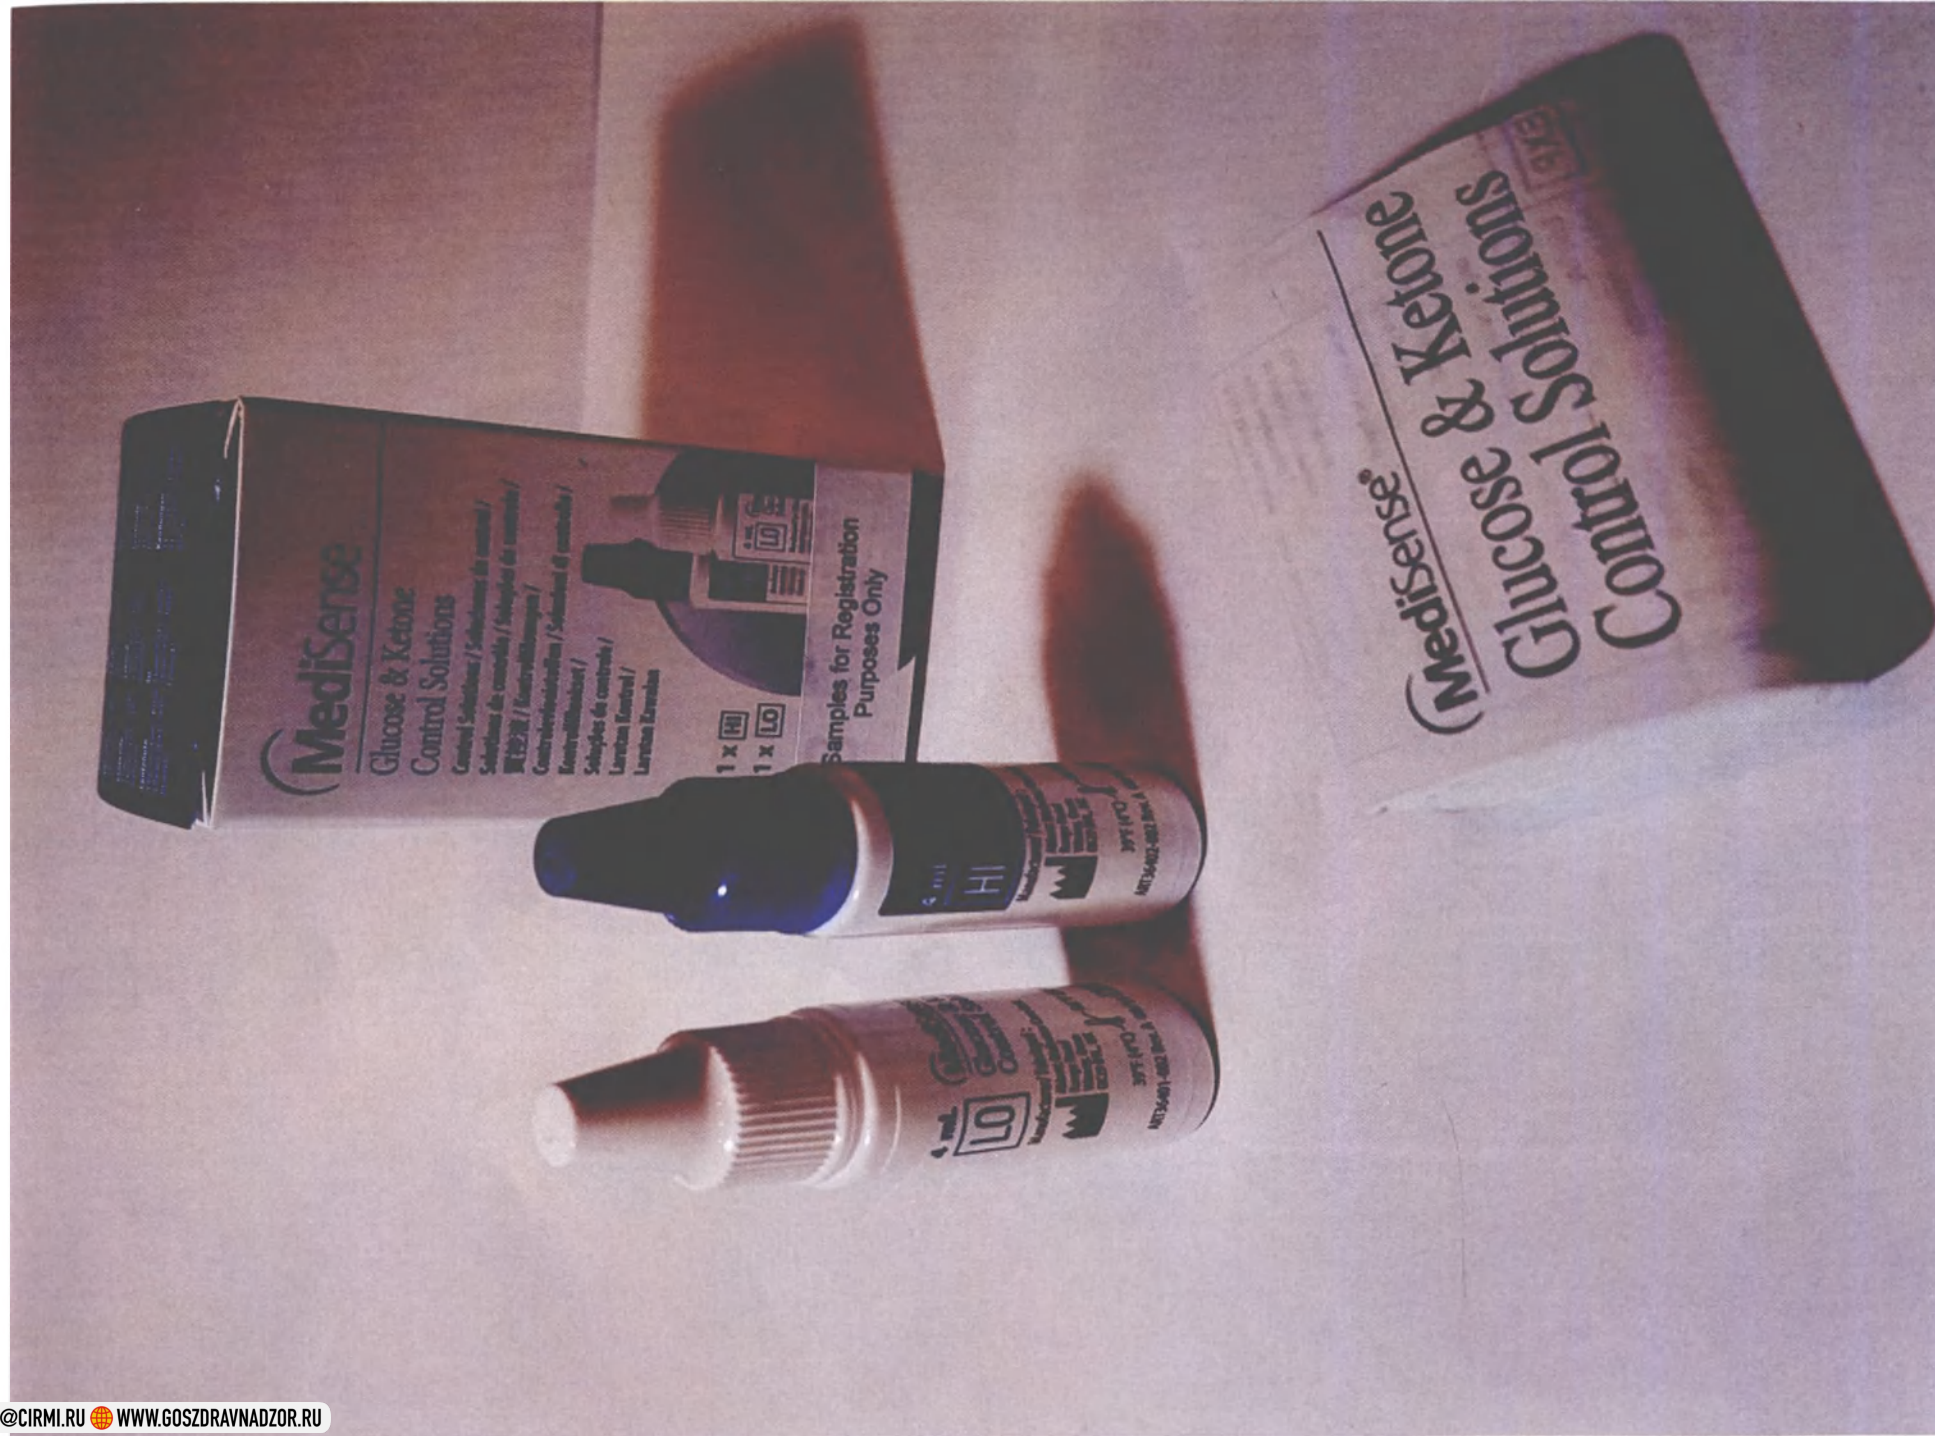




2. 1 флакон (4 мл) – высокой концентрации



2. 1 флакон (4 мл) — высокой концентрации

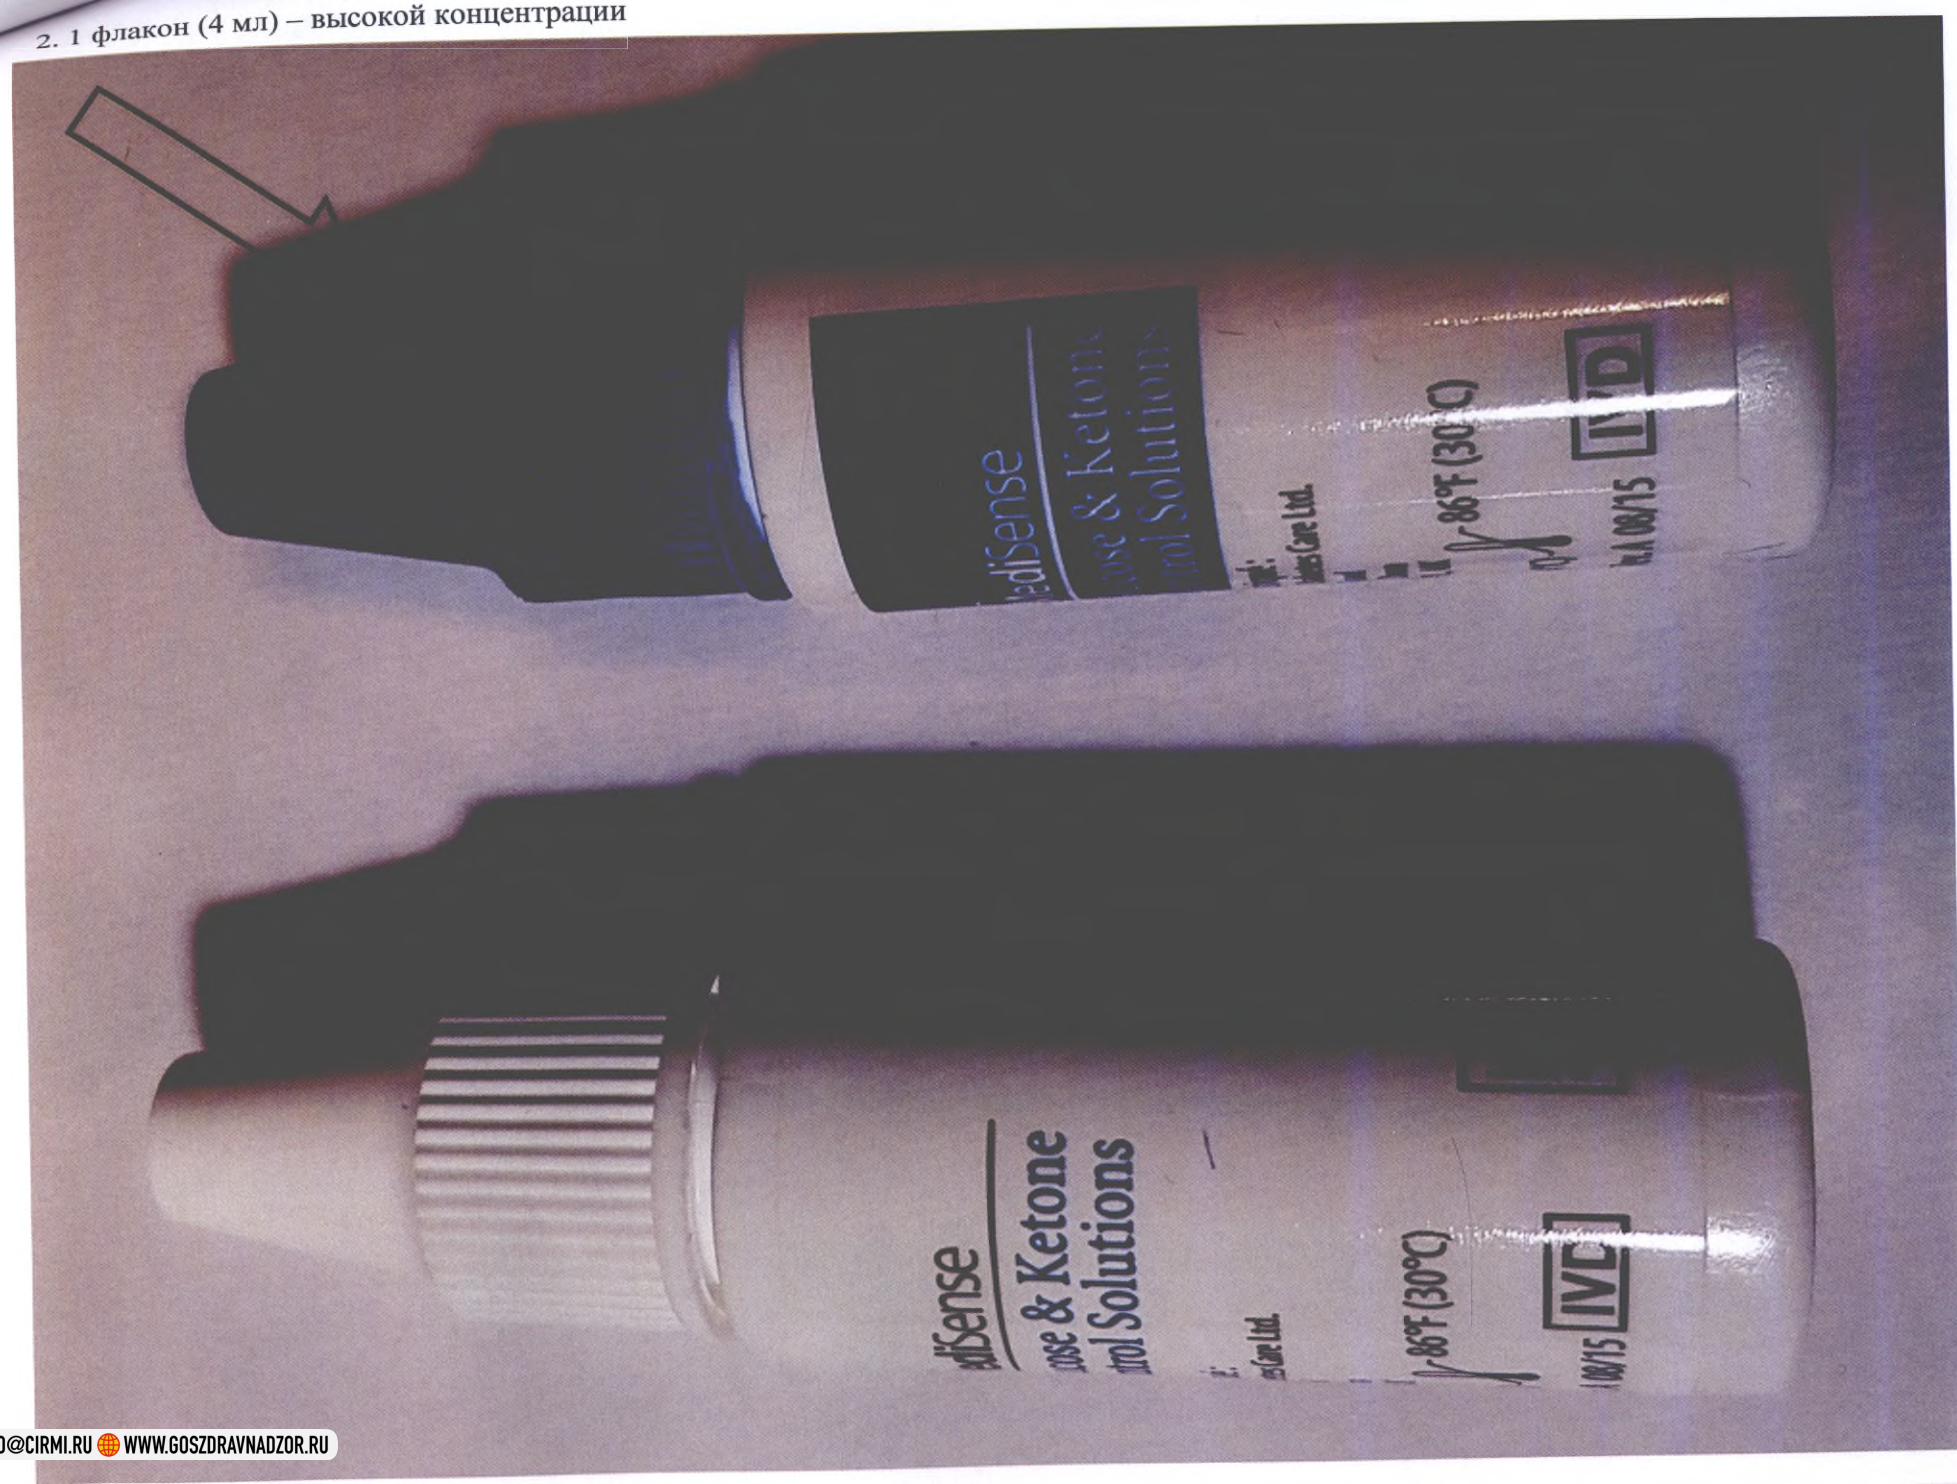


MediSense®

Glucose & Ketone
Control Solutions



هیدرې سینس

The shape of the circle sensor unit, FaceScan, Cam, and related brand marks are owned by Abbott. © 2010-2012 Abbott Products of USA | Register CMA PPD-OCI 2016/07/14 from 12.28.CBE

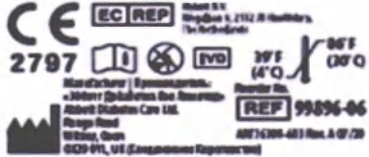[illegible][illegible]

MediSense هيدې سينس

Glucose & Ketone /
Глюкозы и кетонов
Control Solutions

**Control Solutions / Kontrol Solüsyonları /
Kontrollösungen / KONTROLLÖSUNG
معالجات التحكم / Solutions de contrôle /
Kontroln / rezepte /
Kontrollplanungen /
Kontrollösungen /
Kontrollsysteme**



1 x HI
1 x LO



0 699073 998965

Section 1: Personal Information Name: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____			
Section 2: Academic Information School Name: _____ Grade: _____ Teacher's Name: _____	Section 3: Parent/Guardian Information Parent/Guardian Name: _____ Relationship: _____ Signature: _____ Date: _____	Section 4: Student Information Student Name: _____ Student ID: _____ Signature: _____ Date: _____	Section 5: School Information School Name: _____ Principal's Name: _____ Principal's Signature: _____ Date: _____

Content

1 bottle (4 mL) - Low
1 bottle (4 mL) - High

Instructions

Zawartość

1 butelka (4 mL) - mała
1 butelka (4 mL) - duża

Instrukcja

Innhold

1 flaske (4 mL) - Lav
1 flaske (4 mL) - Høi

Instruktion

Içerigi

1 şişe (4 mL) - Düşük
1 şişe (4 mL) - Yüksek

Talimatlar

المحتوى

1 عبوة (4 مل) - منخفض
1 عبوة (4 مل) - مرتفع

الارشادات

Innhold

1 flaske (4 mL) - lav
1 flaske (4 mL) - høi

Instruktioner

Содержимое

1 флакон (4 мл) -
низкой концентрации
1 флакон (4 мл) -

высокой концентрации

Инструкция по

применению

Contenu

1 flacon (4 mL) - Bas
1 flacon (4 mL) - Haut

Instructions

Saturs

1 pudele (4 mL) - zemas
koncentracijas

1 pudele (4 mL) - augstas
koncentracijas

koncentracijas

Instrukcija

Obsah

1 lahvička (4 mL) - nízká
koncentrace

1 lahvička (4 mL) -

vysoká koncentrace

Pokyny



MediSense

میدی سینس

Not for use with/ Şununla kullanım için değildir/ Не для использования с/ Nie stosować z/ Ne pas utiliser avec/ Nepoužívejte s/ Ikke til brug med/ Ikke til bruk med/ Nav paredzēts lietošanai ar: **Optium Mini, Optium Omega**

لا تصلح للاستخدام مع: أوبتيوم ميني، أوبتيوم أوميغا

The shape of the circle sensor unit, FreeStyle, Libre, and related brand marks are owned by Abbott. ©2009-2020 Abbott Product of USA | Продукт США
РУ № ФСЗ 2010/07543 from XX.XX.XXXX

CE
2797

EC REP

Abbott B.V.
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands



IVD

39°F
(4°C)

86°F
(30°C)

Manufacturer | Производитель:
«Эбботт Дайабитиз Кэе Лимитед»

Abbott Diabetes Care Ltd.

Range Road
Witney, Oxon

OX29 0YL, UK (Соединенное Королевство)

Reorder No.

REF 99896-06

ART36399-603 Rev. A 07/20

For consumer home testing and healthcare professional use with (where available)/ Şu ürünlerle, tüketicilerin evde test yapmaları ve sağlık uzmanlarının kullanımı içindir (geçerli olan durumlarda)/ Для использования пациентами на дому или медицинскими работниками с (при наличии в продаже)/ Do samodzielnego wykonywania pomiarów i stosowania przez personel medyczny z (w krajach, w których jest dostępny)/ Pour les utilisateurs réalisant des tests à domicile et une utilisation par des professionnels de santé avec (si disponible)/ Pro domácí testování zákazníky a pro použití lékaři nebo zdravotními sestrami s (kde jsou dostupné)/ Til hjemmemåling for forbrugere og anvendelse blandt sundhedspersonale med (hvis til stede)/ Til egenmåling hjemme hos forbruker og til profesjonell bruk av helsepersonell sammen med (hvor tilgjengelig)/ Klientiem pārbaudes veikšanai mājās un veselības aprūpes speciālistiem izmantošanai ar (kur pieejams): **FreeStyle Libre 2, FreeStyle Libre, FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Optium Neo H, FreeStyle Precision Neo, FreeStyle Precision Neo H, FreeStyle Precision Pro, Precision Xceed Pro and all other/ ve tüm diğer/ и всеми другими/ i wszystkie inne/ et tous les autres/ a všemi ostatními/ og alle andre/ og alle andre/ un visām citām, Precision, Optium Blood Glucose and β -Ketone Monitoring Systems/ Kan Glukozu ve β -Keton İzleme Sistemleri/ системами контроля уровня глюкозы и β -кетонов в крови/ Systemy monitorowania stężenia glukozy i ciał ketonowych we krwi/ systèmes de surveillance de la glycémie et de la cétonémie/ systémy pro monitorování glykémie a β -ketonémie/ Målesystemer til blodsukker og β -keton/ Målesystemer for blodsukker og β -keton/ asins glikozes un β -ketonu līmeņa novērošanas sistēmām.**

للاختبار المنزلي للمستهلك ولاستخدام مختص الرعاية الصحية مع (حسب المتوفر): فري ستايل ليبري ٢، فري ستايل ليبري، فري ستايل أوبتيوم نيو، فري ستايل أوبتيوم نيو اتش، فري ستايل بريسيجن نيو، فري ستايل بريسيجن نيو اتش، فري ستايل بريسيجن برو، بريسيجن إكسيد برو وجميع أنظمة بريسيجن وأوبتيوم الأخرى لمراقبة جلوكوز الدم وبيتا كيتون.

MediSense ميدي سينس

Glucose & Ketone /
ГЛЮКОЗЫ И КЕТОНОВ
Control Solutions

Control Solutions / Kontrol Solüsyonları /
Контрольные растворы / Roztwory kontrolne /
محاليل التحكم / Solutions de contrôle /
Kontrolni roztoky /
Kontrolløsninger /
Kontrolløsninger /
Kontrolšķidumi

1 x **HI**

1 x **LO**

ABBOTT



0 699073 998965

**Distributed by/ Dağıtım / Дистрибьютор/ Dystrybuja/ يوزع من قبل/ Distribué par/ Distributor/ Forhandlet af / Distribuer
av / Izplatitājs:**

ООО «Диамедика»
Индекс 220100
Республика Беларусь
г. Минск
ул. Богдановича, д. 70

Abbott A/S
Abbott Diabetes Care
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø
Denmark

Abbott Laboratories, s.r.o.
Abbott Diabetes Care
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6
Česká republika

Abbott Laboratories
Poland Sp. z o.o.
Abbott Diabetes Care
ul. Postępu 21 b
02-676 Warszawa, Polska

Уполномоченный
представитель/
импортер в РФ:
ООО "Эбботт
Лабораториз"
Abbott Diabetes Care
125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 16 А, стр. 1
тел. 8-800-100-88-07

FreeStyle Distributor:
Abbott Diabetes Care
Mediserv
P.O. Box 40758
Riyadh 11511
Saudi Arabia

Abbott Laboratuvarları İthalat
İhracat ve Tic. Ltd. Şti.
Saray Mah. Dr. Adnan
Büyükdere Cad.
No: 2 Akkom Ofis Park Kelf
Plaza 3. Blok Kat: 12-20
34768 Ümraniye—İstanbul
Türkiye

PharmaWorld LLC
Entrance-3, 1st floor,
Office-5
Bellhoul Building,
P.O. Box-5527
Garhoud, Dubai,
United Arab Emirates

VD Mais
Отдел медицинской
техники
ул. М. Донца, 6
03061 Киев



میدی سینس

4 mL

LO

MediSense

Glucose & Ketone
Control Solutions



Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

39°F (4°C) 86°F (30°C)

ART36401-001 Rev. A 09/15

IVD

DATE

LOT

EXP

میدی سینس

4 mL

HI

MediSense

Glucose & Ketone
Control Solutions

 Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

39°F (4°C)  86°F (30°C)

ART36402-001 Rev. A 09/15

IVD

DATE

LOT

EXP

