

«Утверждаю»
Генеральный директор
ЗАО «ИМПЛАНТА»



Еременко И.В.
м.п.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система для неинвазивного исследования центральной гемодинамики методом
биоимпедансометрии NICaS CS с принадлежностями**

производства

**НЬЮ ЭН. АЙ. МЕДИКАЛ (2011) Лтд./ NEW N. I. MEDICAL (2011) Ltd.
14 Imbar Street, Petah Tikva, 4951148 Israel (Израиль)**

**2020
г. Москва**

Прибор NICaS CS (вид сверху)

NImedical

NICaS CS

**BIOIMPEDANCE CARDIAC MEASURING
and ANALYZING SYSTEM**



Илпдоp NICA CS (BИЛ COOKY)

Принадлежности

1. Кабель с отведениями для проведения ИКГ (NICaS CS ICG Cable) – не более 10 шт.;



2. Кабель с отведениями для проведения ИКГ с электродами со встроенным штекером (NICaS CS ICG Cable for Prewired sensors) – не более 10 шт.;



3. Кабель с отведениями для проведения ЭКГ (NICaS CS ECG Cable) – не более 10 шт.;



4. Кабель с отведениями для проведения ЭКГ с электродами со встроенным штекером (NICaS CS ECG Cable for Prewired sensors) – не более 10 шт.;




5. Кабель-USB (USB cable) – не более 10 шт.;



6. Набор одноразовых электродов для проведения ИКГ по 100 штук (NICaS Sensors) – не более 1000 упаковок;



Одноразовый электрод для проведения ИКГ (NICaS Sensors)

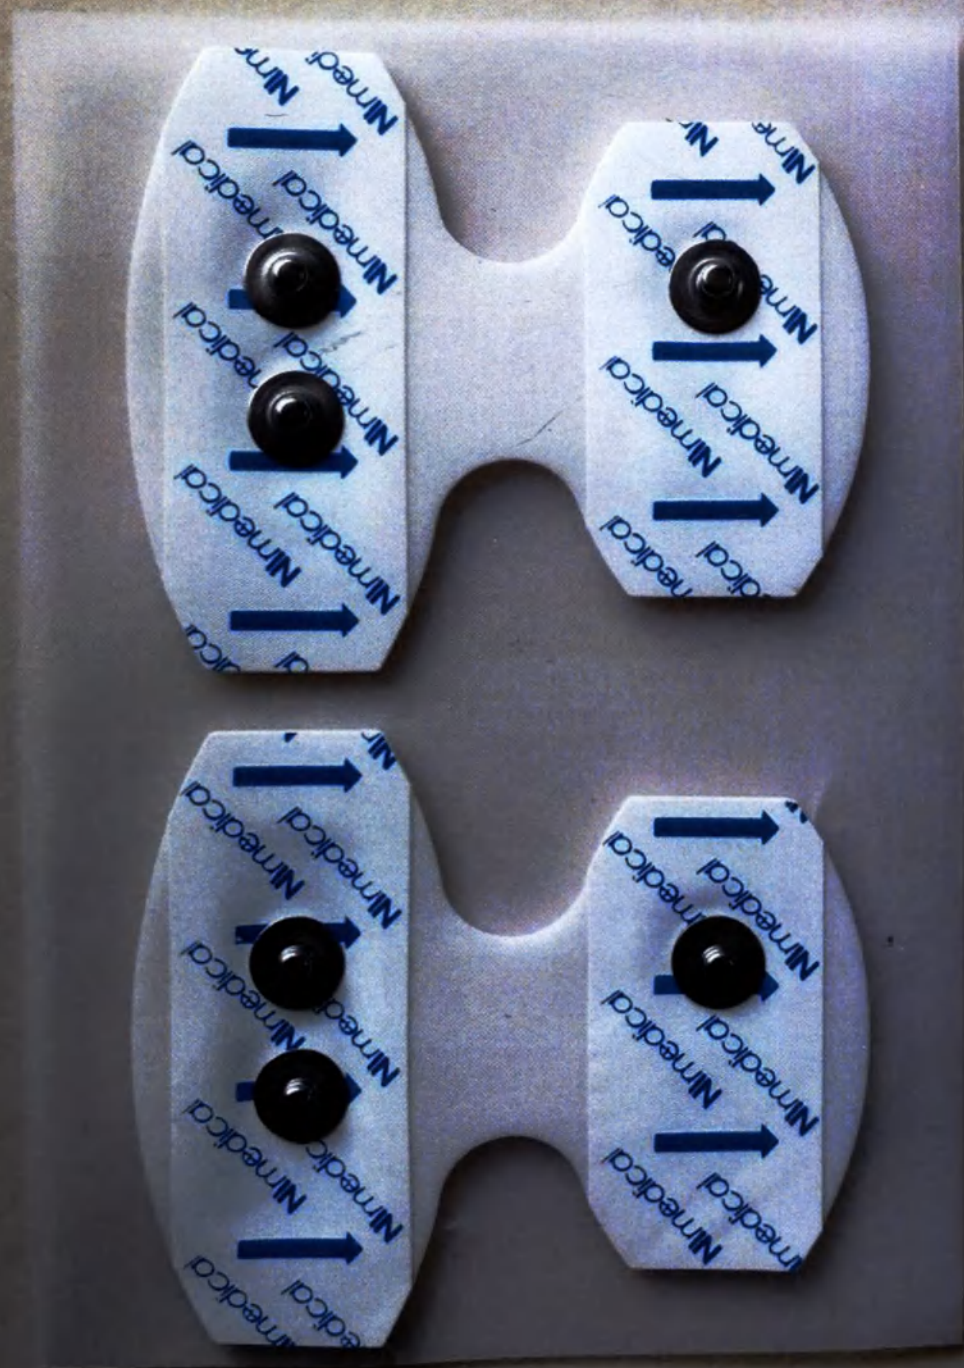

7. Набор одноразовых электродов со встроенным штекером для проведения ИКГ по 100 штук (NICaS Prewired Sensors) – не более 1000 упаковок;



Одноразовый электрод со встроенным штекером для проведения ИКГ (NICaS Prewired Sensors)



8. Зажим для фиксации на штативе (при необходимости)

9. Слот подключения прибора NICA S CS (при необходимости);

На фото: Слот подключения прибора NICA S CS закреплен на Зажиме для фиксации на штативе



10. Переносная сумка (при необходимости).



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Закрытое акционерное общество «ИМПЛАНТА»

 Генеральный директор
Еременко И.В.

