



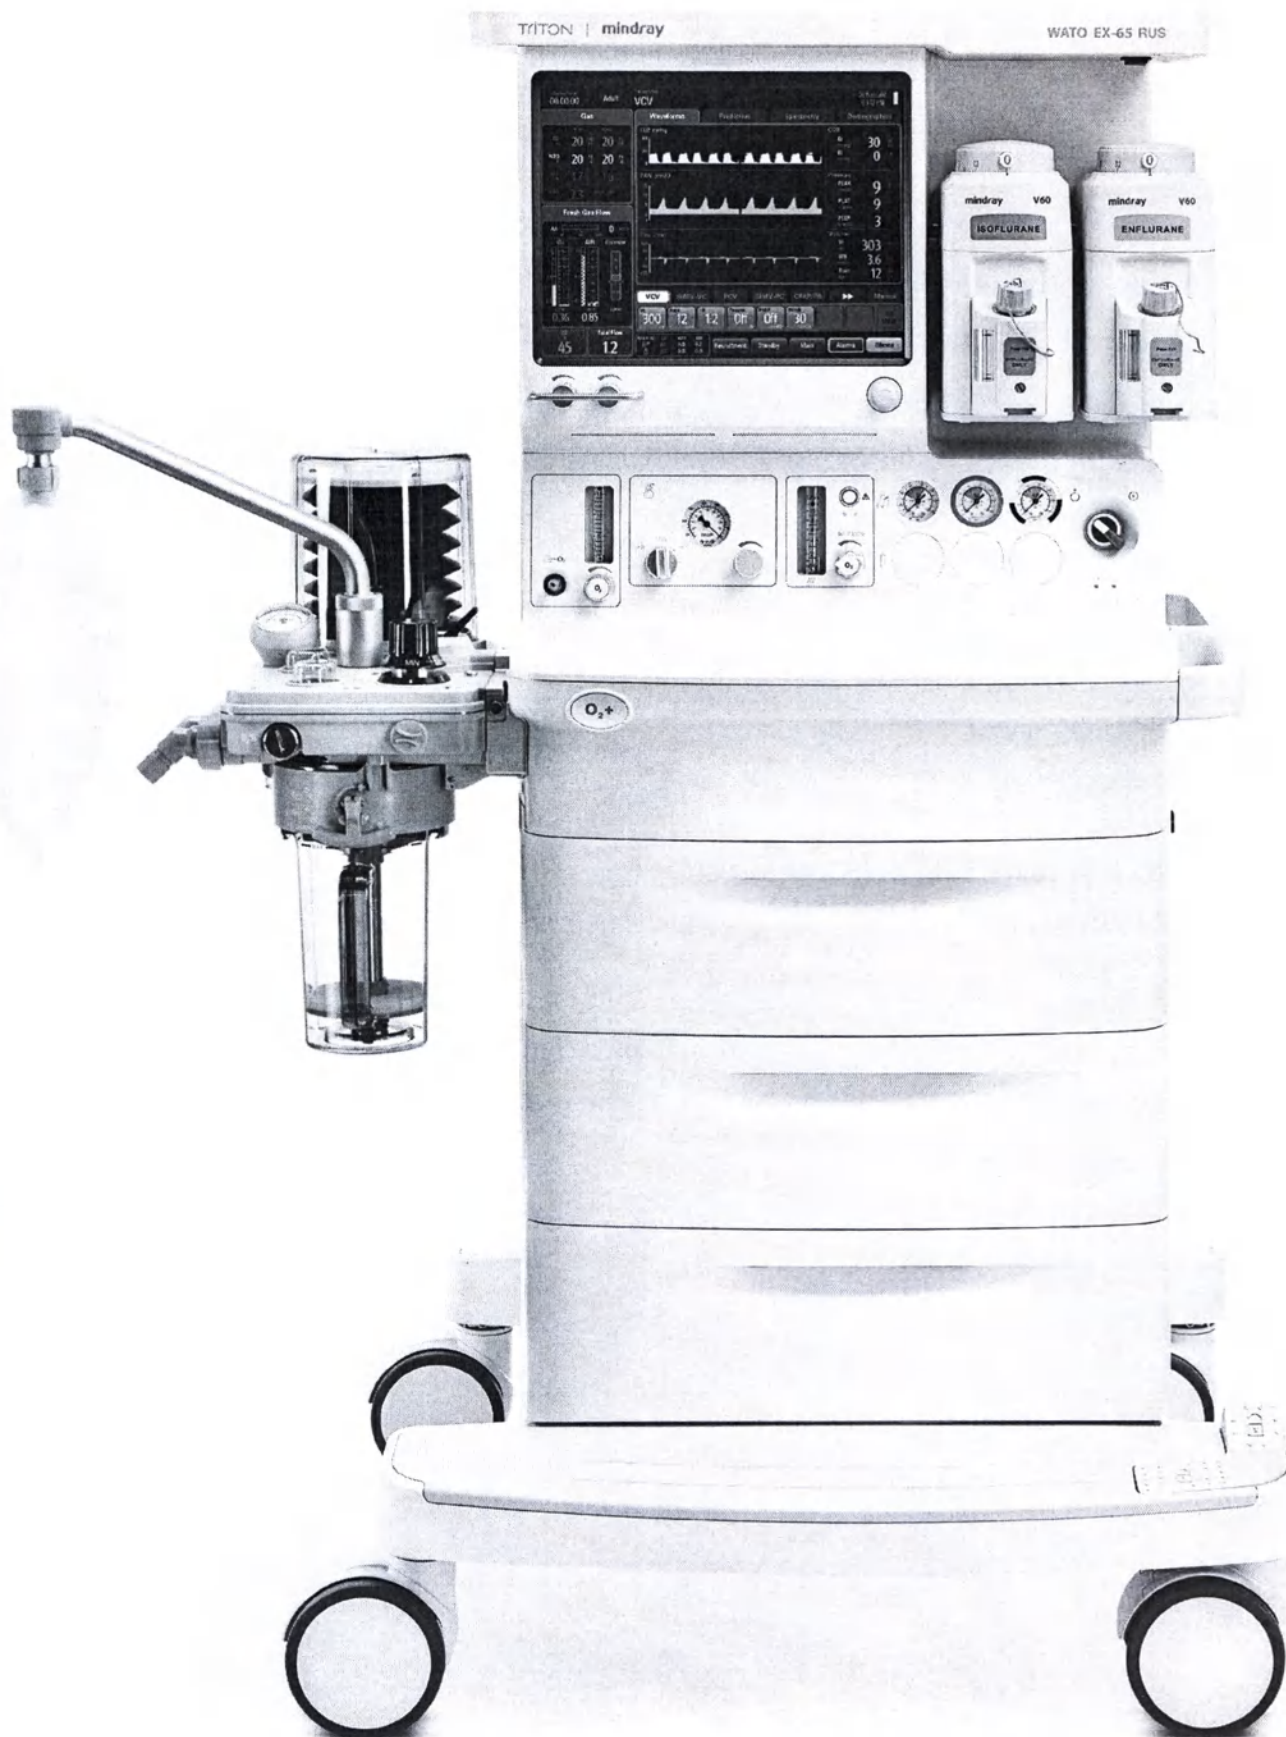

1. Блок основной ТЭСМ.943119.012-02,
пр-ва ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

91568
17.11.2020

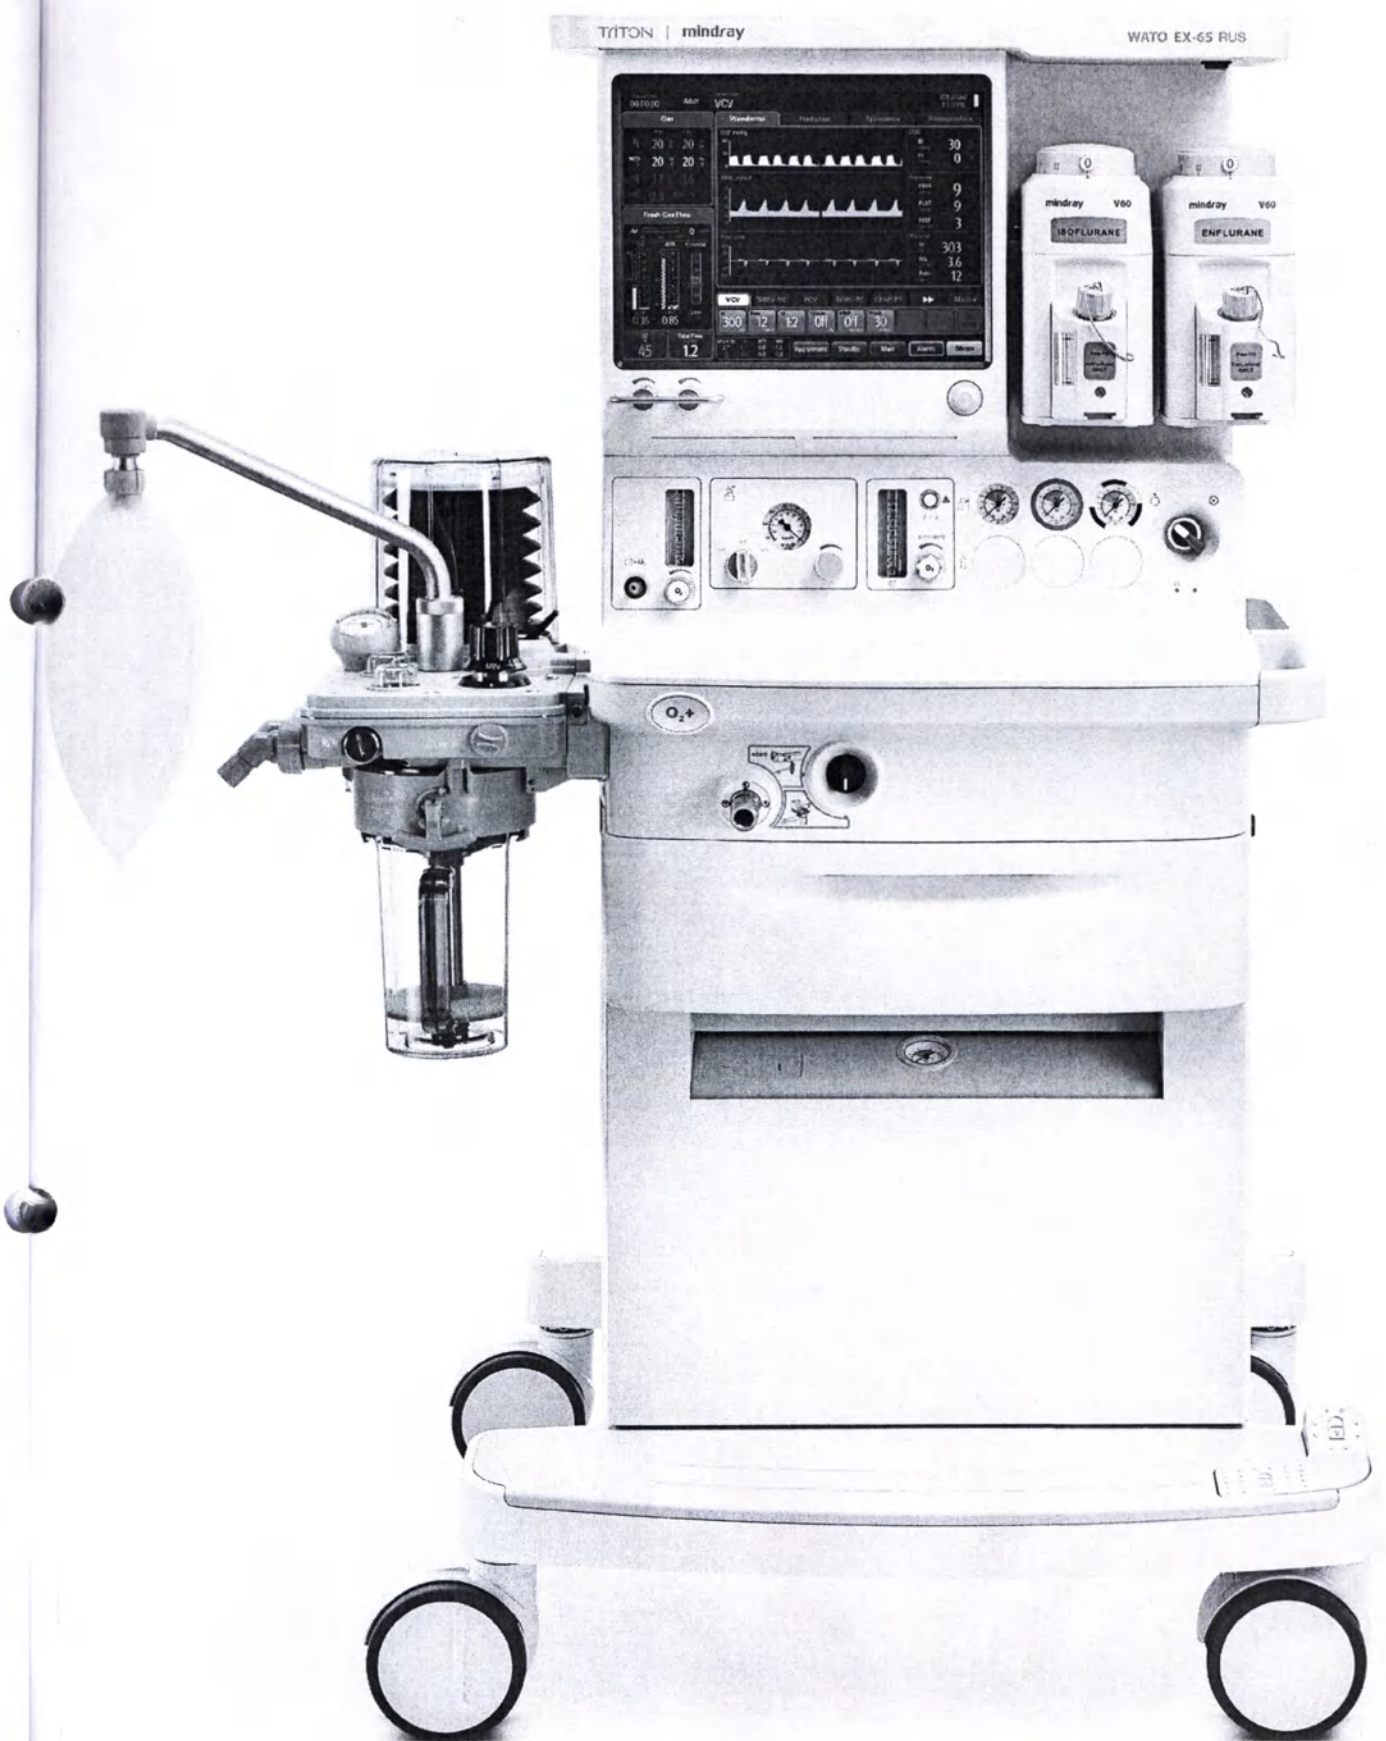

. Блок основной со встроенным компрессором
ЭСМ.943119.012-04,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

р-ва ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия

91568
17.11.2020




2. Шланги для газов: кислорода, закиси азота, воздуха,




3. Испаритель анестетика Десфлюран M35500 D-Vapor 2000, в составе:



Испаритель анестетика Десфлюран Tec 6 Plus,
 пр-ва GE Healthcare, США.

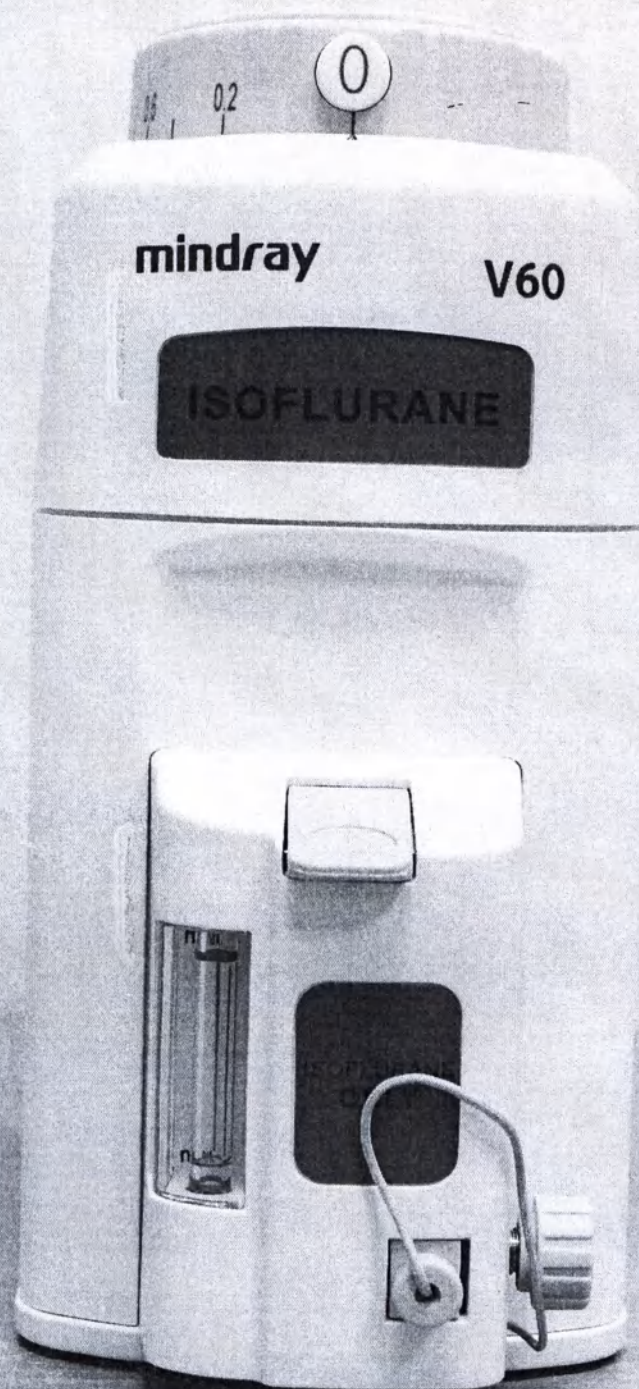

5. Испаритель анестетика Изофлюран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

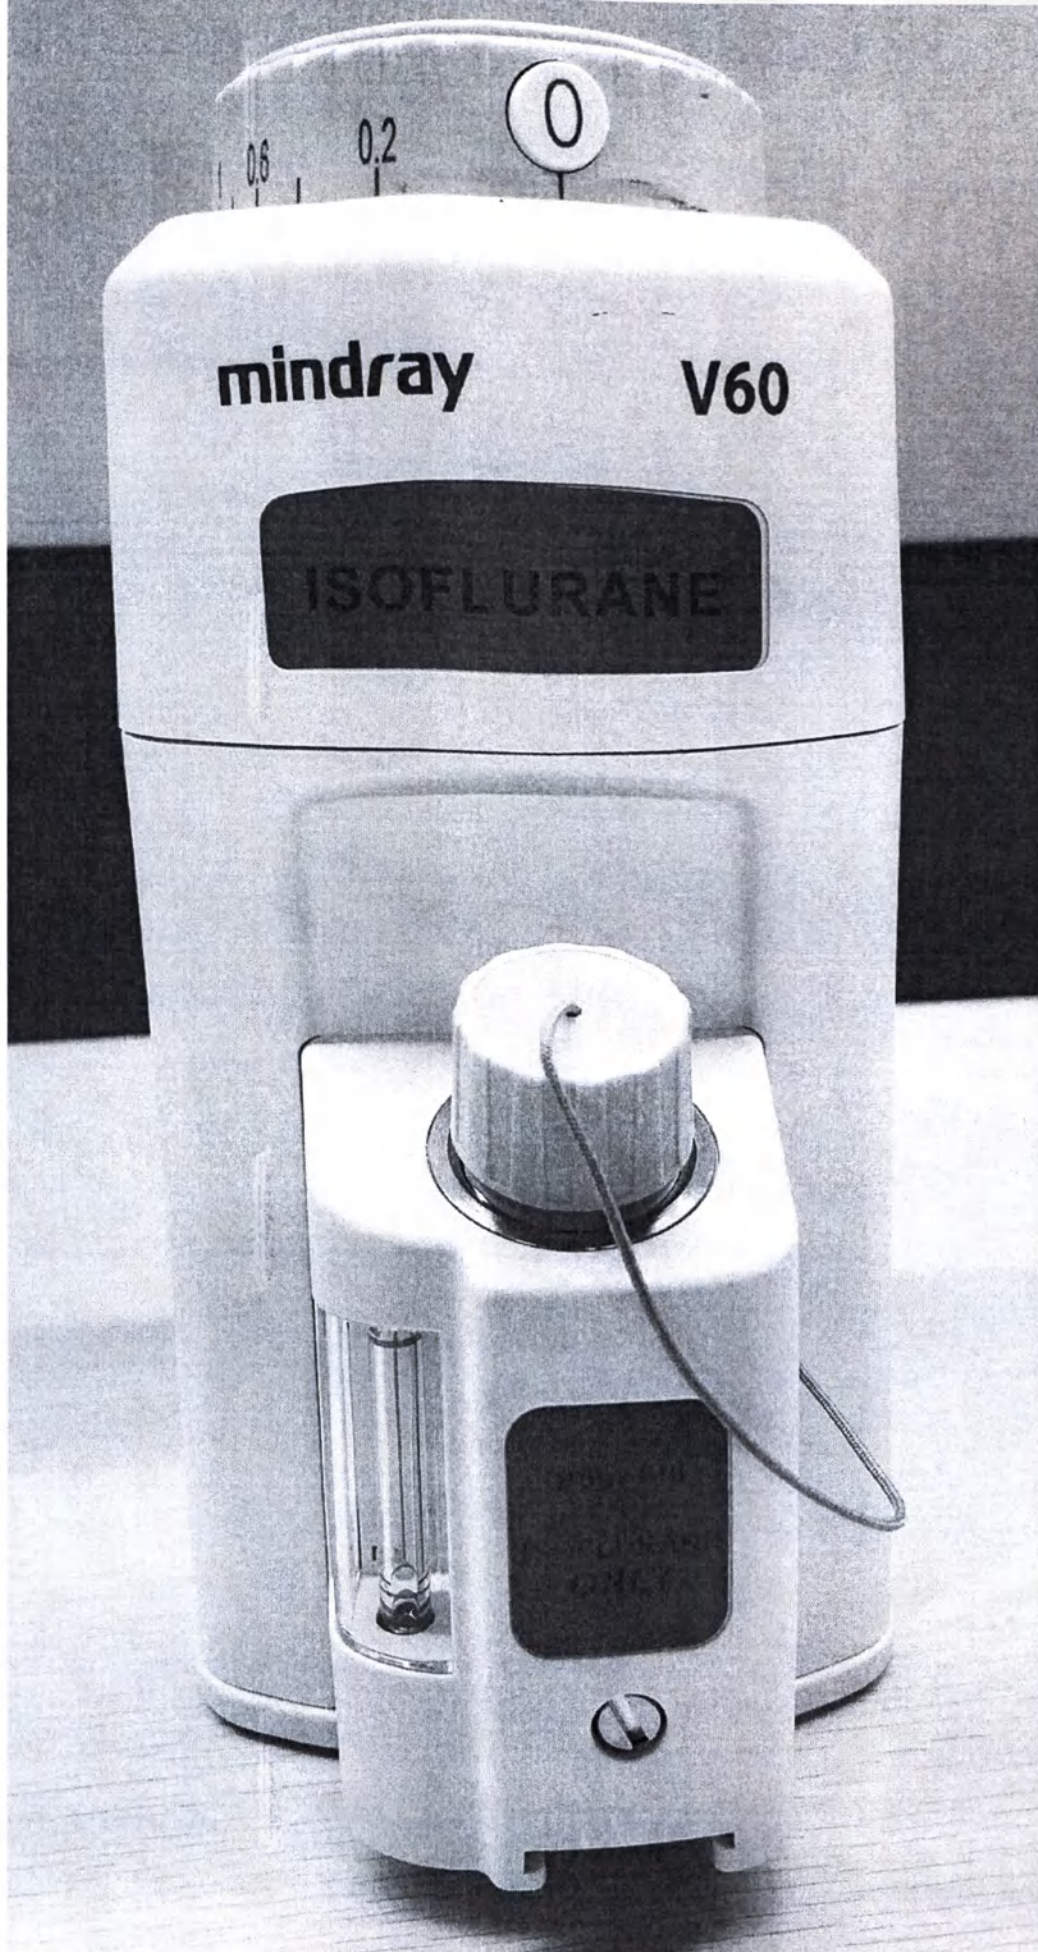

6. Испаритель анестетика Изофлюран V60 (Pour-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics



7. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical




8. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Pour-Fill),
пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,
Китай.



9. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Quick-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




10. Испаритель анестетика Галотан V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fil,
г-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

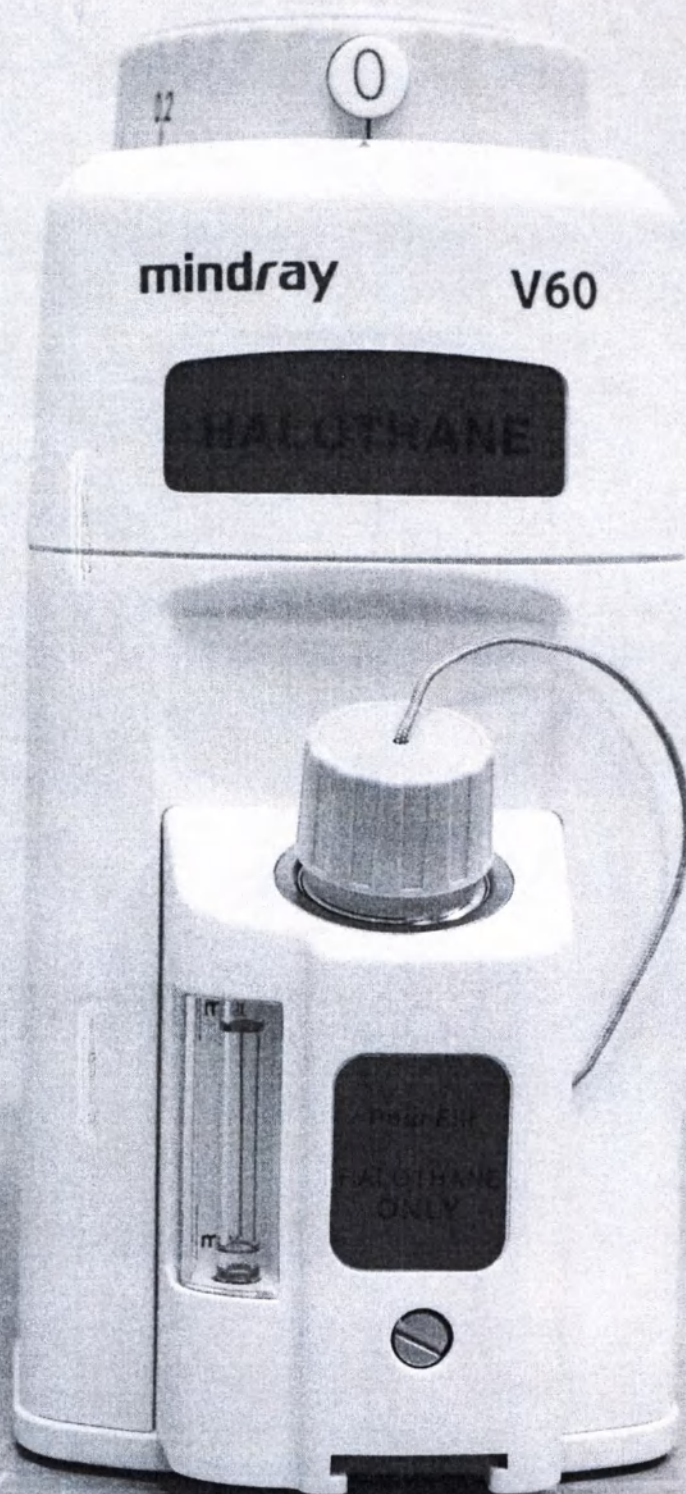

11. Испаритель анестетика Галотан V60 (Pour-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




2. Испаритель анестетика Энфлуран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, р-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

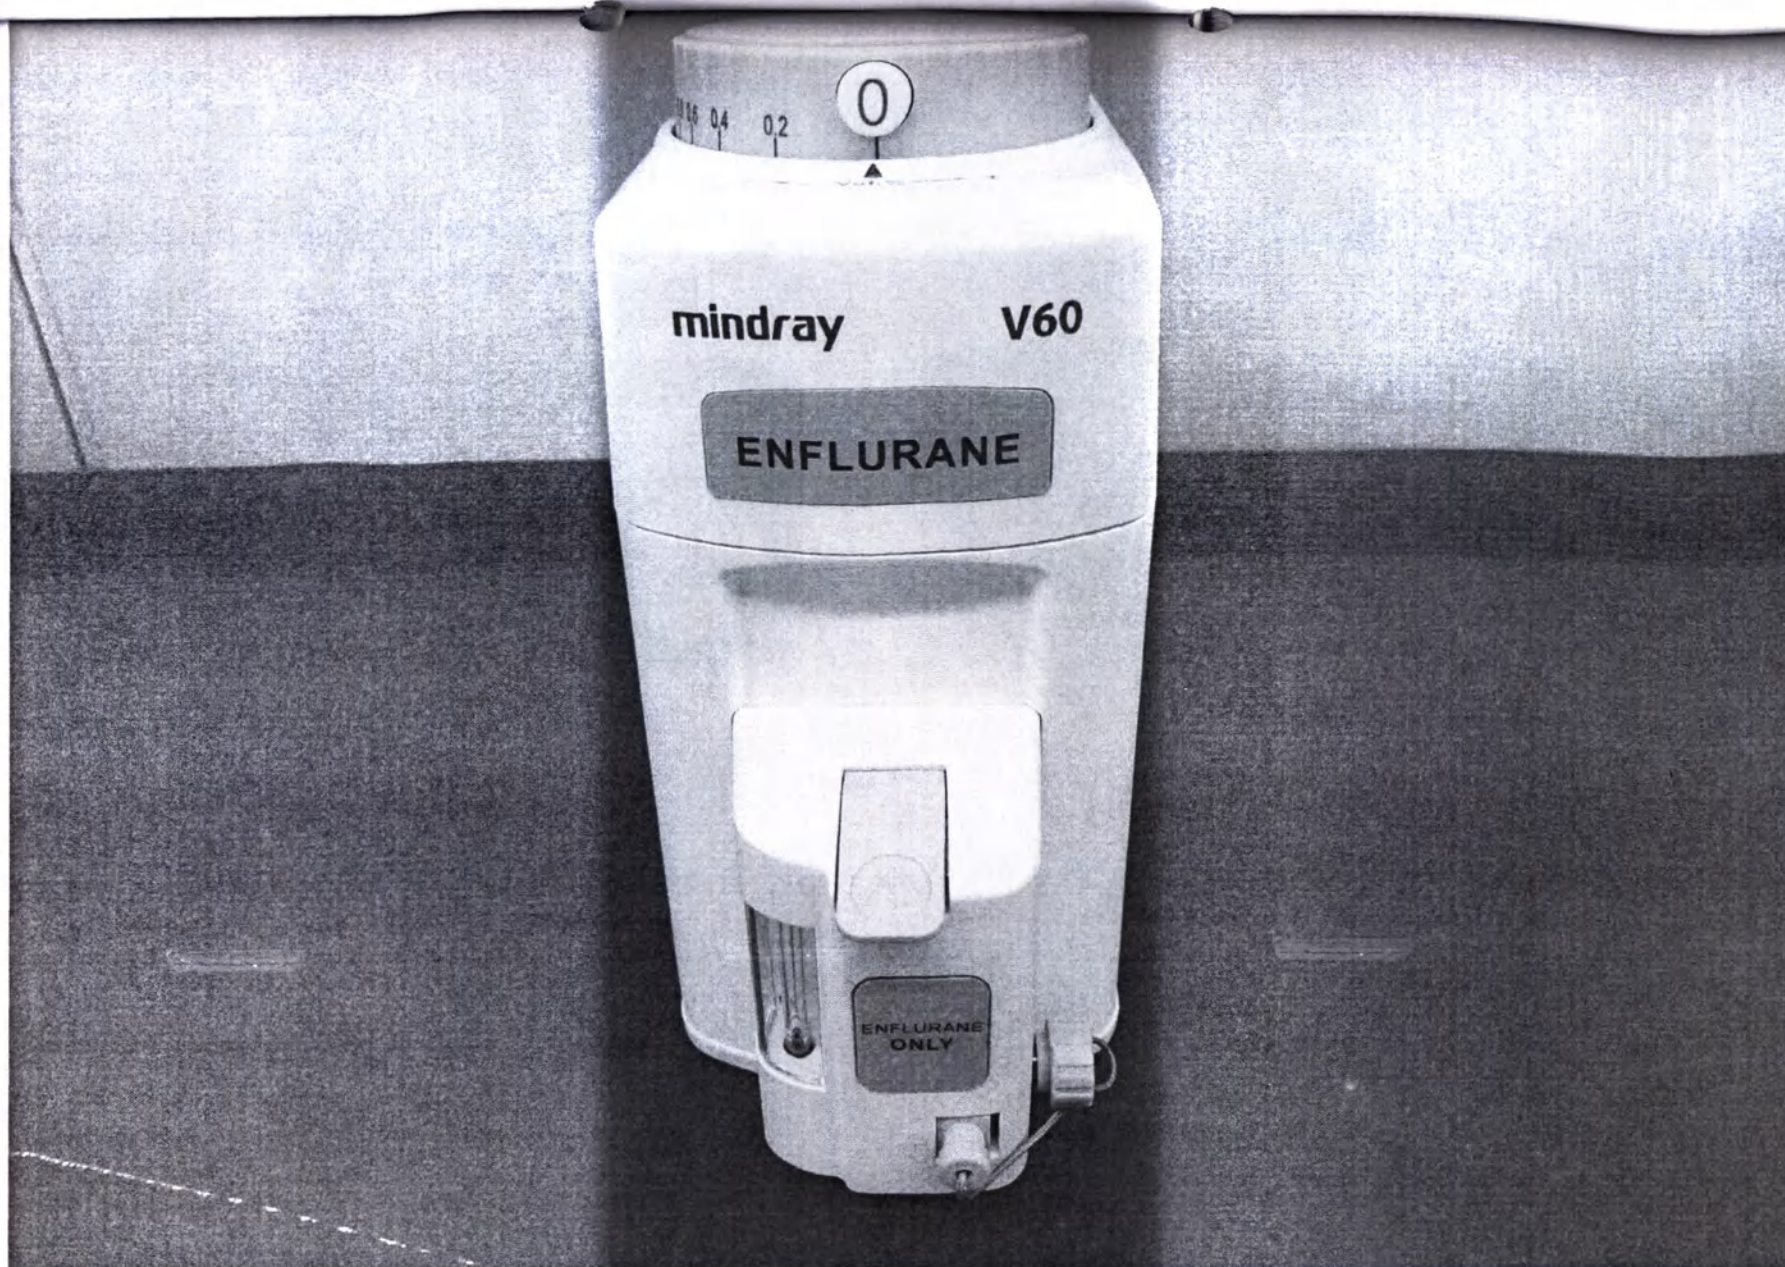

13. Испаритель анестетика Энфлуран V60 (Pour-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай¹⁵⁶⁸




14. Испаритель анестетиков Sigma Delta с принадлежностями (виды 282600, 299670, 215300, 168200) DV № ФСЗ 2011/10743, пр-ва Penlon Ltd., Соединенное Королевство.

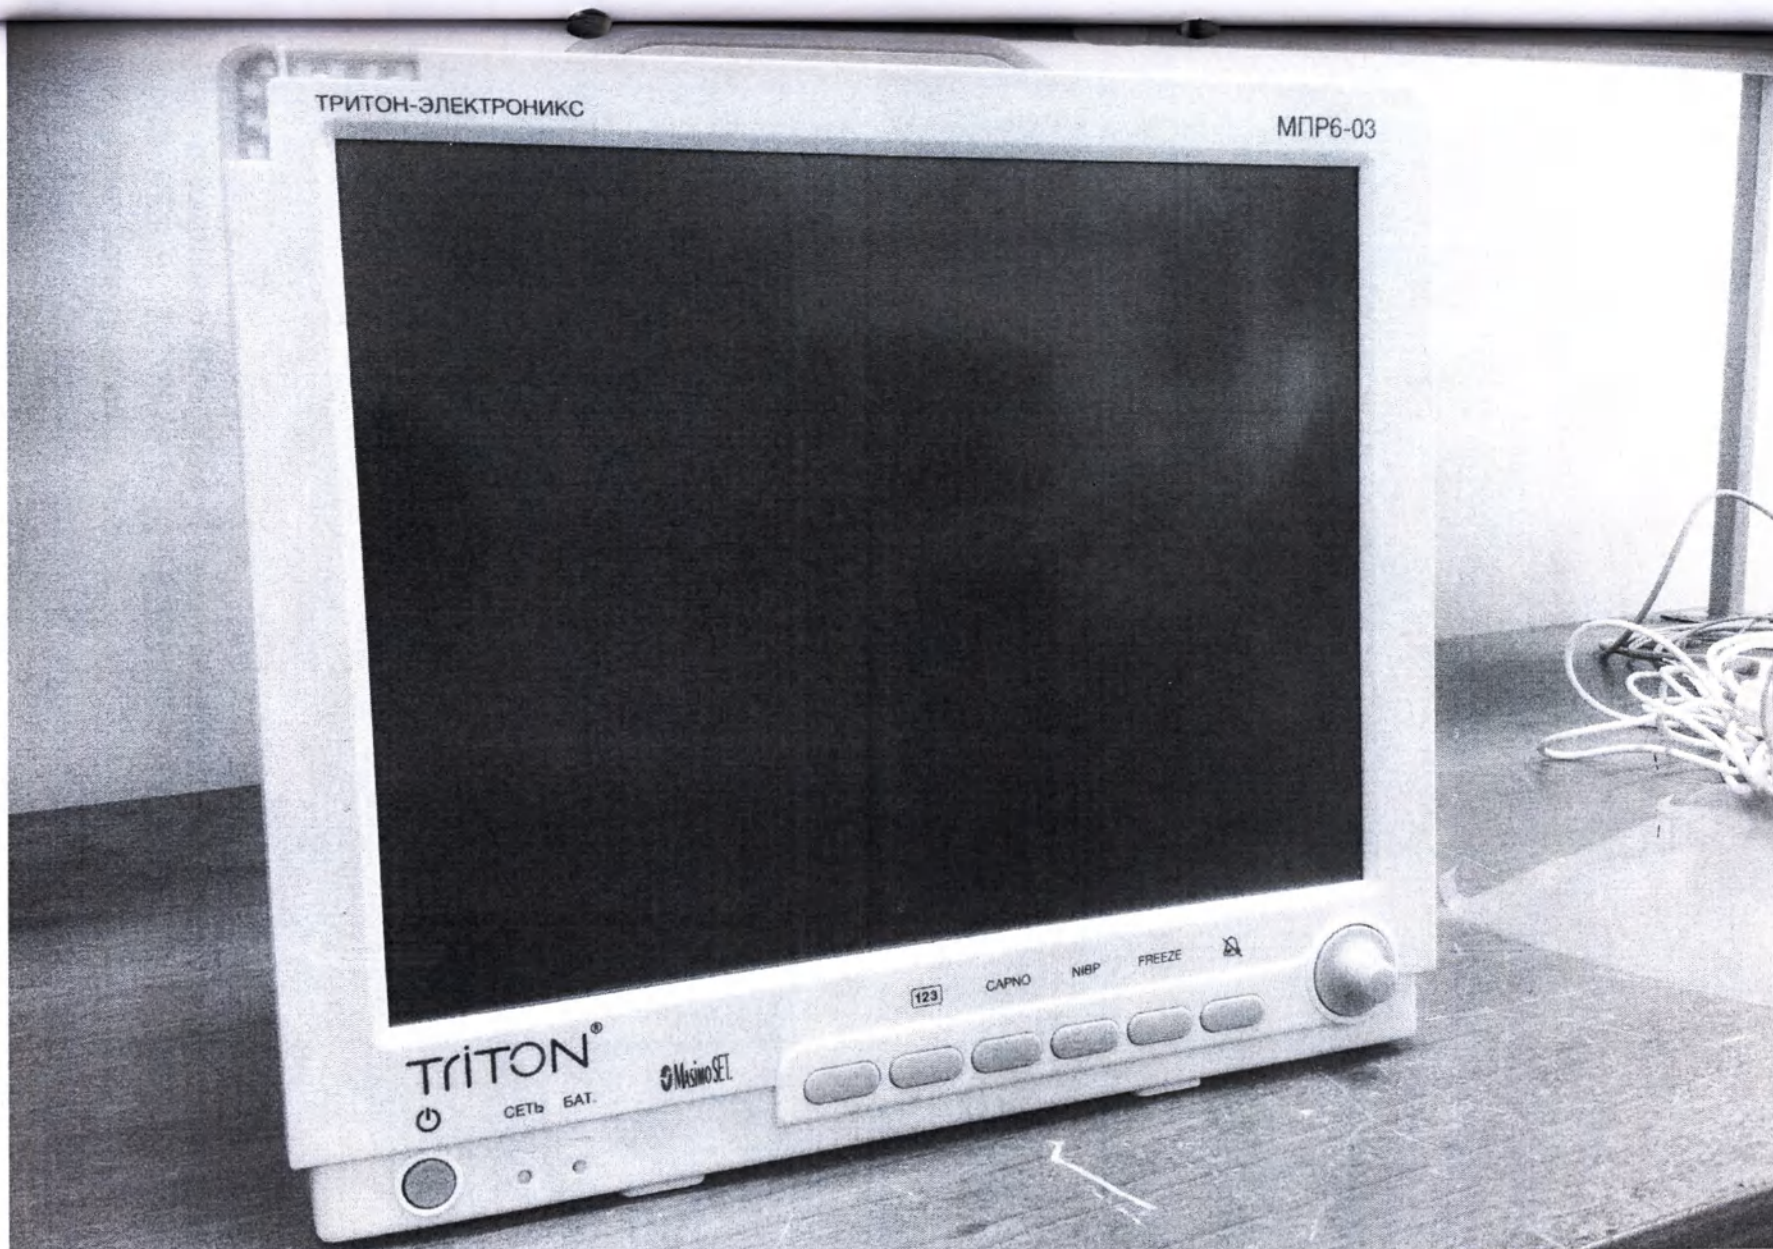


15. Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МНР6-03-"Тритон" по ТУ 26.60.12-011-32119398-2019 (при необходимости), РУ № ФСР 2007/00597, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, 1 шт.




17. Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 по ТУ 26.60.12-018-32119398-2018, РУ № РЗН 2015/2595, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

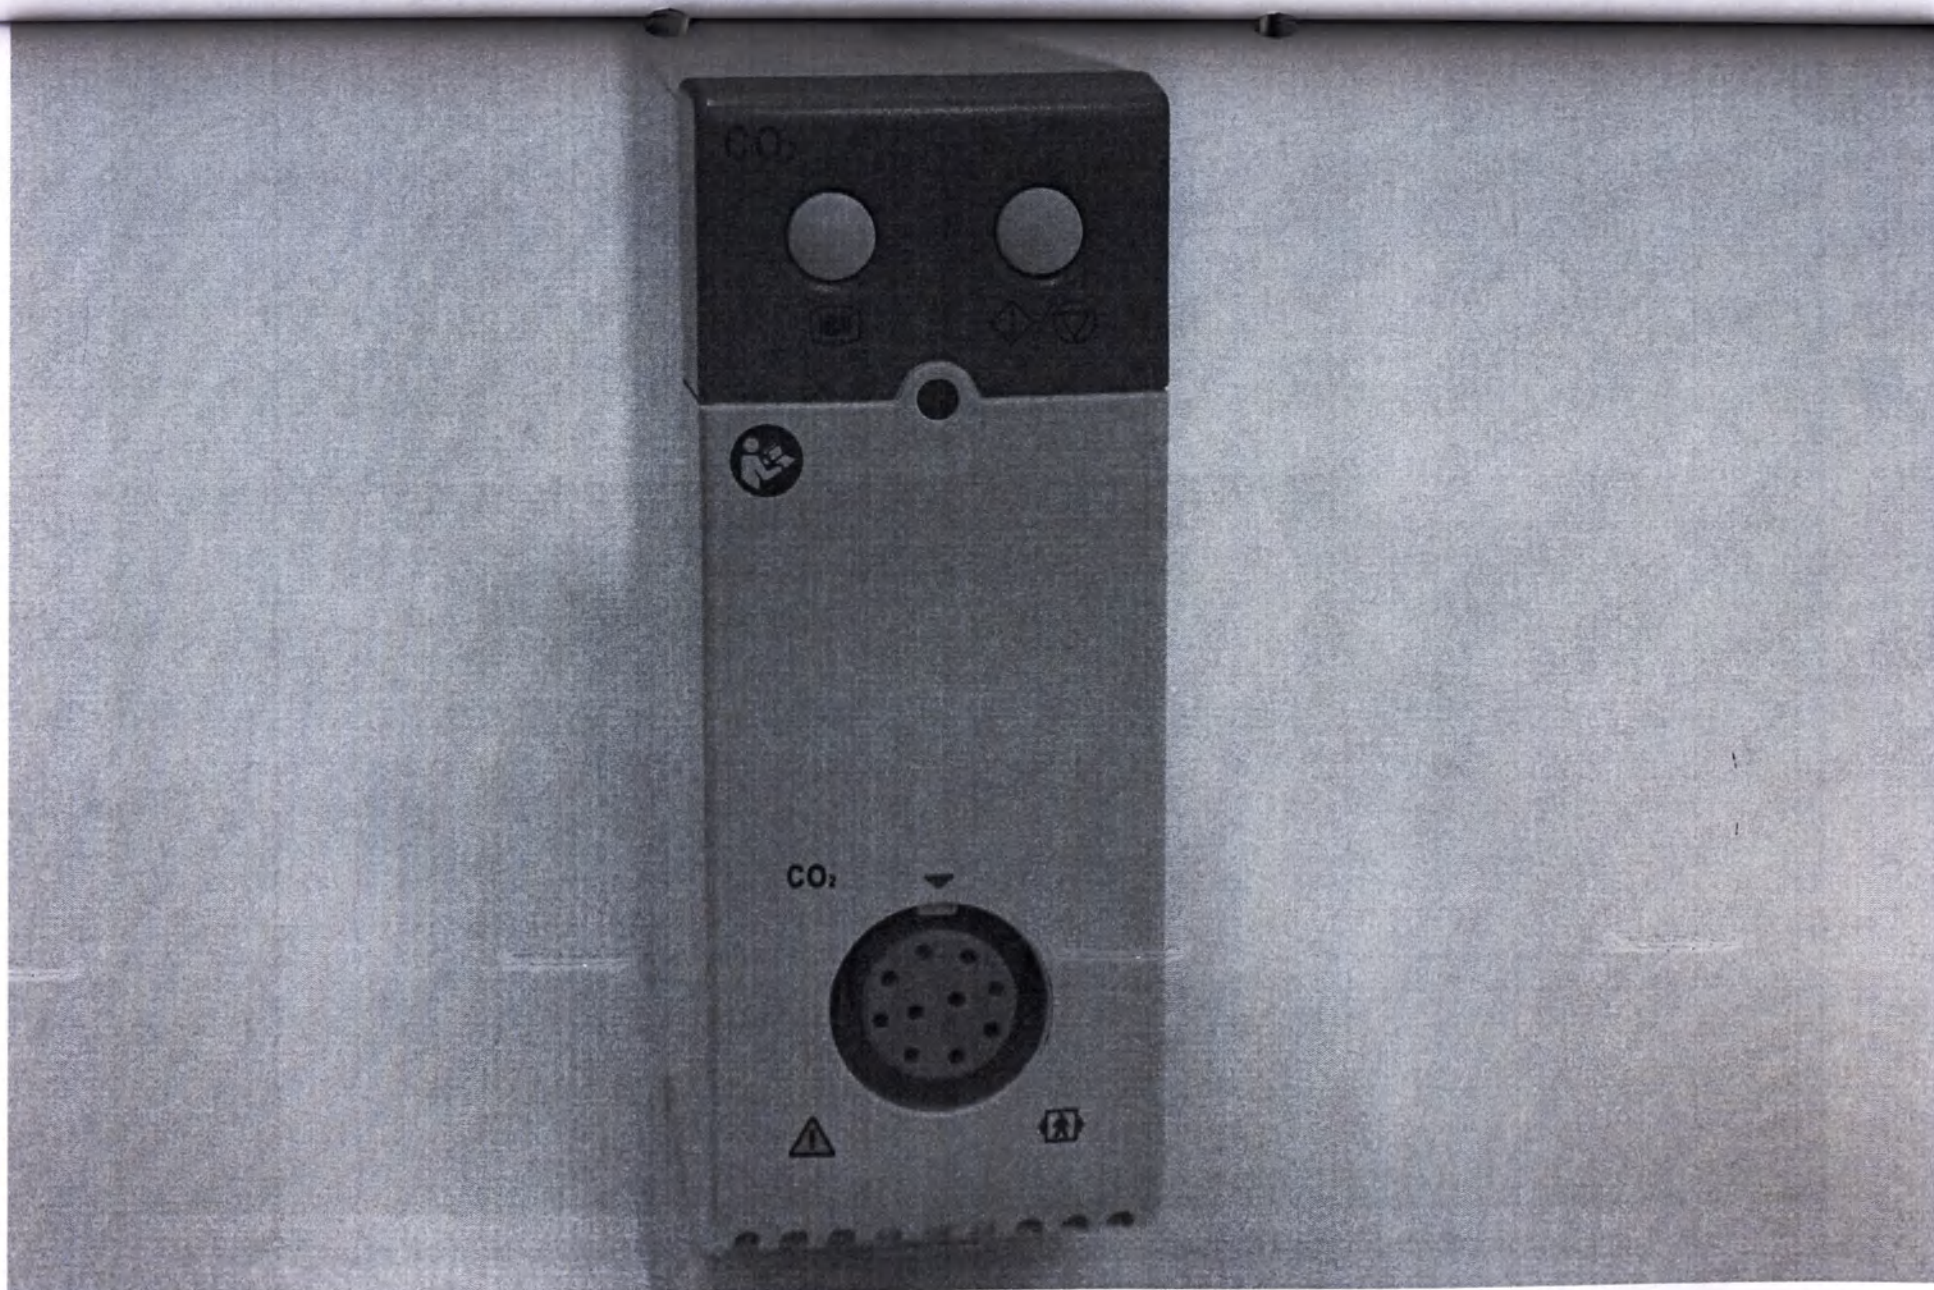


18. Модуль капнометрии прямого потока, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen

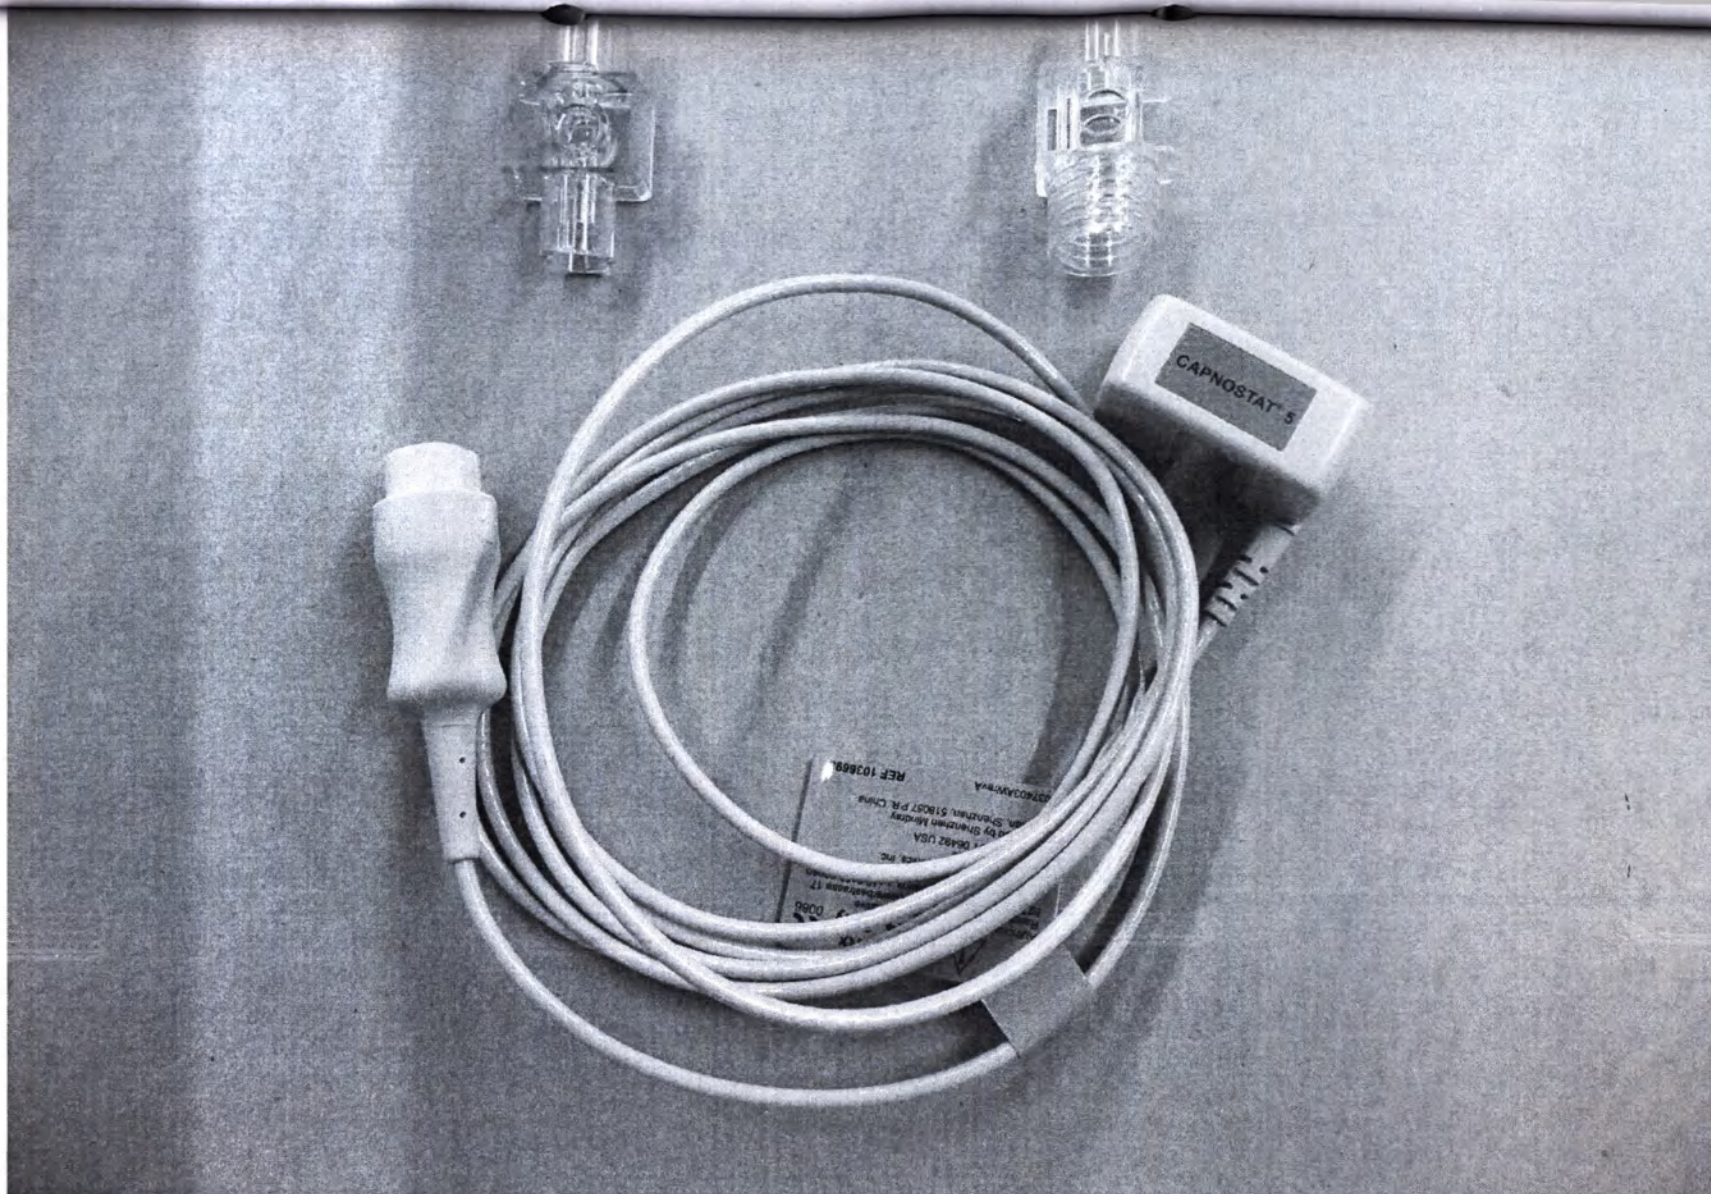


19. Набор для капнометрии прямого потока, в составе: адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослые/дети, адаптер для подключения в дыхательный контур, дети/новорождённые, датчик Capnostat CO₂, крепёж датчика CO₂, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

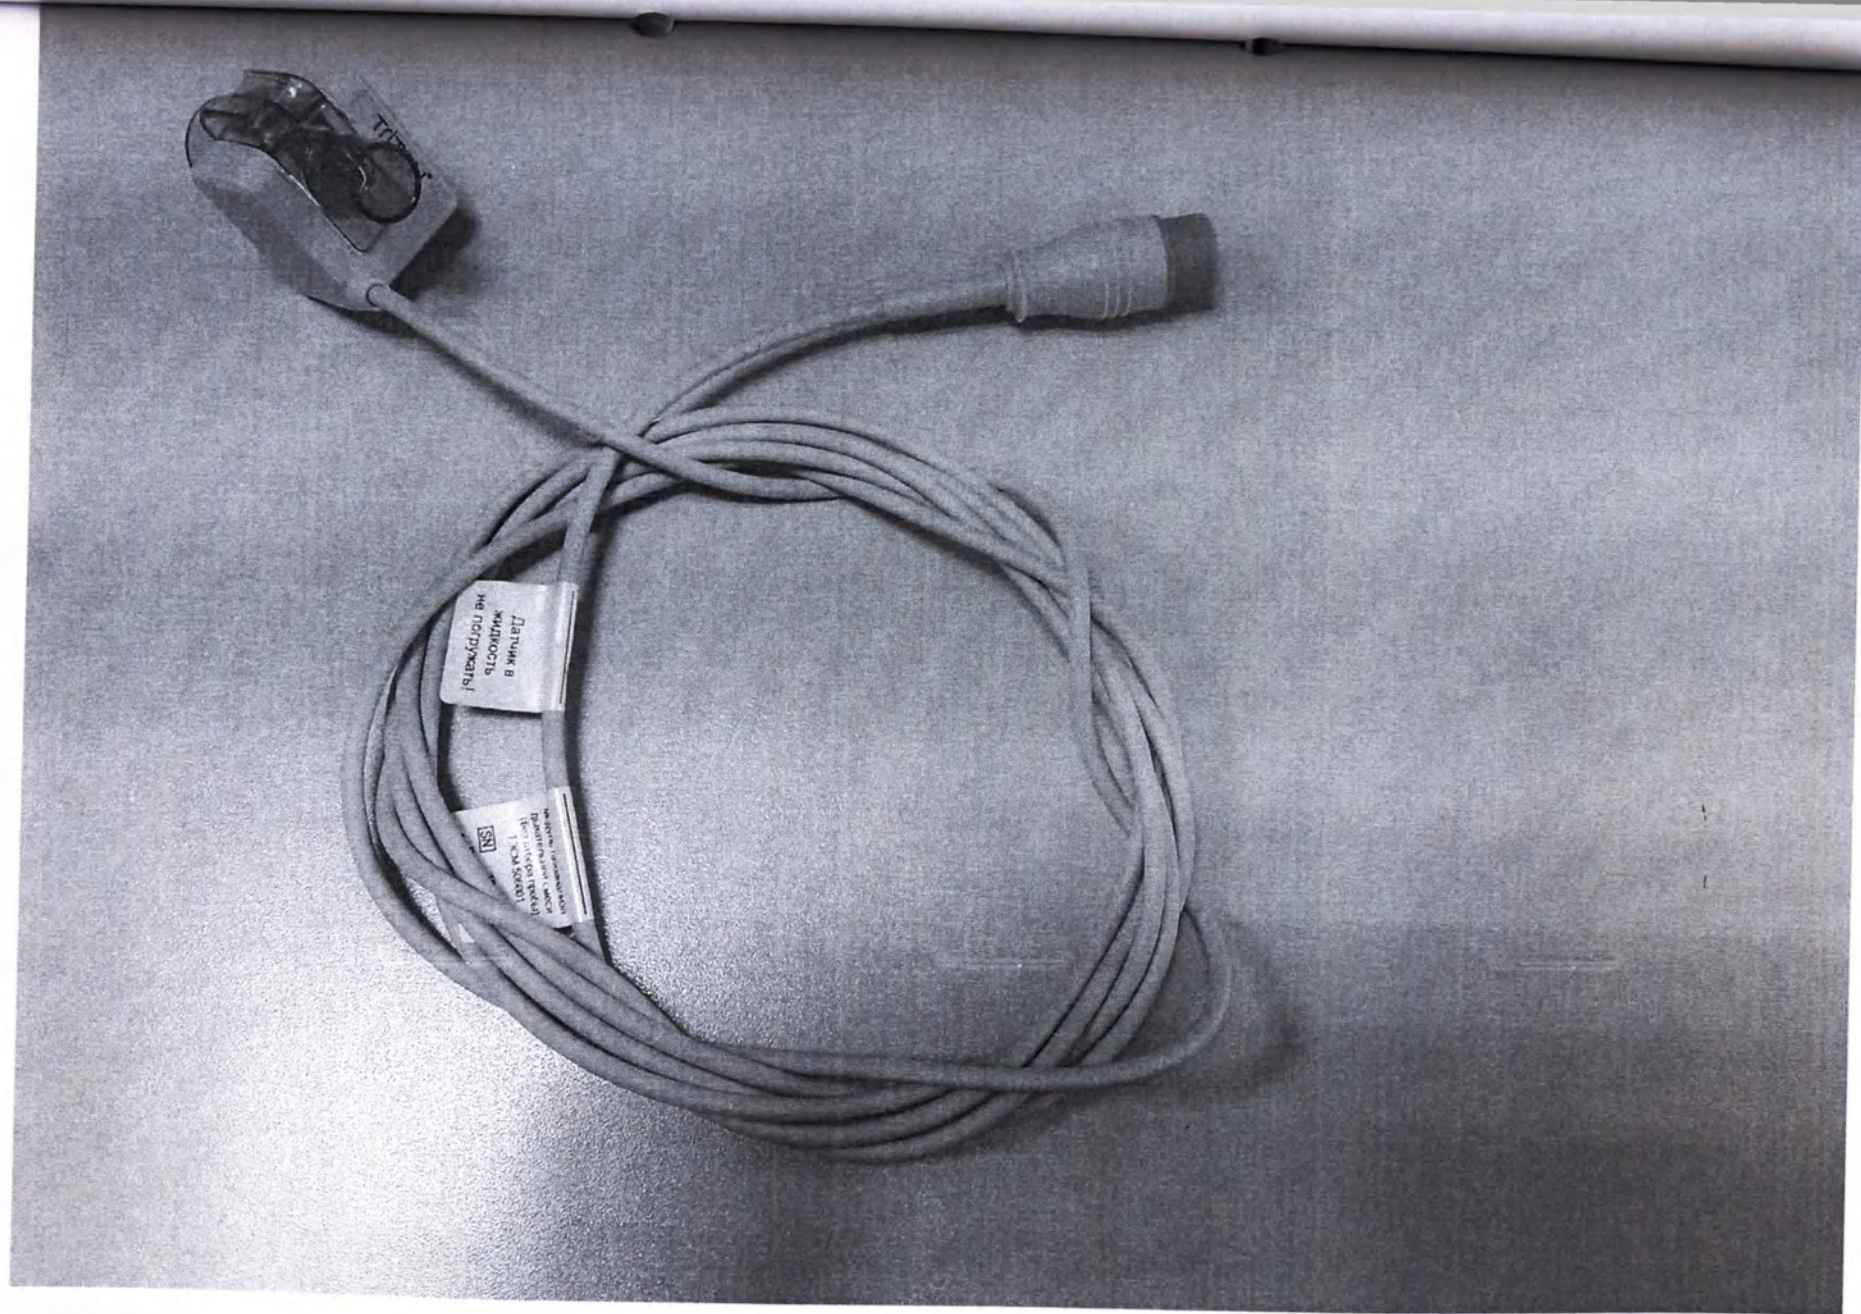


20. Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы), в составе: датчик CO₂ в прямом потоке, вентиляционный адаптер взрослый/детский, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС».

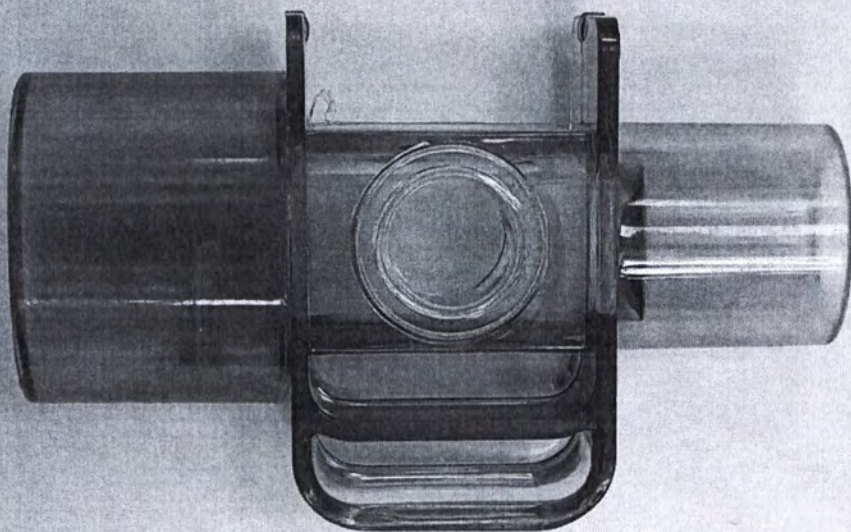


21. Вентиляционный адаптер взрослый/детский,
ТЭСМ.706020,
пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

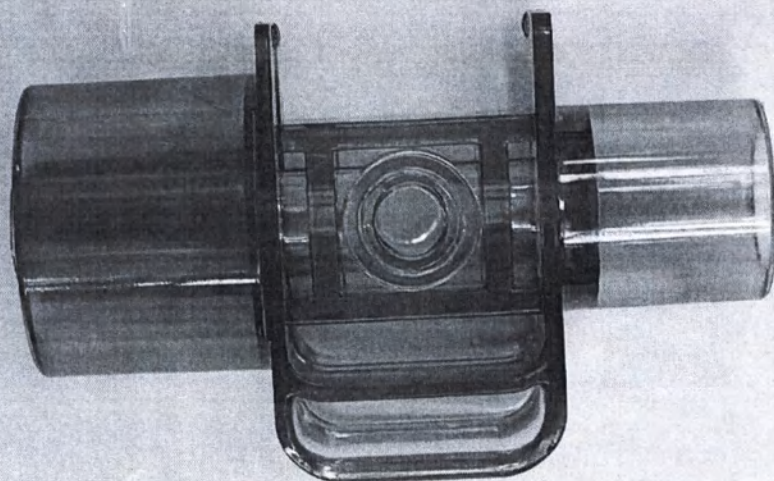

2. Вентиляционный адаптер детский/неонатальный,
ЭСМ.706021,
-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

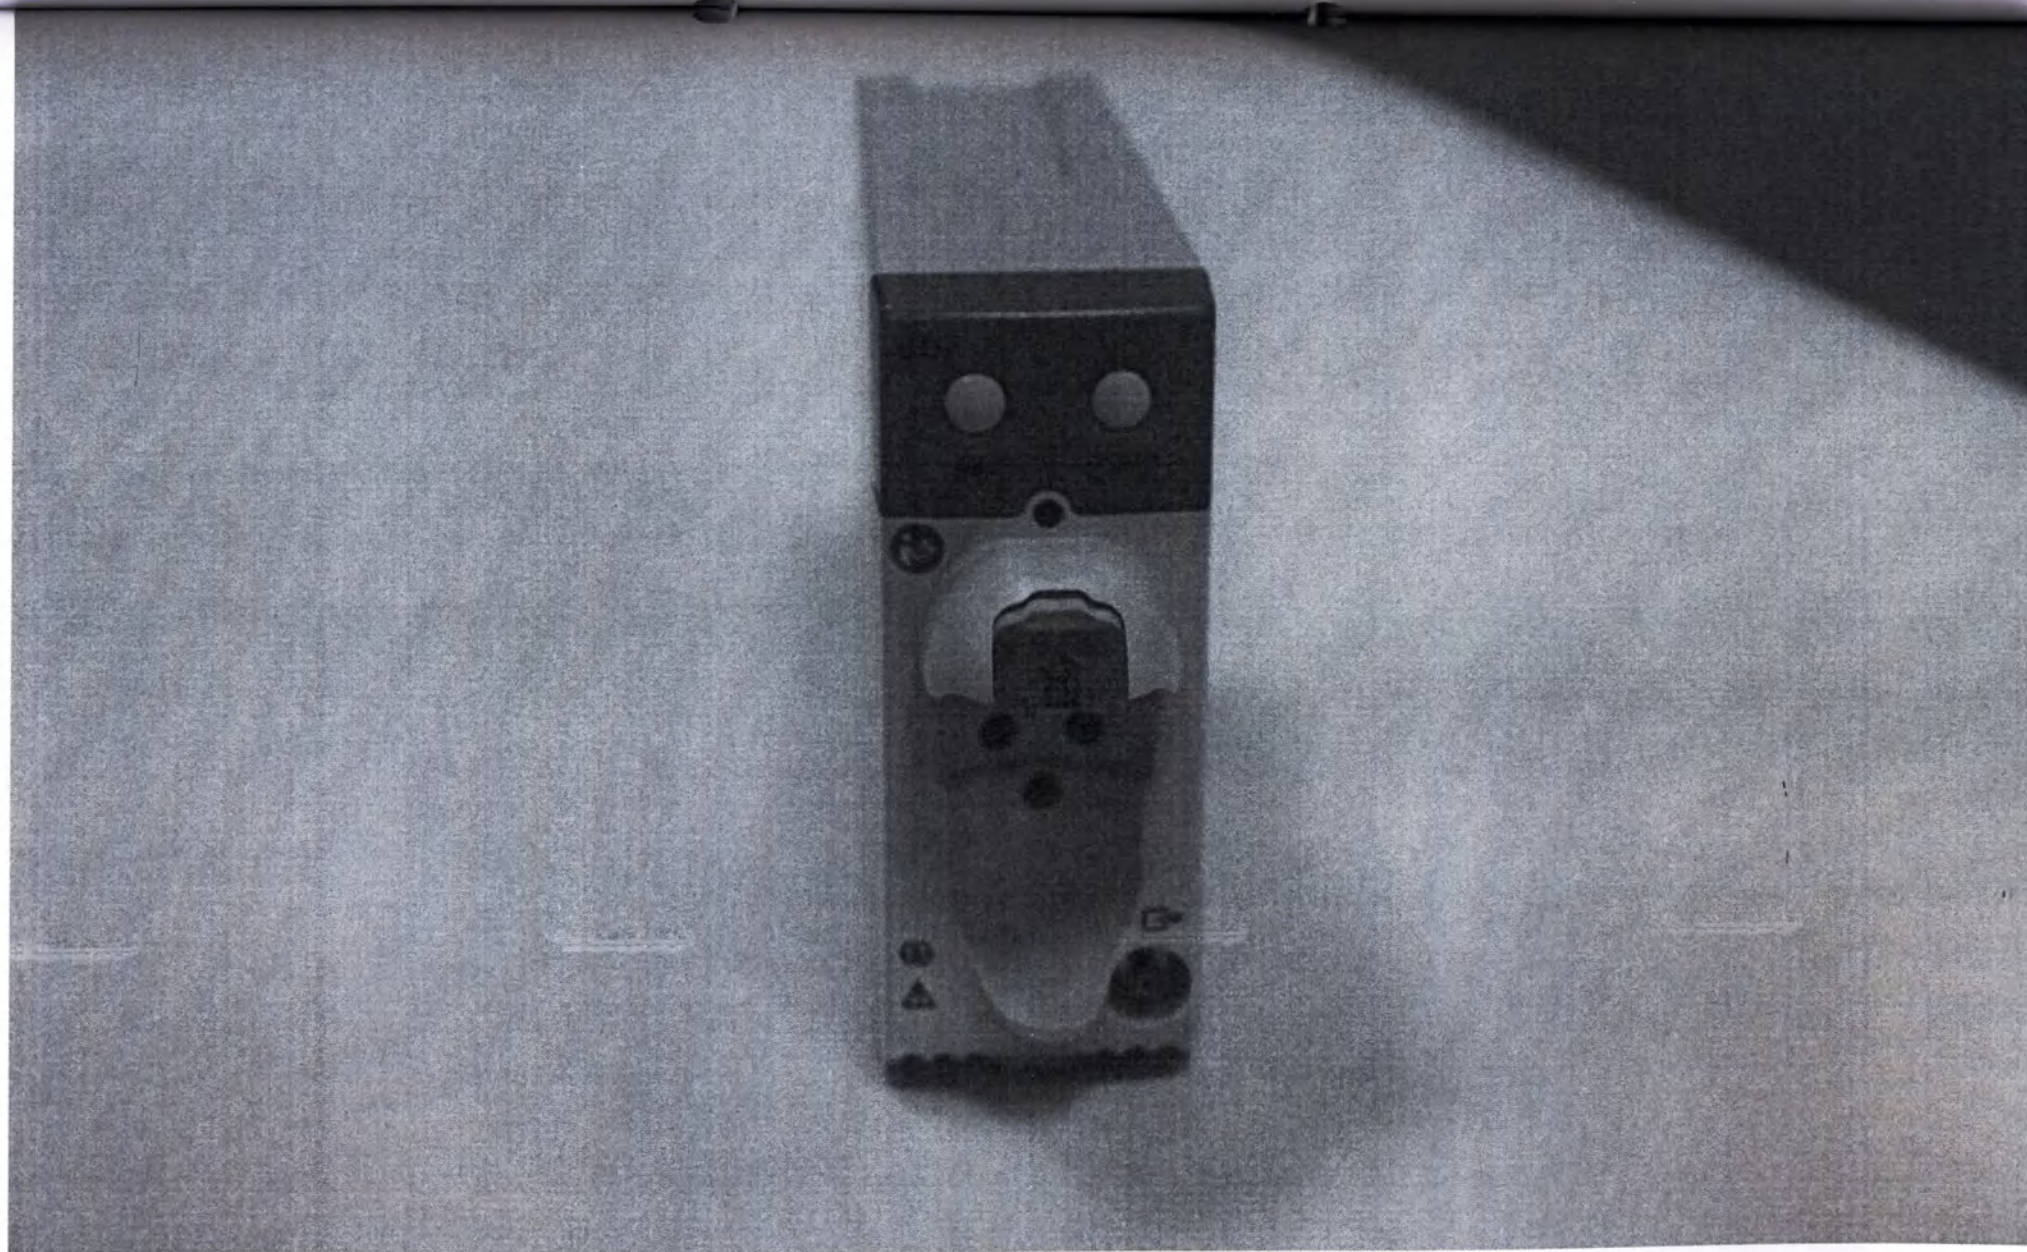


23. Модуль капнометрии бокового потока, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

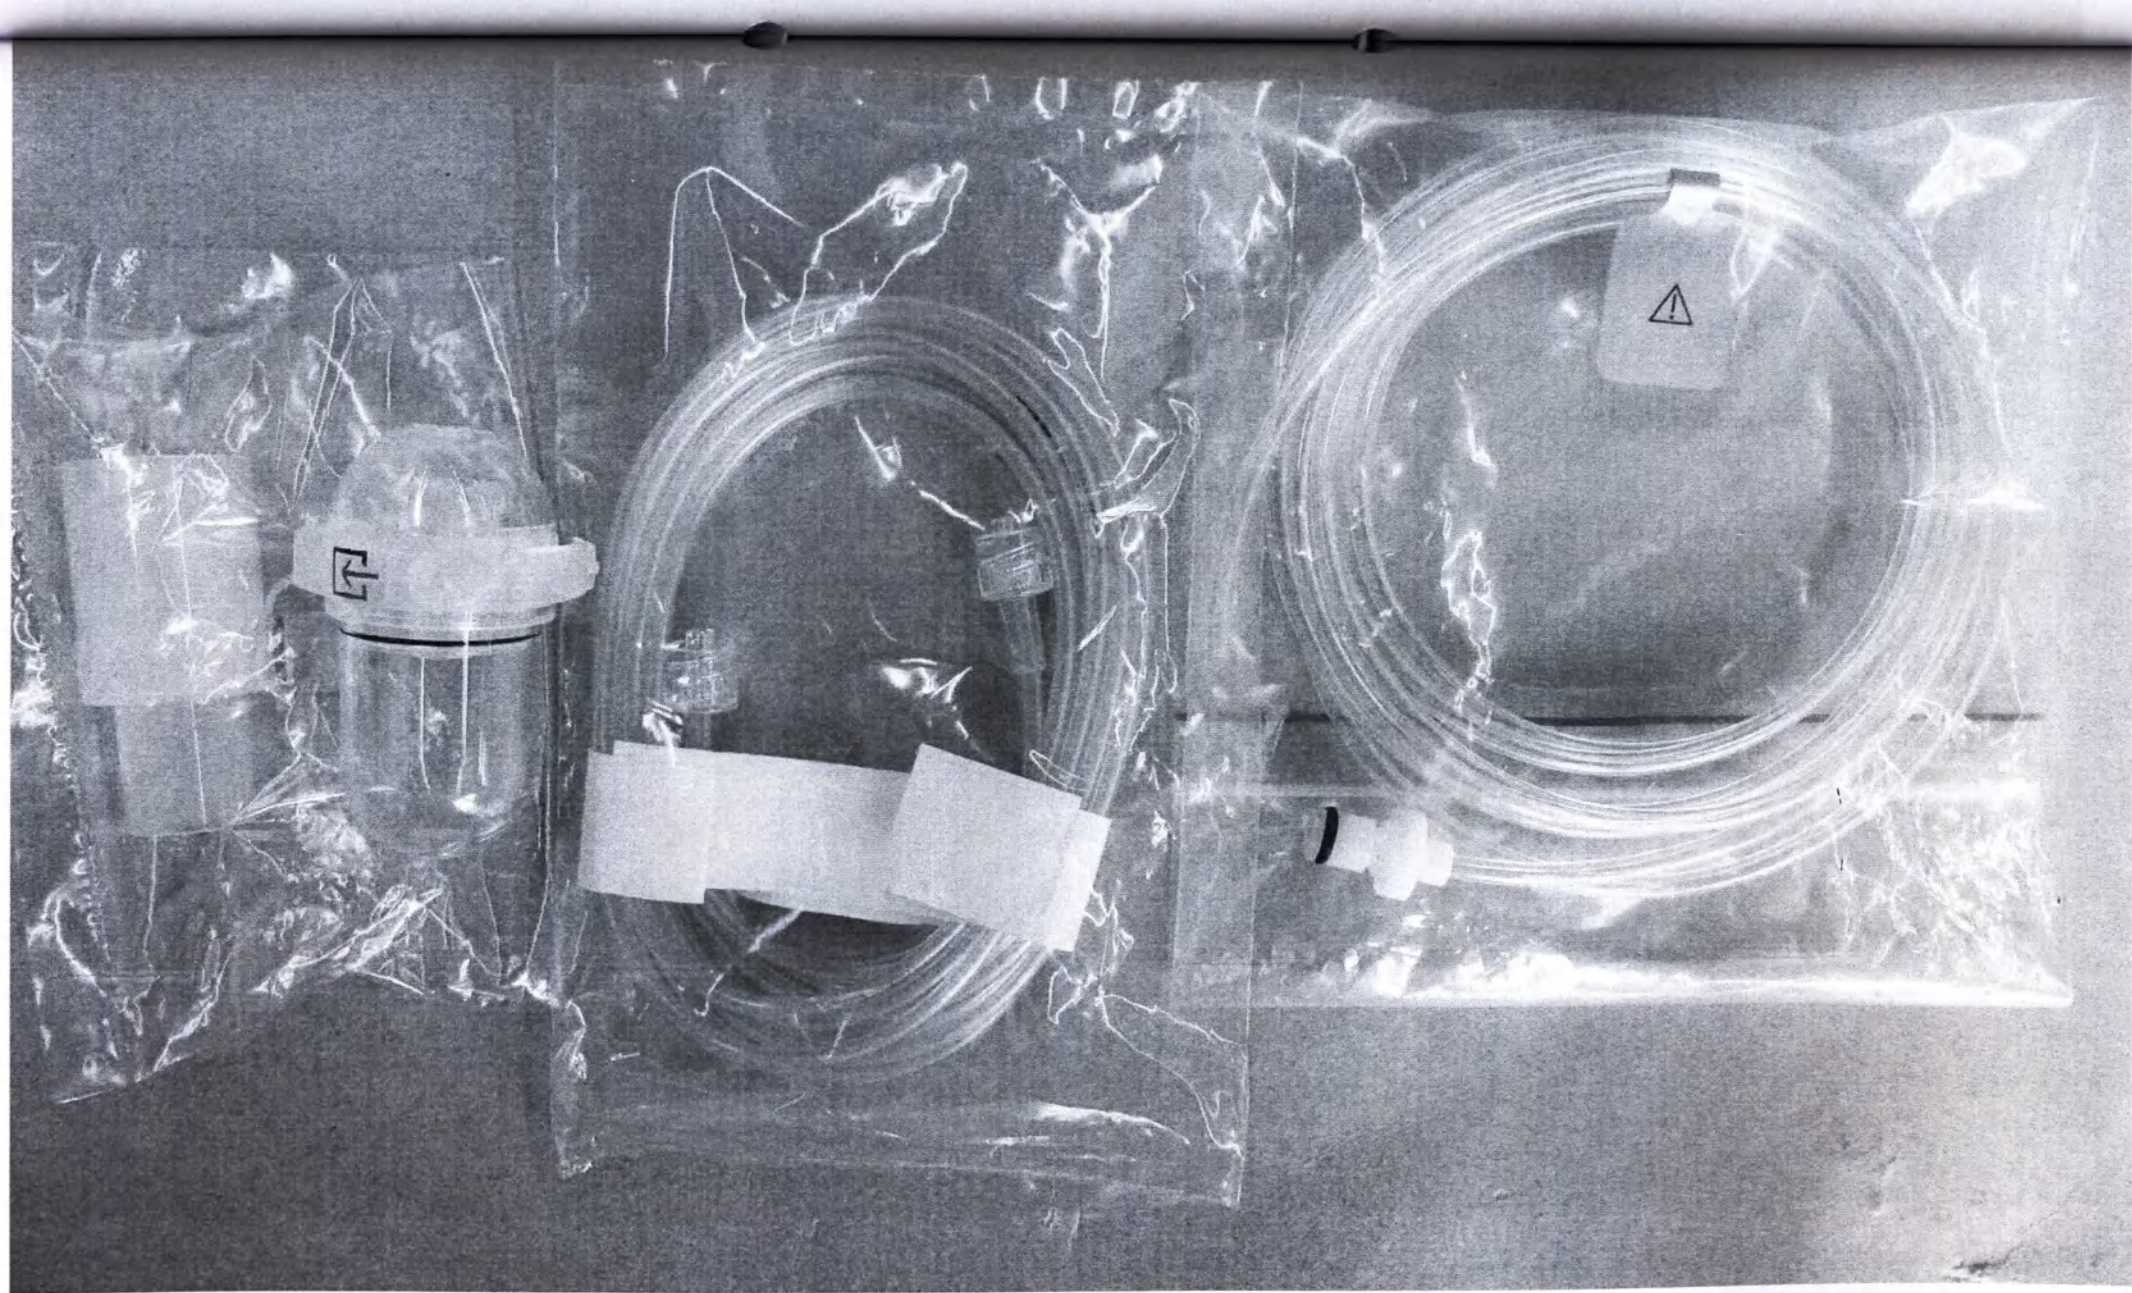

24. Набор для капнометрии в боковом потоке, взрослые/дети, в составе: трубка соединительная с быстроразъёмным адаптером, адаптер для подключения в дыхательный контур, влагосборник, взрослые/дети, линия забора пробы газа, взрослые/дети, пр-во Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




25. Набор для капнометрии в боковом потоке, новорождённые, в составе: трубка соединительная с быстроразъёмным адаптером, адаптер для подключения в дыхательный контур, влагосборник, новорождённые, линия забора пробы газа, новорождённые,

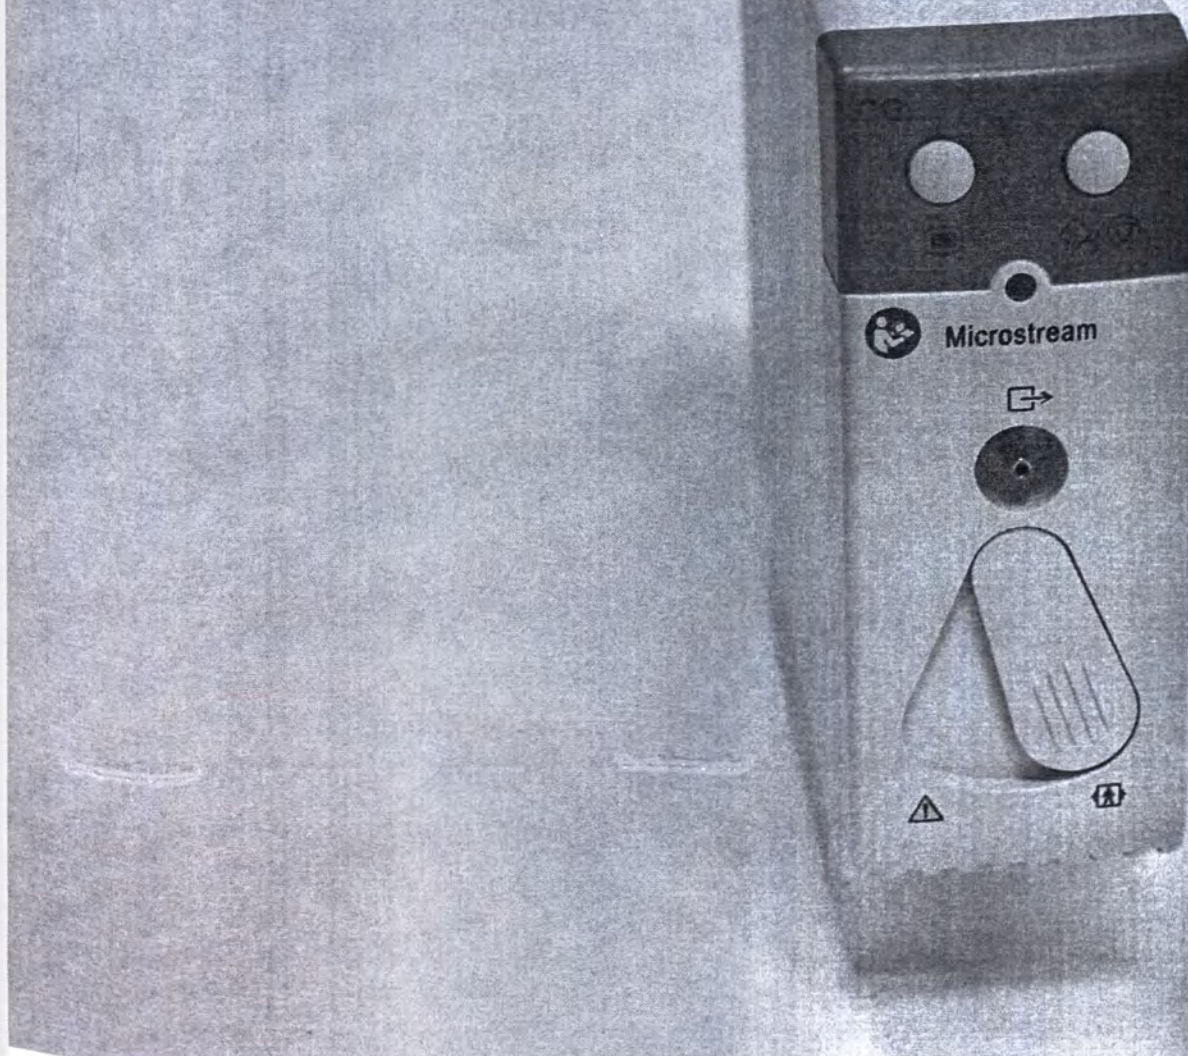

26. Модуль капнометрии низкопоточной (microstream), без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




Набор для капнометрии с технологией microstream, в составе: соединительная трубка с быстроразъёмным адаптером, линия забора пробы газа, взрослые/дети, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

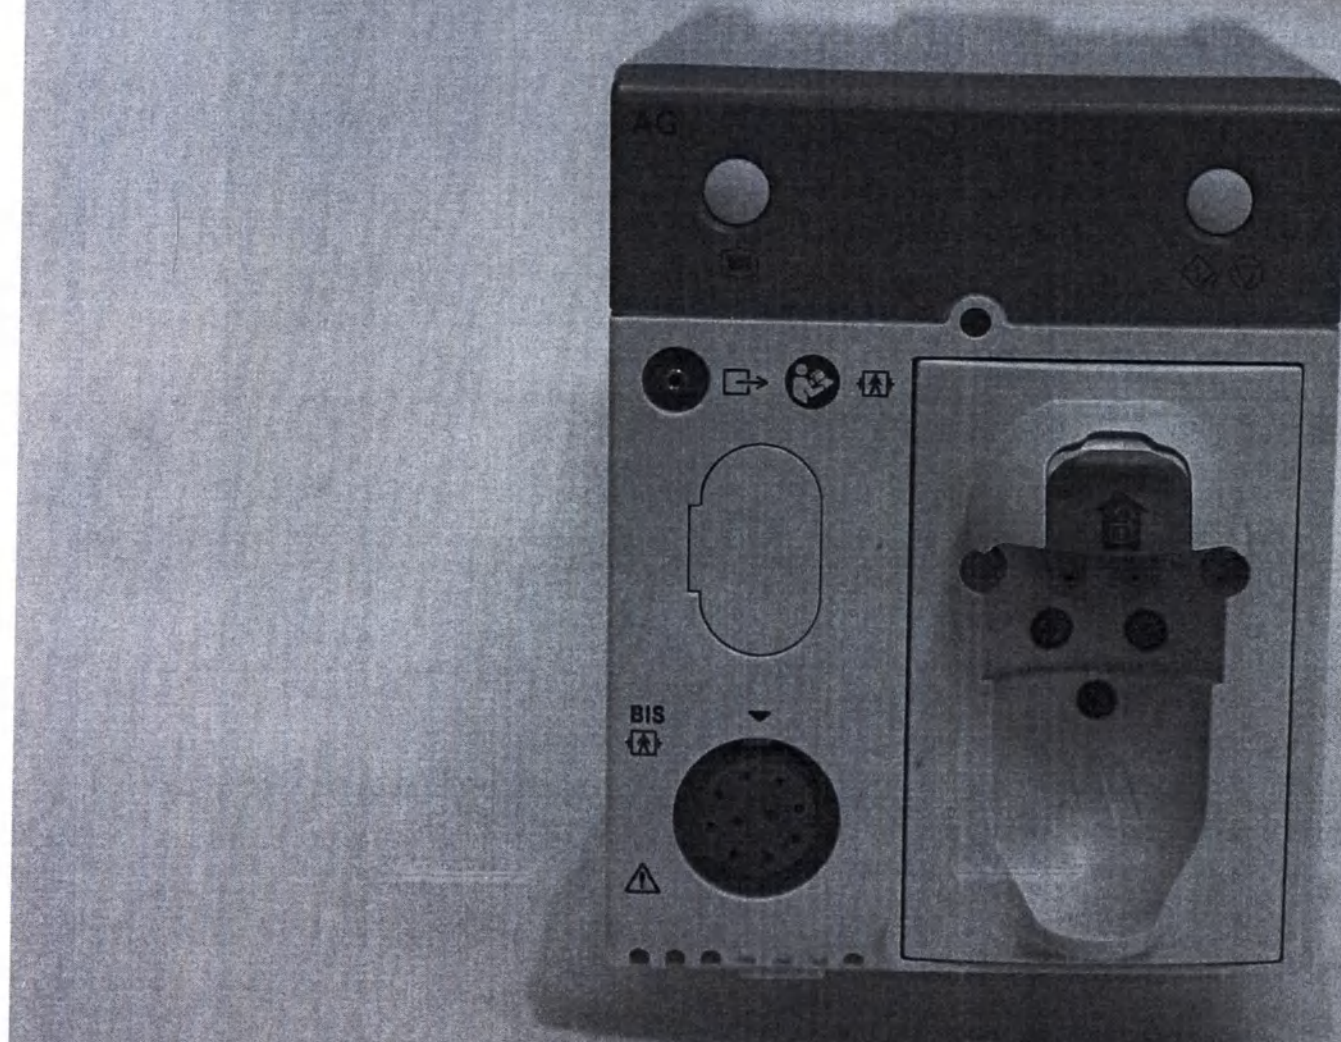


28. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



29. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, с мониторингом кислорода, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

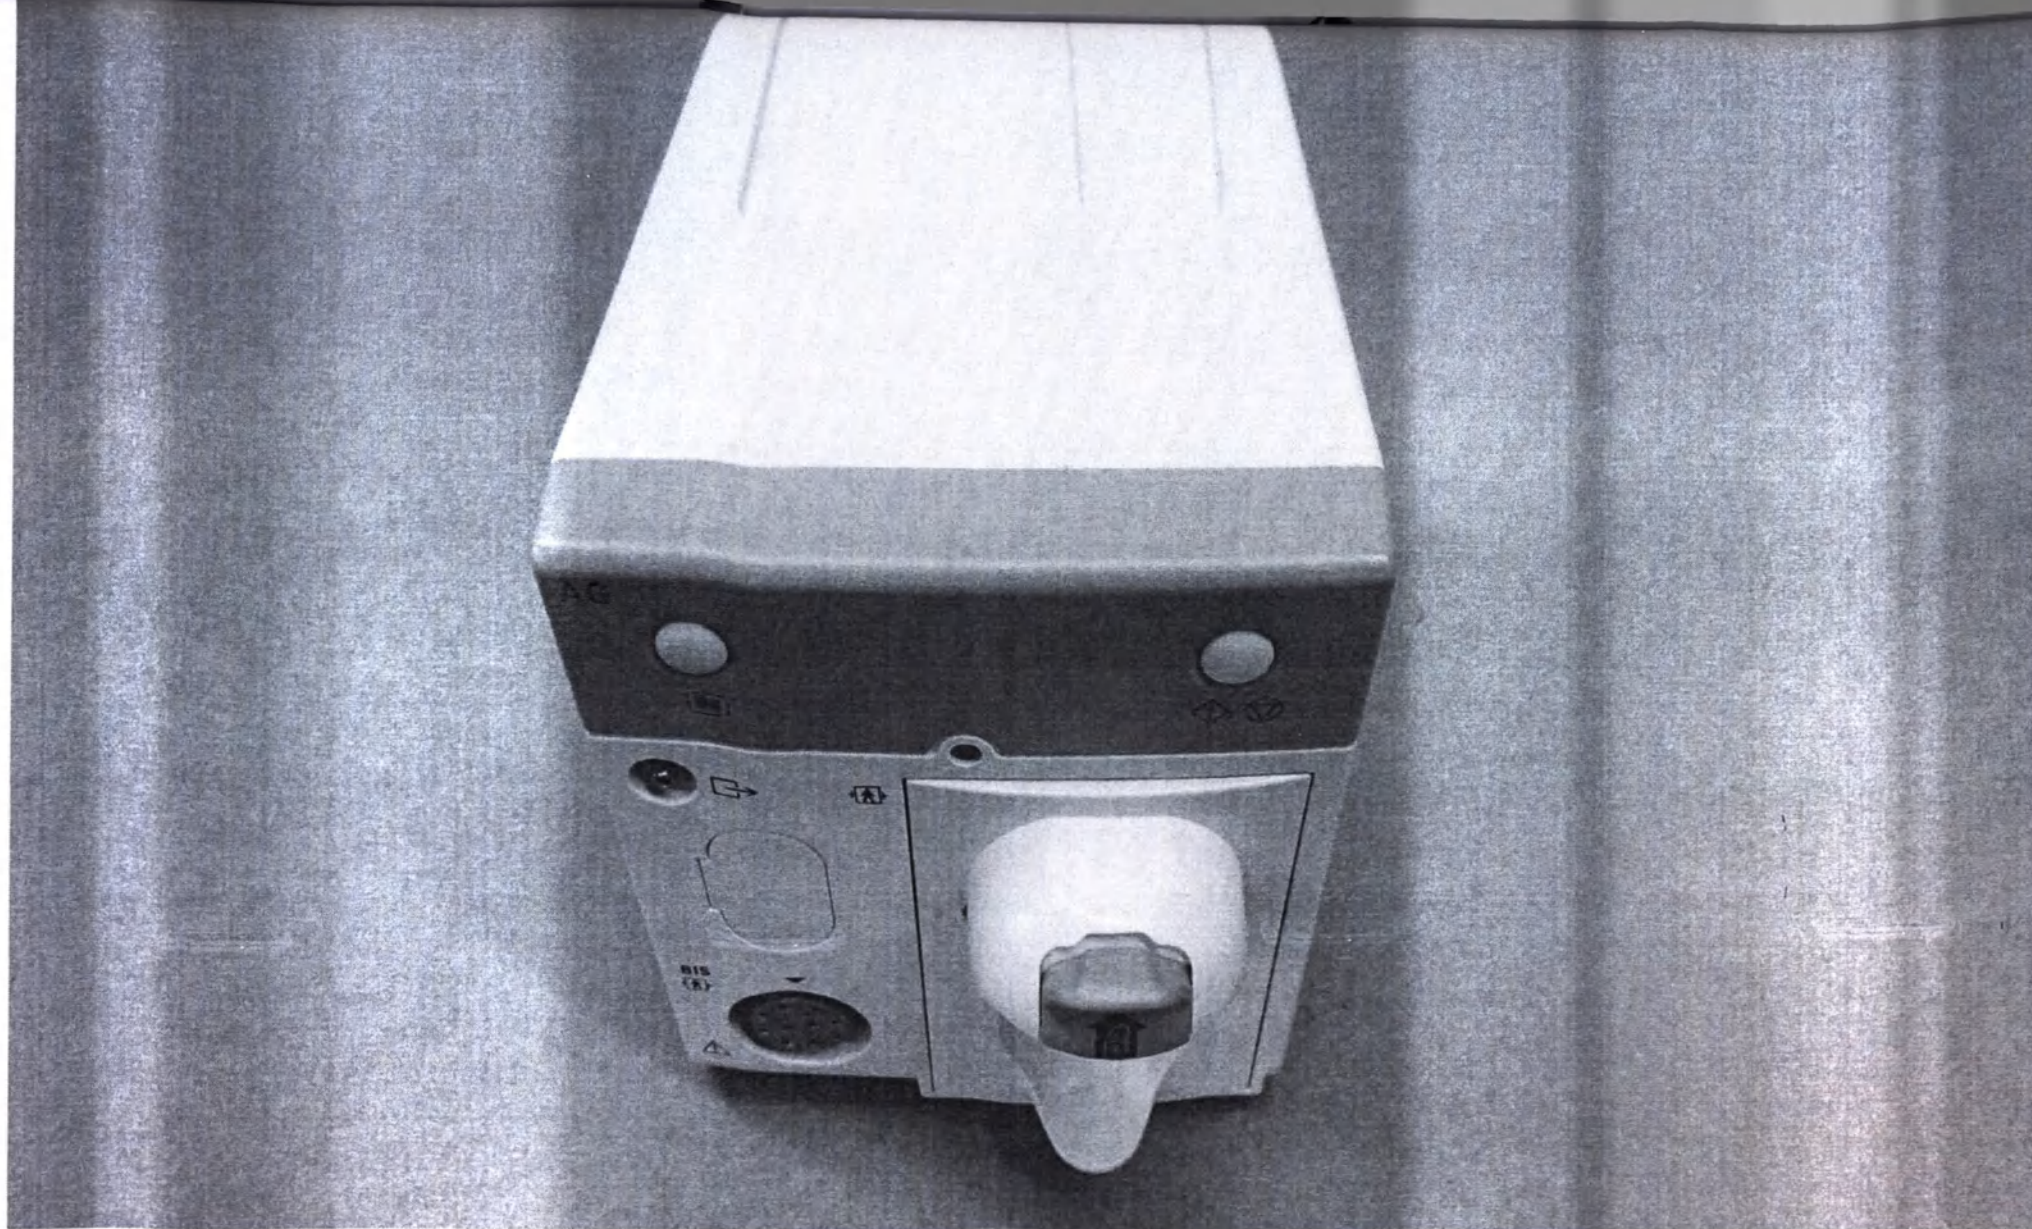


30. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, с мониторингом биспектрального индекса (BIS), без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

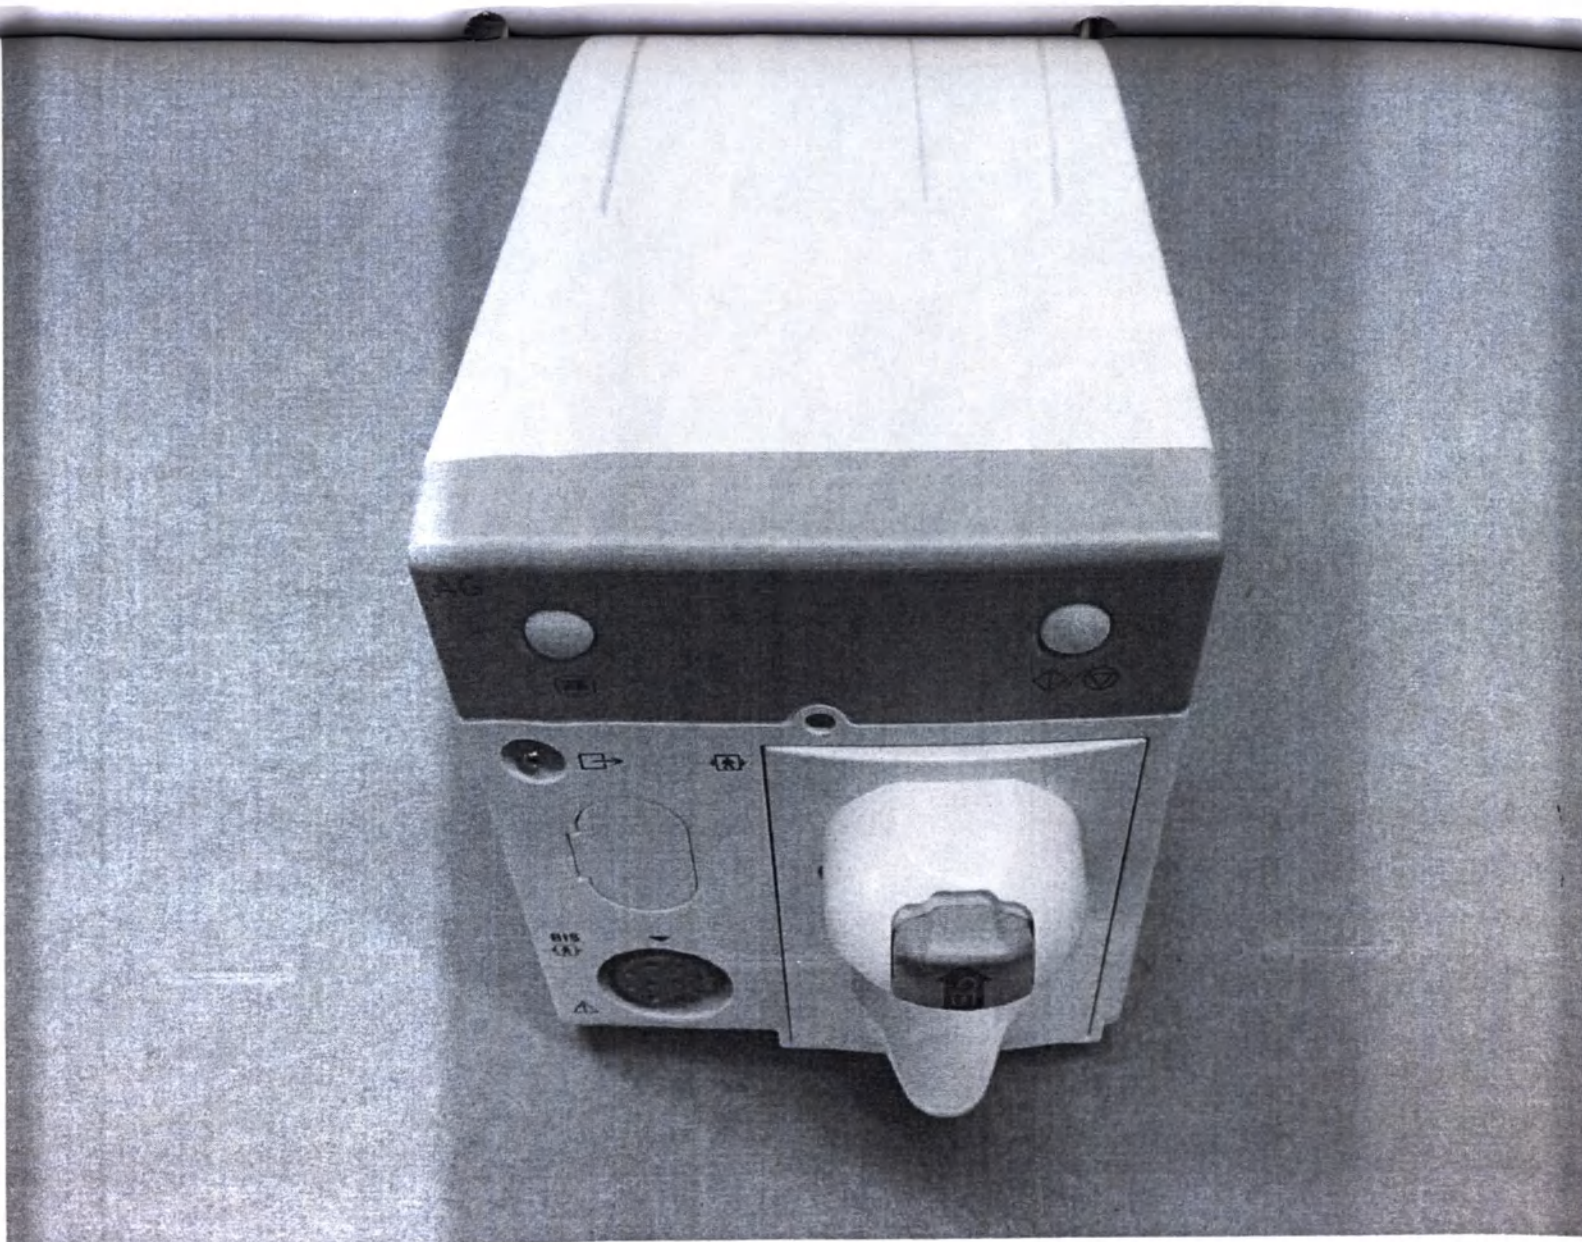

31. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, с мониторингом кислорода и с мониторингом биспектрального индекса (BIS), без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



32 Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, в составе: трубка соединительная с быстроразъёмным адаптером, адаптер прямой, взрослые/дети, адаптер прямой, новорожденные, линия забора пробы газа, взрослые/дети, линия забора пробы газа, новорождённые, влагосорбник, взрослые/дети, влагосорбник, новорождённые, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

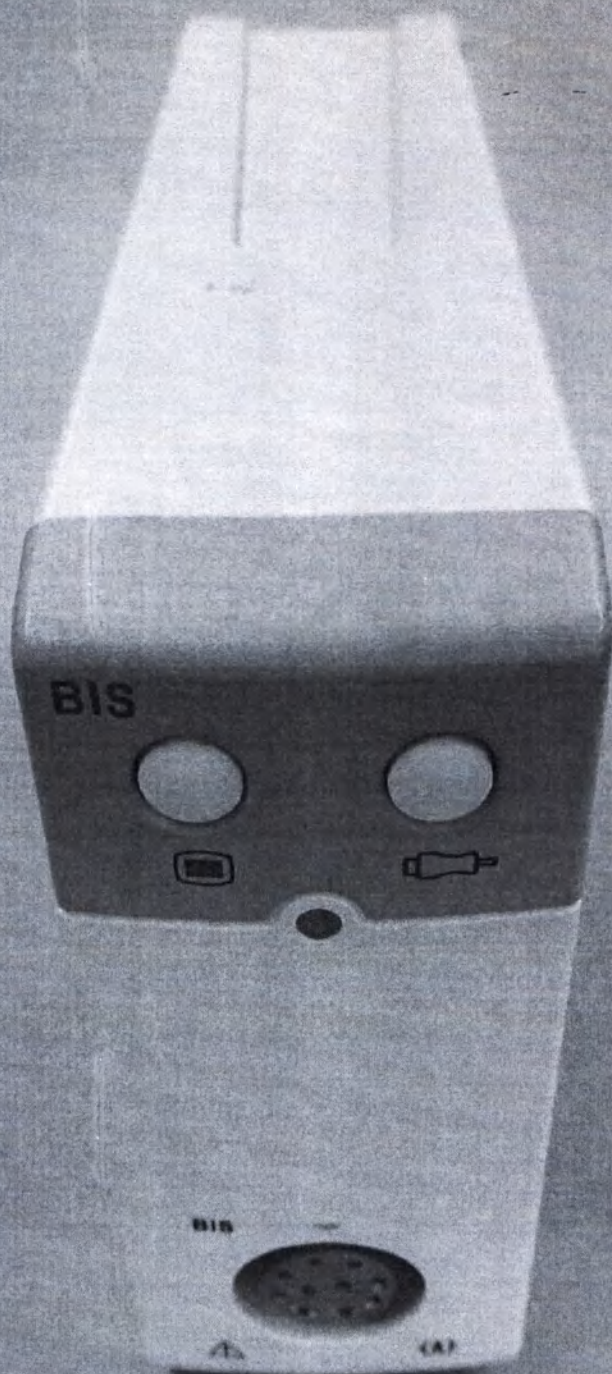


33. Модуль мониторинга биспектрального индекса (BIS), без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




34. Набор для мониторинга биспектрального индекса BISx , в составе: сенсоры одноразовые BIS, цифровой преобразователь сигнала с кабелем для соединения с основным блоком, пр-ва «Covidien Llc», США.



35. Набор для мониторинга биспектрального индекса BISx4, в составе: сенсоры одноразовые BISx4, цифровой билатериальный преобразователь сигнала с кабелем для соединения с основным блоком, пр-ва «Covidien Llc», США.

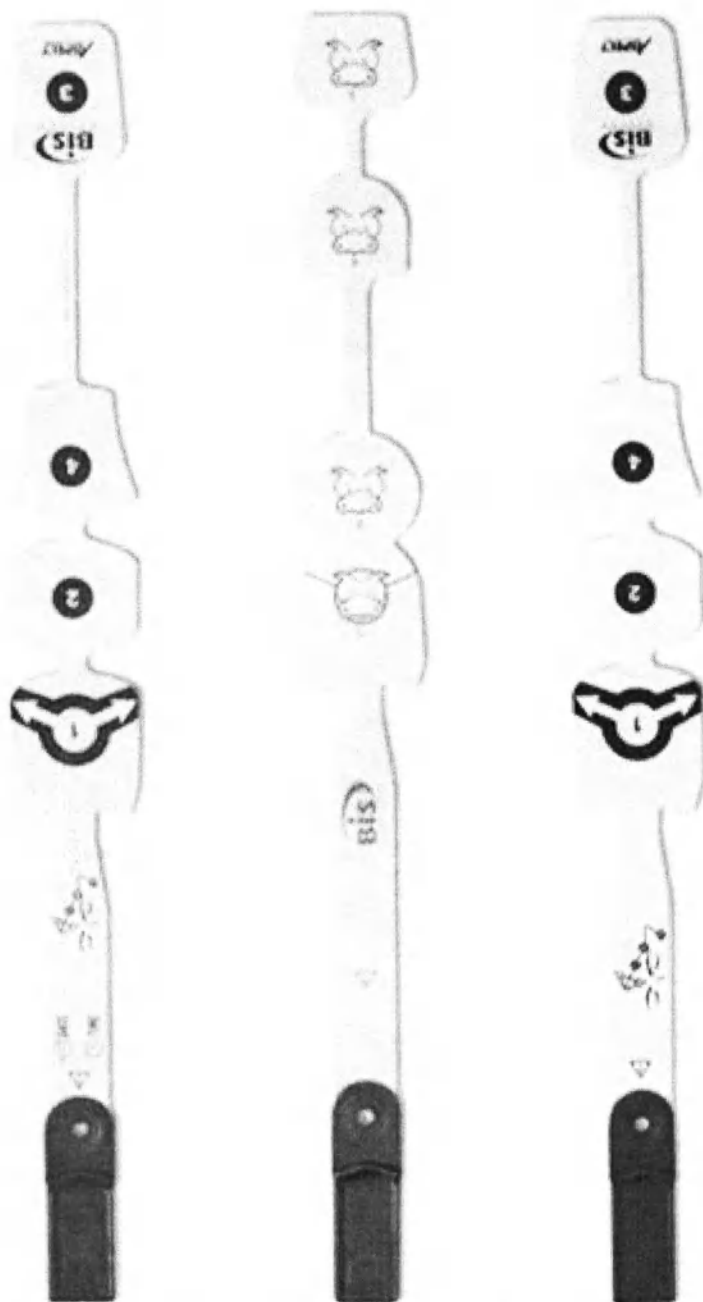

Сенсоры BIS, BIS Quatro, BIS Extend для систем мониторинга
 бины наркоза и седации, РУ № ФСЗ 2011/11013, пр-ва «Covidien Llc»,
 ИА.

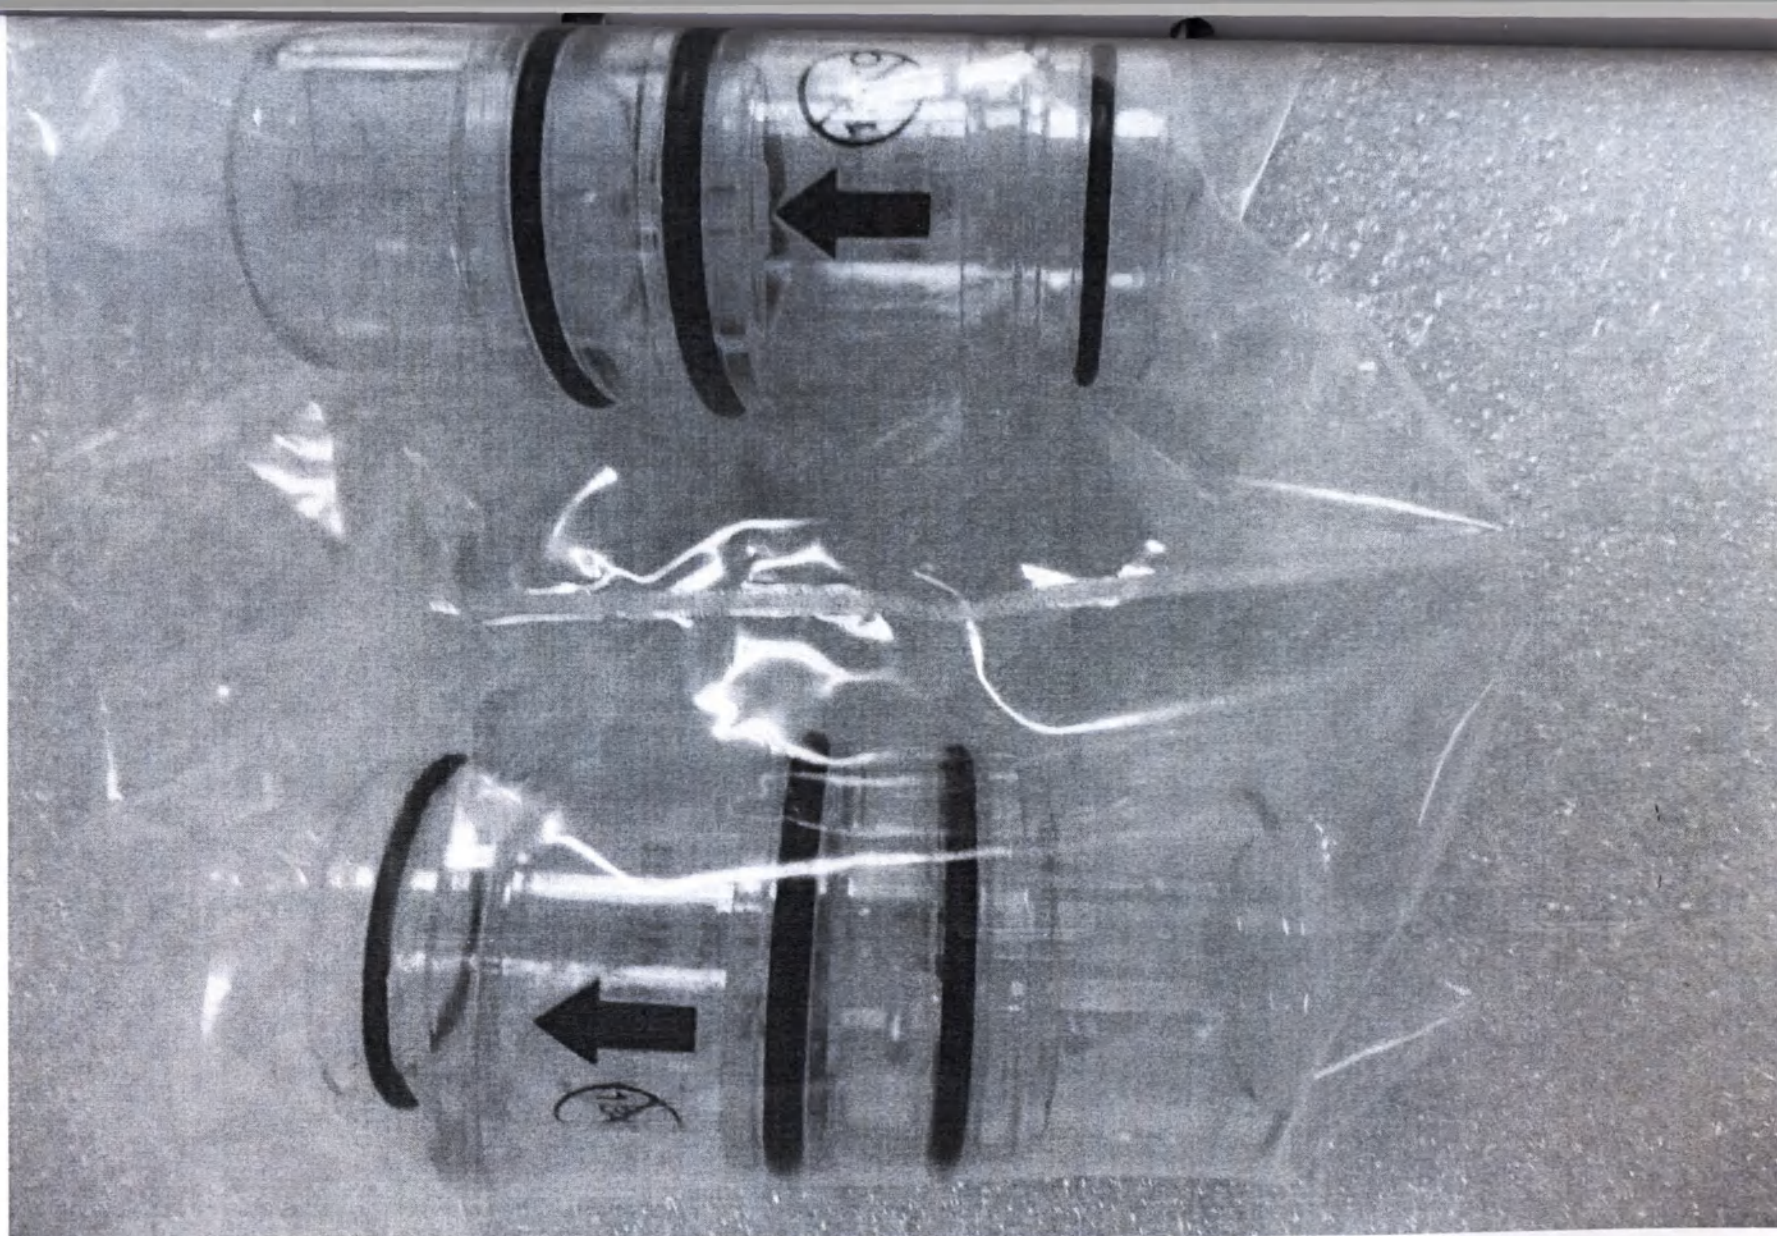


**37. Датчики потока (инспираторные, экспираторные), пр-ва
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.**




38. Набор дыхательного контура, одноразовый, для взрослых, в составе: контур пациента (дыхательный мешок 3 л, прямой адаптер, угловой адаптер, воздушный фильтр), для взрослых, 1.5 м, маска дыхательная, с клапаном, для взрослых, размер 5, 22 мм, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




39. Набор дыхательного контура, одноразовый, для детей, в составе: контур пациента (дыхательный мешок 1 л, прямой адаптер, угловой адаптер, воздушный фильтр), для детей, 1.5 м, маска дыхательная, с клапаном, для детей, размер 2, 22 мм, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

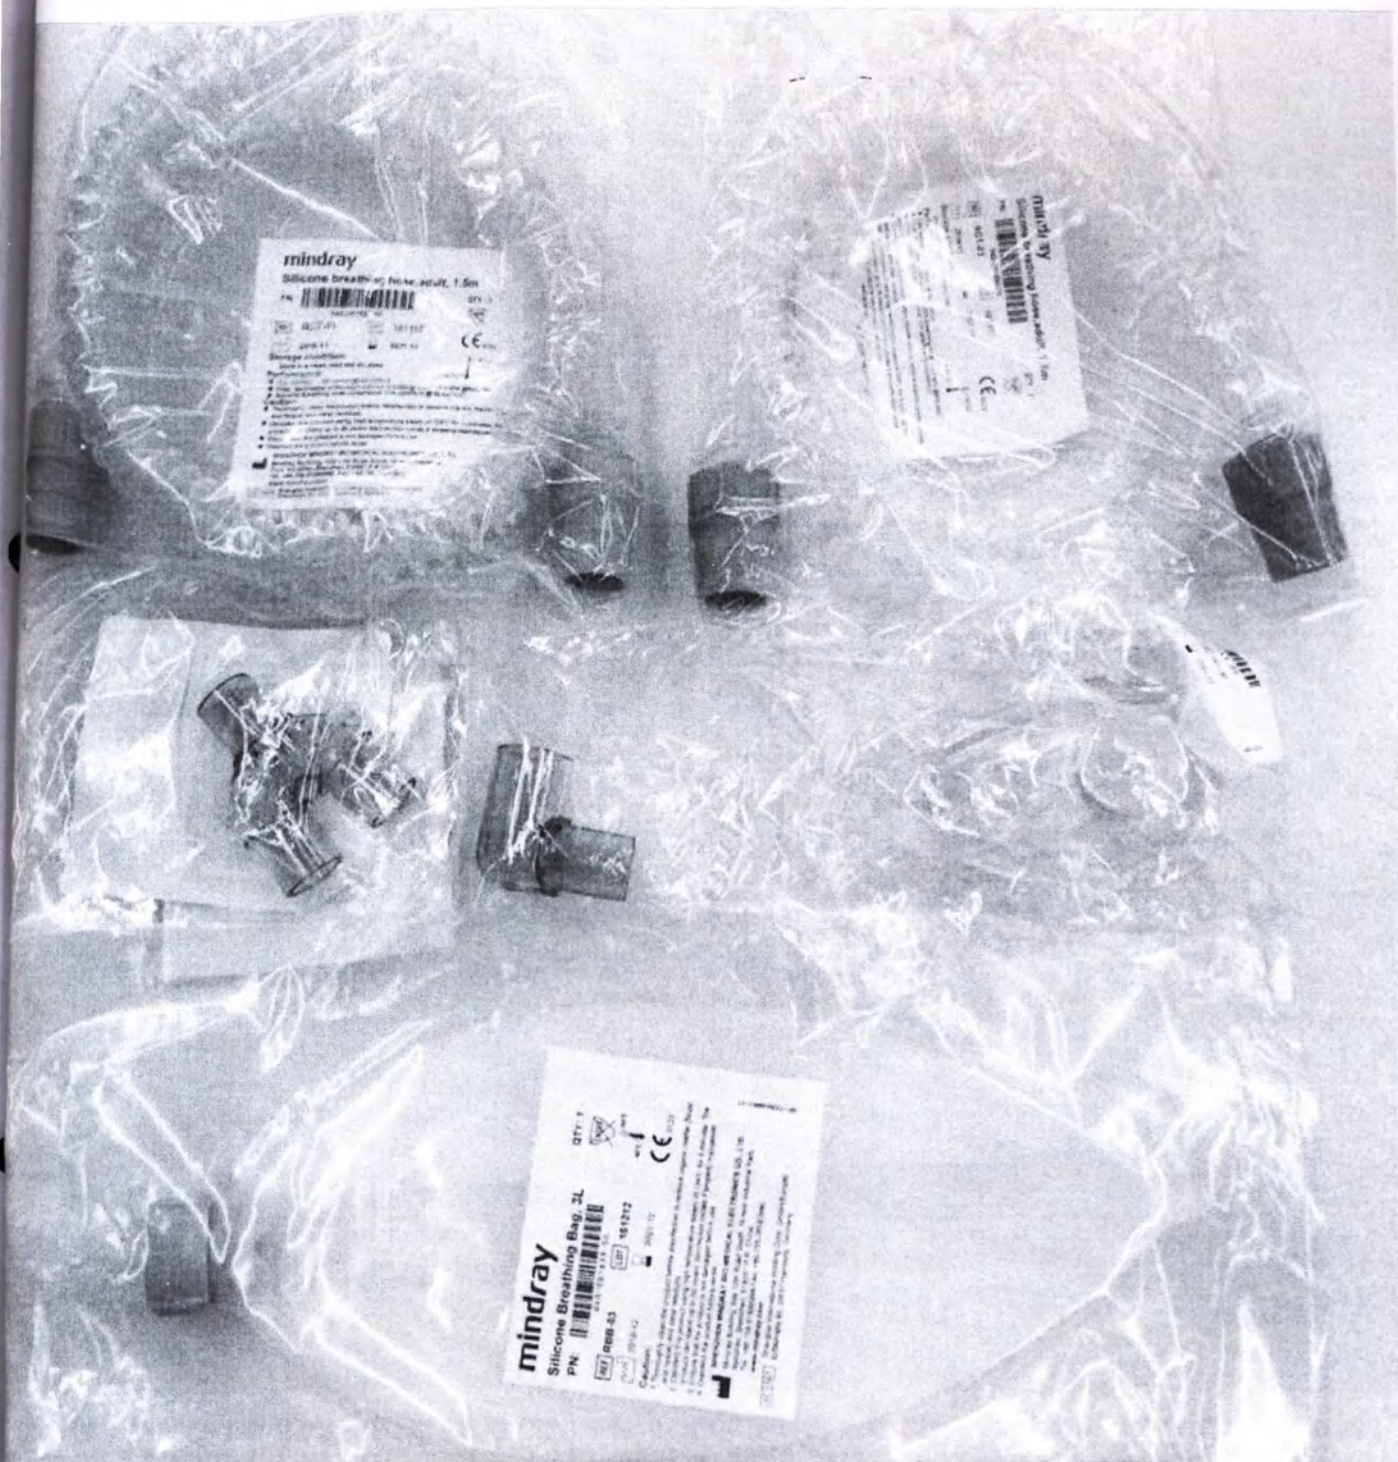


набор дыхательного контура, многоразовый, для взрослых, в составе: контур пациента, силикон, для взрослых, 1.5 м, дыхательный мешок, силикон, 3 л, 22F, маска дыхательная, силикон, для взрослых, размер 5, 22 мм, Y-образный коннектор, 22М, угловой коннектор, 22F, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

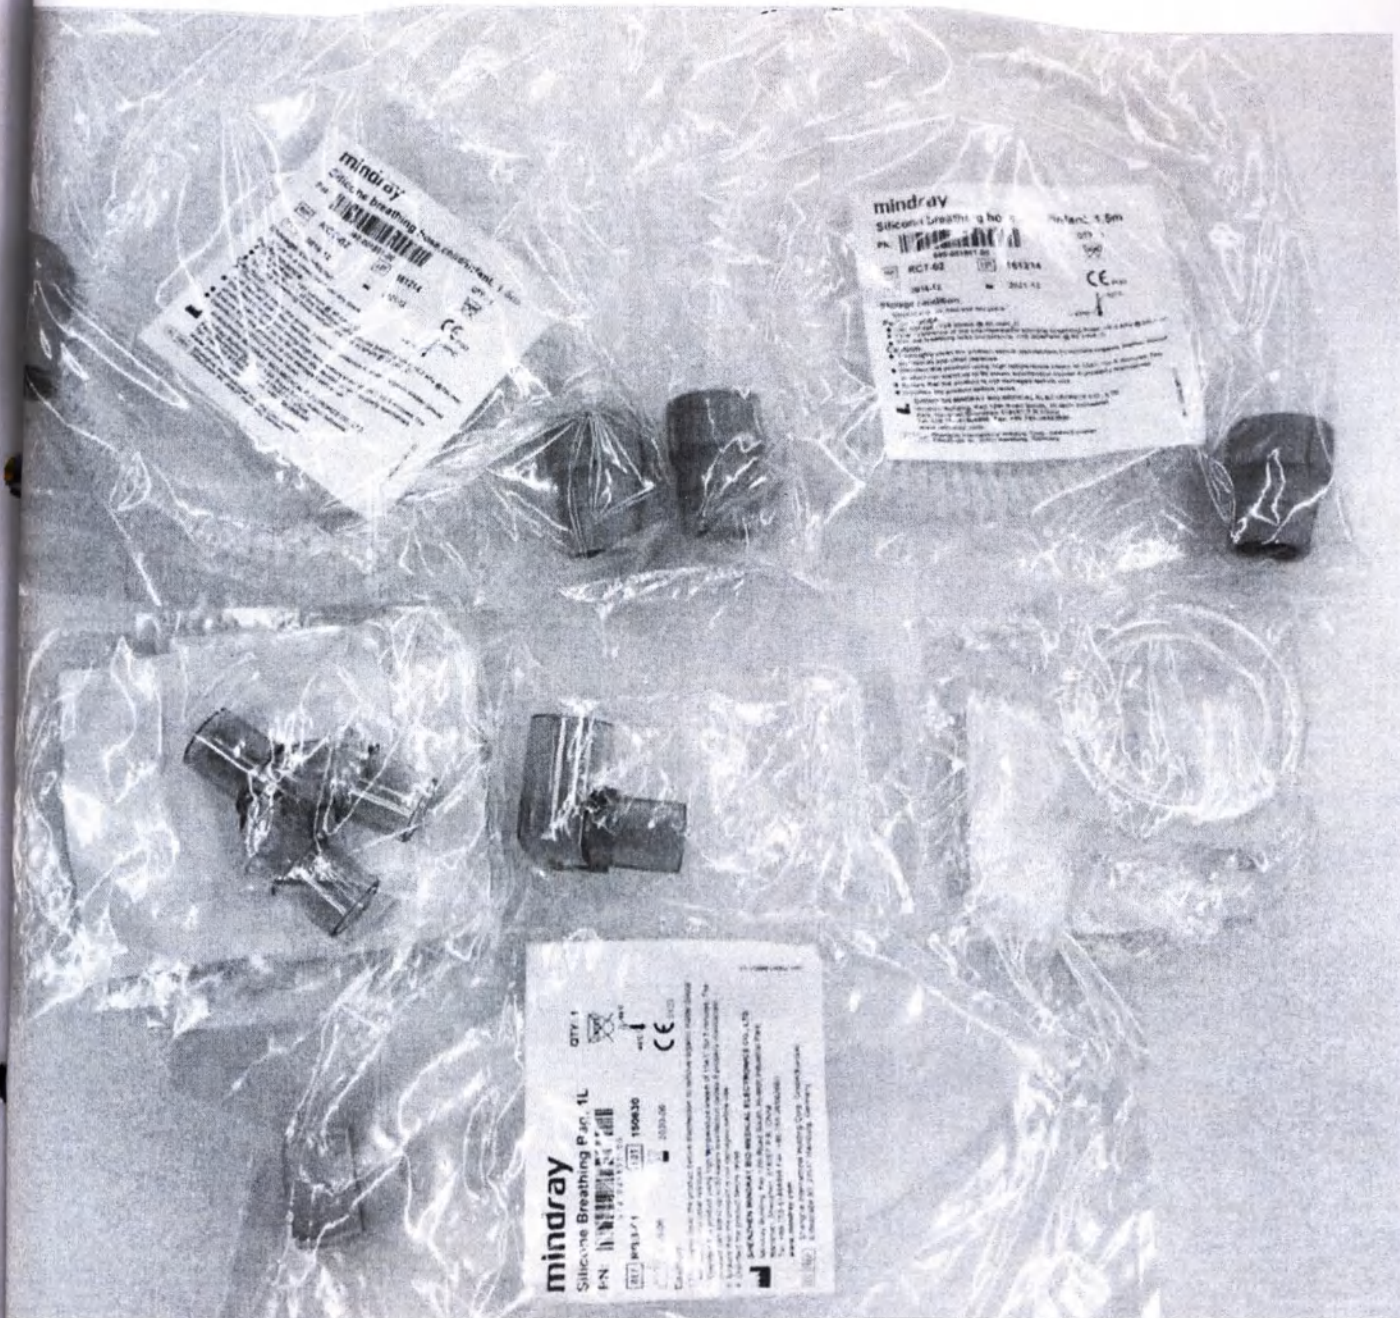

Набор дыхательного контура, многоразовый, для детей, в составе: контур пациента, силикон, для детей, 1,5 м, дыхательный мешок, силикон, 1 л, 22F, маска дыхательная, силикон, для детей, размер 2, 22 мм, Y-образный коннектор, 22М, угловой коннектор, 22F, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd., Китай.

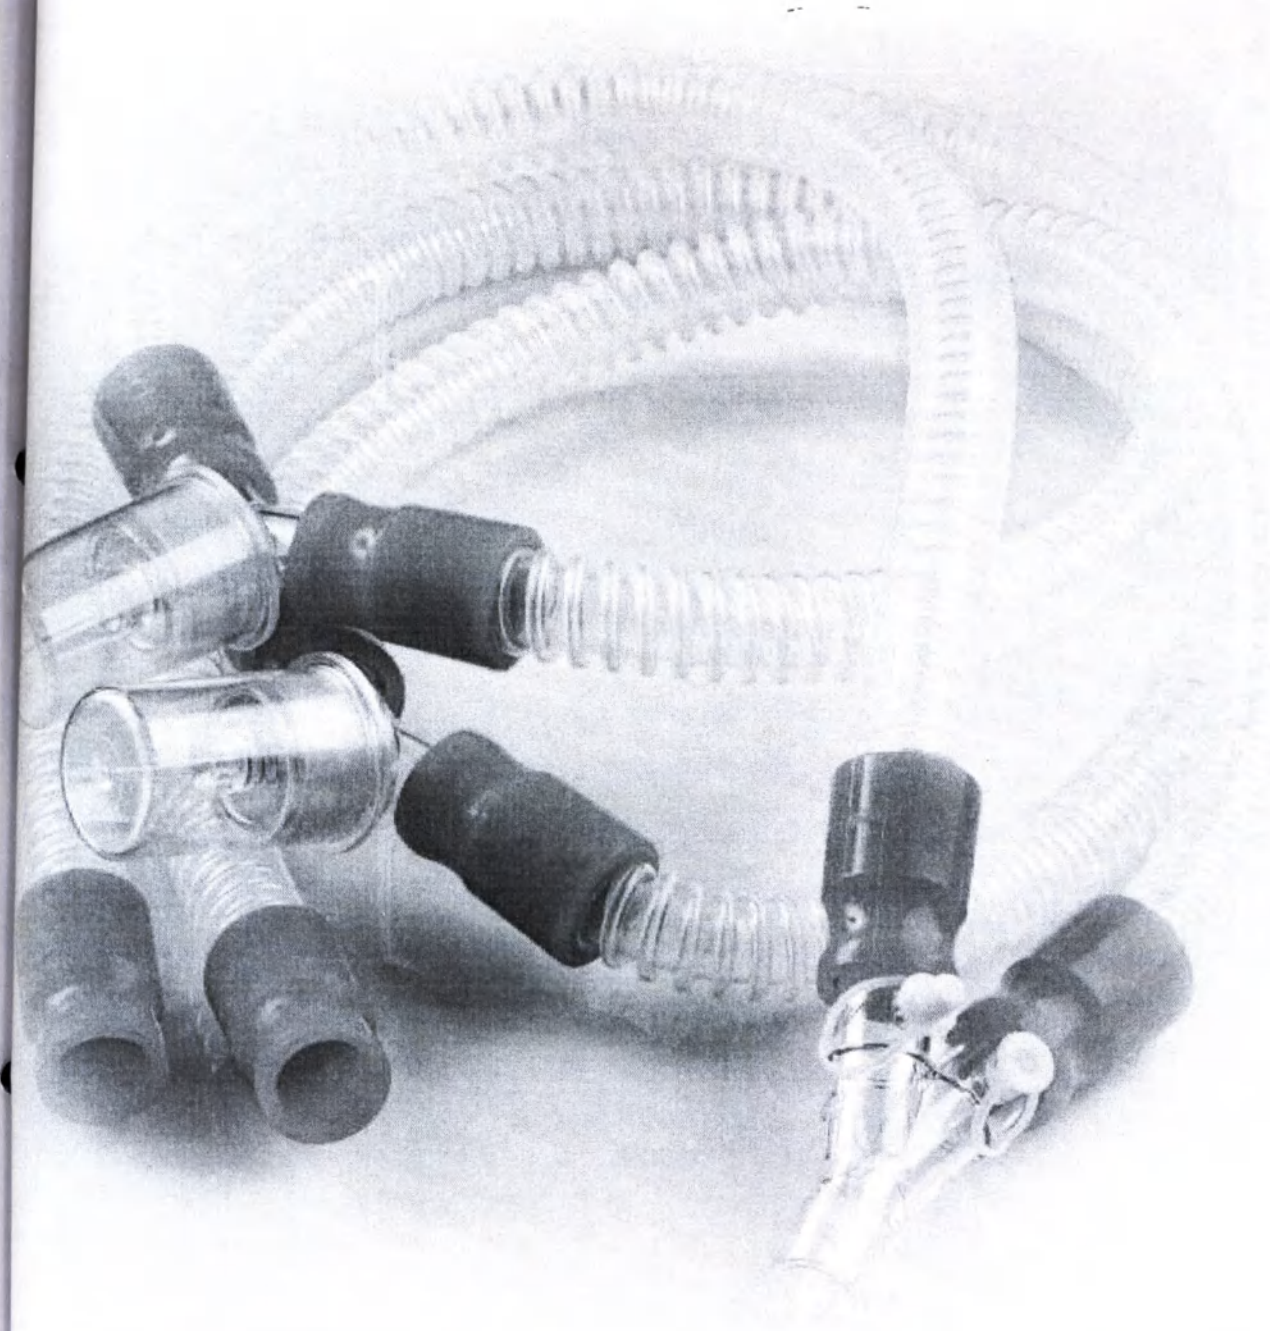


Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные (антимикробные) для взрослых, для детей, для новорожденных с обогревом или без с принадлежностями (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

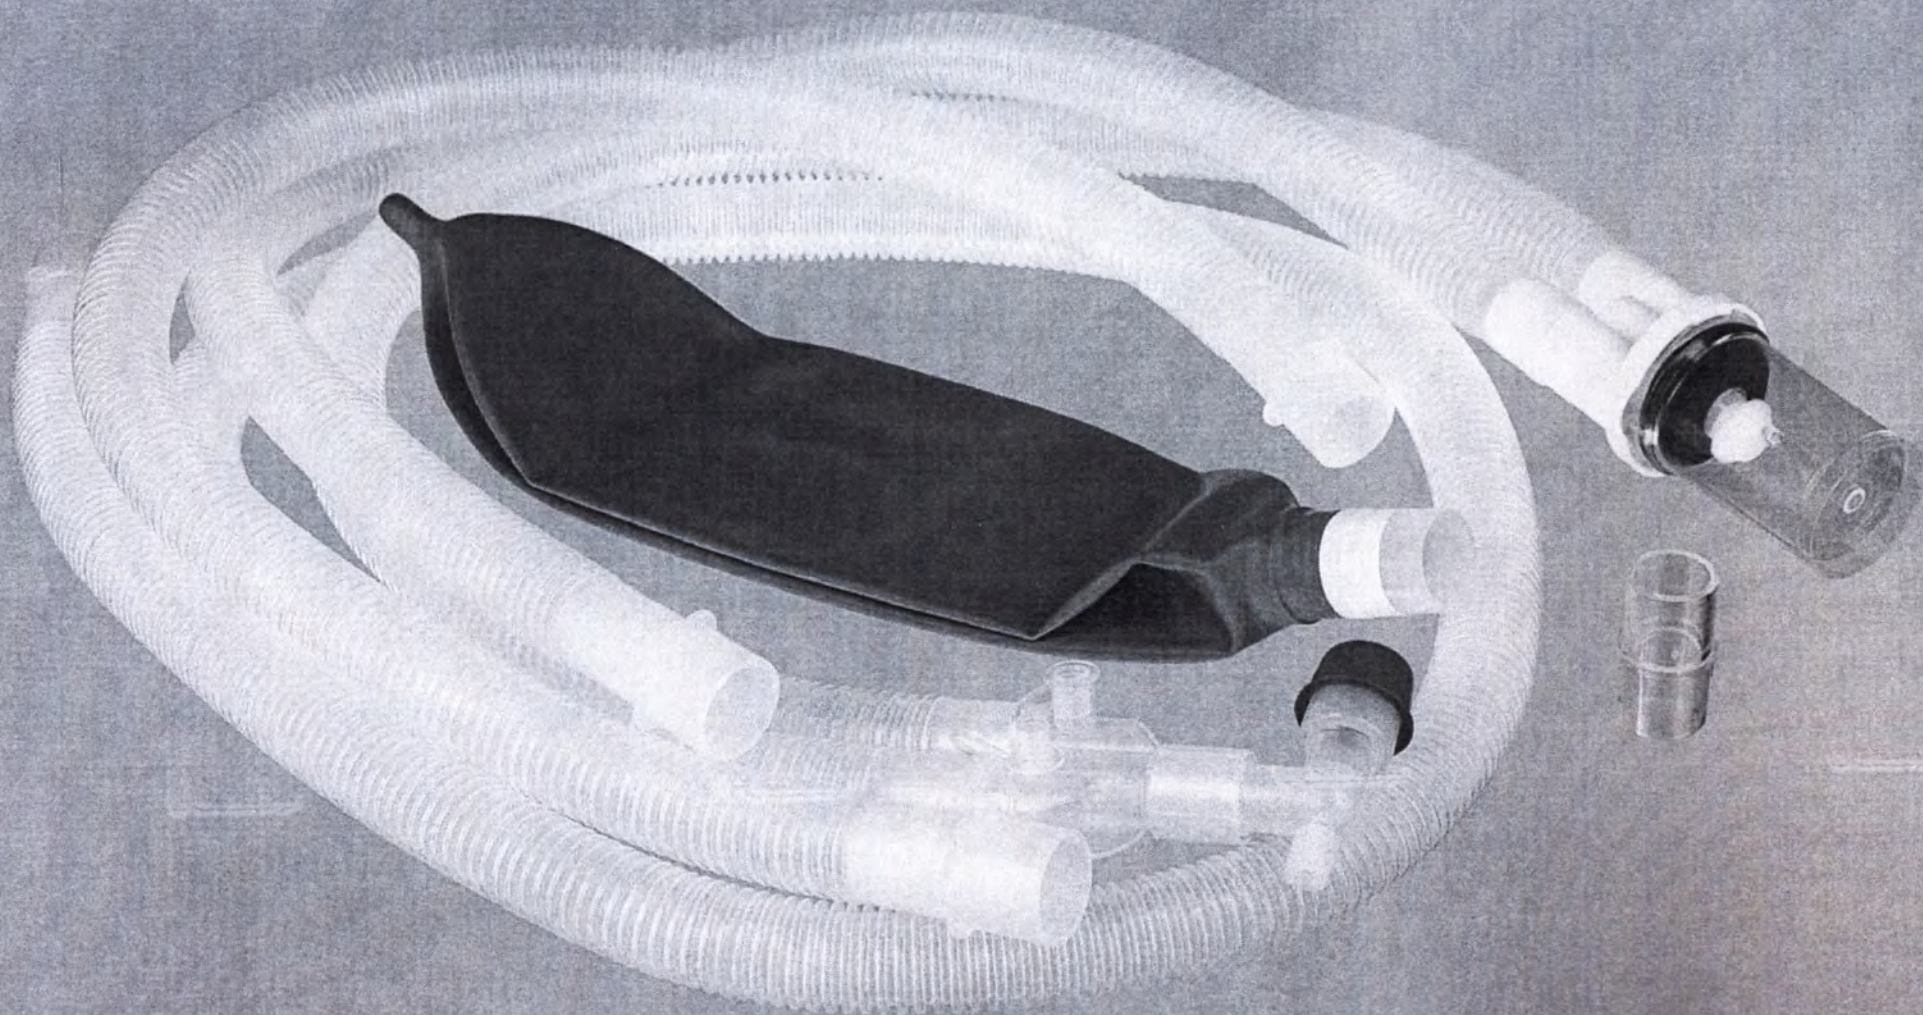


42. Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-"МС-1" по ТУ 9398-001-72474991-2005, РУ № ФСР 2010/07116, пр-ва ООО «Медсиликон», Россия.


91568
17.11.2020

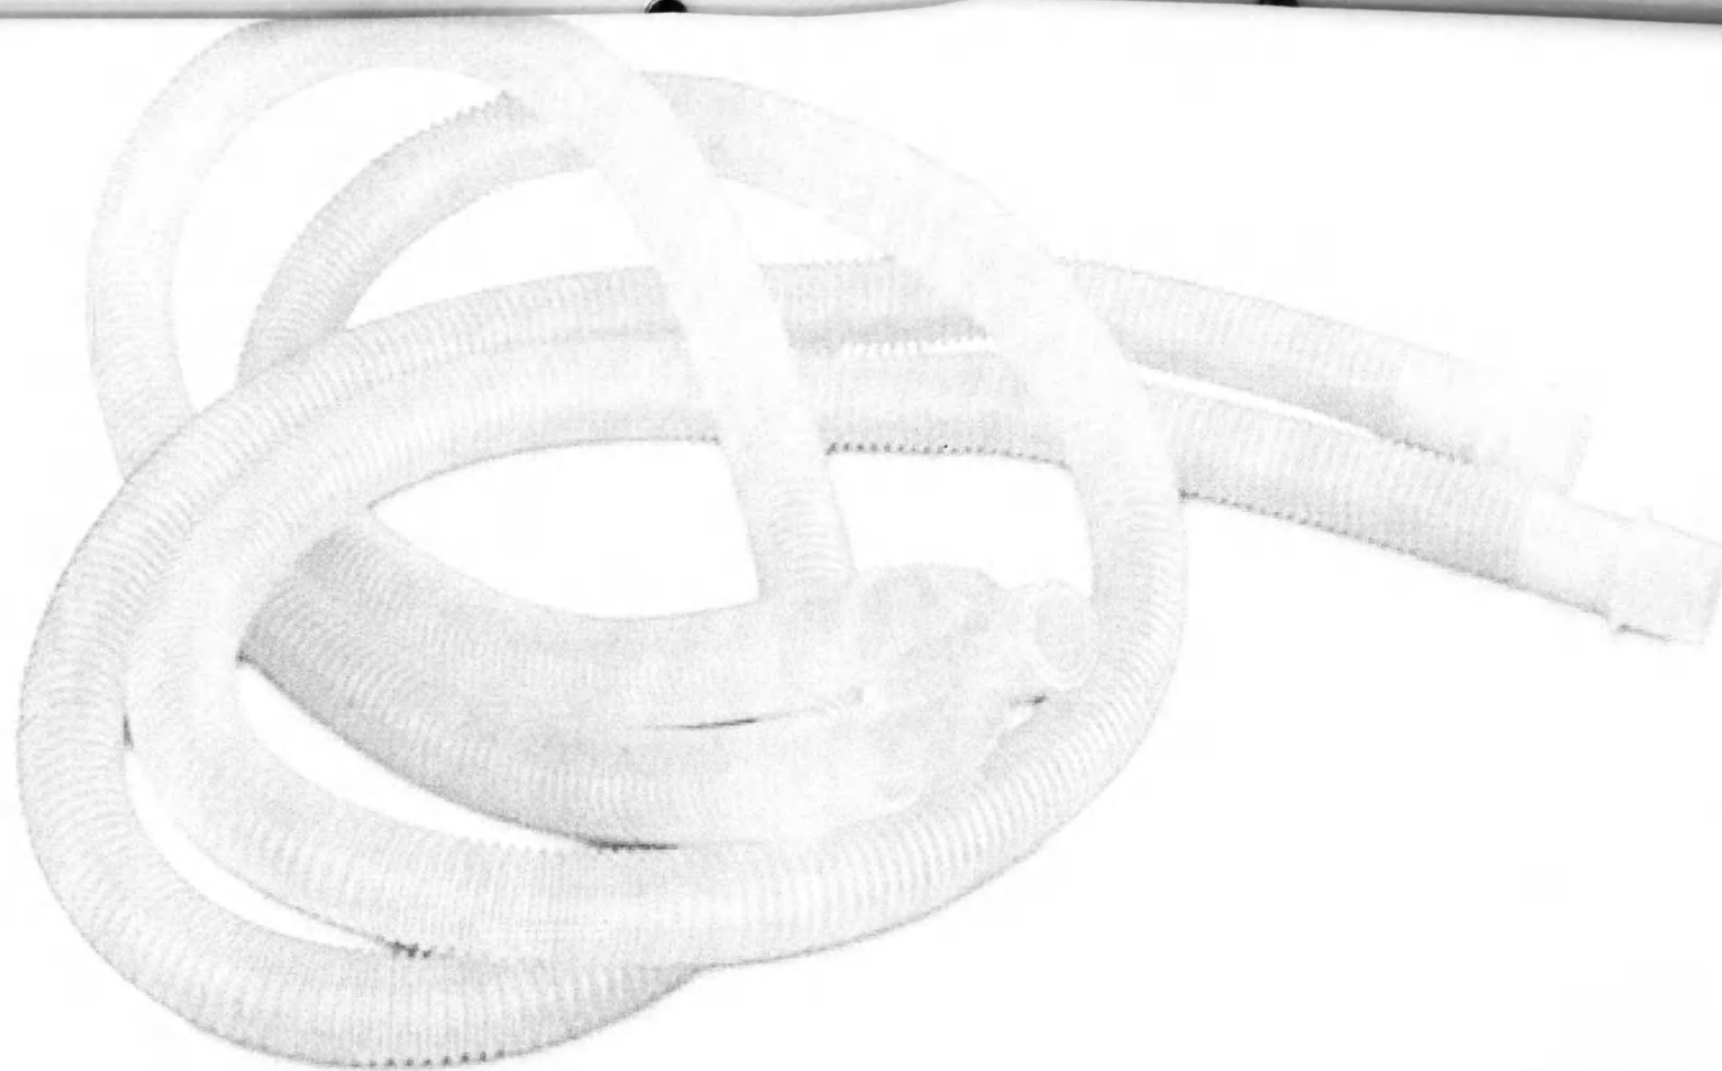

42. Контуры и трубки дыхательные, эндотрахеальные, трахеостомические (виды 275820; 185610; 185600; 136260; 136500), РУ № ФСЗ 2011/11170, пр-ва «Covidien Llc», США.

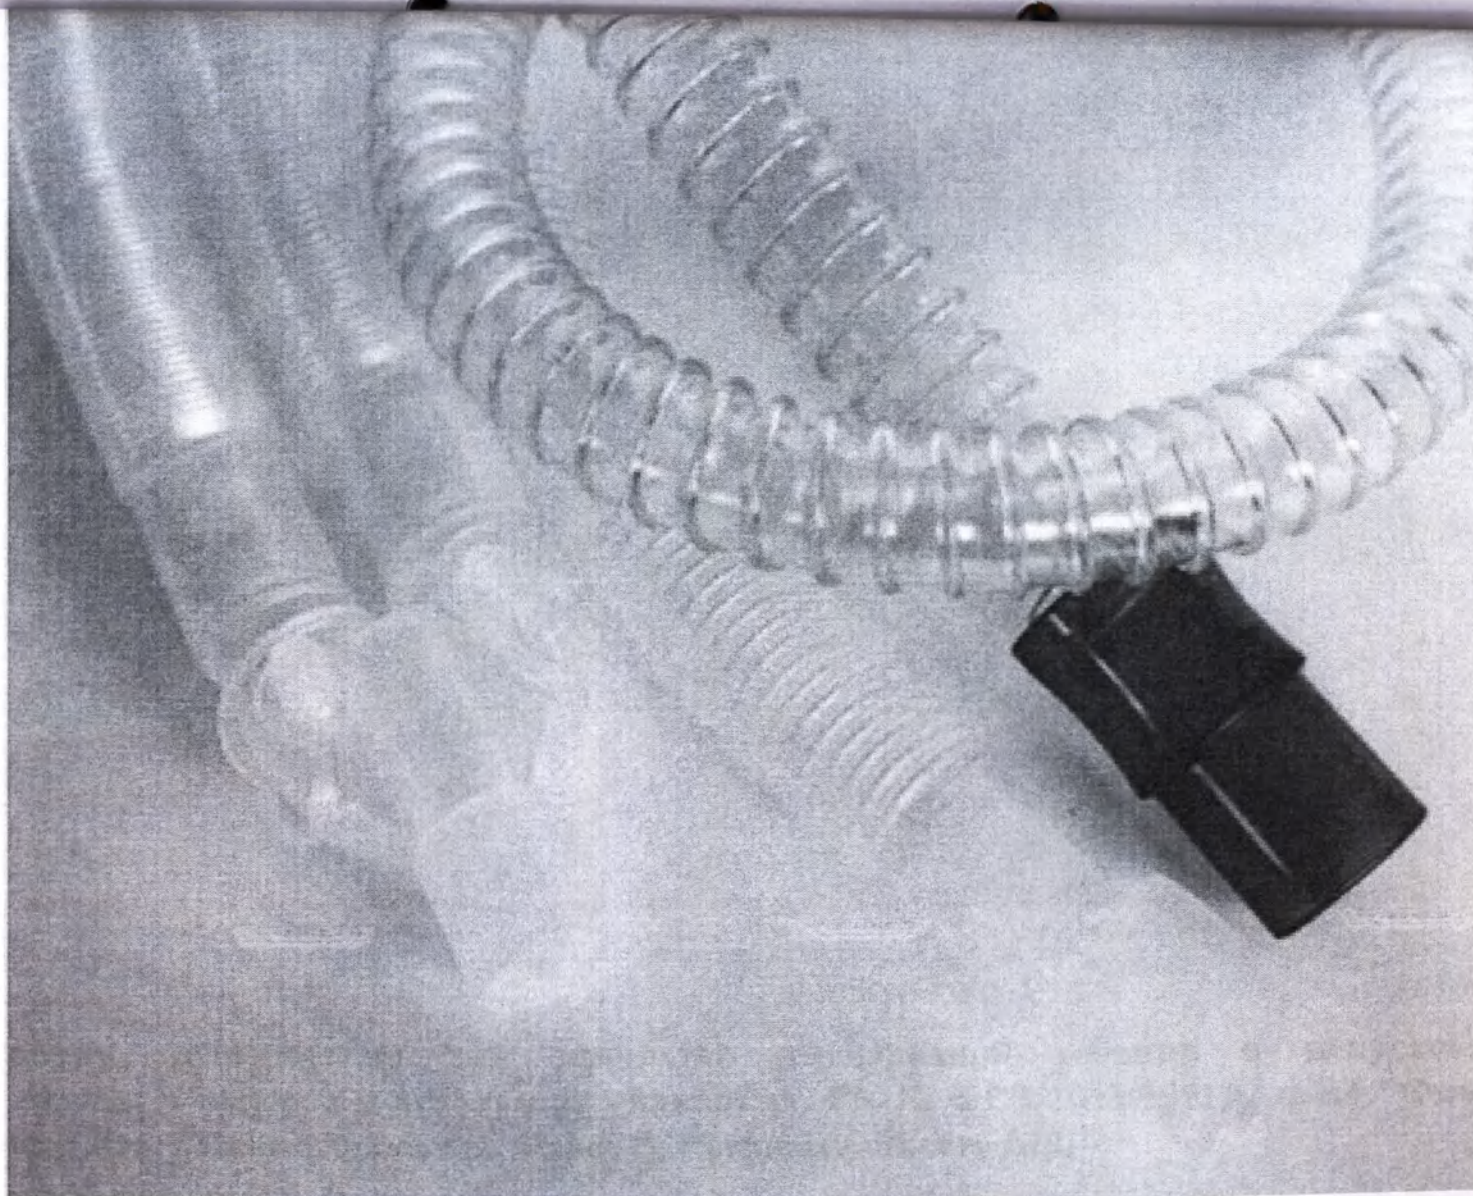

**42. Контур дыхательный, РУ №ФСЗ 2012/12412,
пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия,**

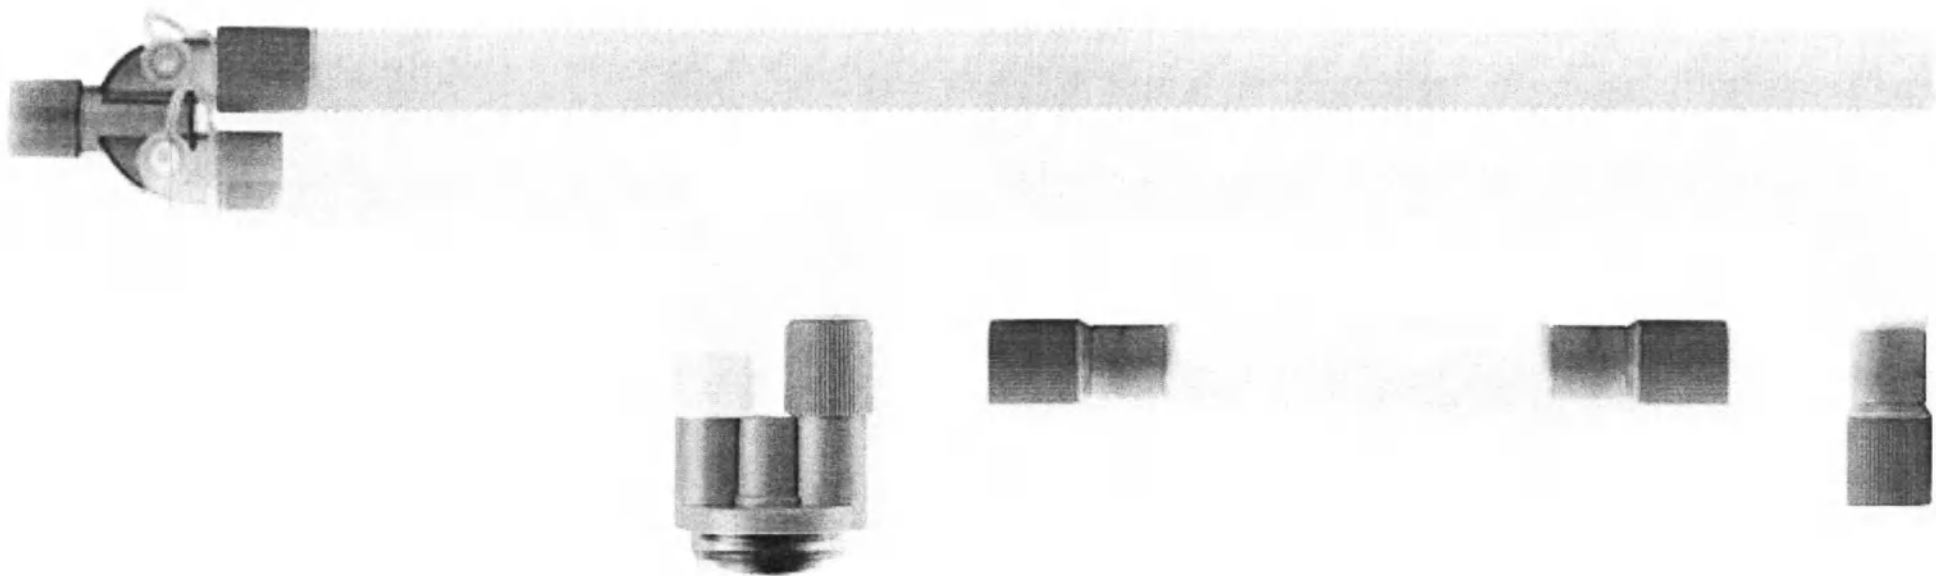


42. Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках, РУ № ФСЗ 2011/09111, пр-ва "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд", Новая Зеландия, Fisher & Paykel Healthcare Ltd.




43. Маски Air-soft, с клапаном: для младенцев, большая, размер 0; для младенцев, большая, размер 1; для детей, размер 2; для детей, большая, размер 3; для взрослых, размер 4; для взрослых, большая, размер 5, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



91568
17.11.2020

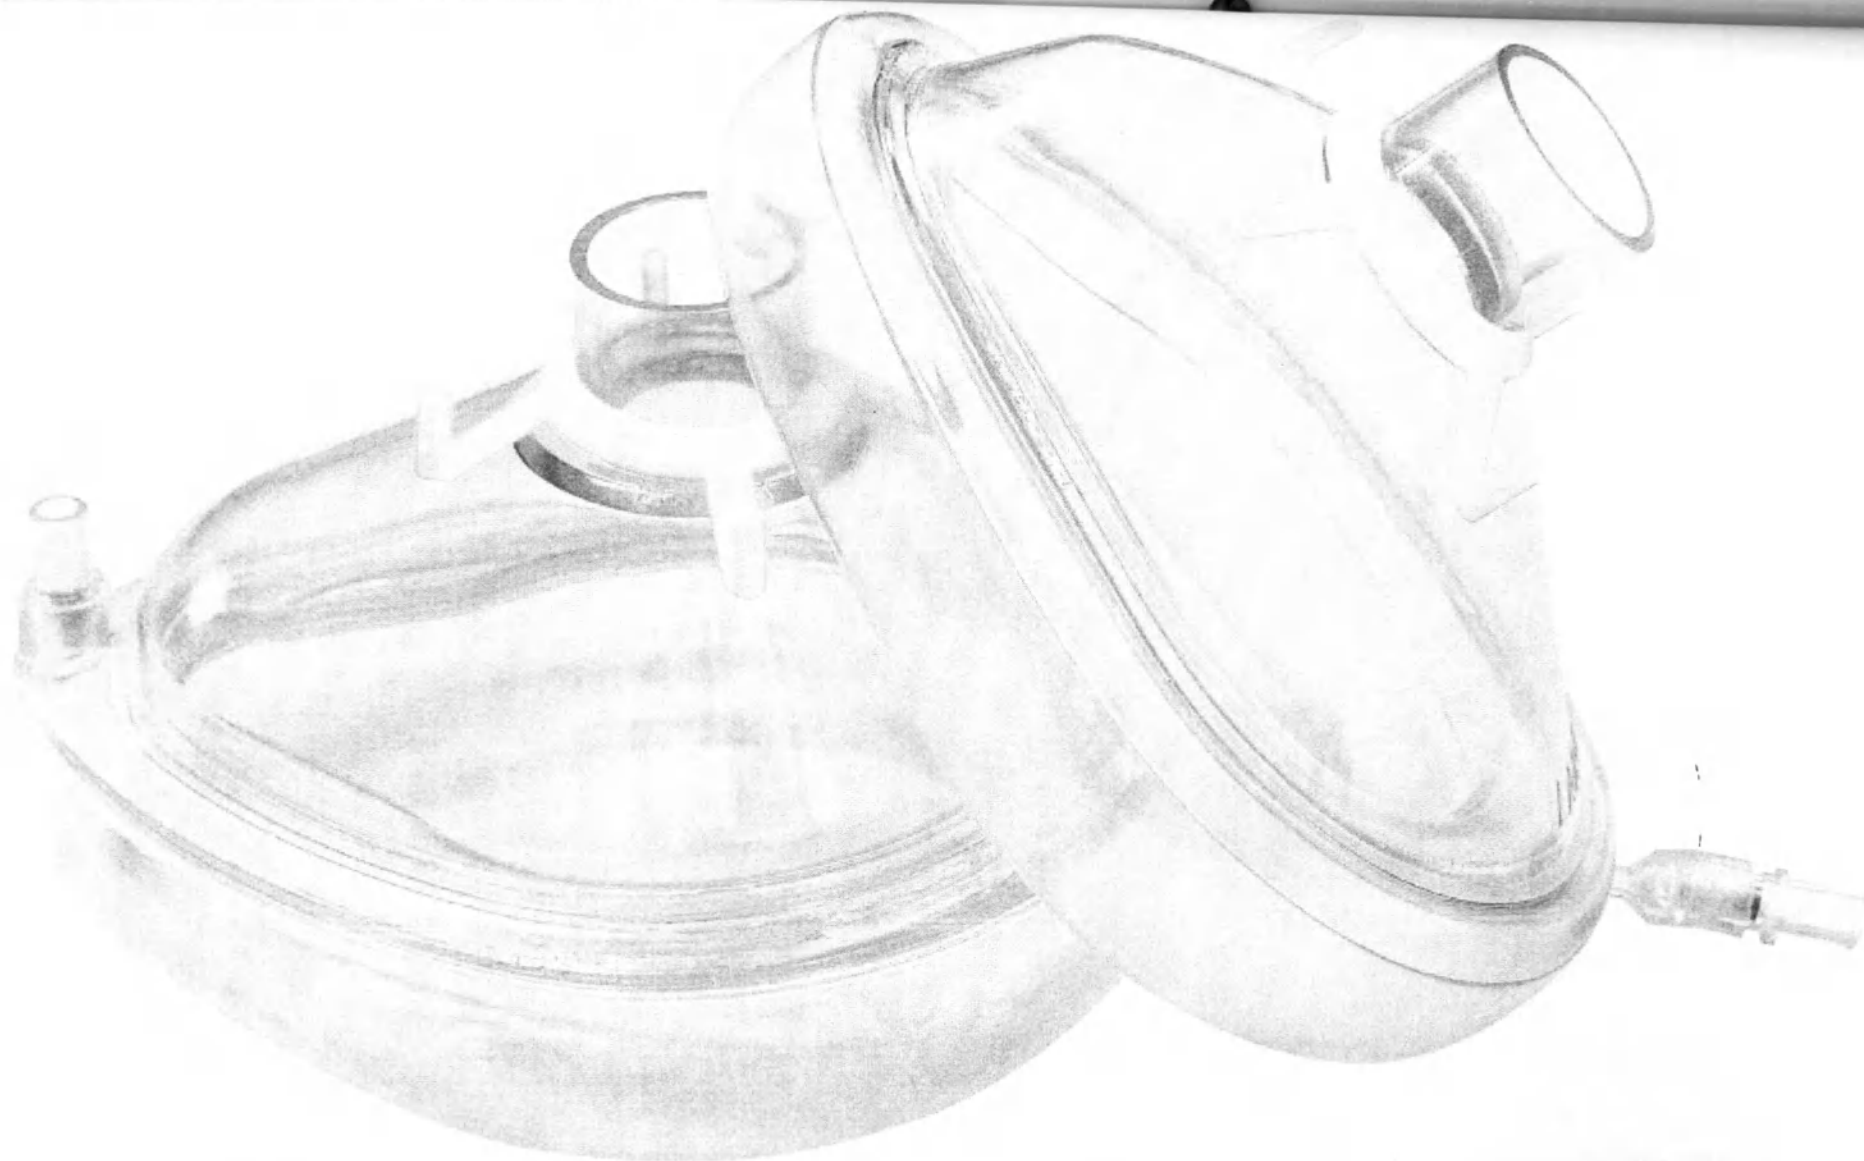


**44. Маска наркозная, РУ № ФСЗ 2012/12412,
пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия.**

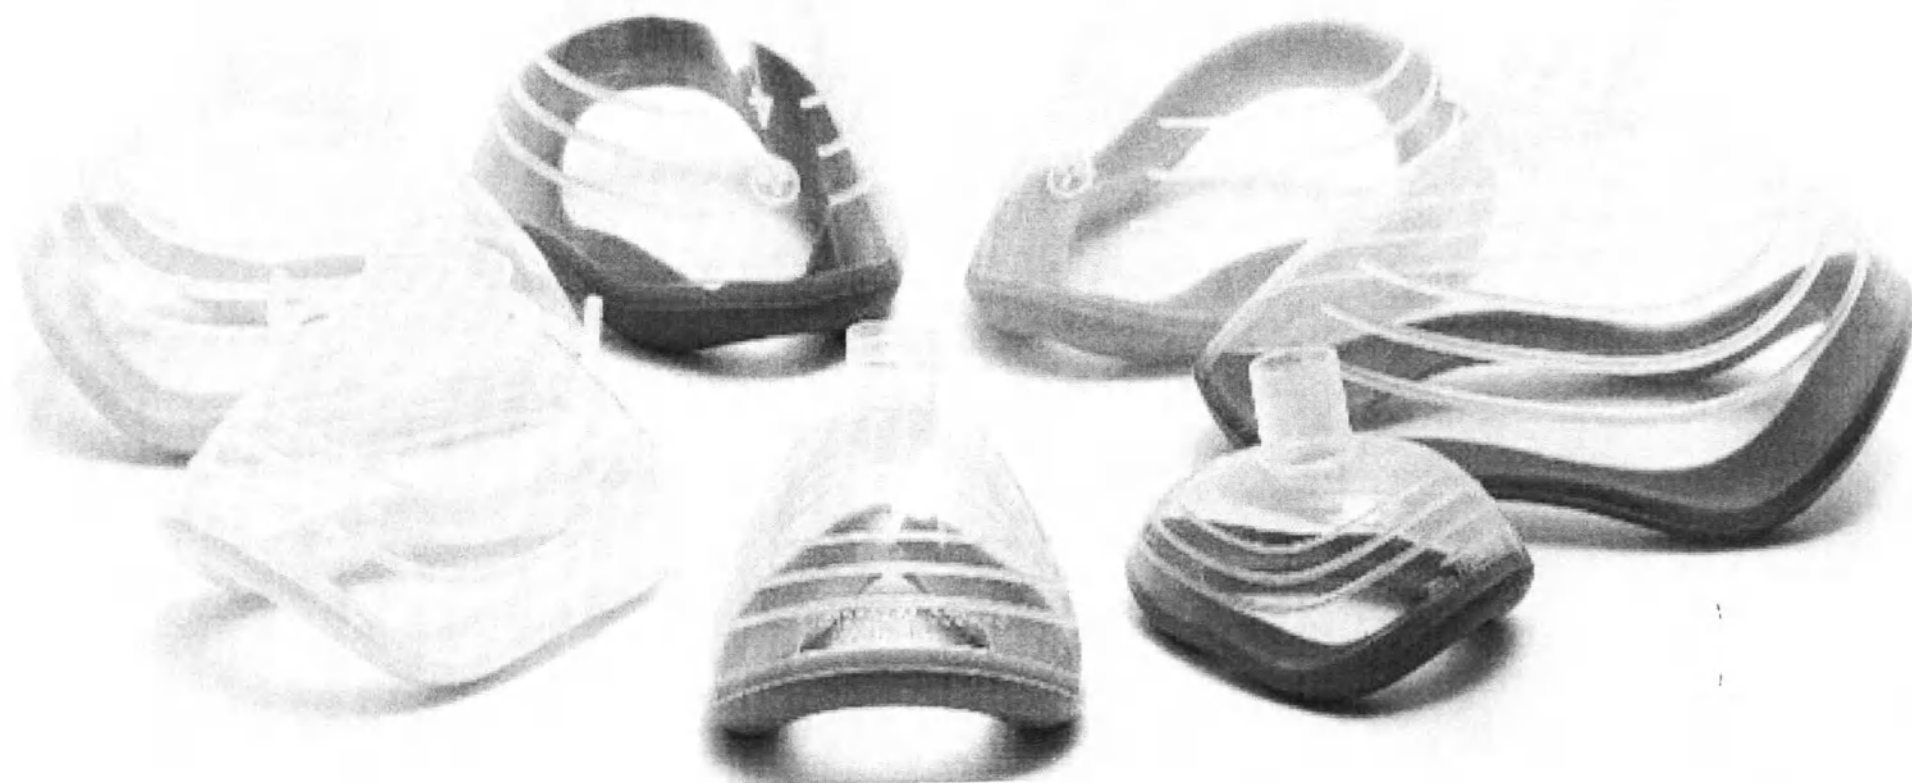


44. Анестезиологические маски, размерами 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6: QuadraLite, EcoMask II, ароматизированные/ неароматизированные лицевые маски, экономичные анестезиологические лицевые маски, анестезиологические бронхоскопические лицевые маски, маски лицевые анатомические, маски ClearFlex, маски Rendell Baker (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

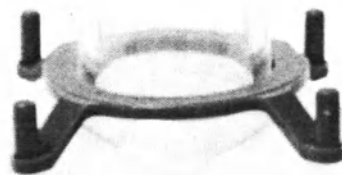


44. Маски (виды 275780; 109730; 109740; 271370), РУ № ФСЗ 2011/11170, пр-ва «Covidien Llc», США.

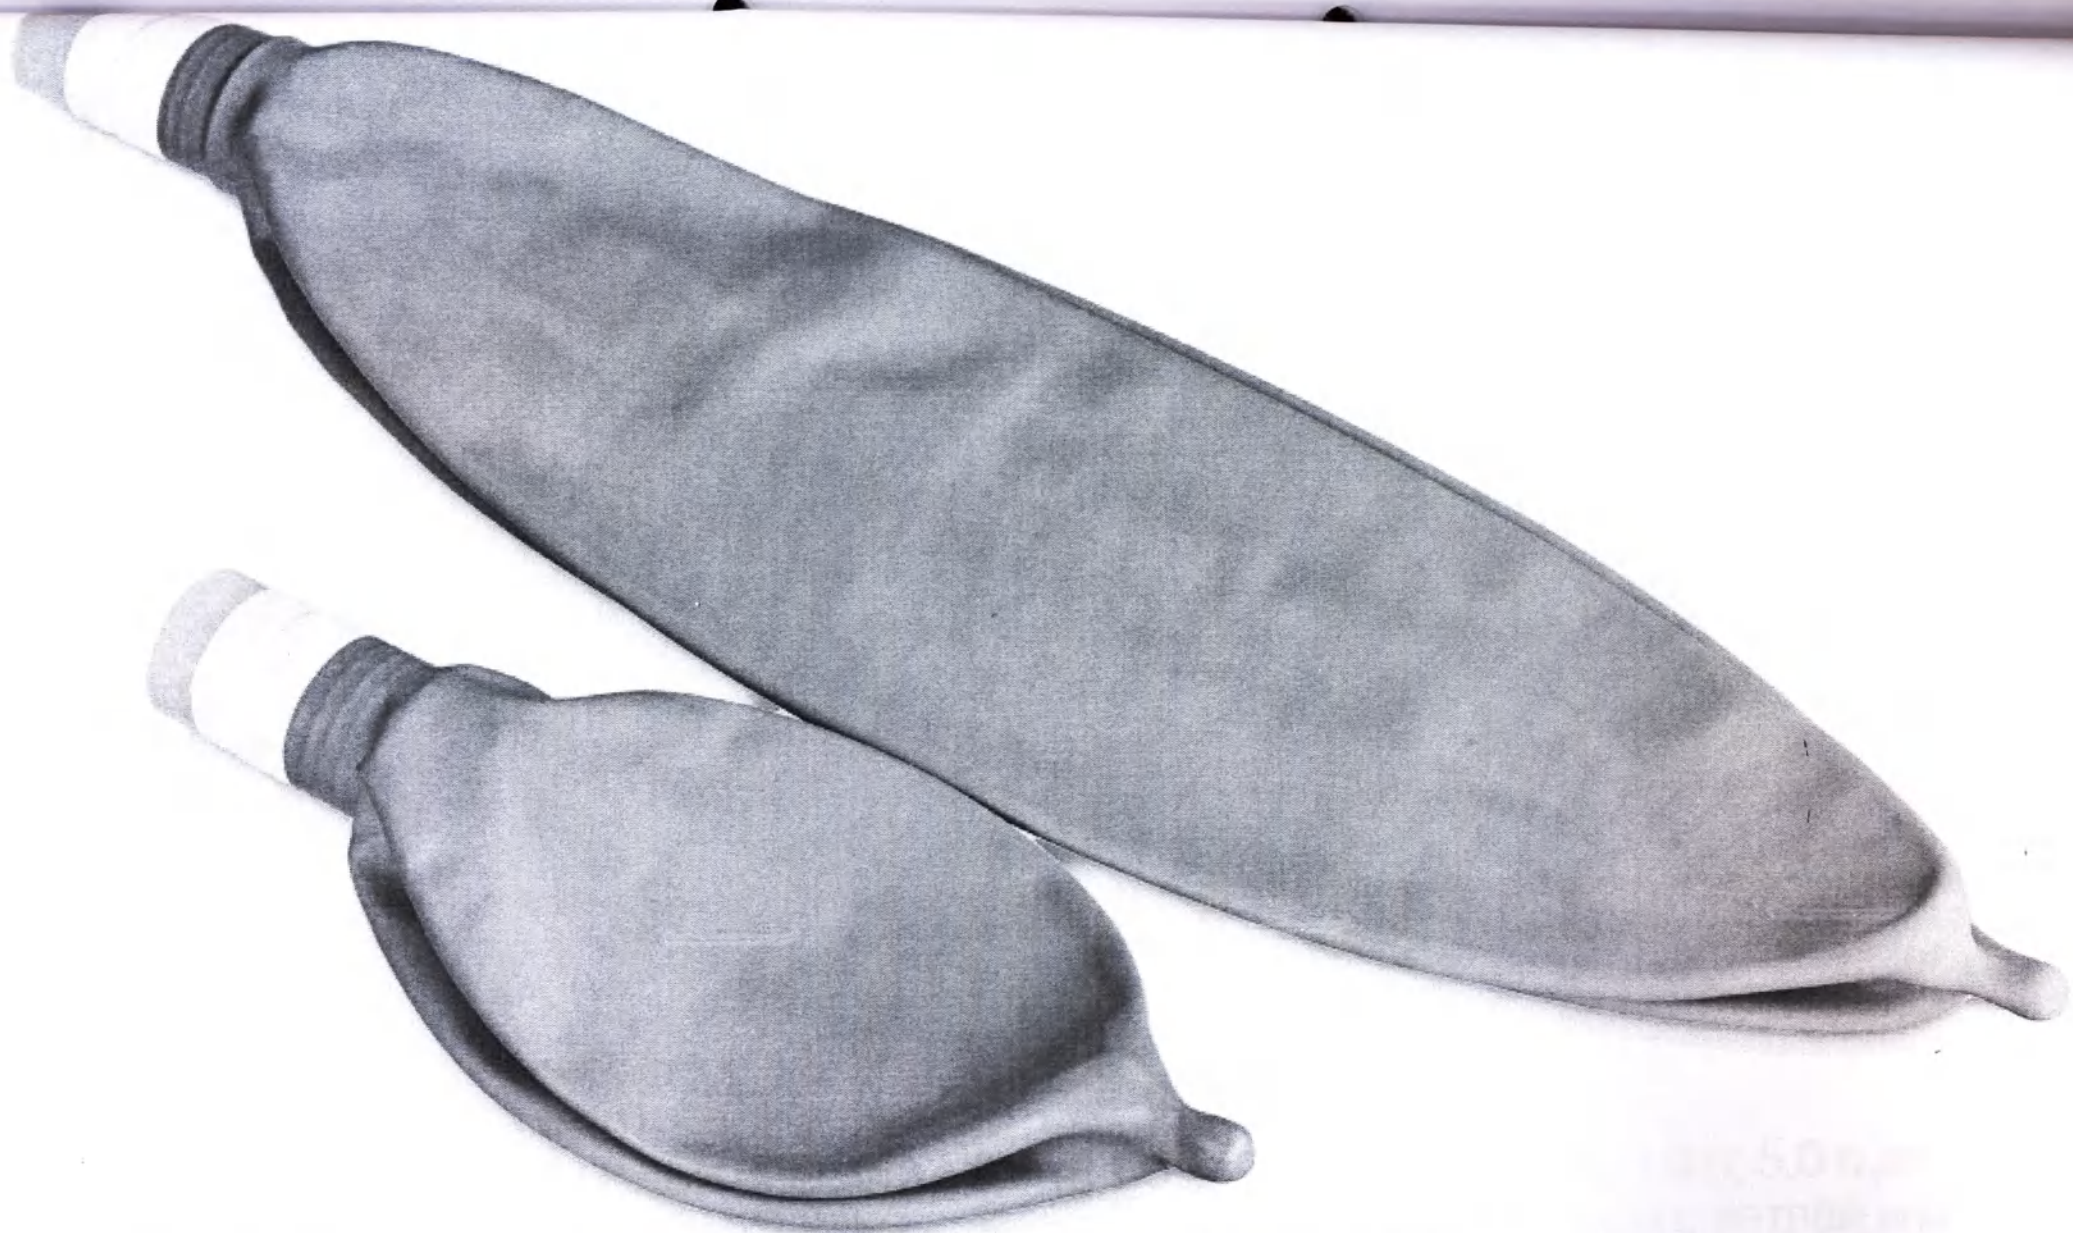

45. Мешки дыхательные (вид 283460), РУ № ФСЗ 2011/11170, пр-ва
«Covidien Llc», США.

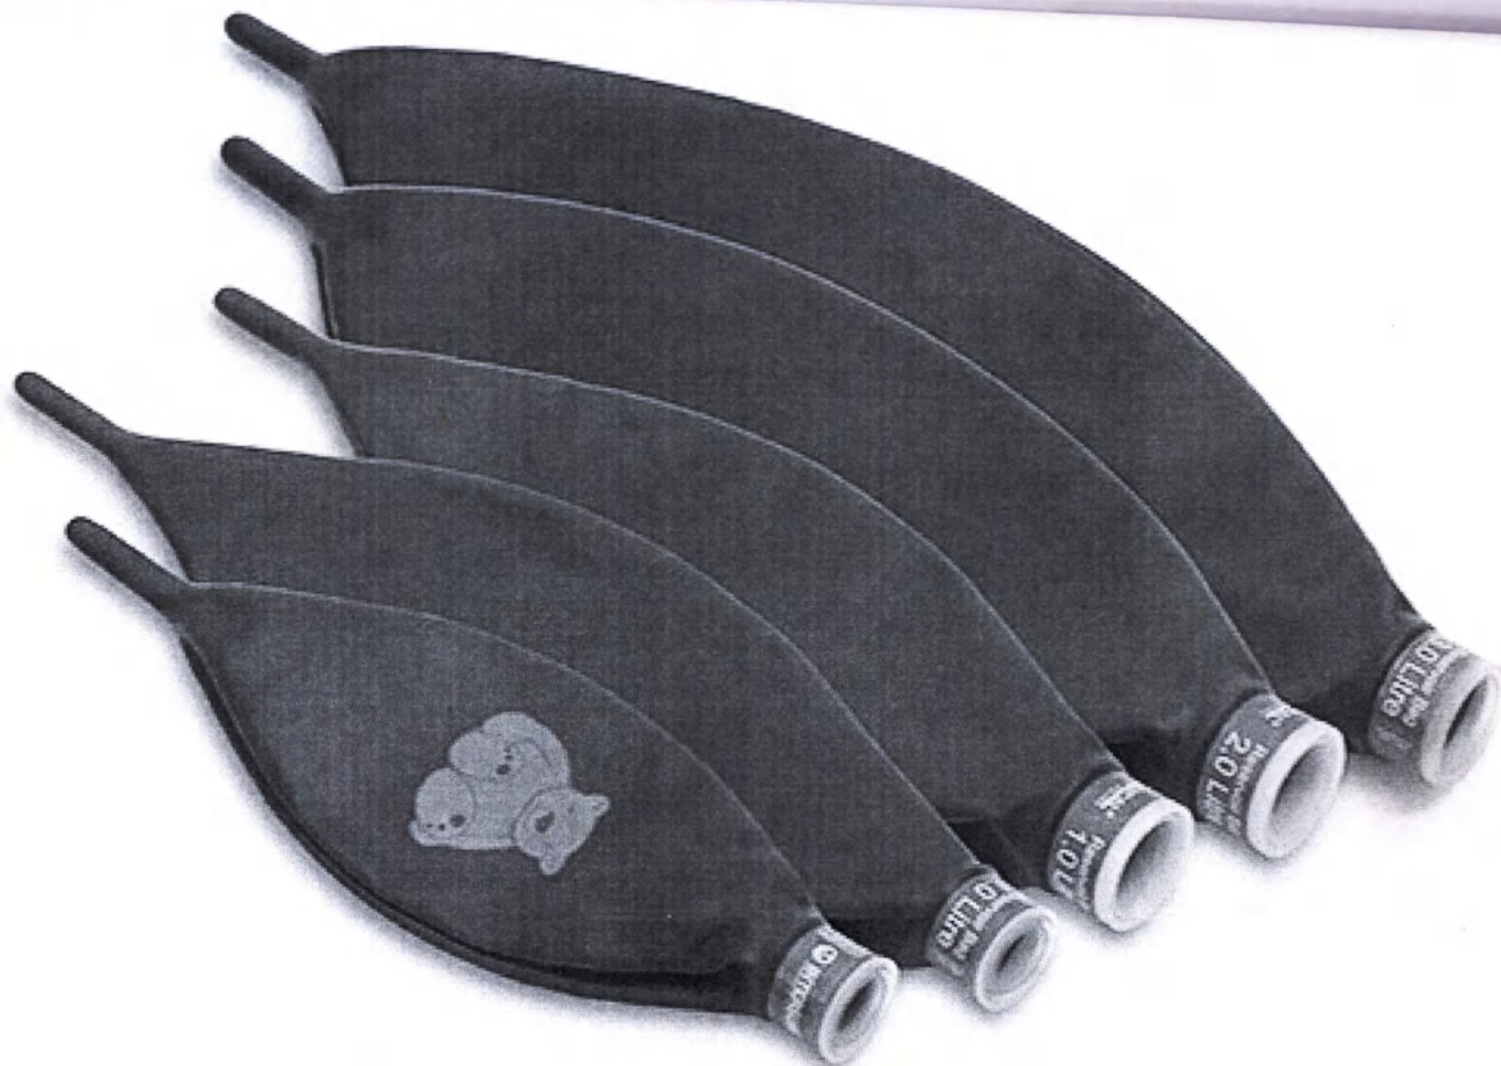

45. Дыхательные мешки объёмом: 0.5 л; 1.0 л; 1.3 л; 2.0 л; 2.3 л; 3.0 л; 5.0 л для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с закрытым концом; для аппаратуры (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

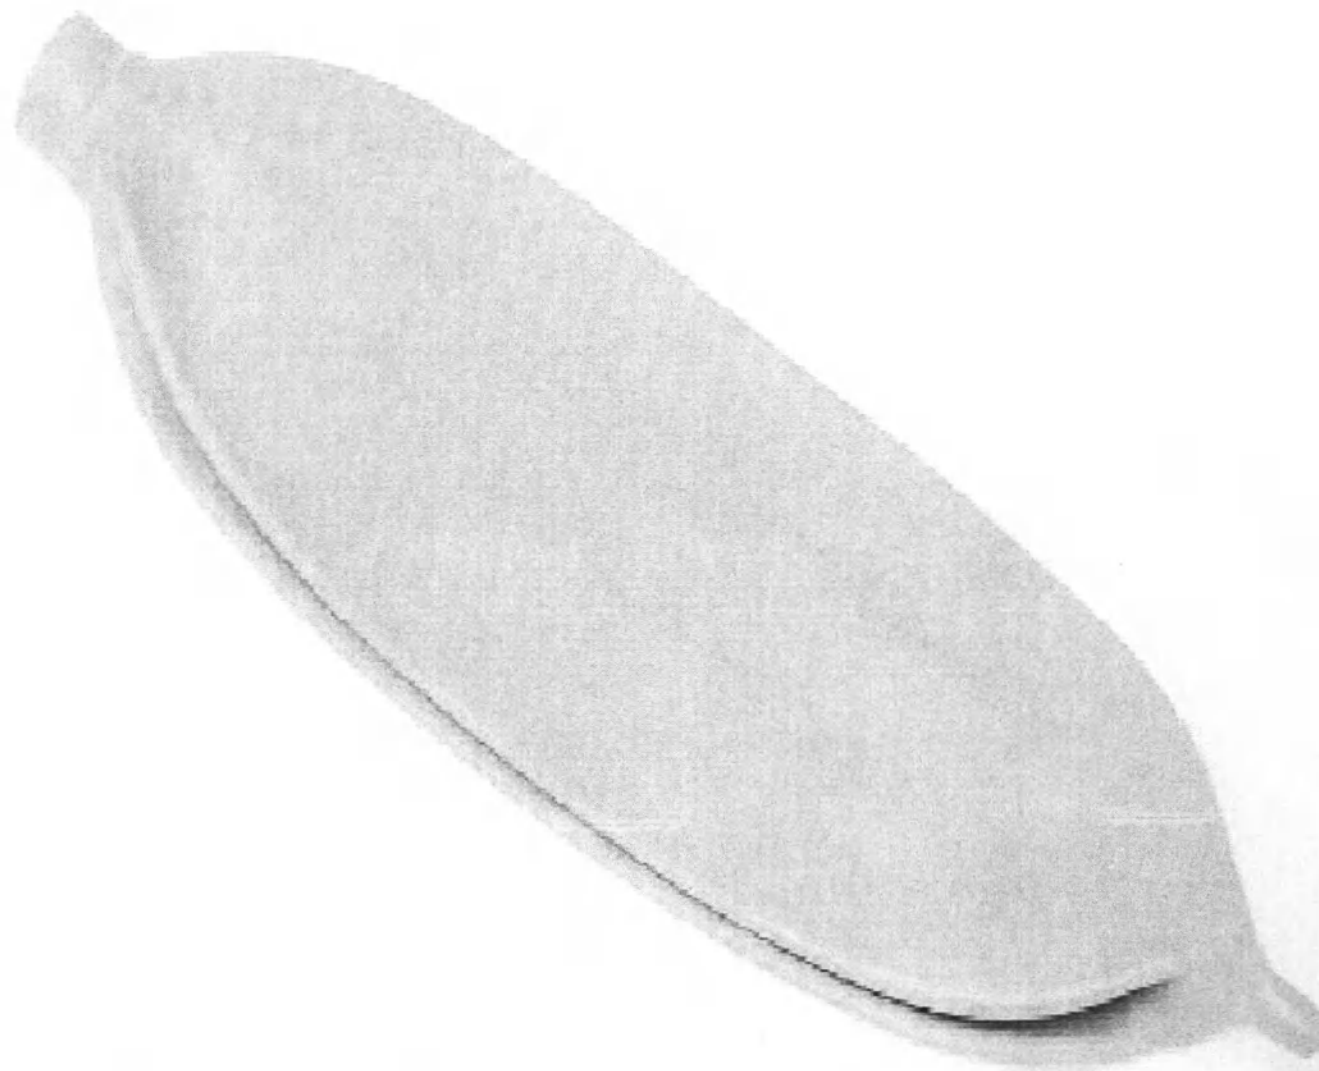

**45. Мешок дыхательный для вентиляции, РУ № ФСЗ
2012/12412, пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия.**



46. Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры без соединителей: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания.

mindray

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

Rechargeable
Li-ion Battery Pack

CAUTION

Risk of fire, explosion, or burns.
Do not disassemble, crush, puncture the battery or cause it to short circuit.
Do not place the battery in fire or water.
Do not place the battery in an environment whose temperature is above 60°C(140°F).
Store the battery in the -20°C(-4°F) to 60°C(140°F) environment.
Use the specified charger only.
Read instructions for use.
Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F).

警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。
切勿拆卸、挤压、刺破或使电池短路。
切勿放置于火中或水中。
切勿放置于60°C(140°F)以上的高温环境中。
在-20°C(-4°F)到60°C(140°F)温度下存储。
只能使用指定的充电器。
阅读本产品的操作说明。
推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。

可充电锂离子电池
Model(型号): LI23S002A
DC 11.1V $\approx$ 4500mAh
49.95Wh




MADE IN CHINA
中国制造



47. Батарея аккумуляторная Li-ion, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.


91568
17.11.2020

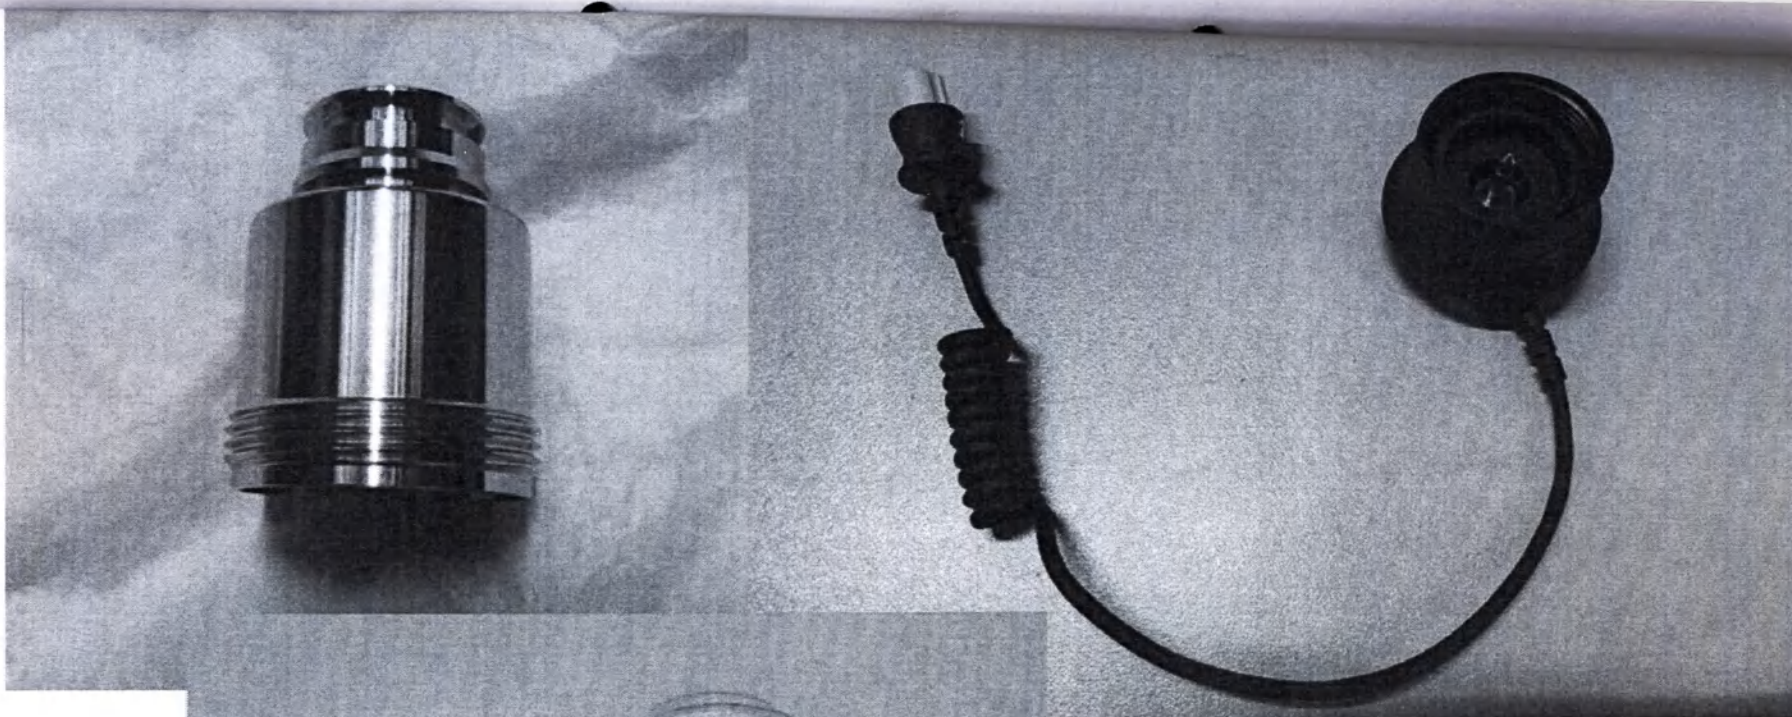

48. Набор для мониторинга концентрации кислорода: датчик кислородный, пр-ва EnviteC-Wismar GmbH, Германия, кабель для датчика кислородного, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




49. Трубка пассивного вывода анестетического газа,
р-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,

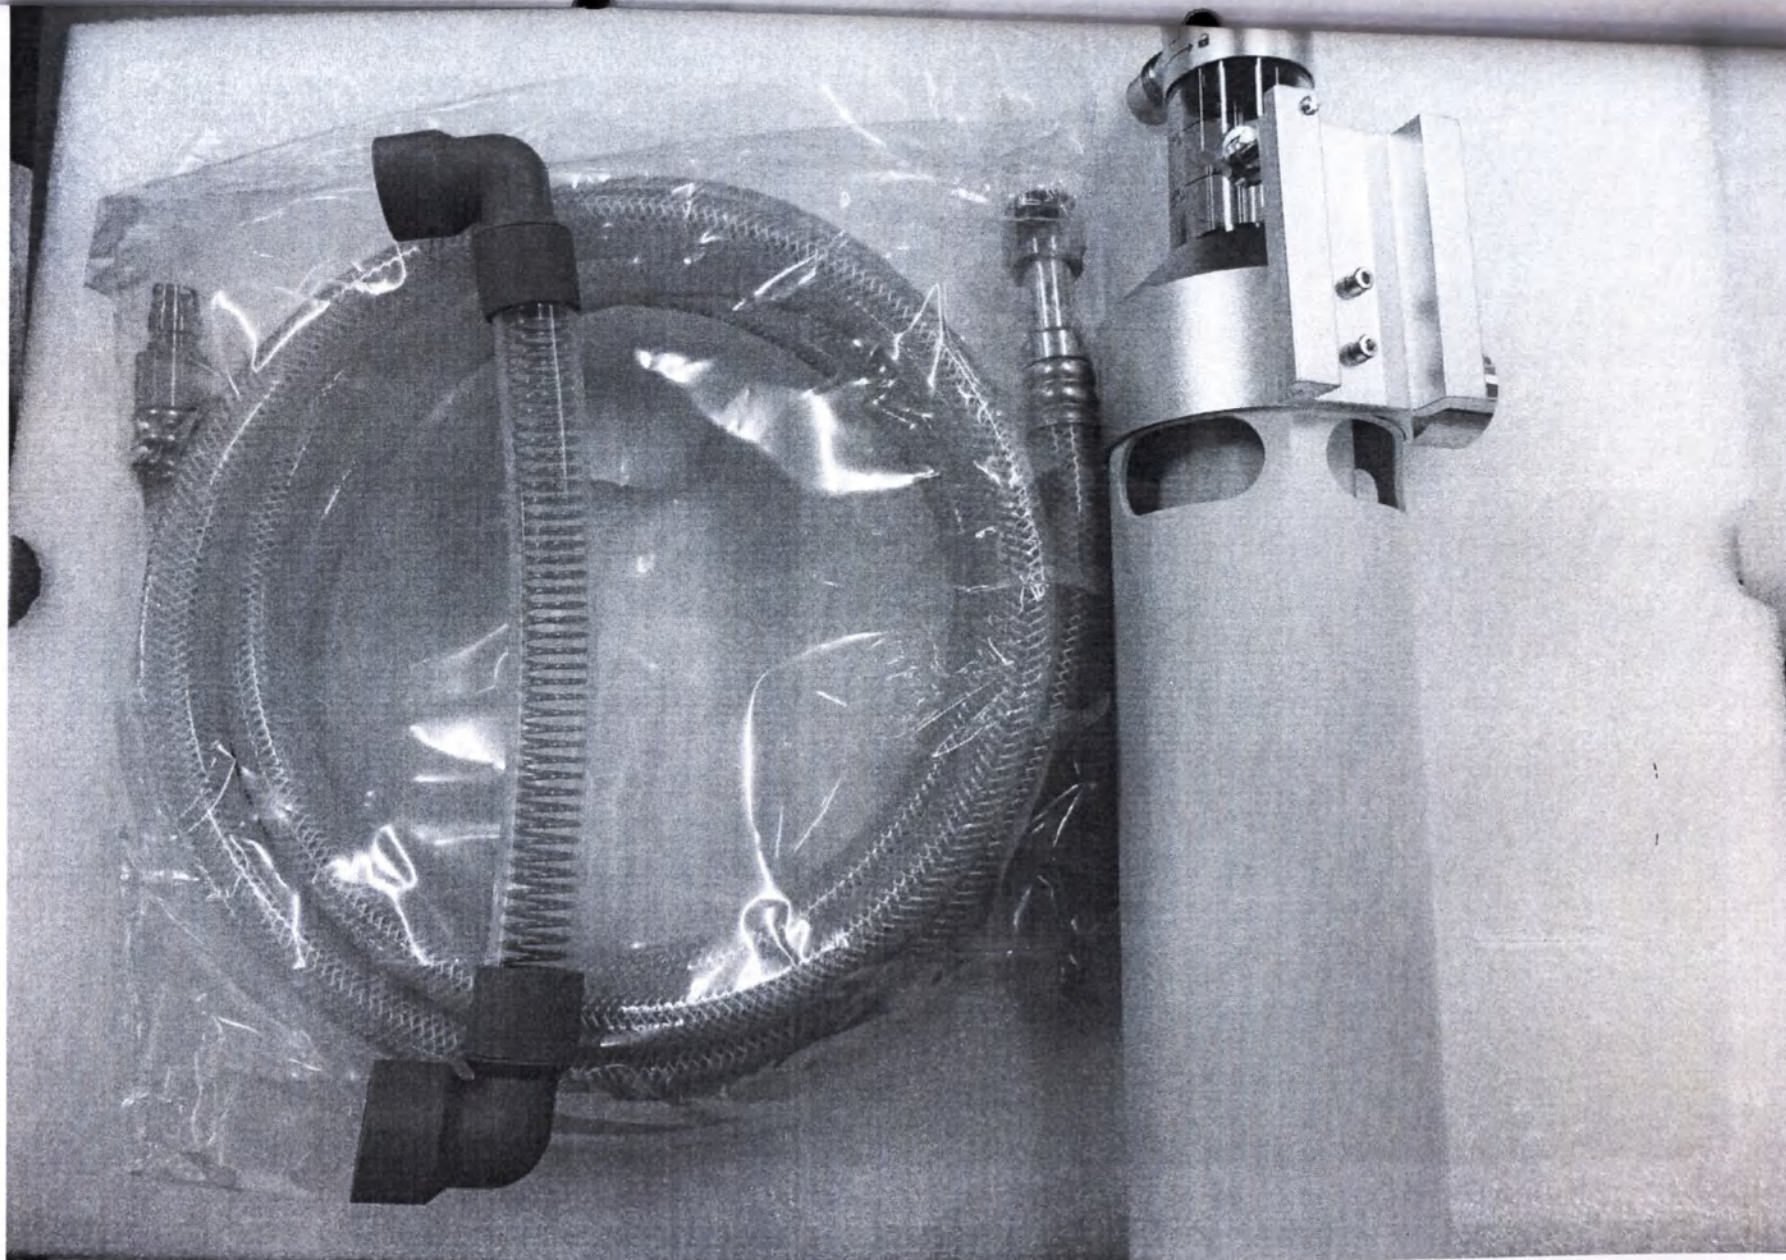


50. Система удаления газовых анестетиков (AGSS system) с высокопоточной системой утилизации, в составе: система утилизации высокопоточная; шланг газопередающий; шланг газывыводящий, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

91568
17.11.2020

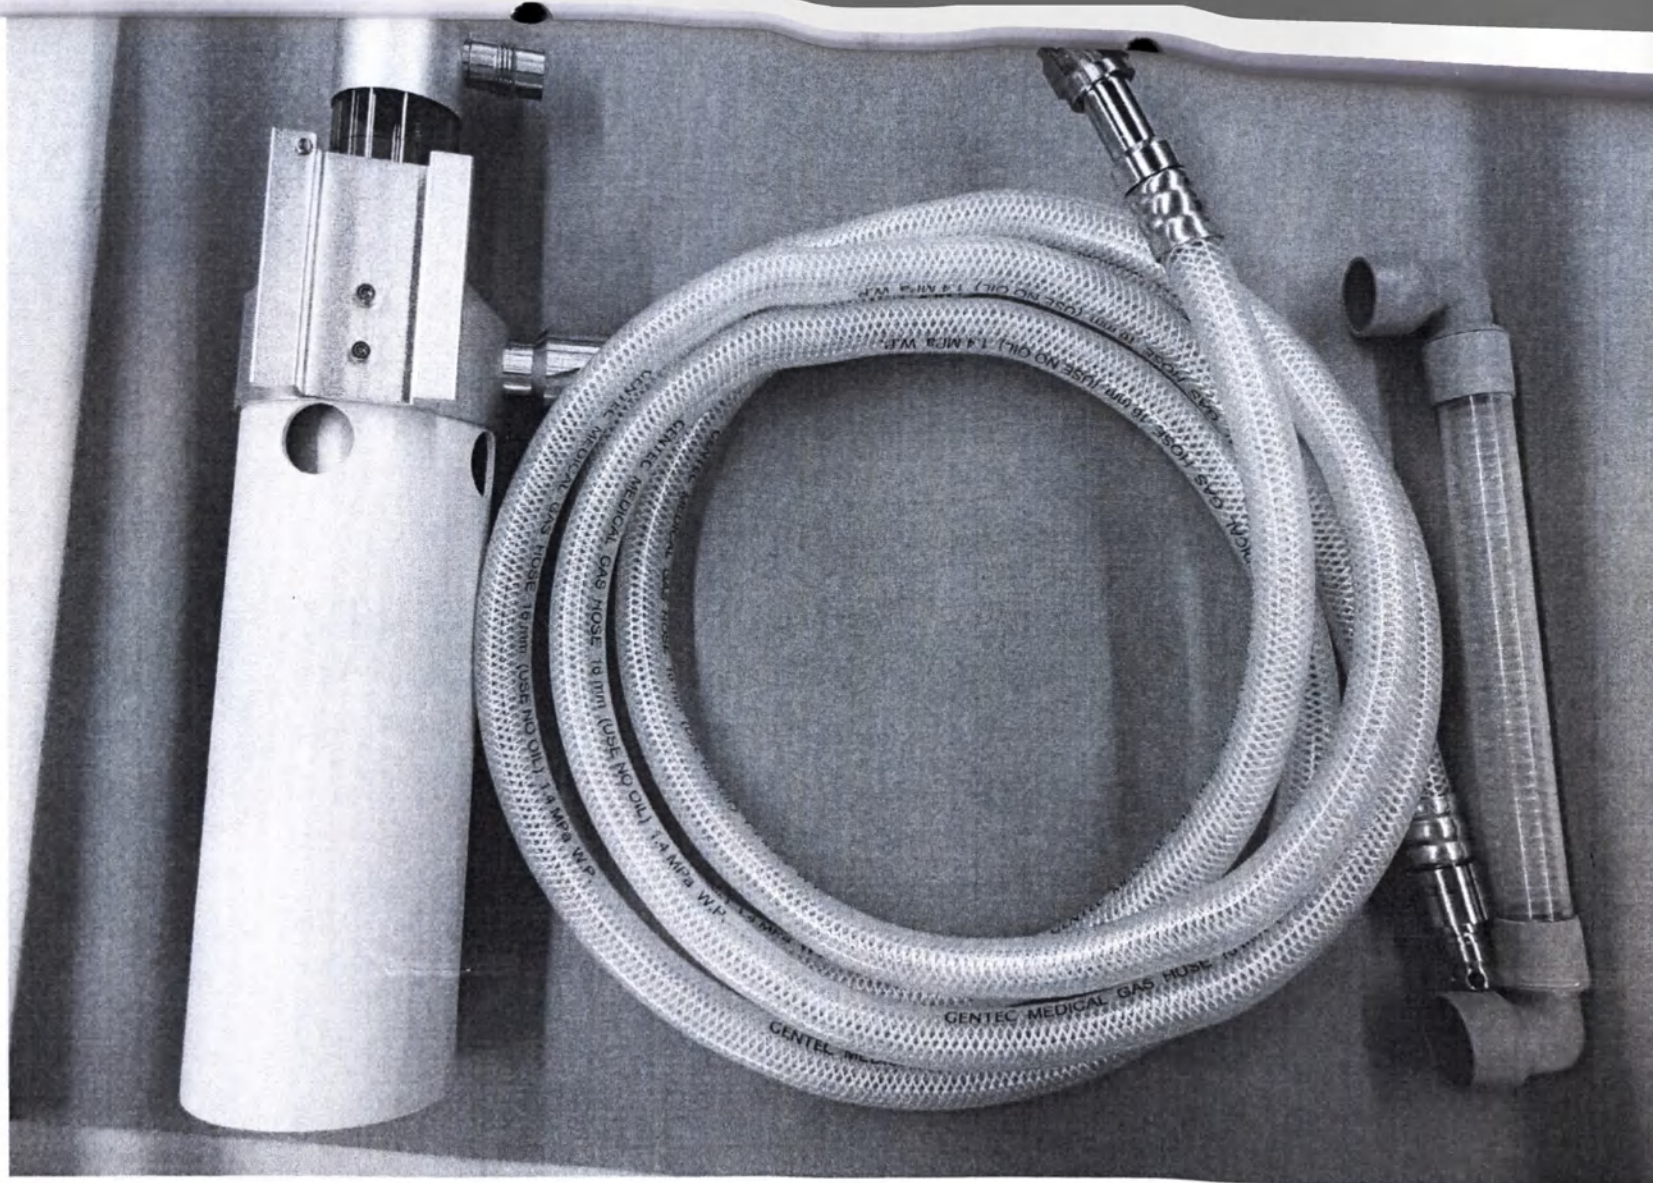

50. Система удаления газовых анестетиков (AGSS system) с низкотоочной системой утилизации, в составе: система утилизации низкотоочная, шланг газопередающий, шланг газывыводящий, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

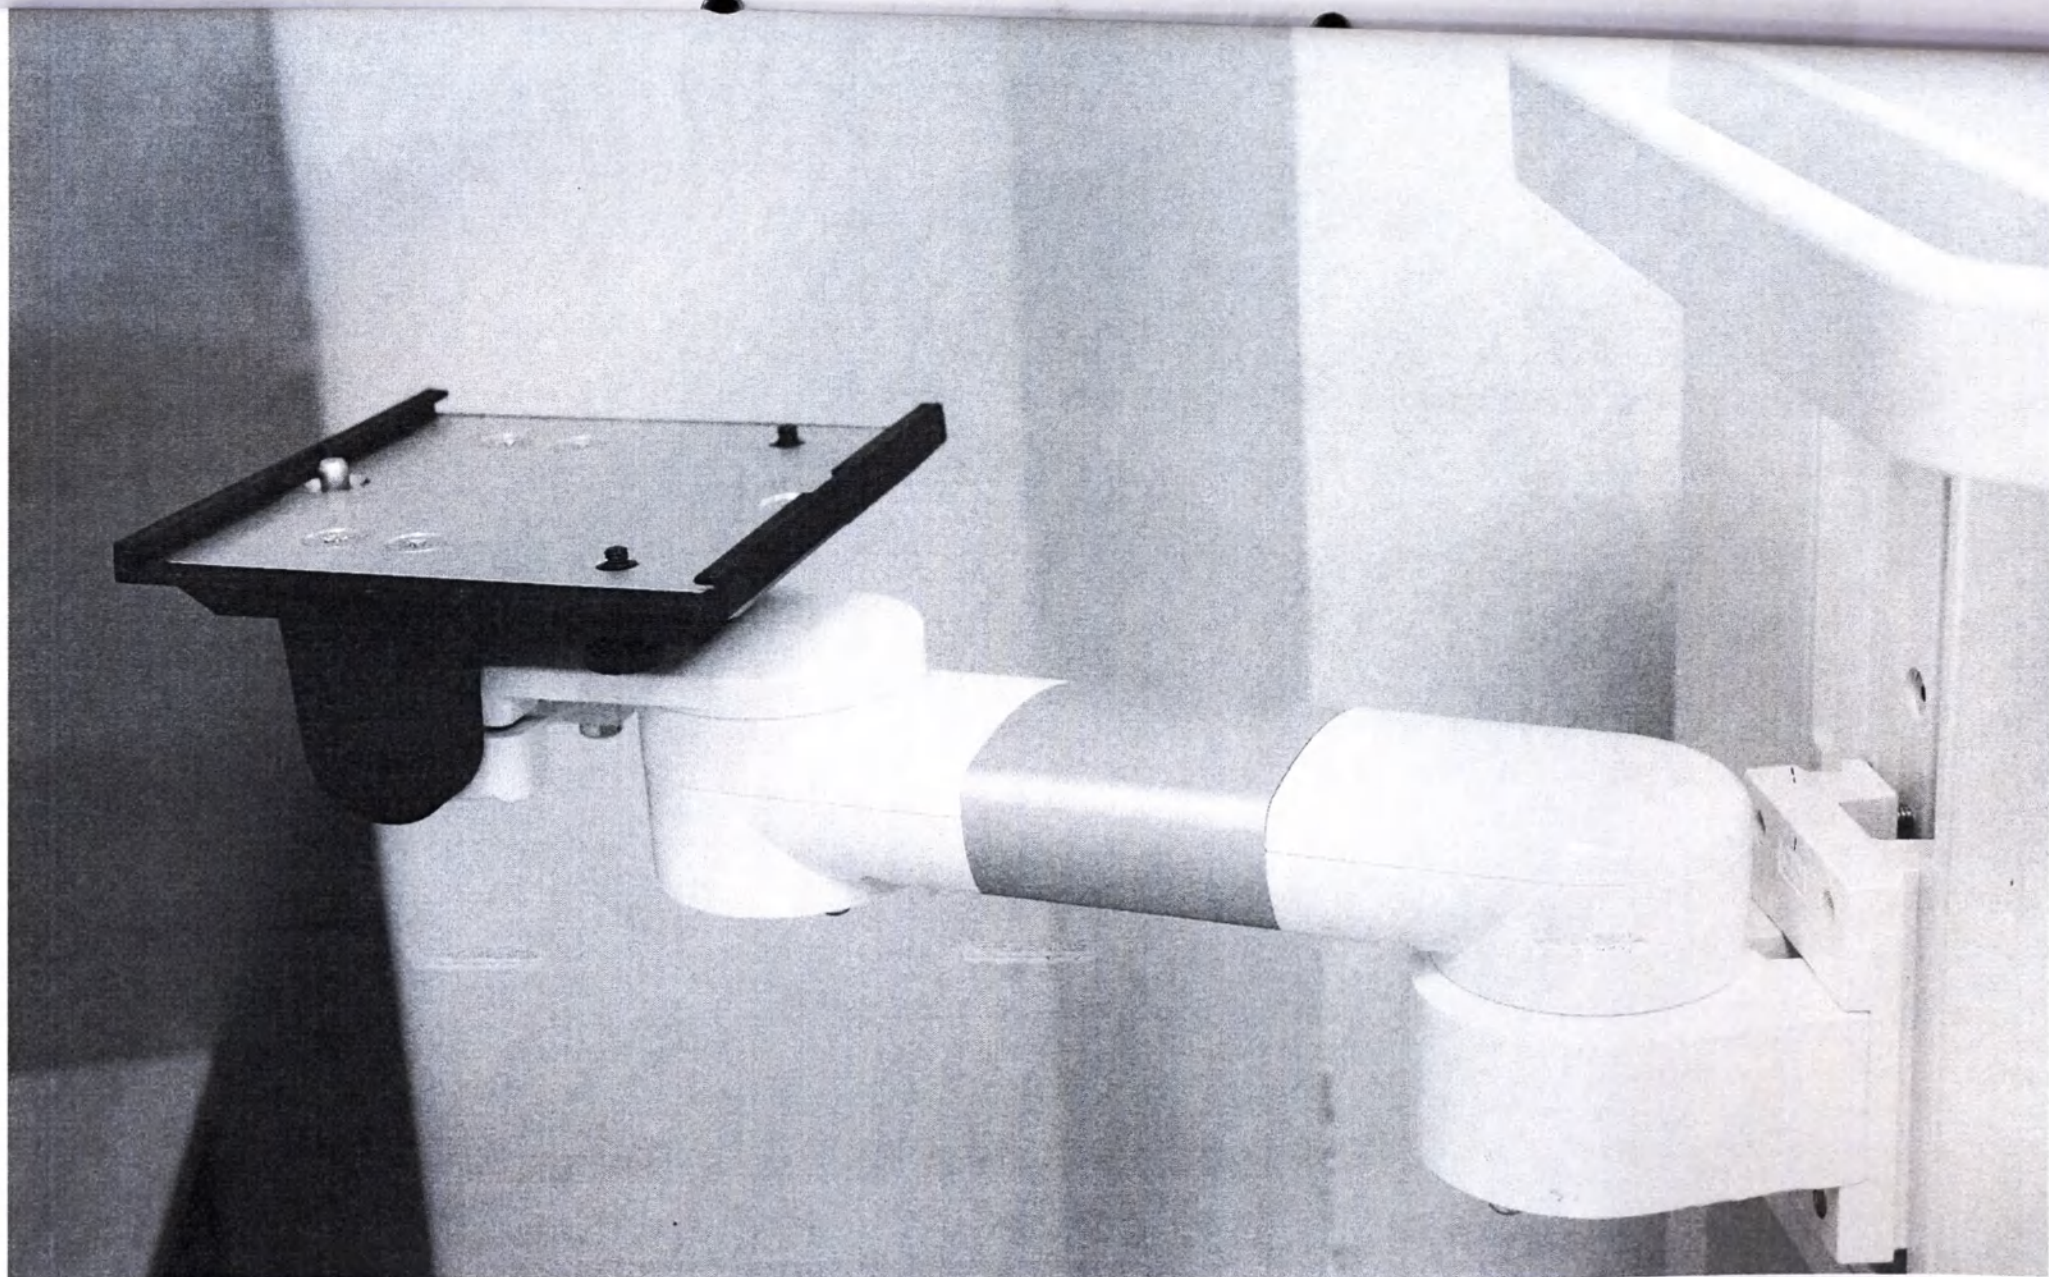

51. Установочное оборудование, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»,
Россия.



52. Кабель питания, пр-ва Производственная компания «Электрическая

91568
17.11.2020



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

, Россия.



52. Кабель питания, пр-ва Baohing Electric Wire & Cable Co., Ltd,

Китай



53. Компрессор медицинский стоматологический DK50, РУ № ФСЗ 2011/10543, пр-ва «ЭКОМ спол. с р.о.», Словацкая Республика.





53. Компрессор медицинский DK50. РУ № ФСЗ 2008/03234, пр-ва «ЭКОМ спол. с р.о.», Словацкая Республика.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 65 лист 06


Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»





В.М. Полунин
« 13 » 11 2020г.

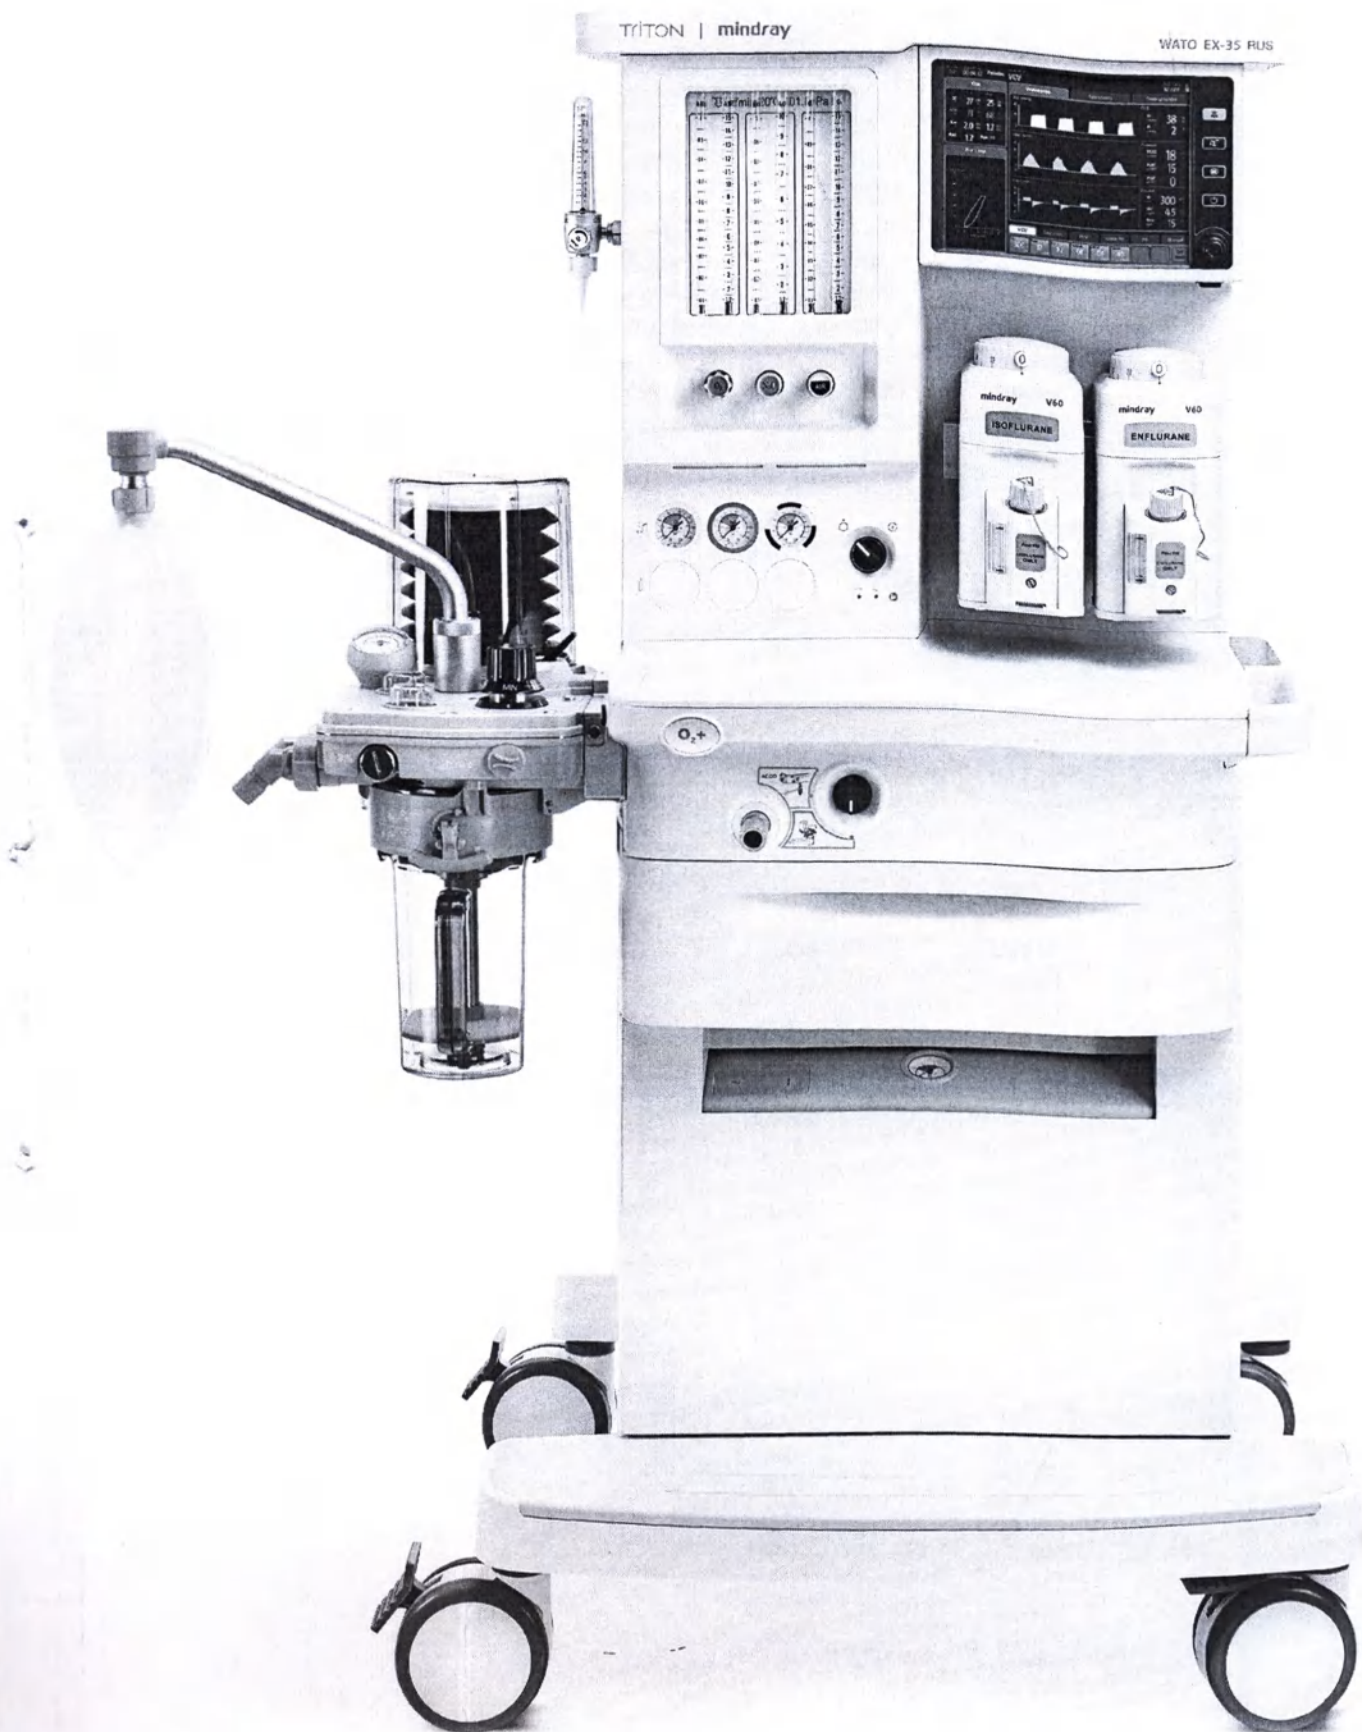

1. Блок основной со встроенным компрессором ТЭСМ.943119.012-03
 пр-ва ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия

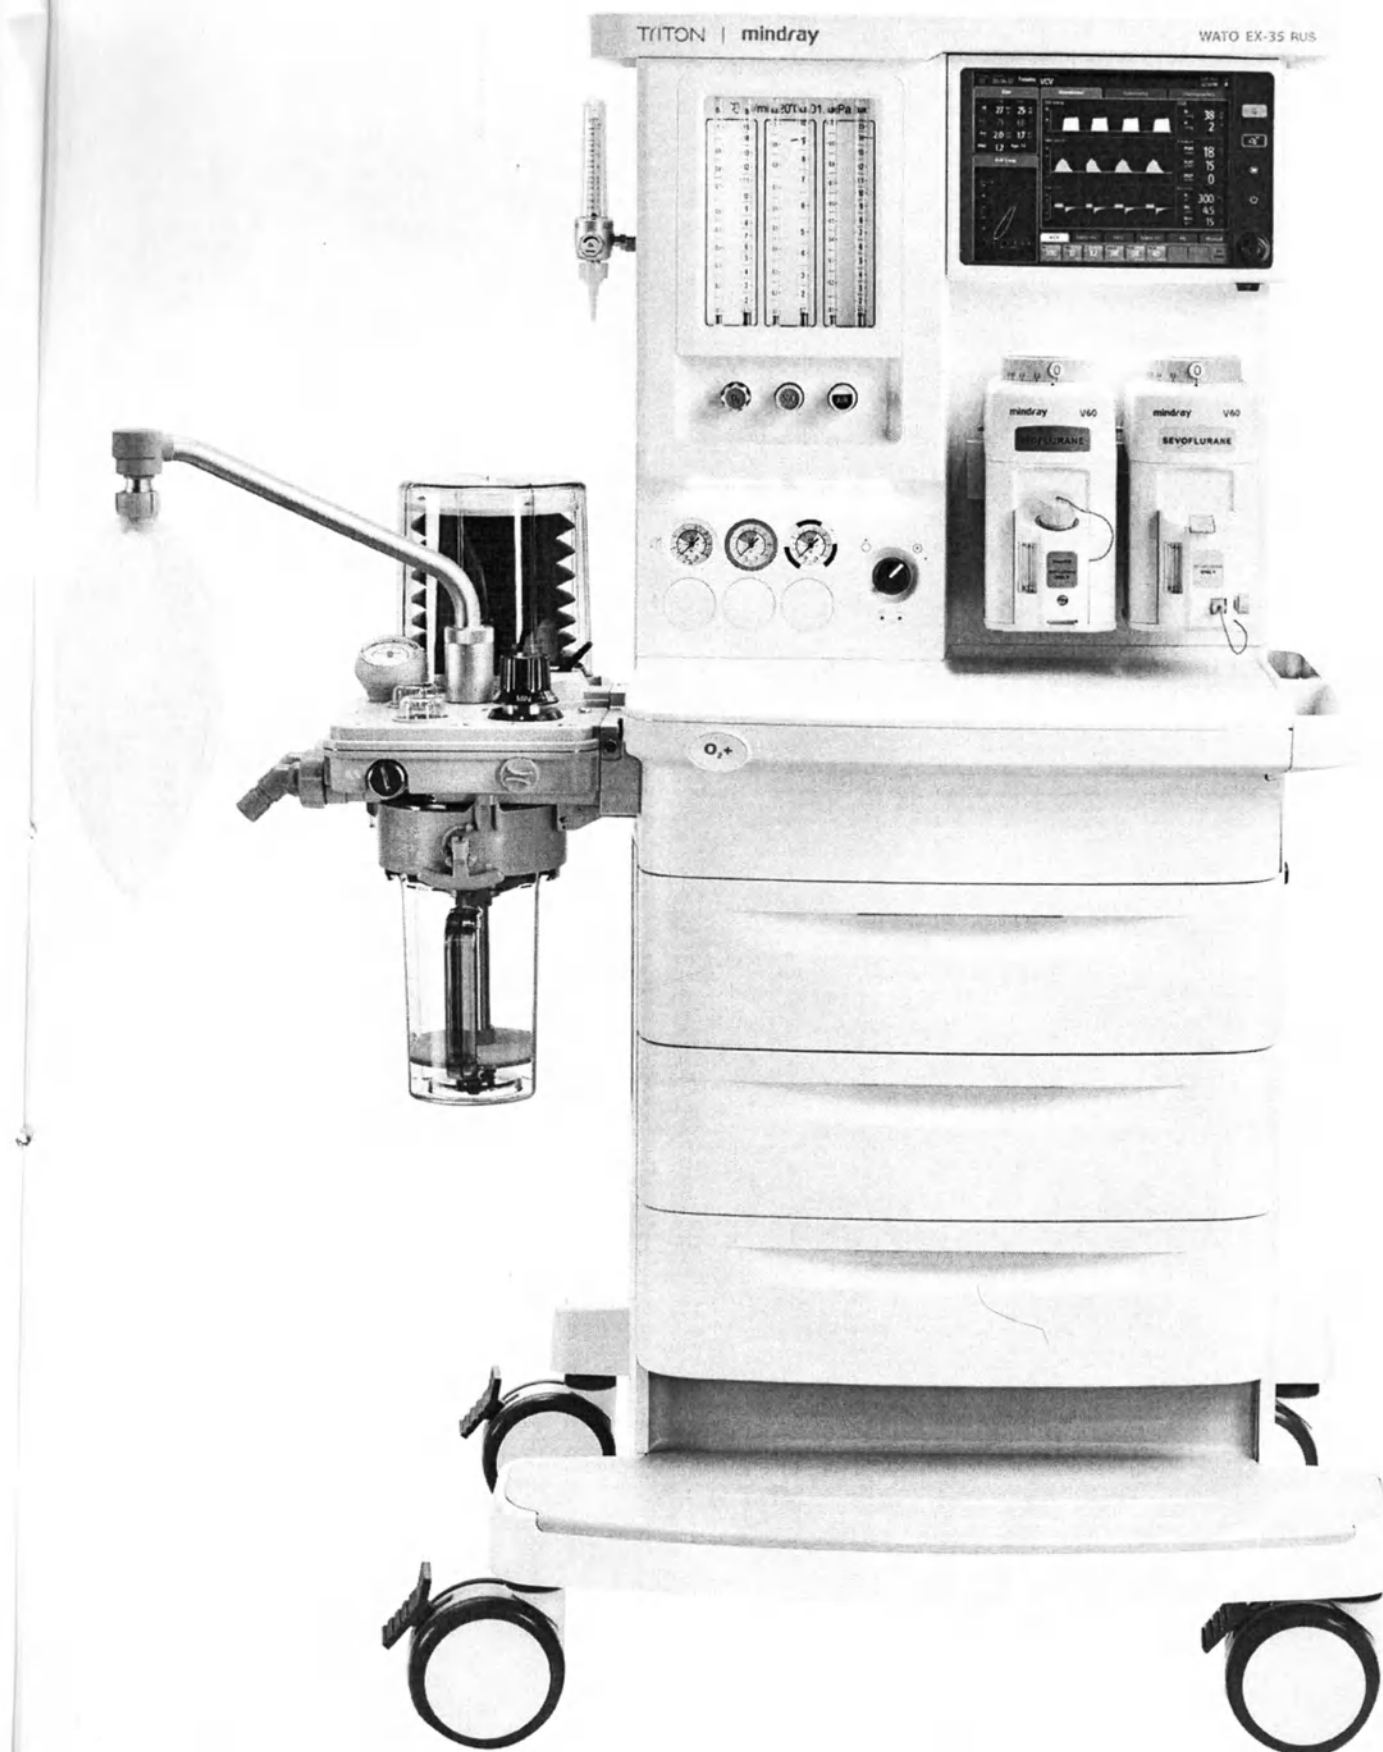

1. Блок основной ТЭСМ.943119.012-01, пр-ва ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС", Россия

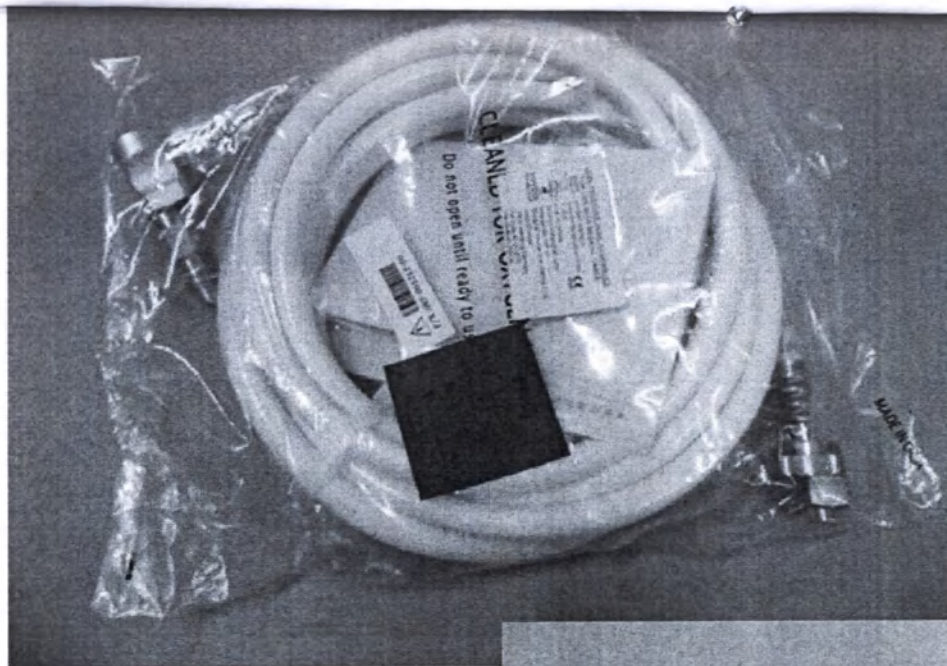


2. Шланги для газов: кислорода, закиси азота, воздуха, пр-ва Genstar Technologies Company, Inc, США



3. Испаритель анестетика Десфлюран М35500 D-Varor 2000, в составе: с системой разъемов S-2000,
Drägerwerk AG & Co, Германия.



4. Испаритель анестетика Десфлюран Tec 6 Plus, пр-ва GE Healthcare, США.

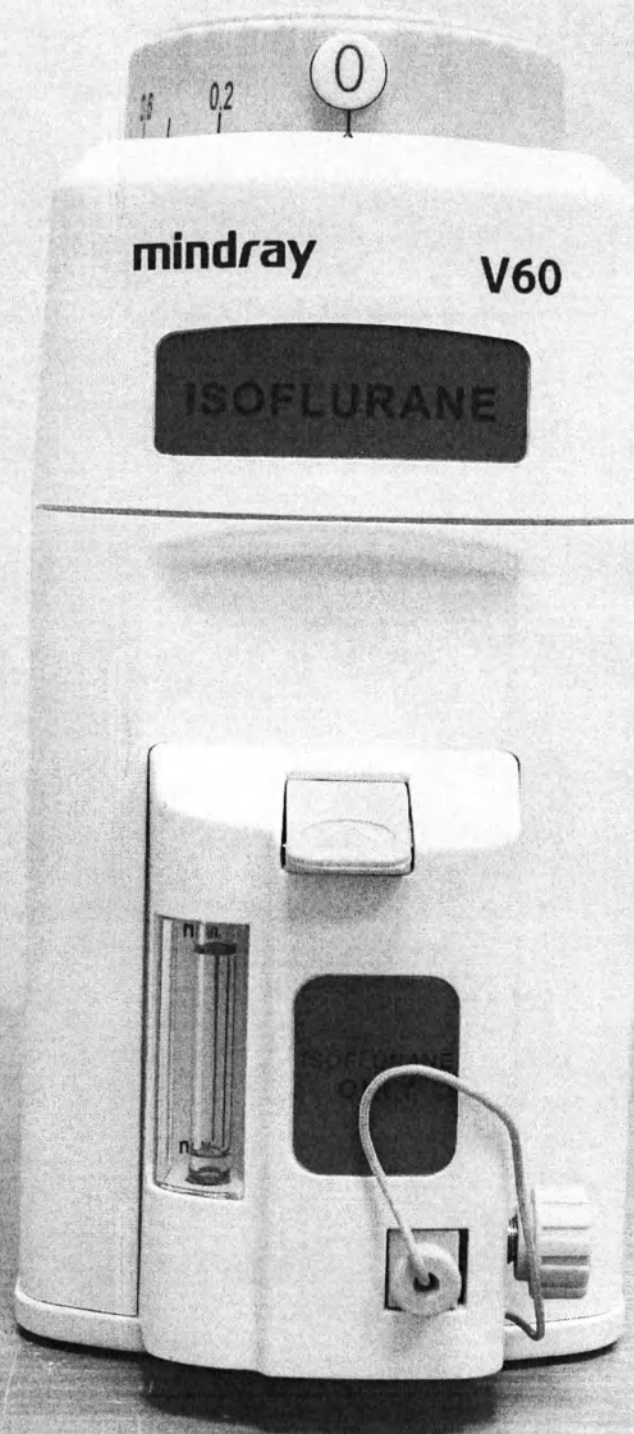

5. Испаритель анестетика Изофлюран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



6. Испаритель анестетика Изофлюран V60 (Pour-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics



7. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical



8. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Pour-Fill),
пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,




9. Испаритель анестетика Севофлюран V60 (Quick-Fill), пр-ва Shenzhen



10. Испаритель анестетика Галотан V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fil,
 от Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



11. Испаритель анестетика Галотан V60 (Pour-Fill), пр-ва Mindray Bio Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

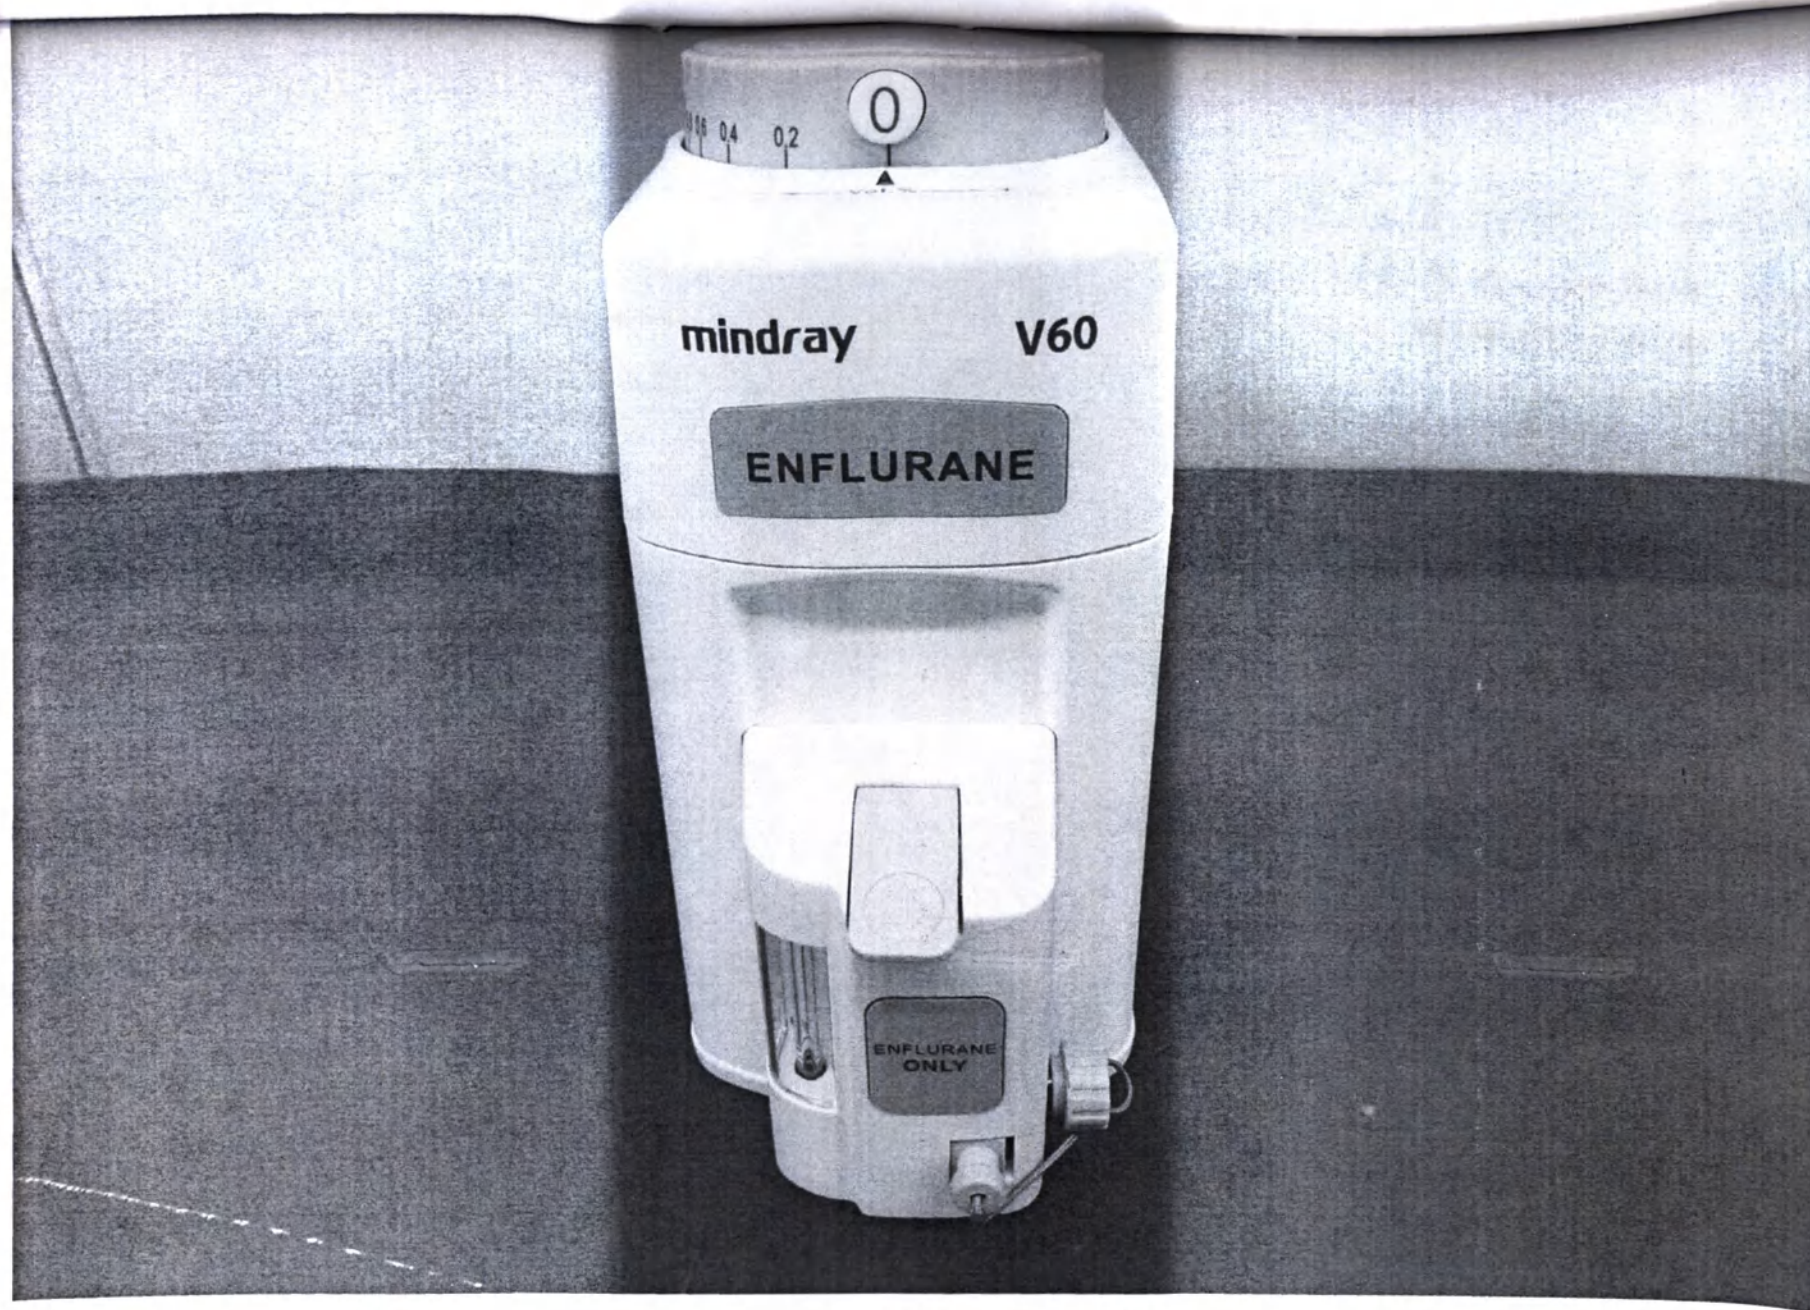


12. Испаритель анестетика Энфлуран V60 (Key-Fill), с адаптером Key-Fill, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




3. Испаритель анестетика Энфлуран V60 (Pour-Fill), пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



14. Испаритель анестетиков Sigma Delta с принадлежностями (виды 282600, 299670, 215300, 168290), РУ № ФСЗ 2011/10743, пр-ва Penlon Ltd., Соединенное Королевство.

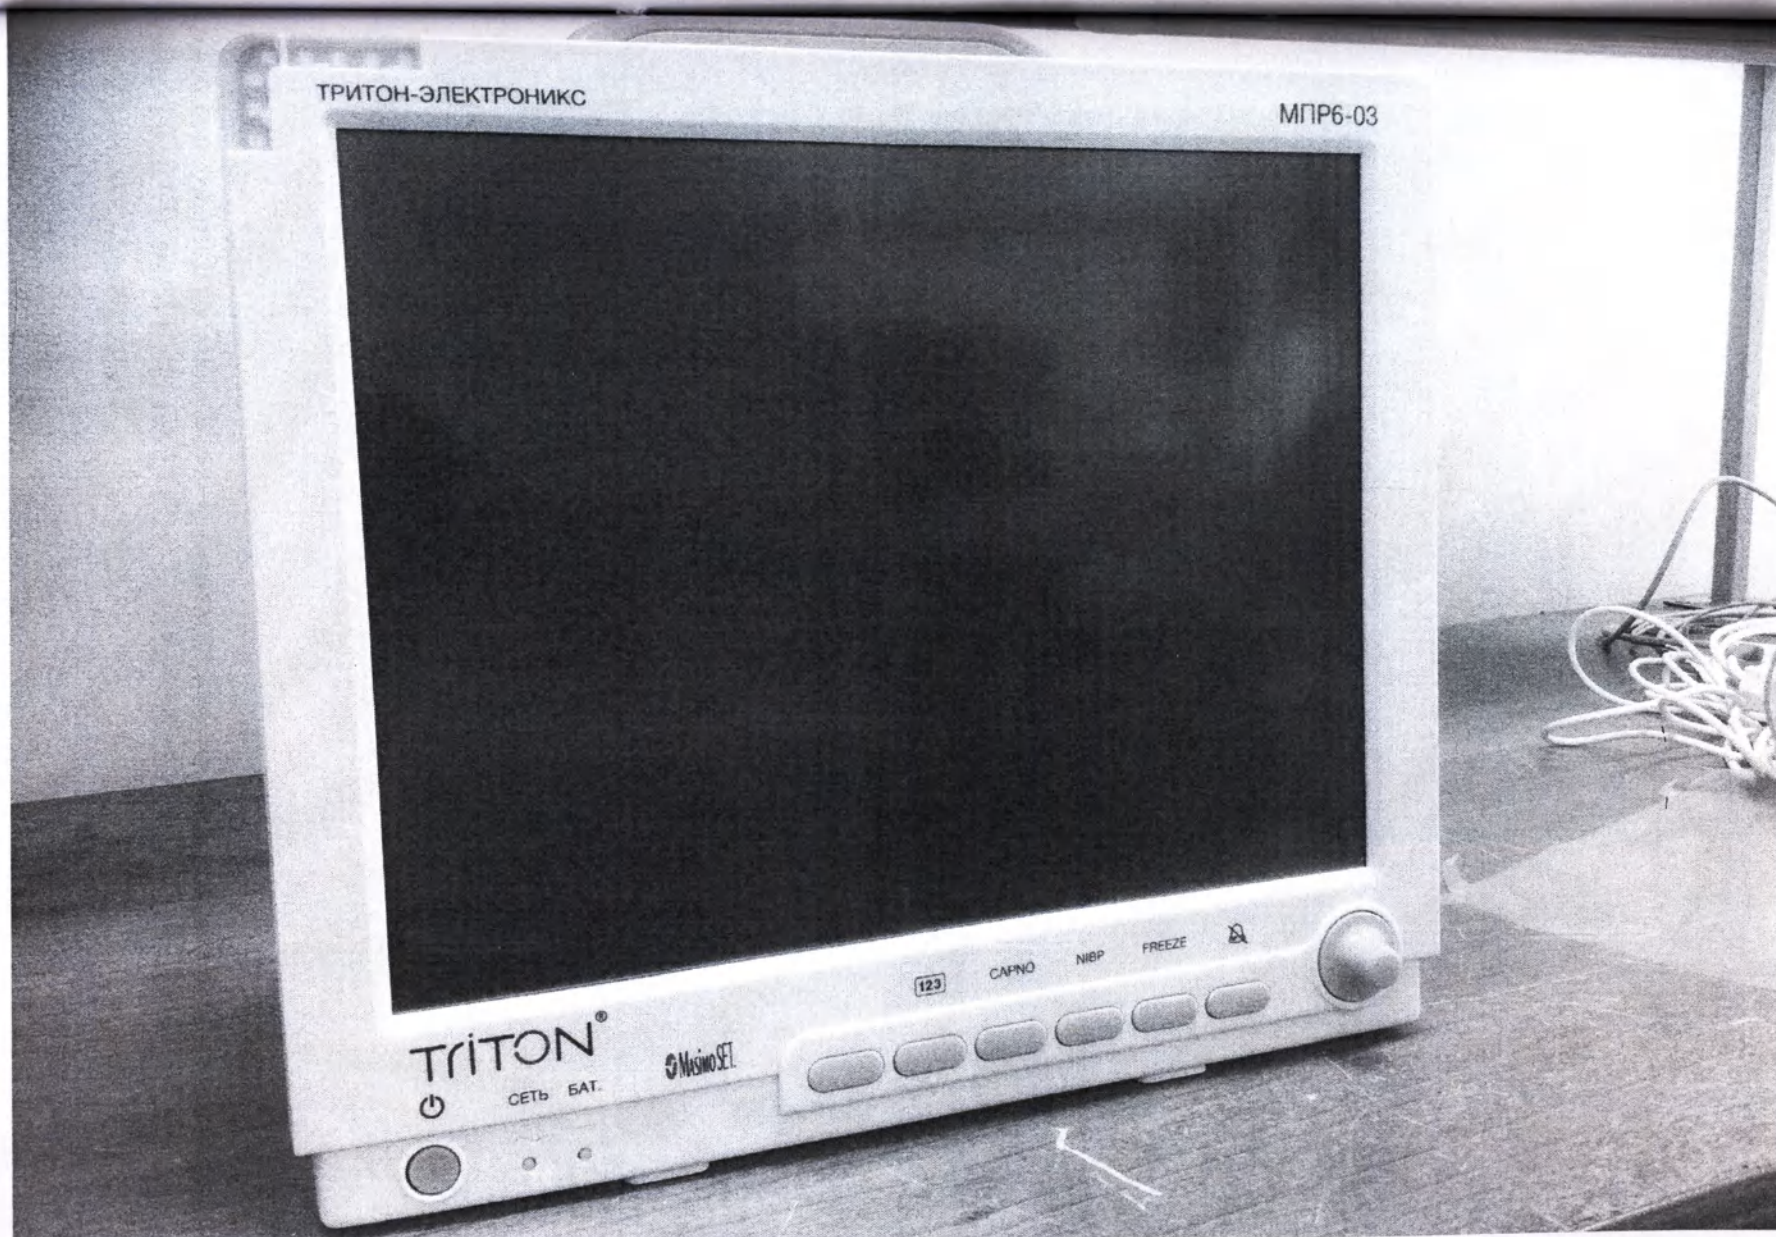


15. Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03-"Тритон" по ТУ 26.60.12-011-221.03.00.0010 (при необходимости), РУ № ФСР 2007/00597, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия, 1 шт.

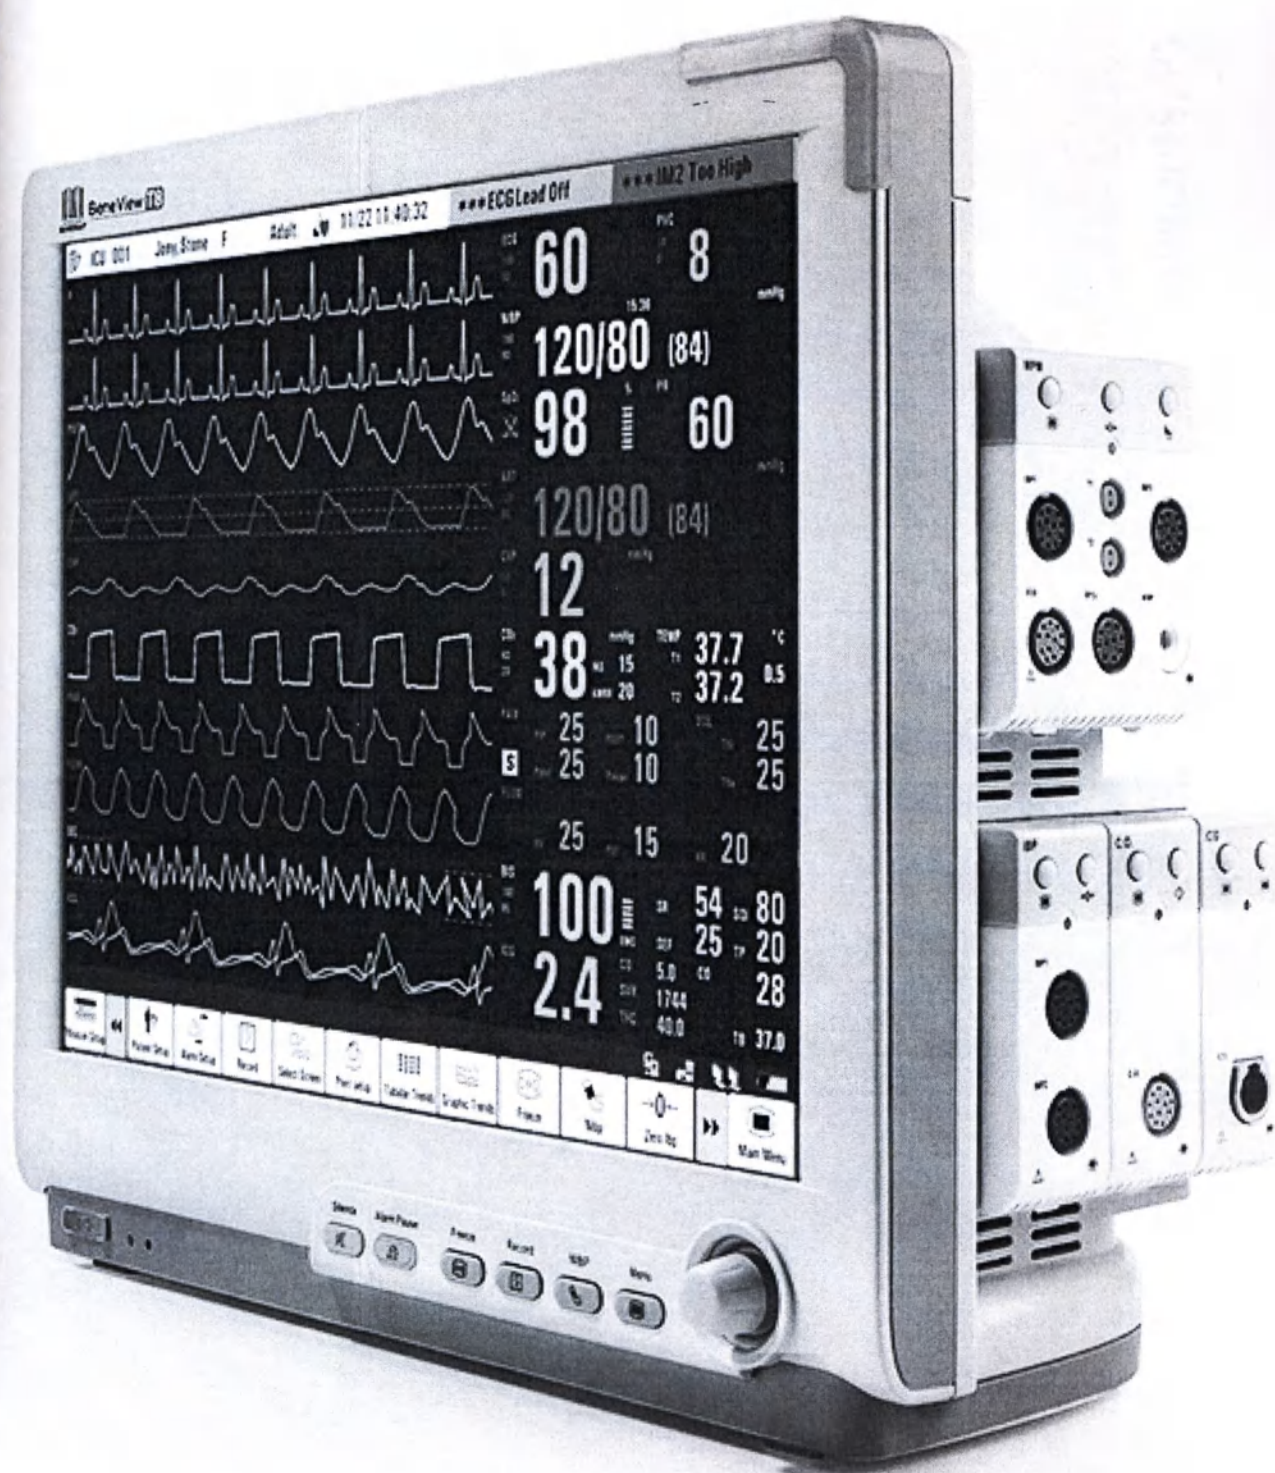

Монитор пациента BeneView с принадлежностями, варианты исполнения T5 RUS, T8 RUS по ТУ 26.60.12-026-32119398-2017, РУ № РЗН 2018/6952, пр-ва ООО «Тригон-ЭлектроникС», Россия.



17. Монитор оценки глубины анестезии МГА-06 по ТУ 26.60.12-018-32119398-2018, РУ № РЗН 2015/2595, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

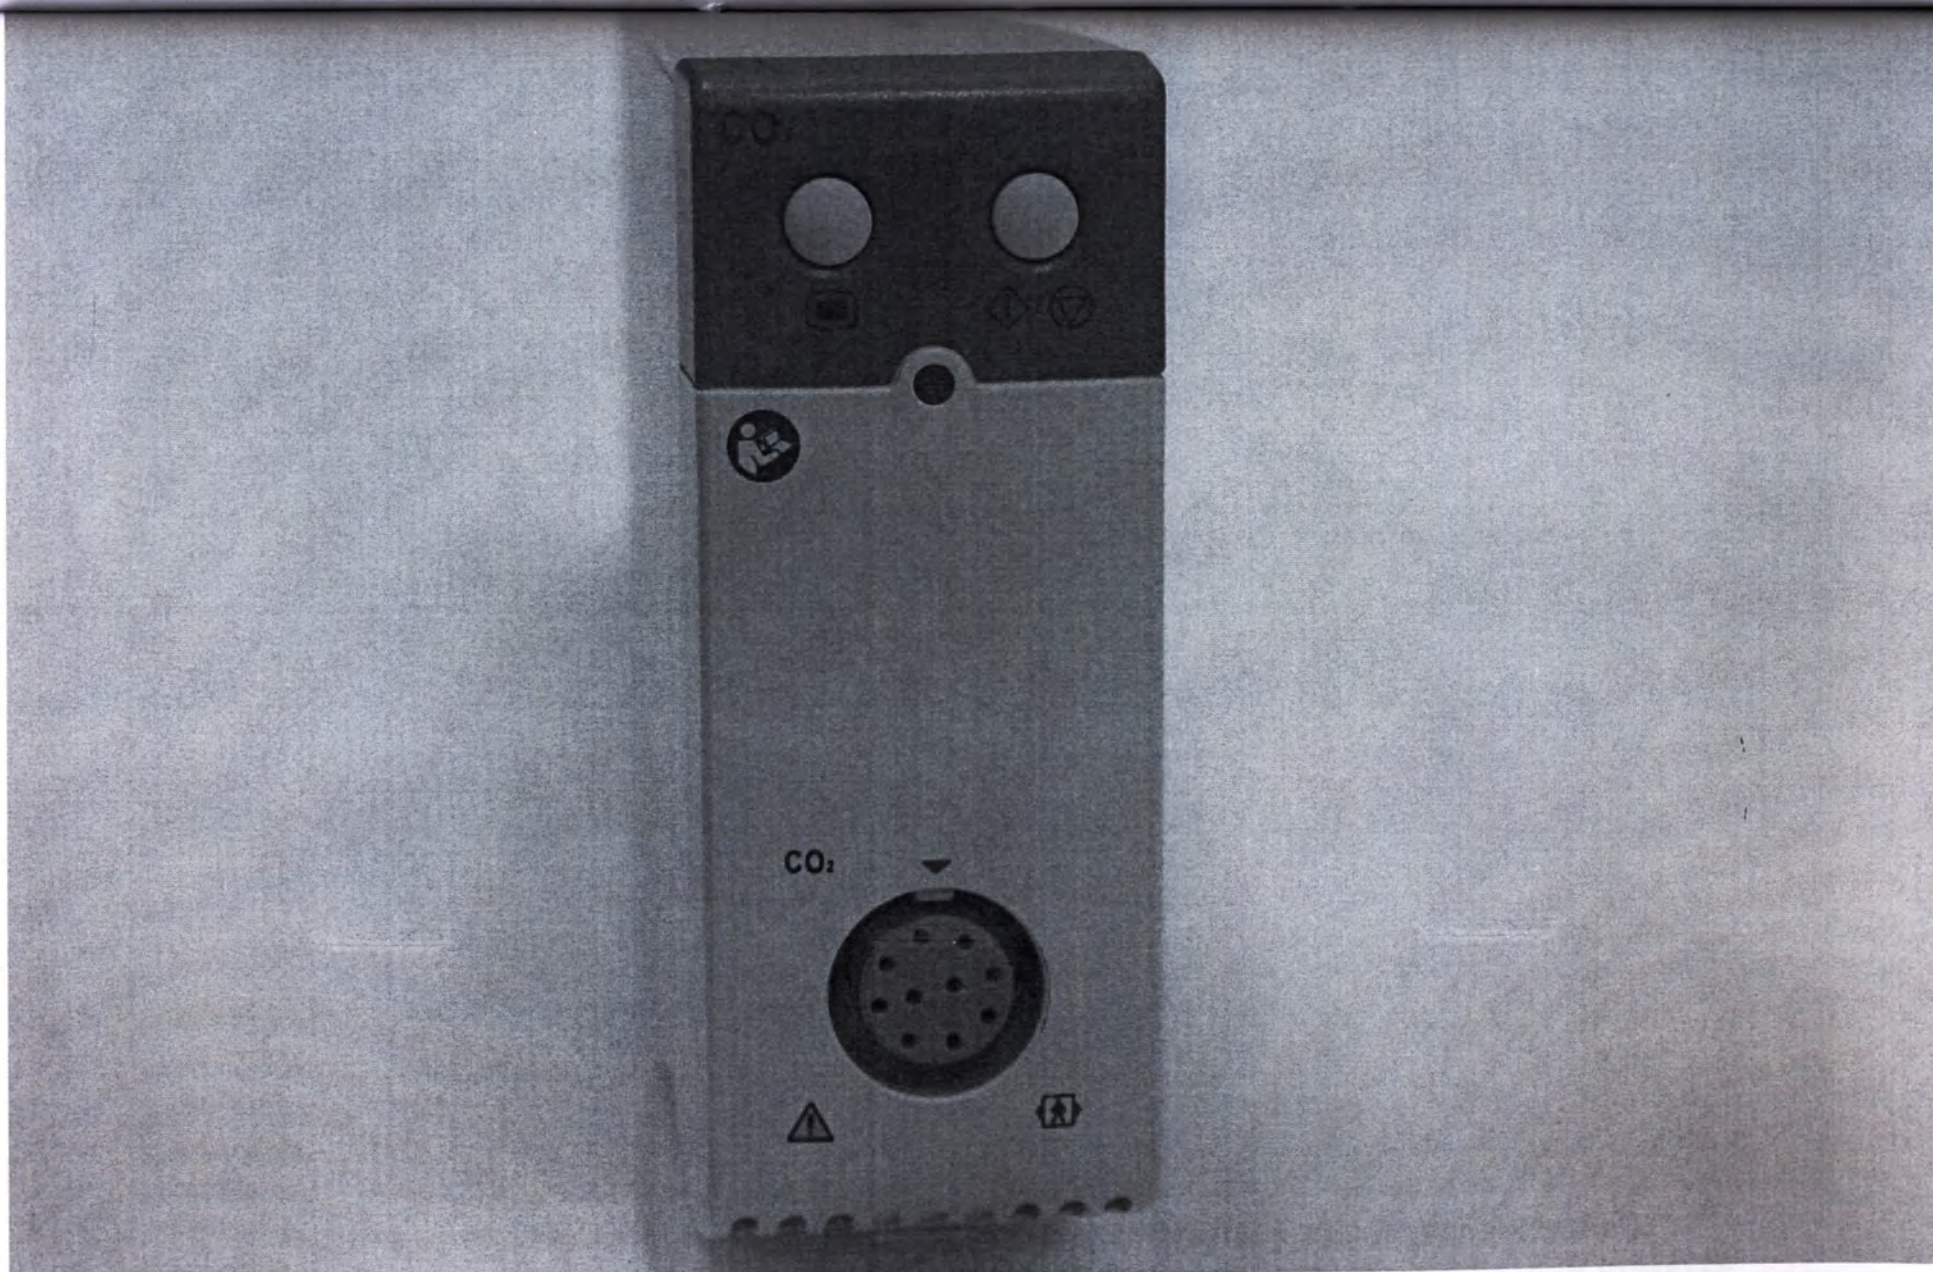


18. Модуль капнометрии прямого потока, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen


ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

91568
17.11.2020




19. Набор для капнометрии прямого потока, в составе: адаптер для подключения в дыхательный контур, взрослые/дети, адаптер для подключения в дыхательный контур, дети/новорождённые, датчик Capnostat CO₂, крепёж датчика CO₂,
изготовитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

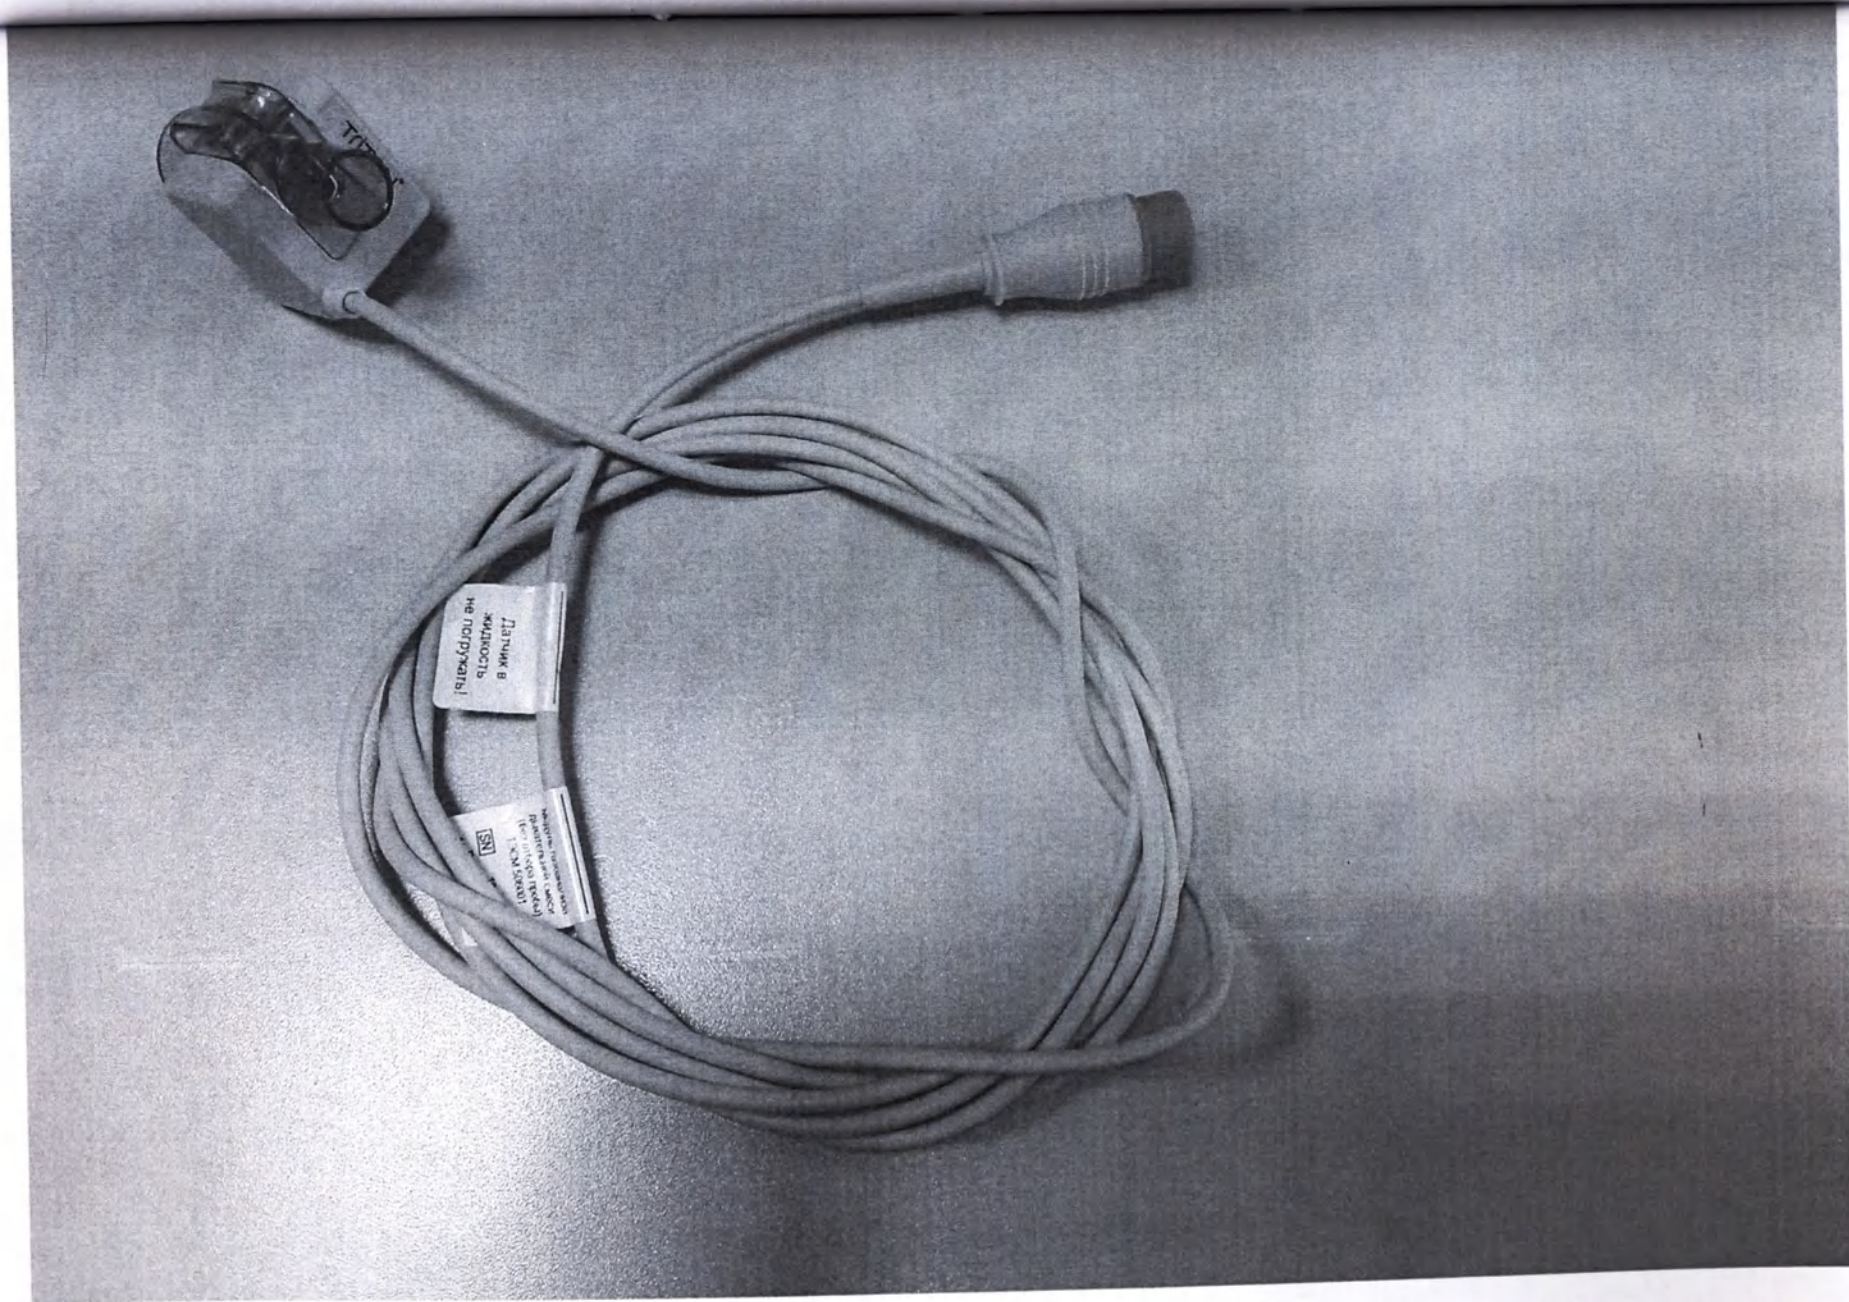


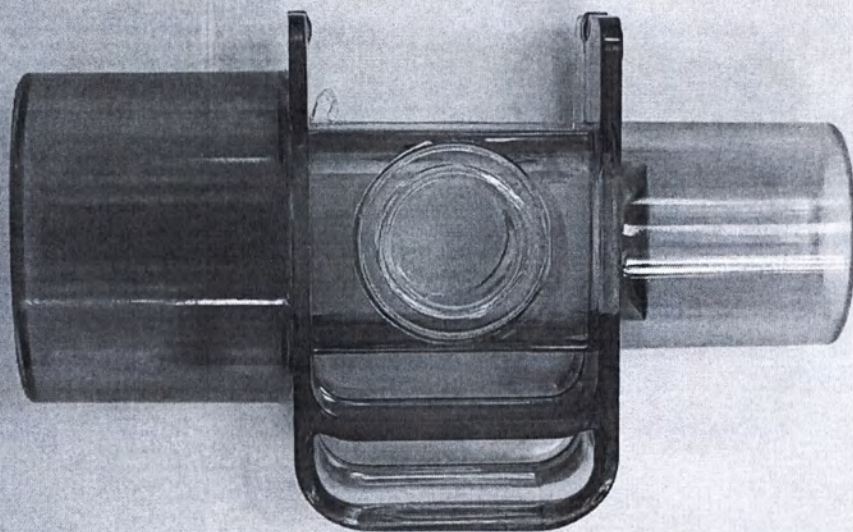


**21. Вентиляционный адаптер взрослый/детский,
ТЭСМ.706020,
пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.**

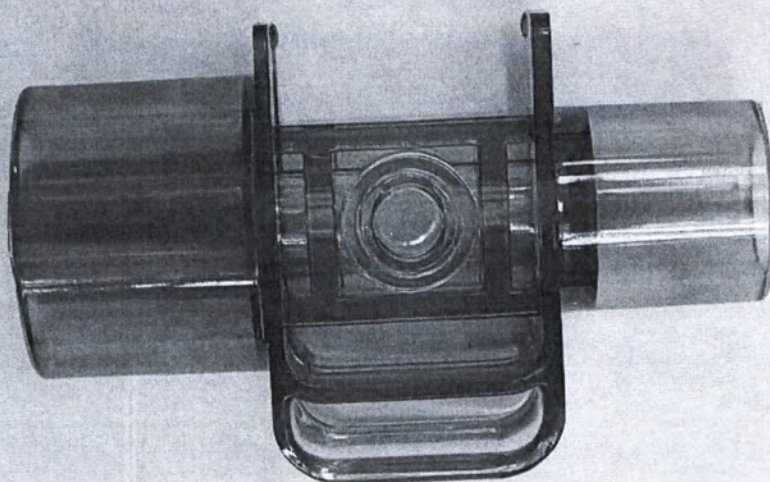

2. Вентиляционный адаптер детский/неонатальный,
ТЭСМ.706021,
пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

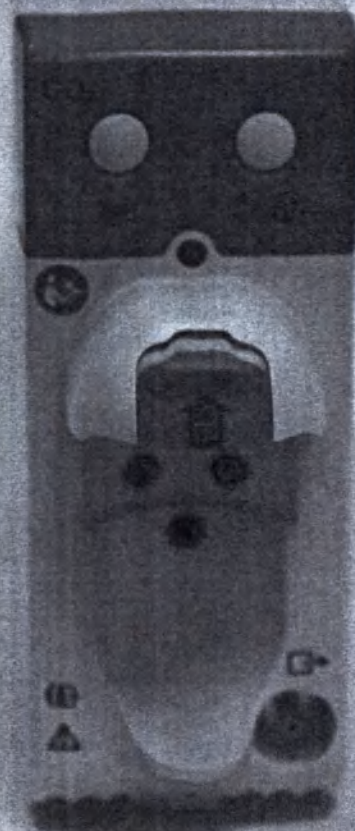


23. Модуль капнометрии бокового потока, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

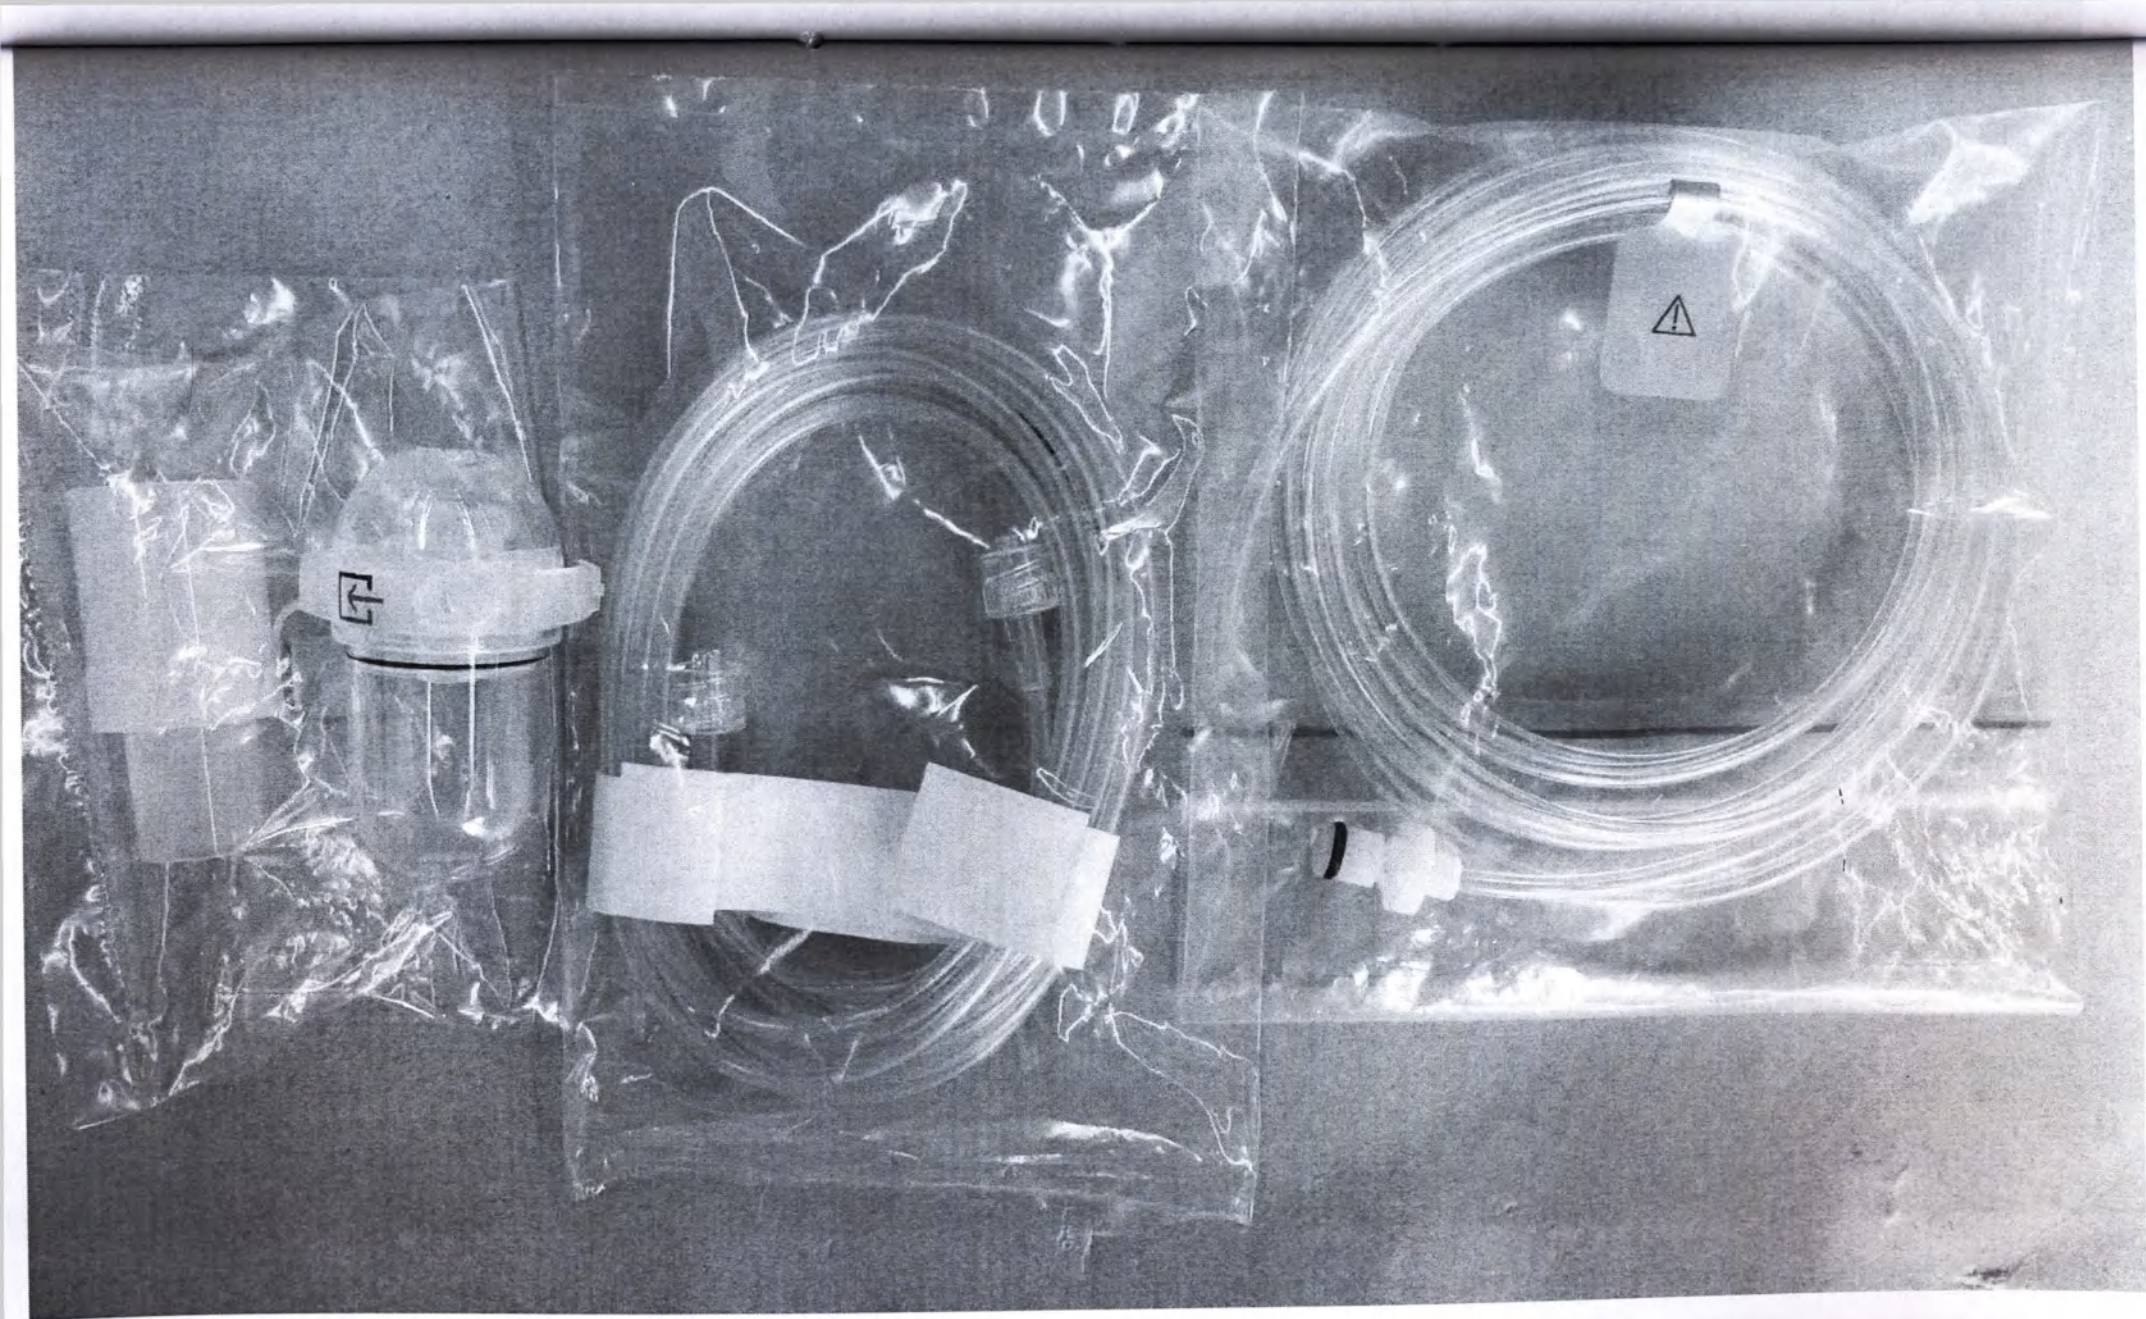


24. Набор для капнометрии в боковом потоке, взрослые/дети, в составе: трубка соединительная с быстроразъёмным адаптером, адаптер для подключения в дыхательный контур, влагосборник, взрослые/дети, линия забора пробы газа, взрослые/дети, пр-




25. Набор для капнометрии в боковом потоке, новорождённые, в составе: трубка соединительная с быстросъёмным адаптером, адаптер для подключения в дыхательный контур, влагосборник, новорождённые, линия забора пробы газа, новорождённые,

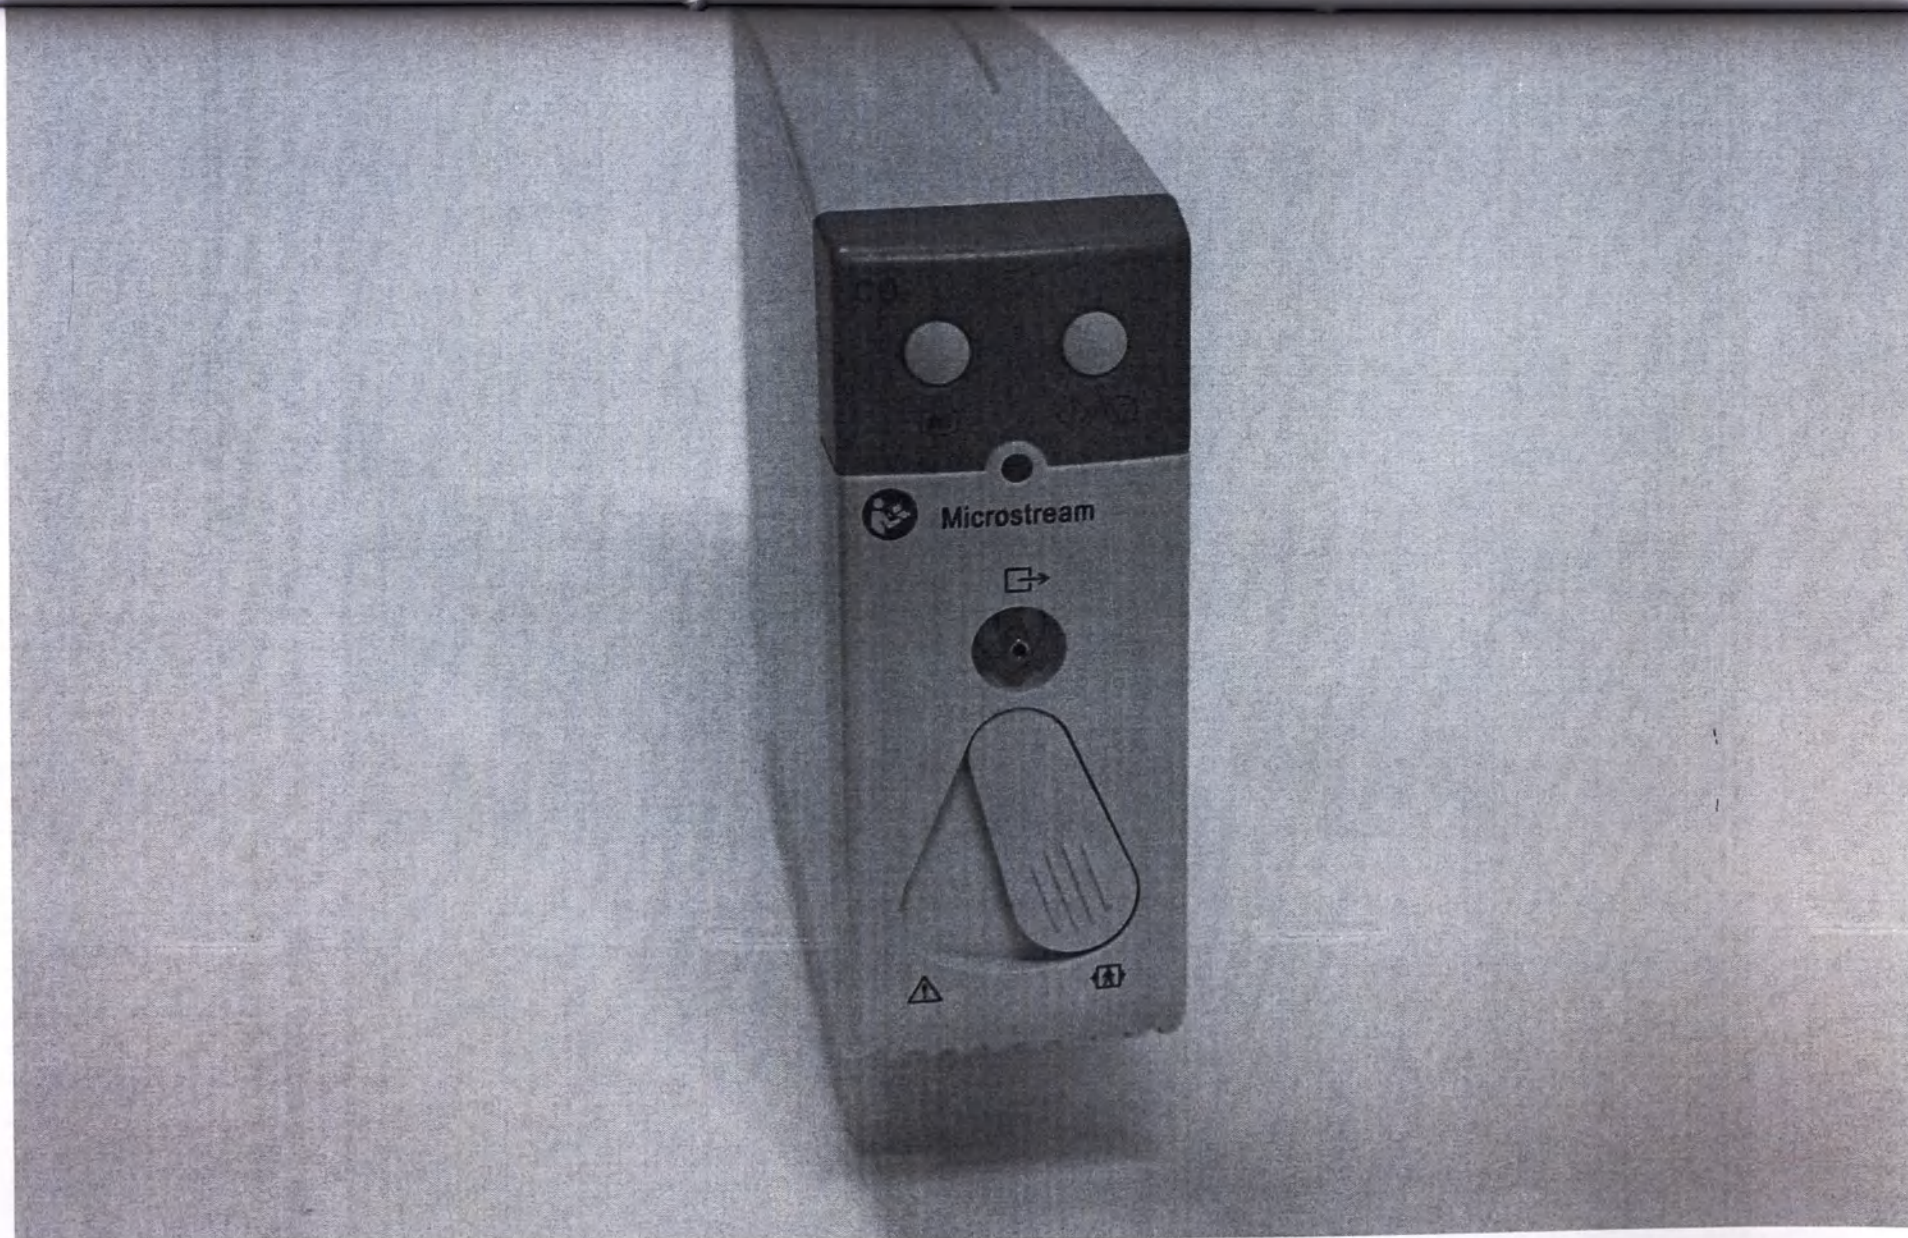

26. Модуль капнометрии низкопоточной (microstream), без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

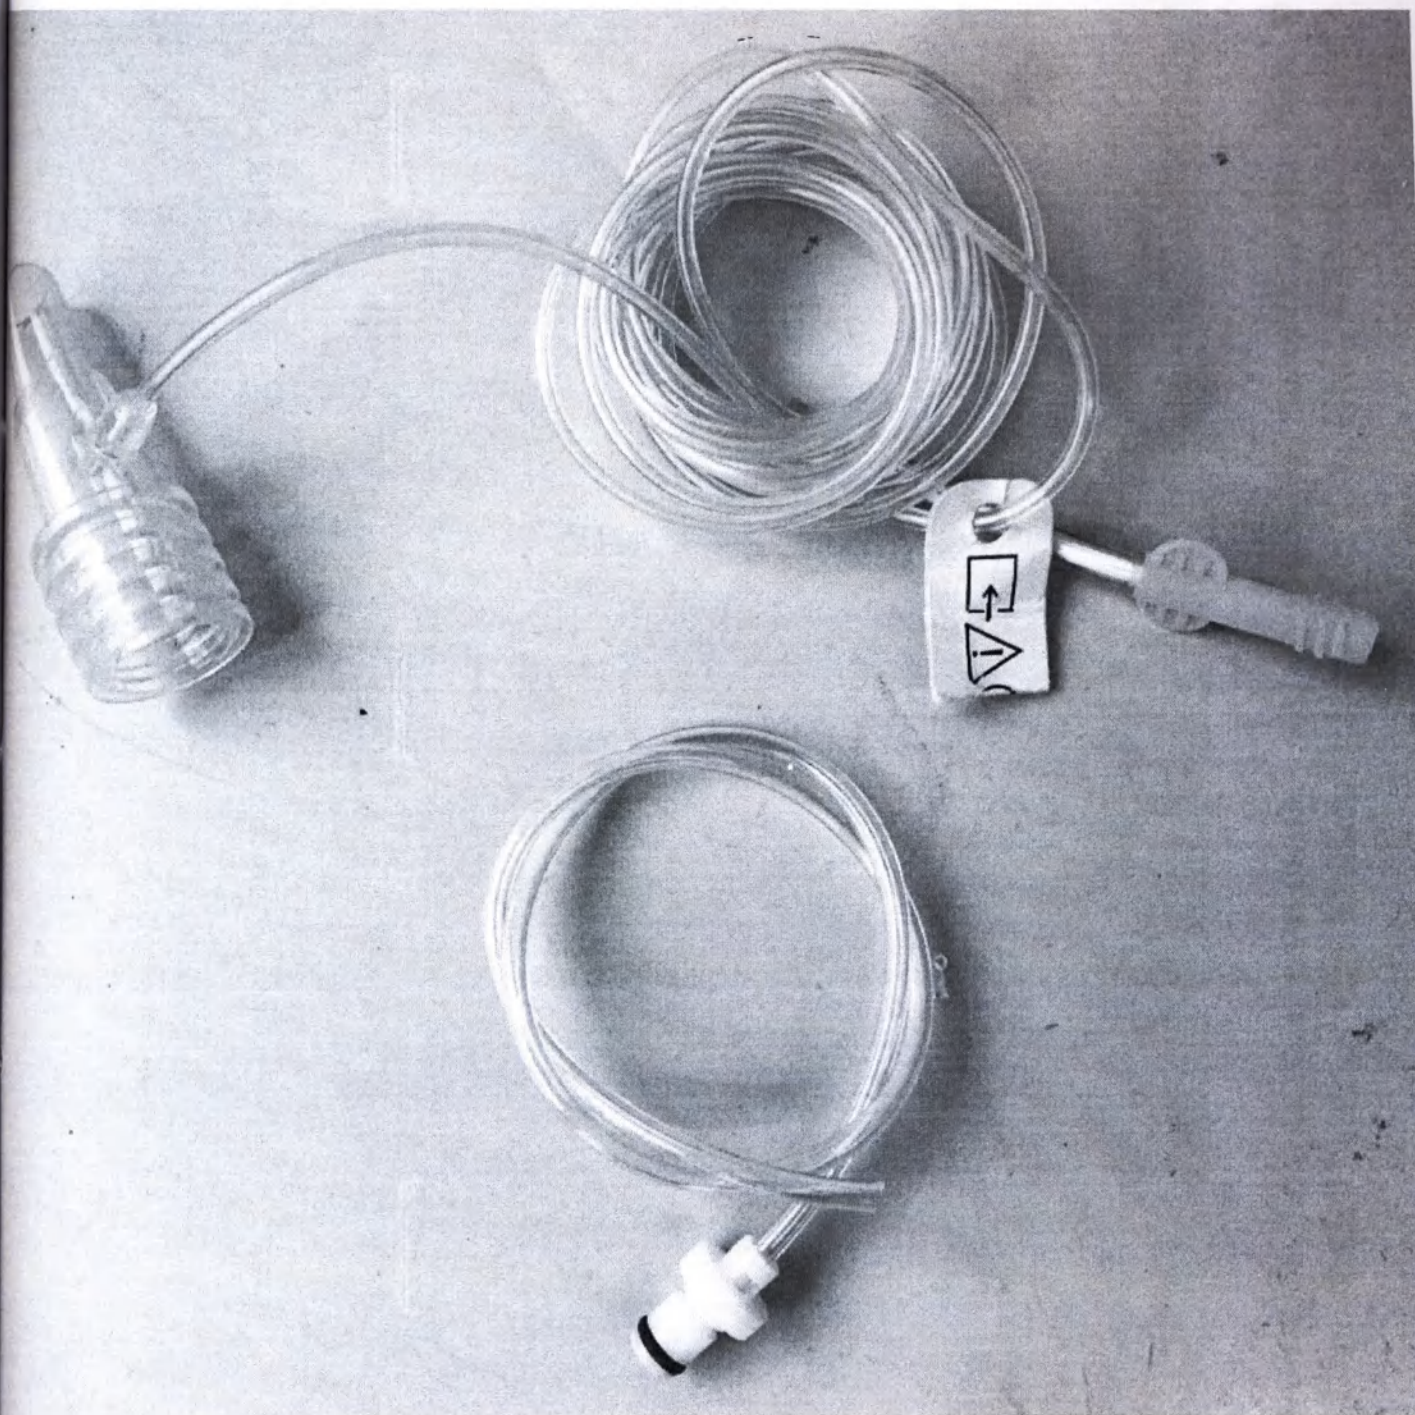

Набор для капнометрии с технологией microstream, в составе: соединительная трубка с поразъёмным адаптером, линия забора пробы газа, взрослые/дети, пр-ва Shenzhen Mindray Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

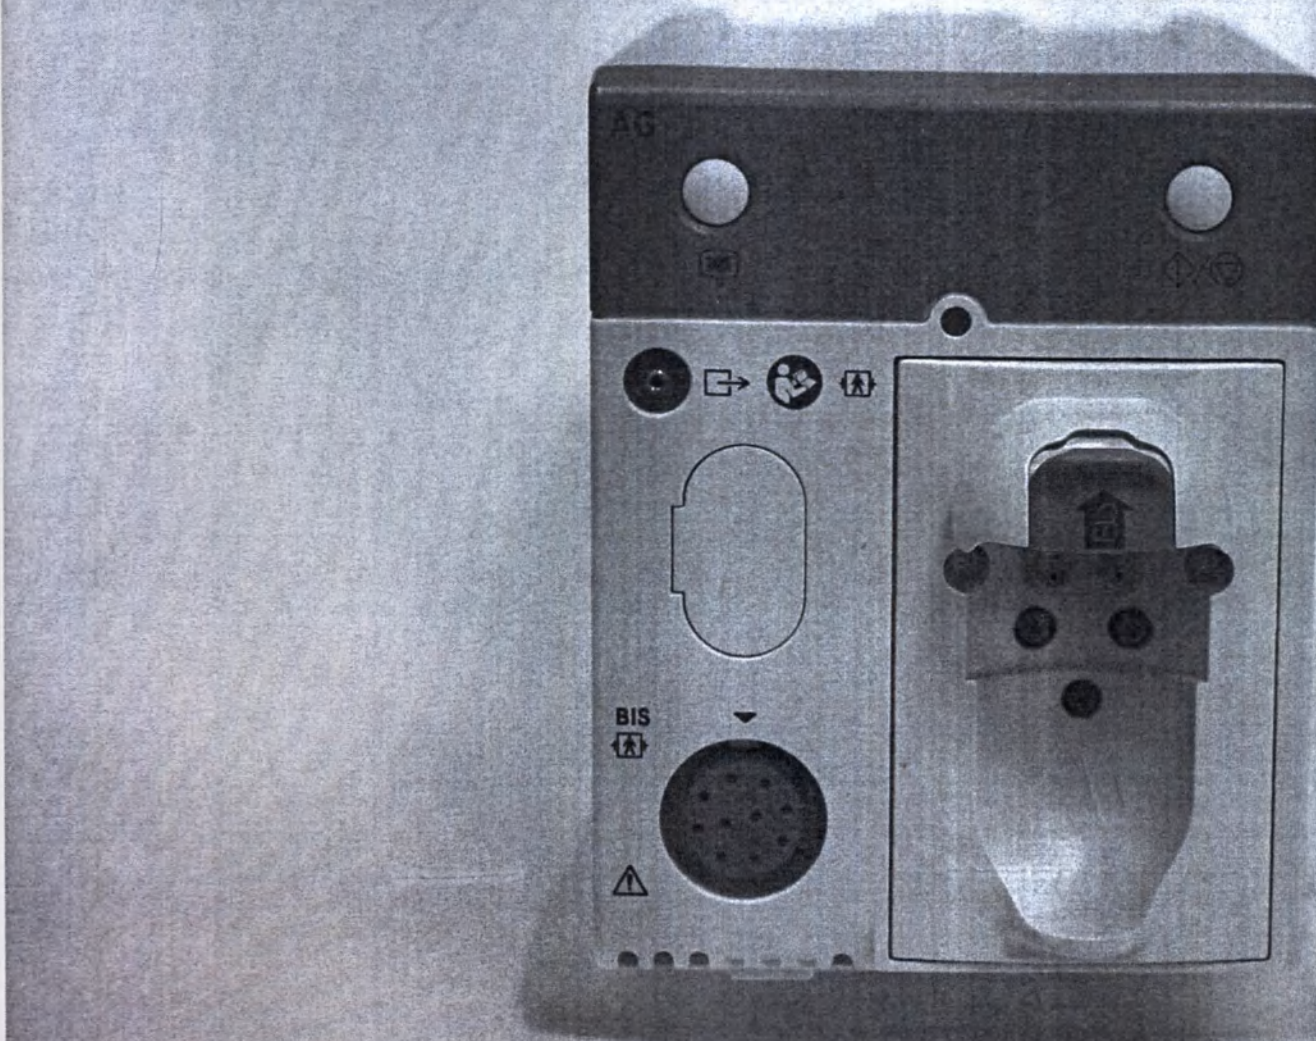


28. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, без расходных материалов, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



29. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, с мониторингом кислорода, без расходных материалов,



30. Модуль газоанализа, с автоматическим определением анестетика, в составе: трубка соединительная с быстроразъёмным адаптером, адаптер прямой, взрослые/дети, адаптер прямой, новорожденные, линия забора пробы газа, взрослые/дети, линия забора пробы газа, новорождённые, влагосборник, взрослые/дети, влагосборник, новорождённые, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

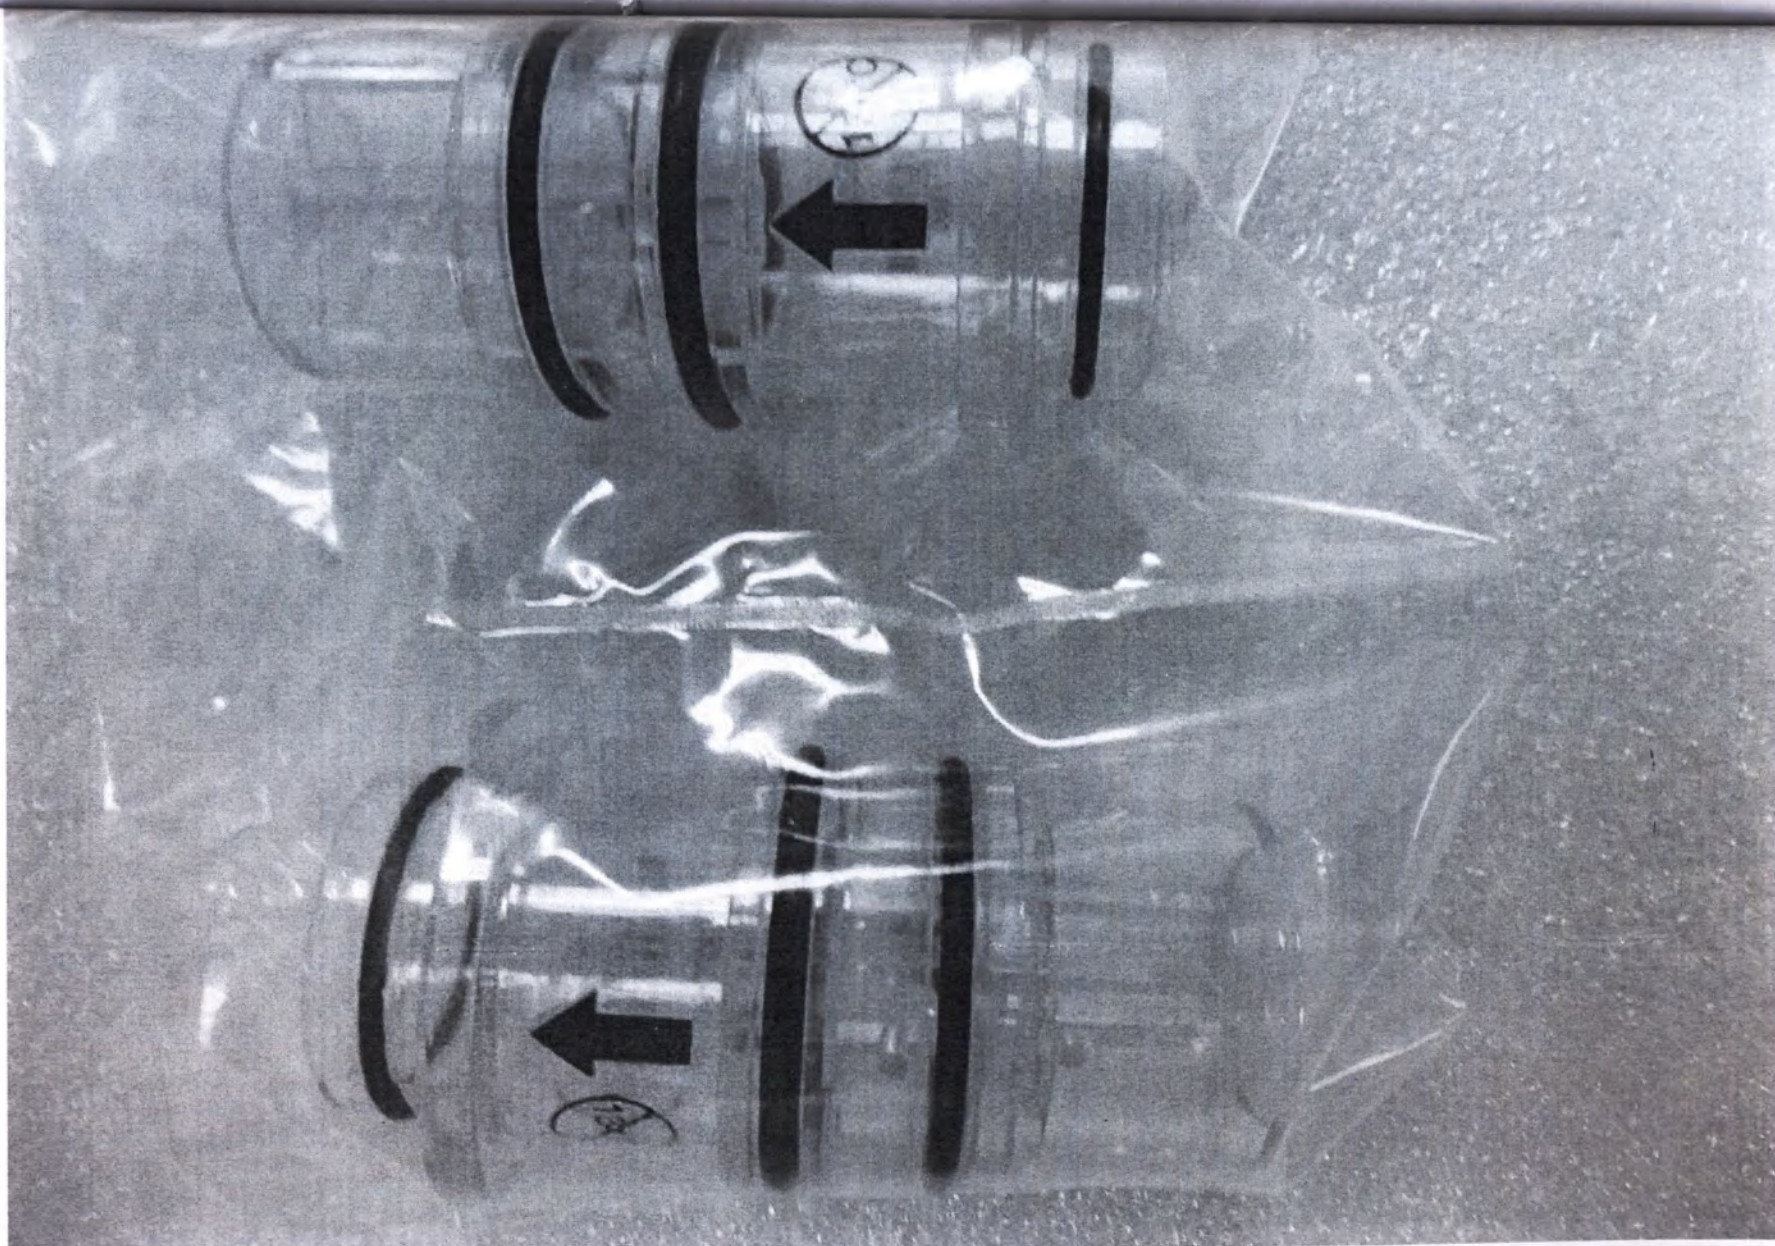


31. Датчики потока (инспираторные, экспираторные),
пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.




32. Набор дыхательного контура, одноразовый, для взрослых, в составе: контур пациента (дыхательный мешок 3 л, прямой адаптер, угловой адаптер, воздушный фильтр), для взрослых, 1.5 м, маска дыхательная, с клапаном, для взрослых, размер 5, 22 мм, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.


91568
17.11.2020

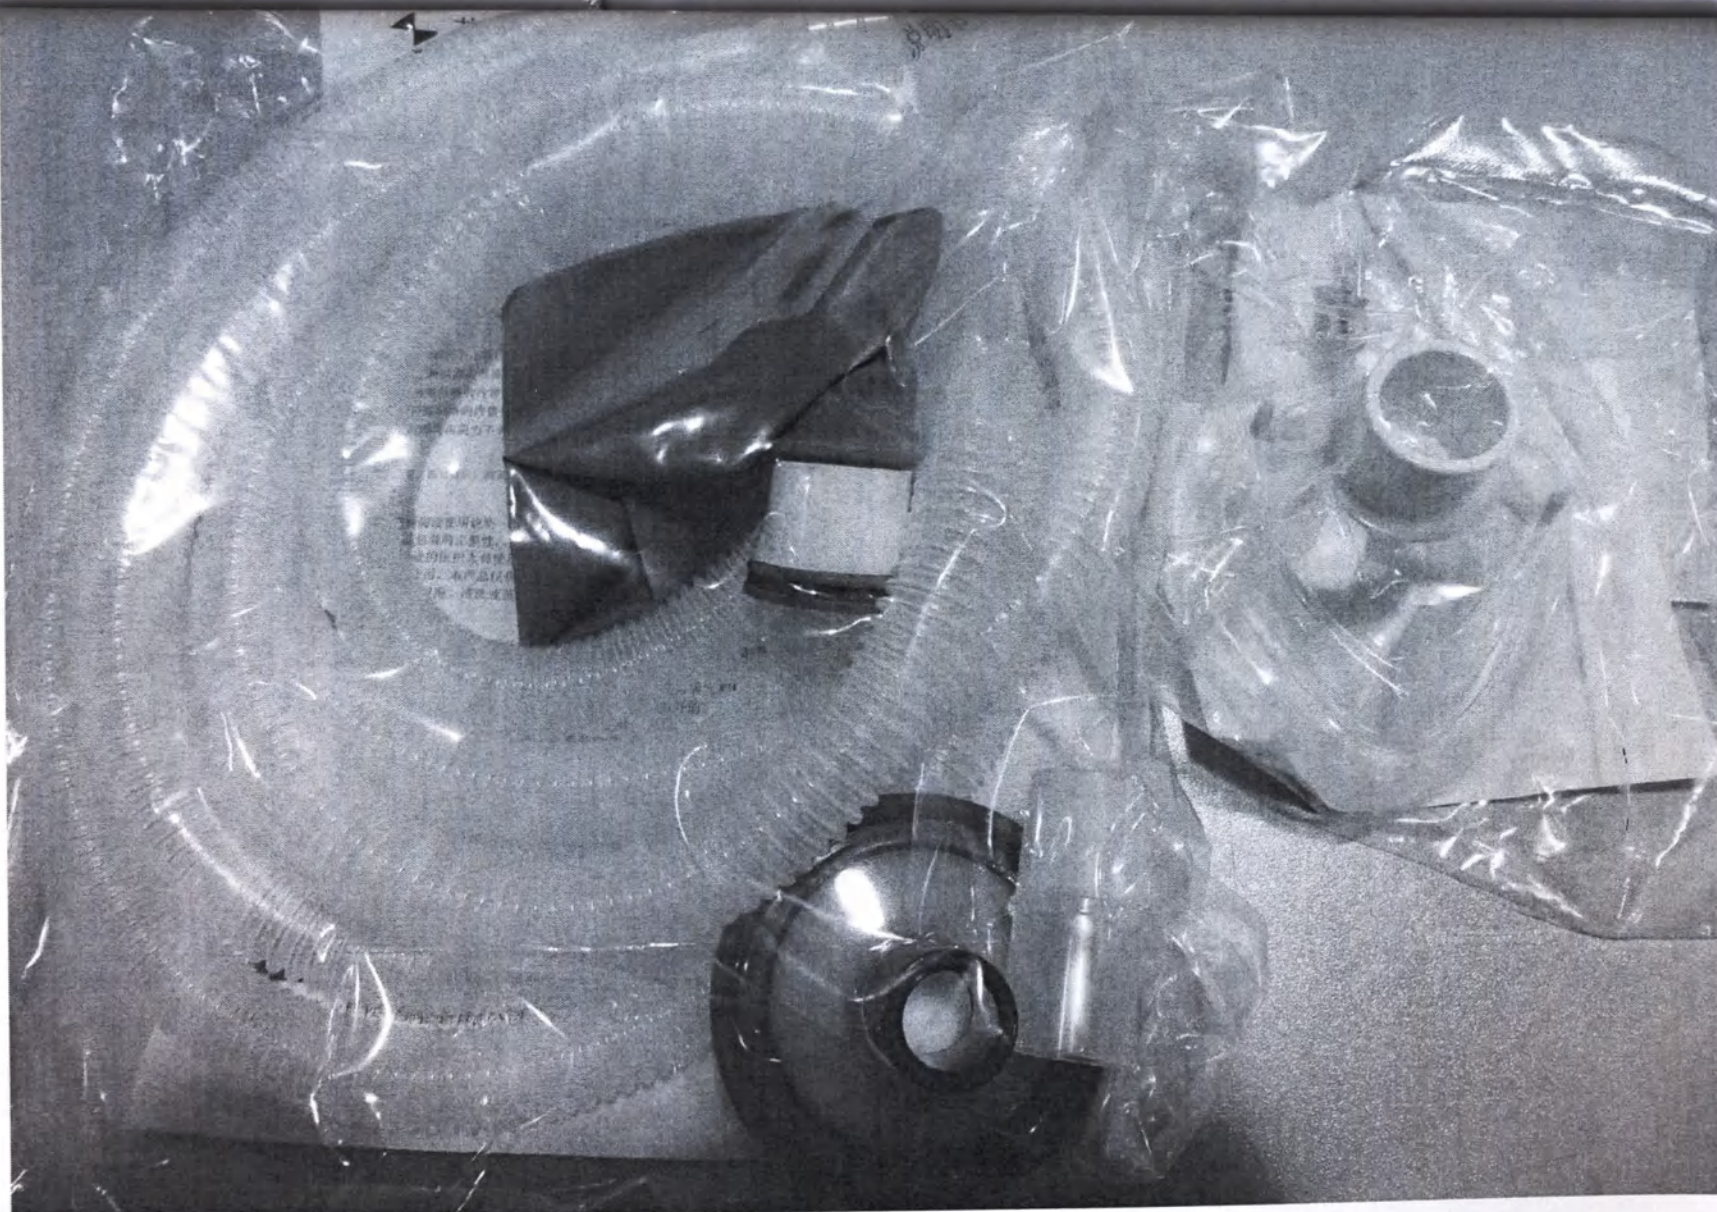


33. Набор дыхательного контура, одноразовый, для детей, в составе: контур пациента (дыхательный мешок 1 л, прямой адаптер, угловой адаптер, воздушный фильтр), для детей, 1.5 м, маска дыхательная, с клапаном, для детей, размер 2, 22 мм,

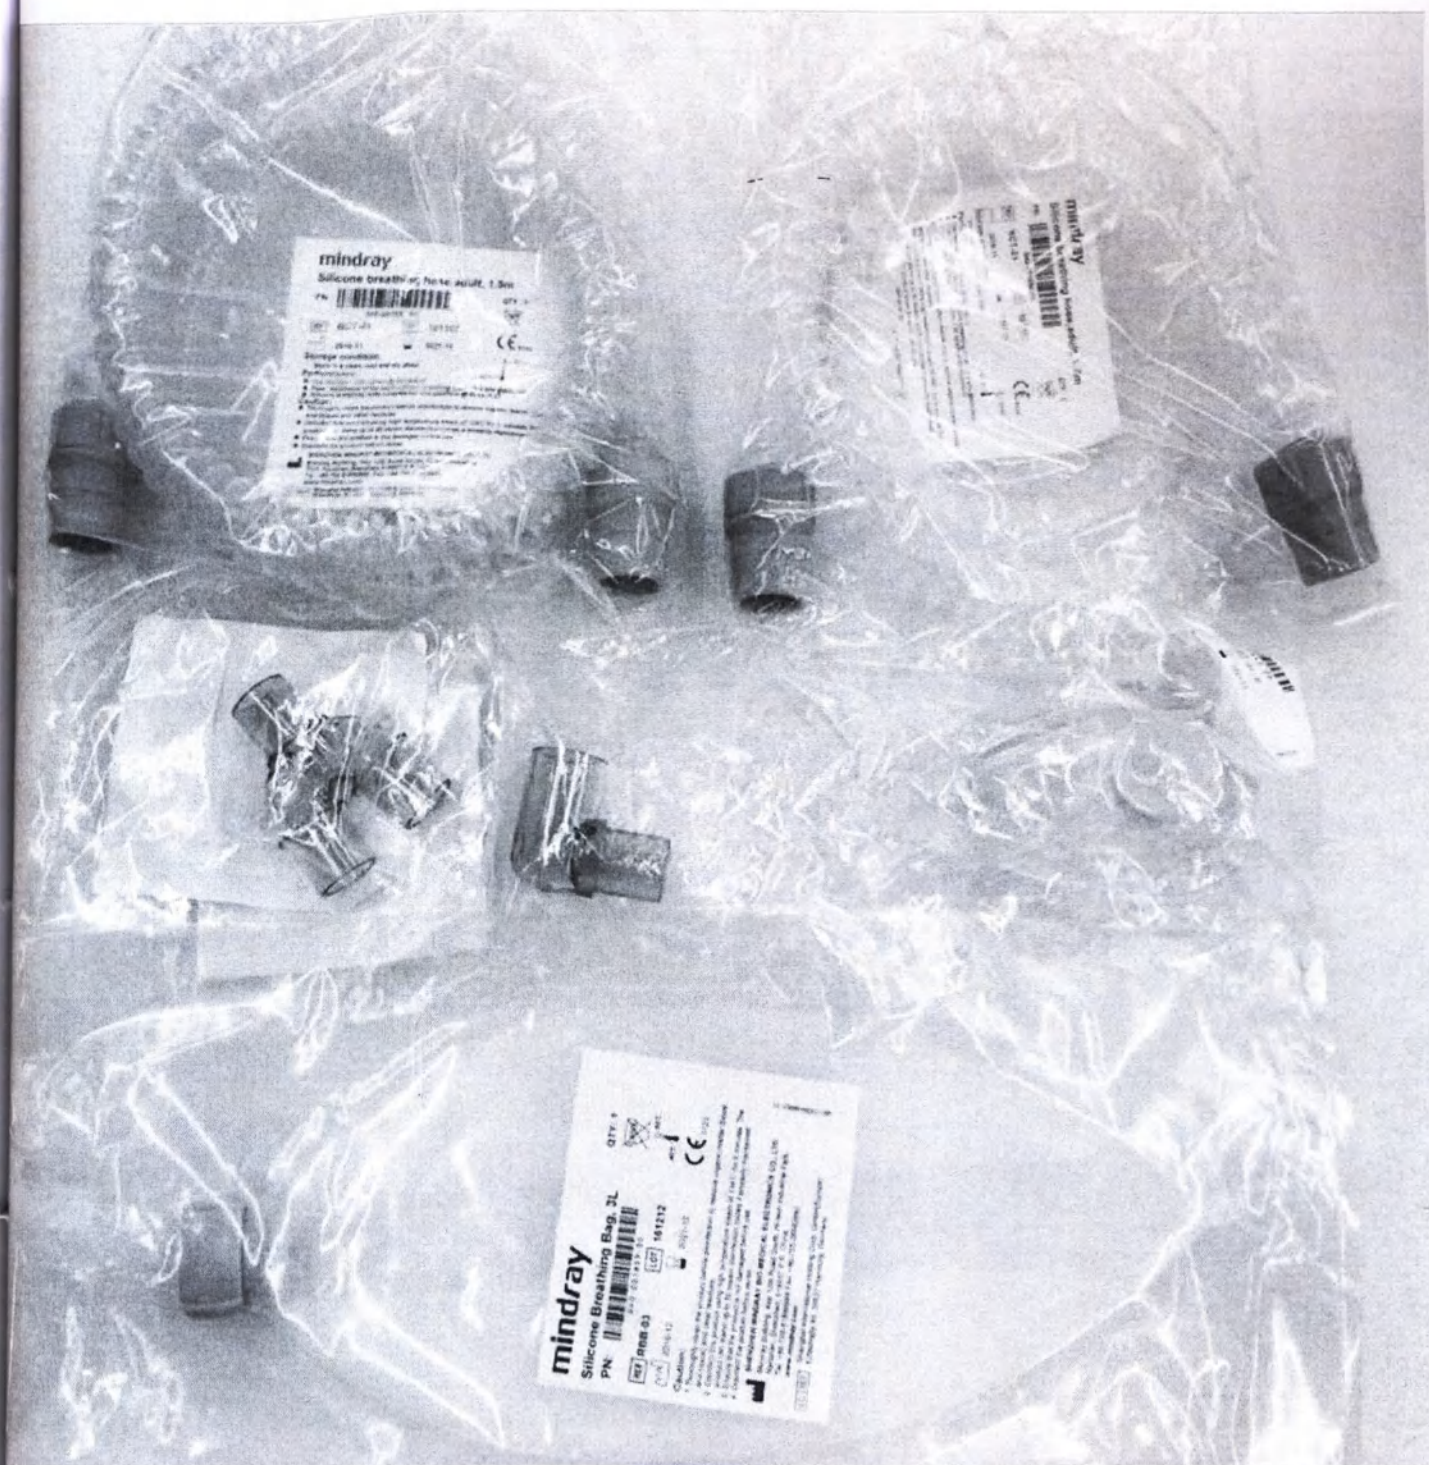


Набор дыхательного контура, многоразовый, для взрослых, в составе: контур пациента, силикон, для взрослых, 1.5 м, дыхательный мешок, силикон, 3 л, 22F, маска дыхательная, силикон, для взрослых, размер 5, 22 мм, Y-образный коннектор, 22М, угловой коннектор, 22F, Ф-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

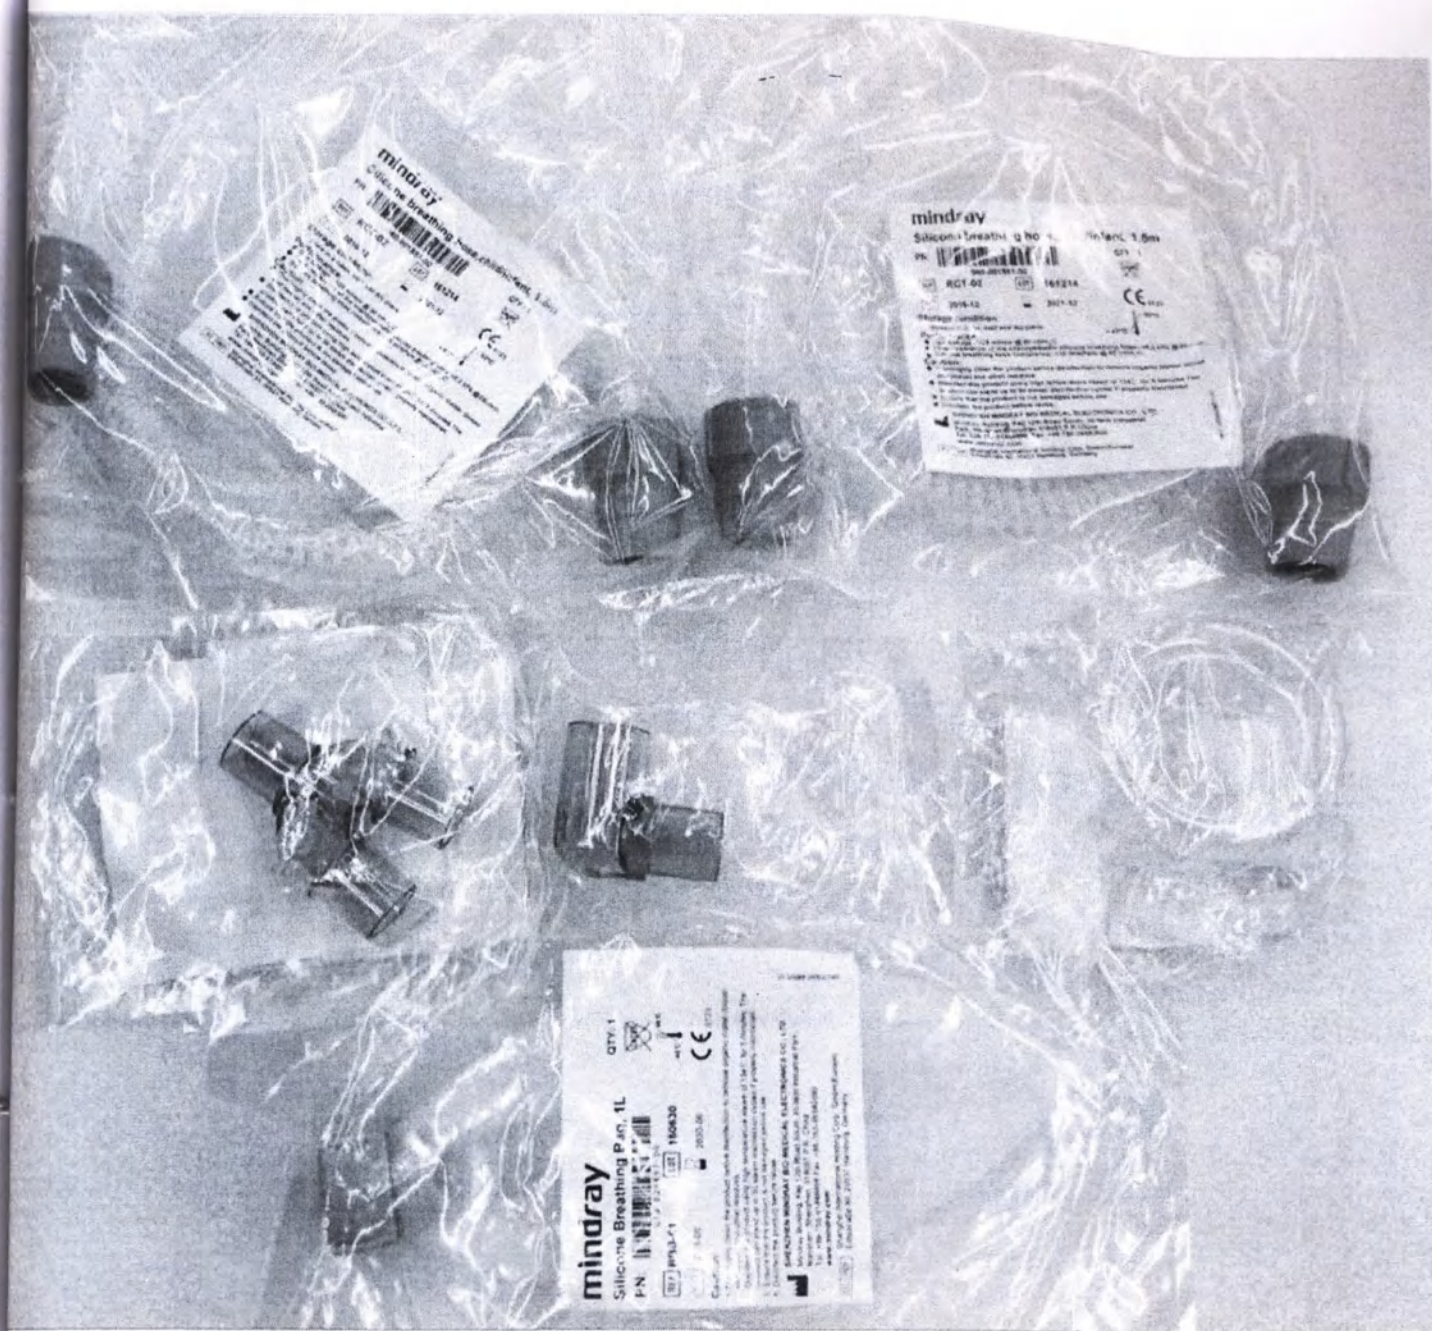


3. Набор дыхательного контура, многоразовый, для детей, в составе:
 контур пациента, силикон, для детей, 1,5 м, дыхательный мешок,
 силикон, 1 л, 22F, маска дыхательная, силикон, для детей, размер 2, 22
 м, Y-образный коннектор, 22М, угловой коннектор, 22F, пр-ва Shenzhen
 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

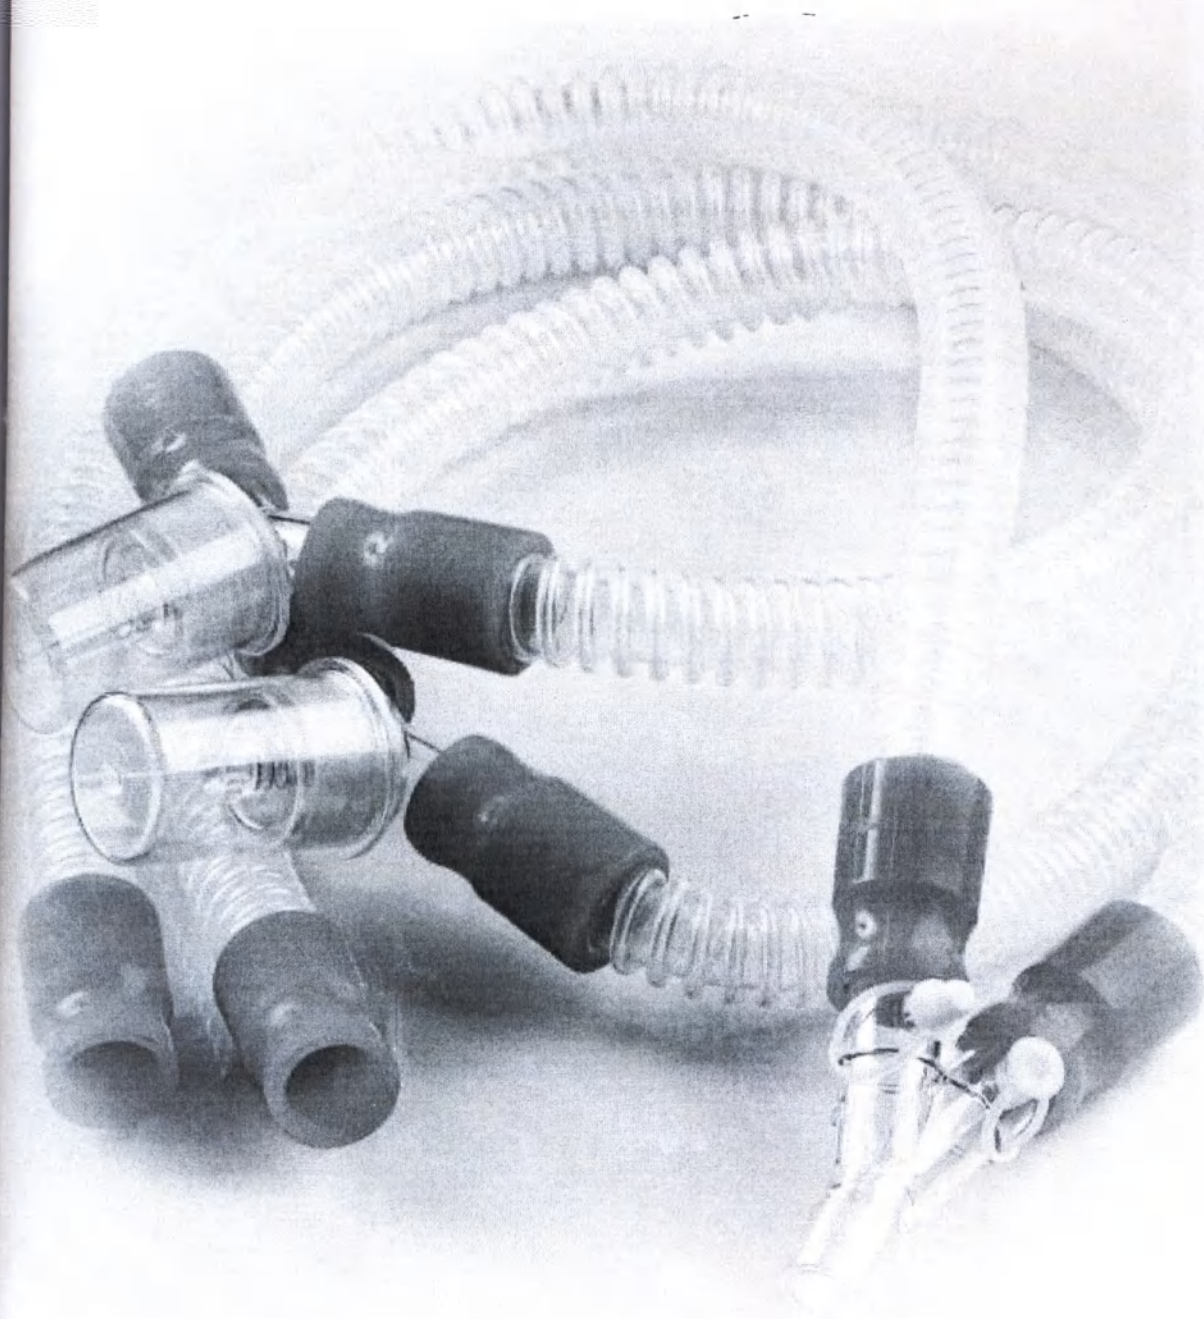


3. Дыхательные контуры анестезиологические и реанимационные (антимикробные) для взрослых, для детей, для новорожденных с обогревом или без с принадлежностями (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

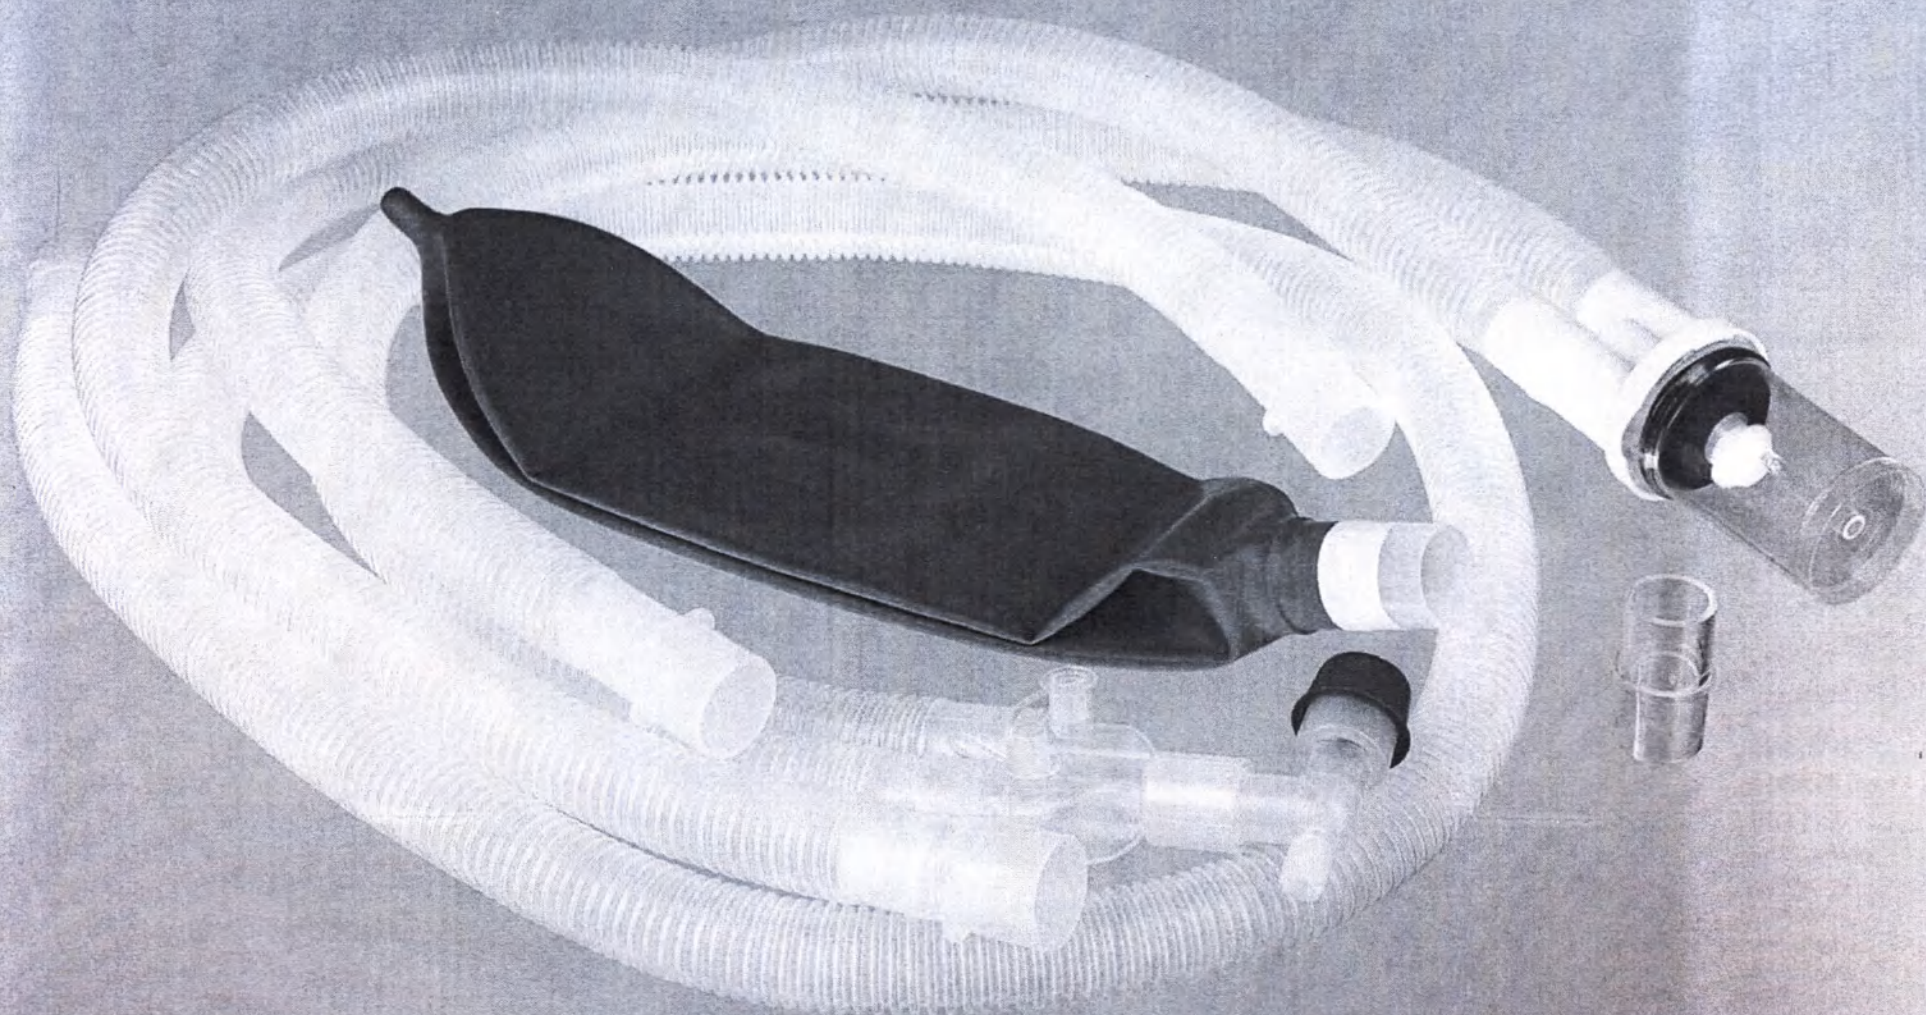


36. Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-\"МС-1\" по ТУ 9398-001-72474991-2005, РУ № ФСР 2010/07116, пр-ва ООО «Медсиликон», Россия.

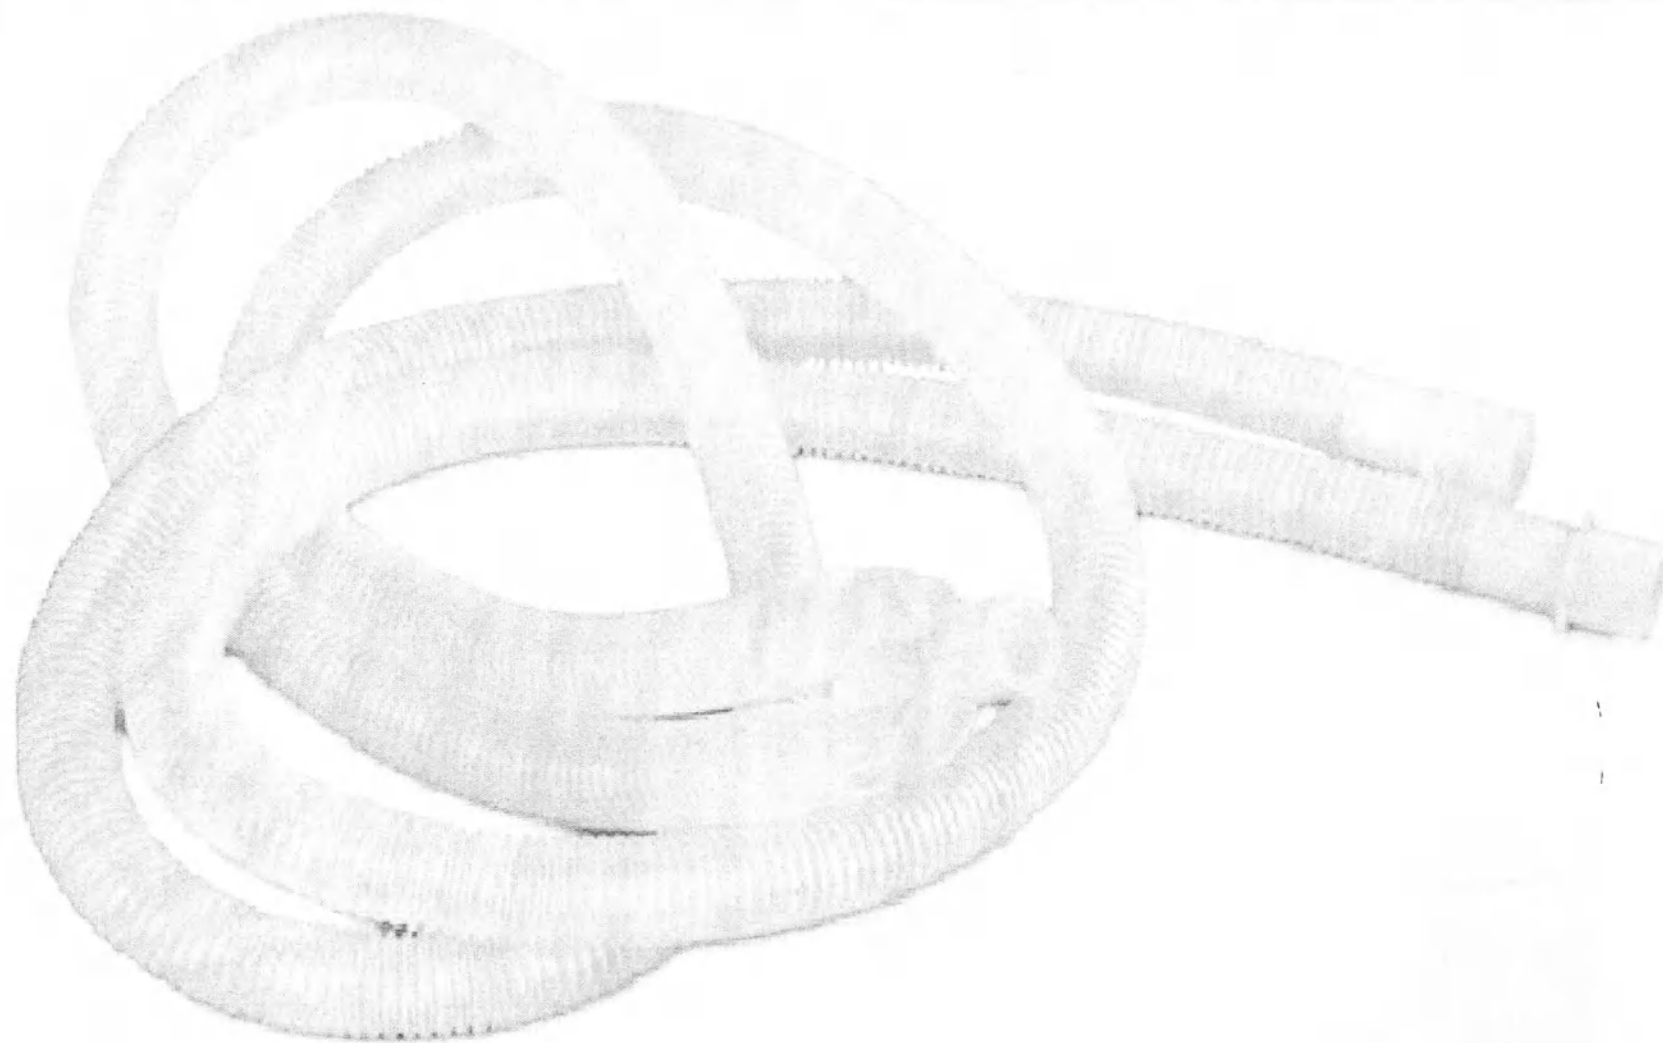

36. Контуры и трубки дыхательные, эндотрахеальные, трахеостомические (виды 275820; 185610; 185600; 136260; 136500), РУ № ФСЗ 2011/11170, пр-ва «Covidien Llc», США,

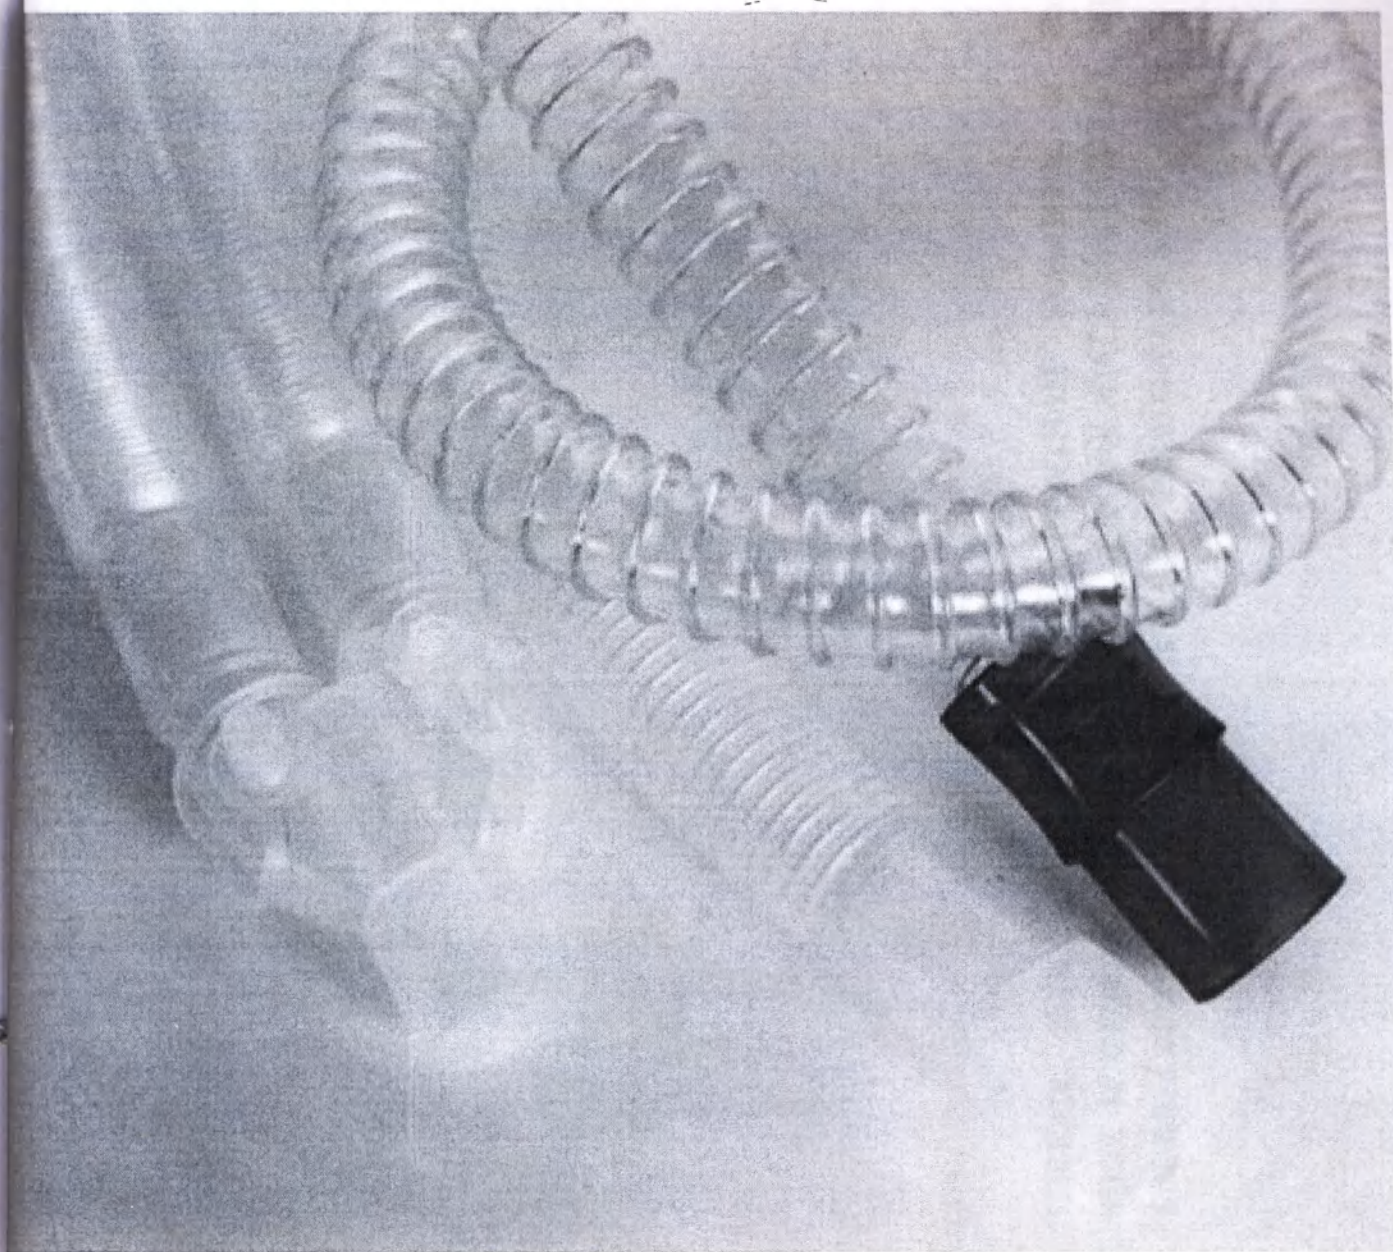


36. Контур дыхательный, РУ №ФСЗ 2012/12412,
пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия.

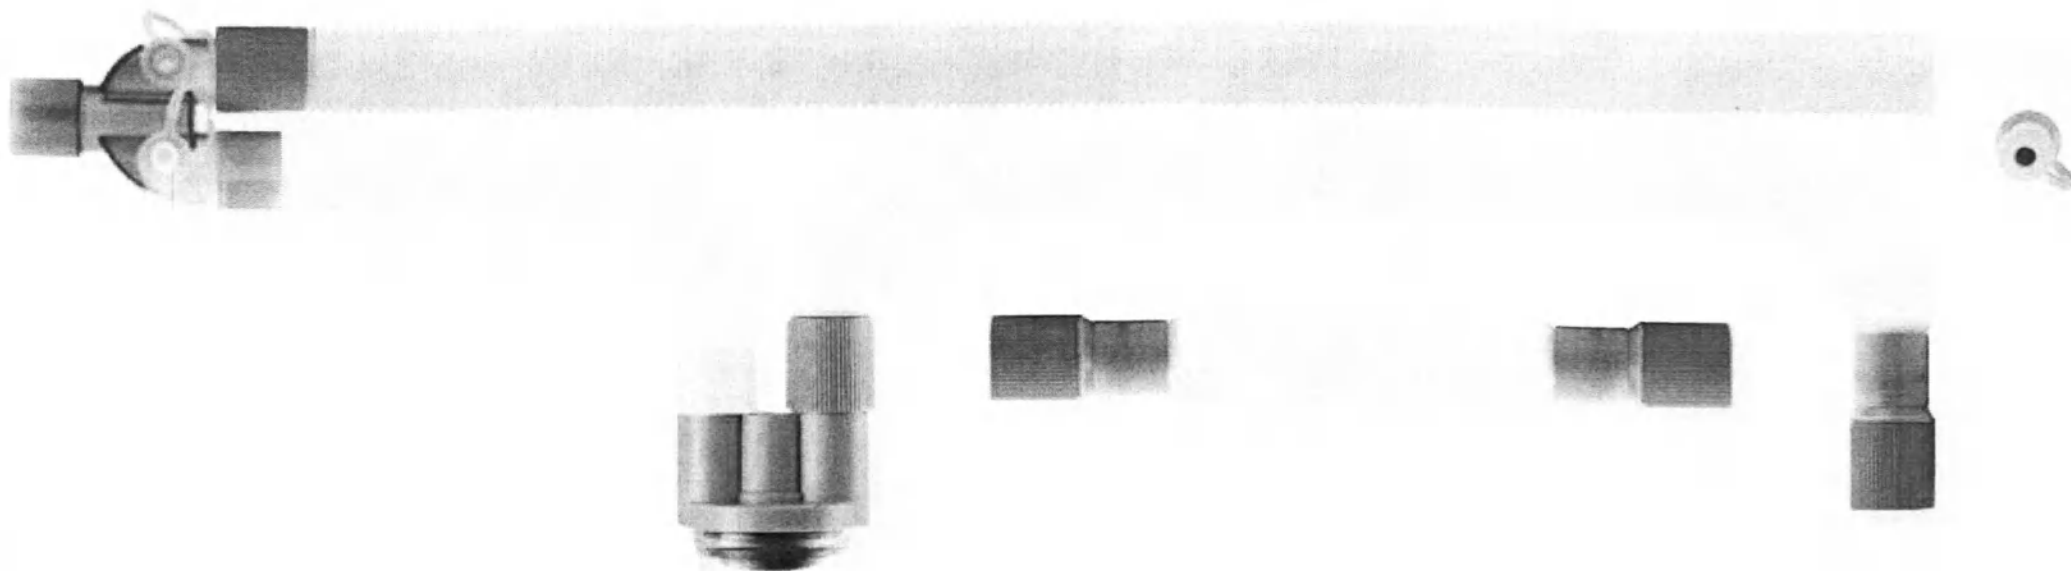


36. Изделия медицинские для аппаратов кислородной терапии и искусственной вентиляции легких в наборах и отдельных упаковках, РУ № ФСЗ 2011/09111, пр-ва "Фишер & Пэйкер Хелткер Лтд", Новая Зеландия, Fisher & Paykel Healthcare Ltd.




37. Маски Air-soft, с клапаном: для младенцев, большая, размер 0; для младенцев, большая, размер 1; для детей, размер 2; для детей, большая, размер 3; для взрослых, размер 4; для взрослых, большая, размер 5, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

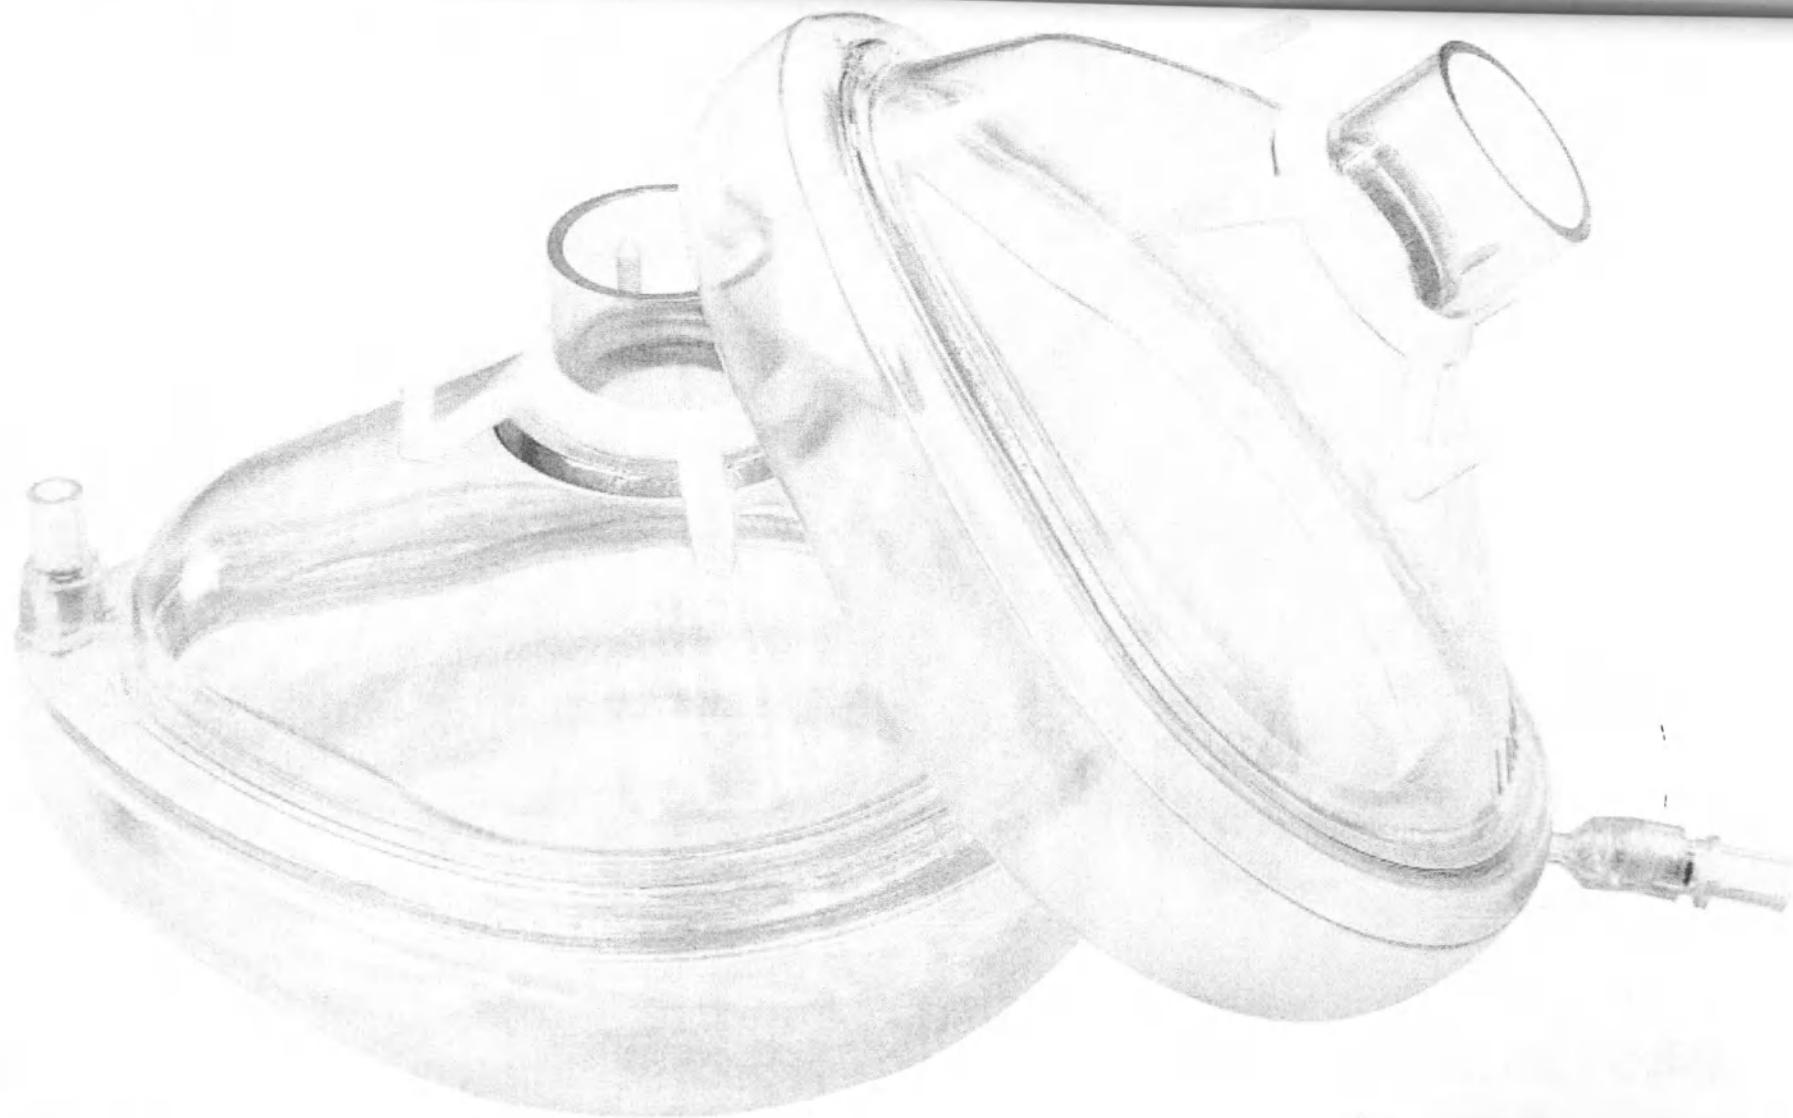


**38. Маска наркозная РУ № ФСЗ 2012/12412,
пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия.**

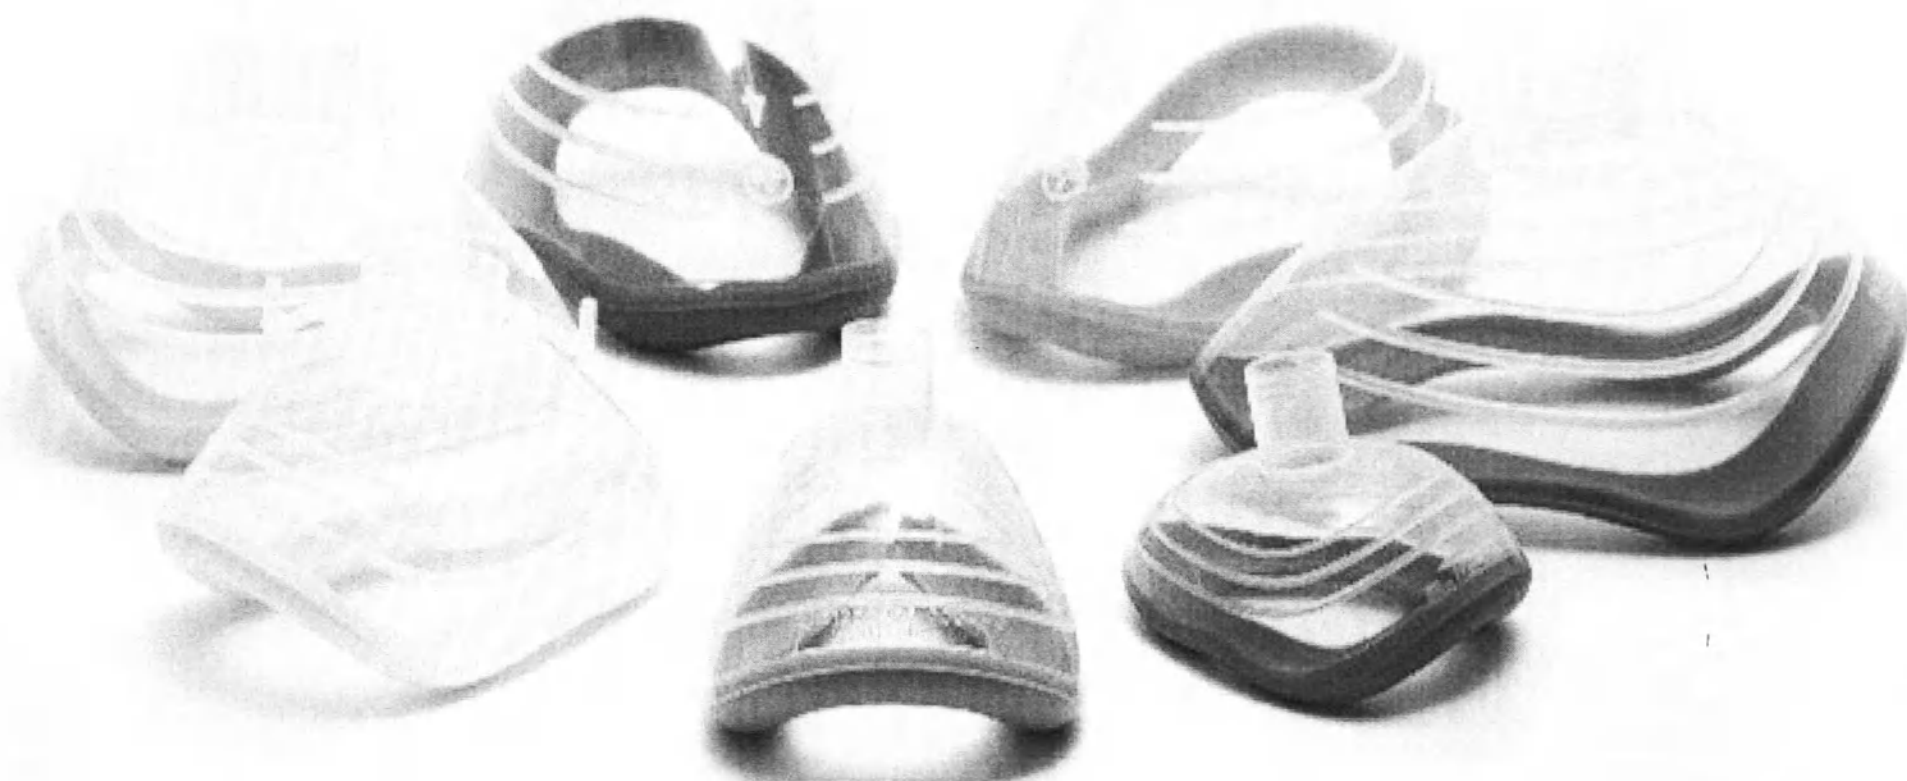

38. Анестезиологические маски, размерами 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6: QuadraLite, EcoMask II, ароматизированные/ неароматизированные лицевые маски, экономичные анестезиологические лицевые маски, анестезиологические бронхоскопические лицевые маски, маски лицевые анатомические, маски ClearFlex, маски Rendell Baker (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

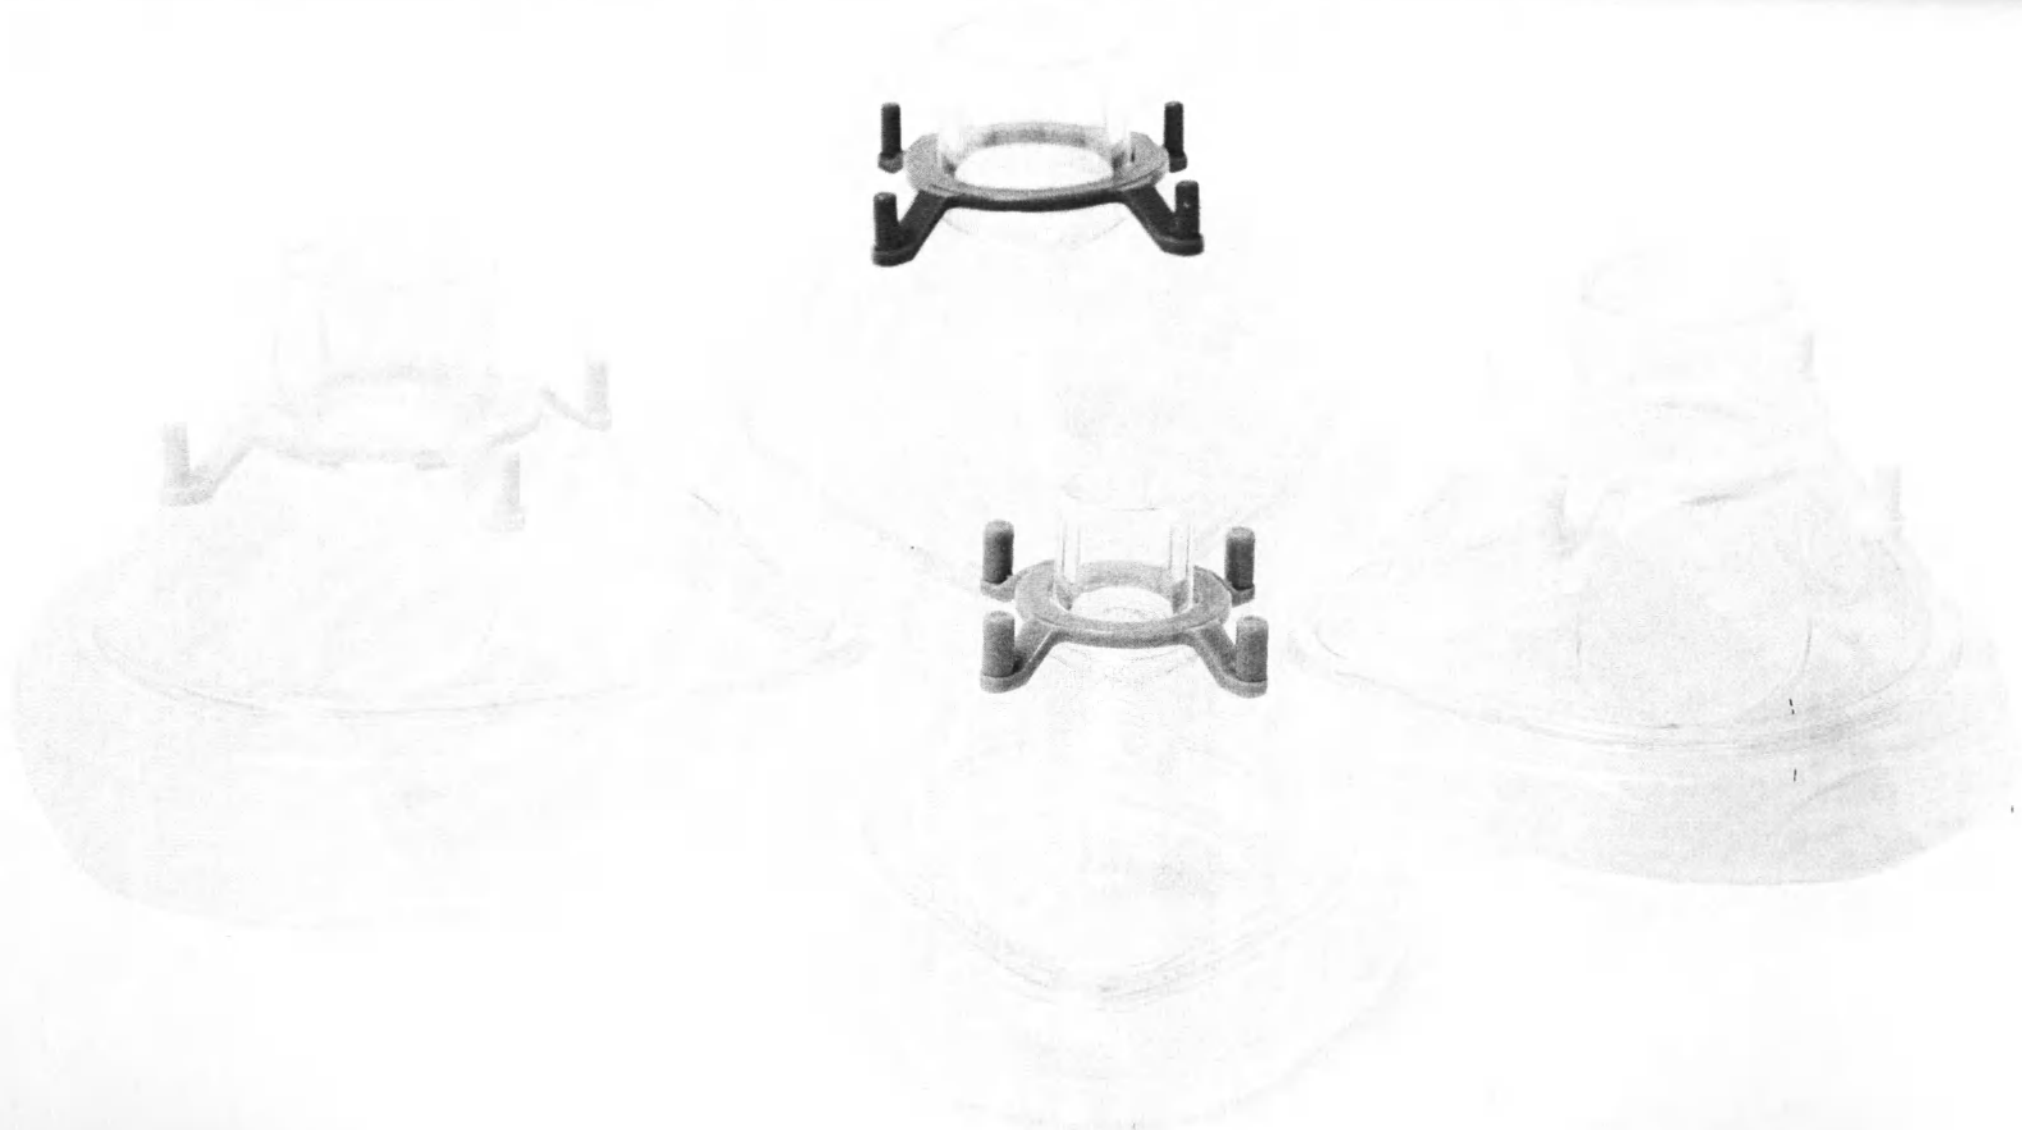


38. Маски (виды 275780; 109730; 109740; 271370), РУ № ФСЗ 2011/11170, пр-ва «Covidien Llc», США.

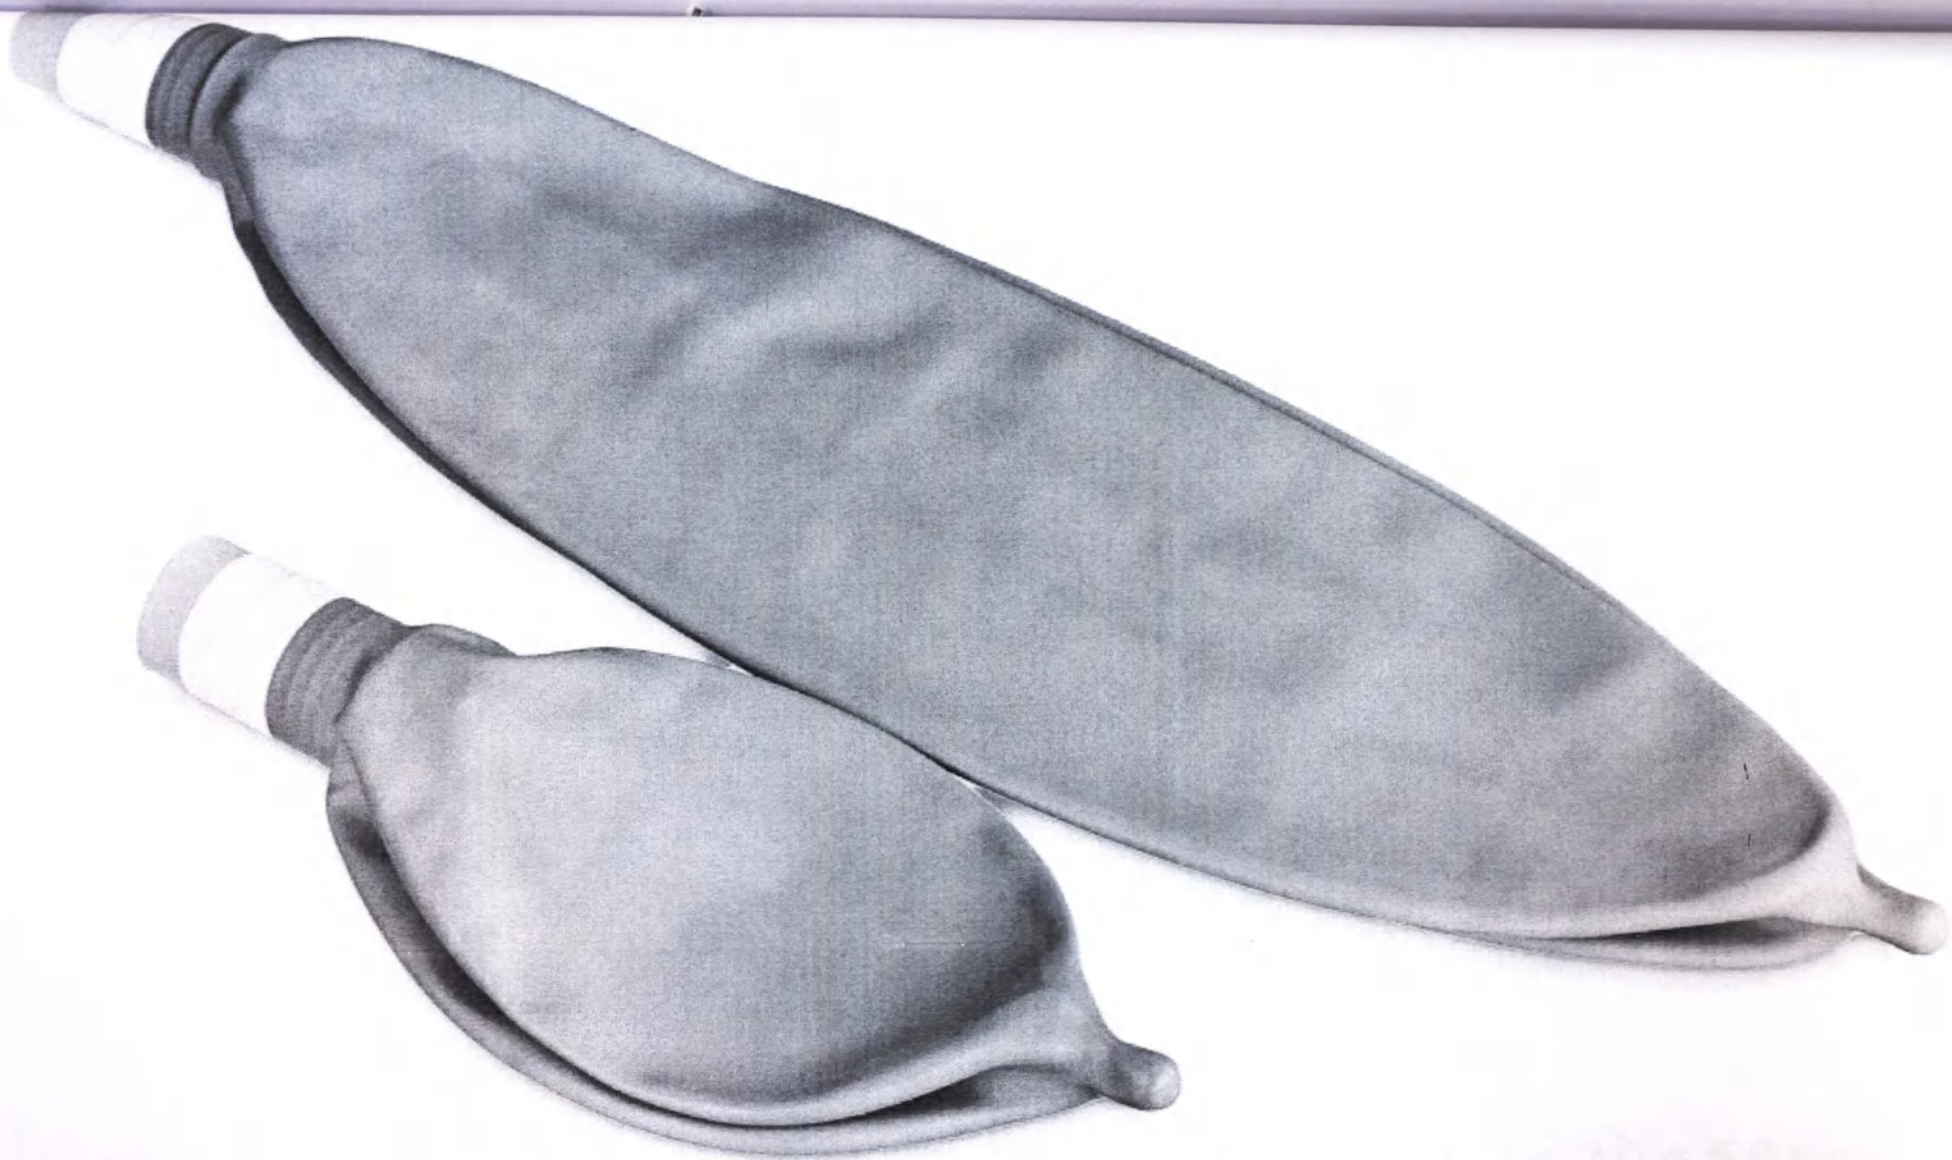


39. Мешки дыхательные (вид 283460),
РУ № ФСЗ 2011/11170,
пр. на «Covidien Llc», США.

91568
17.11.2020

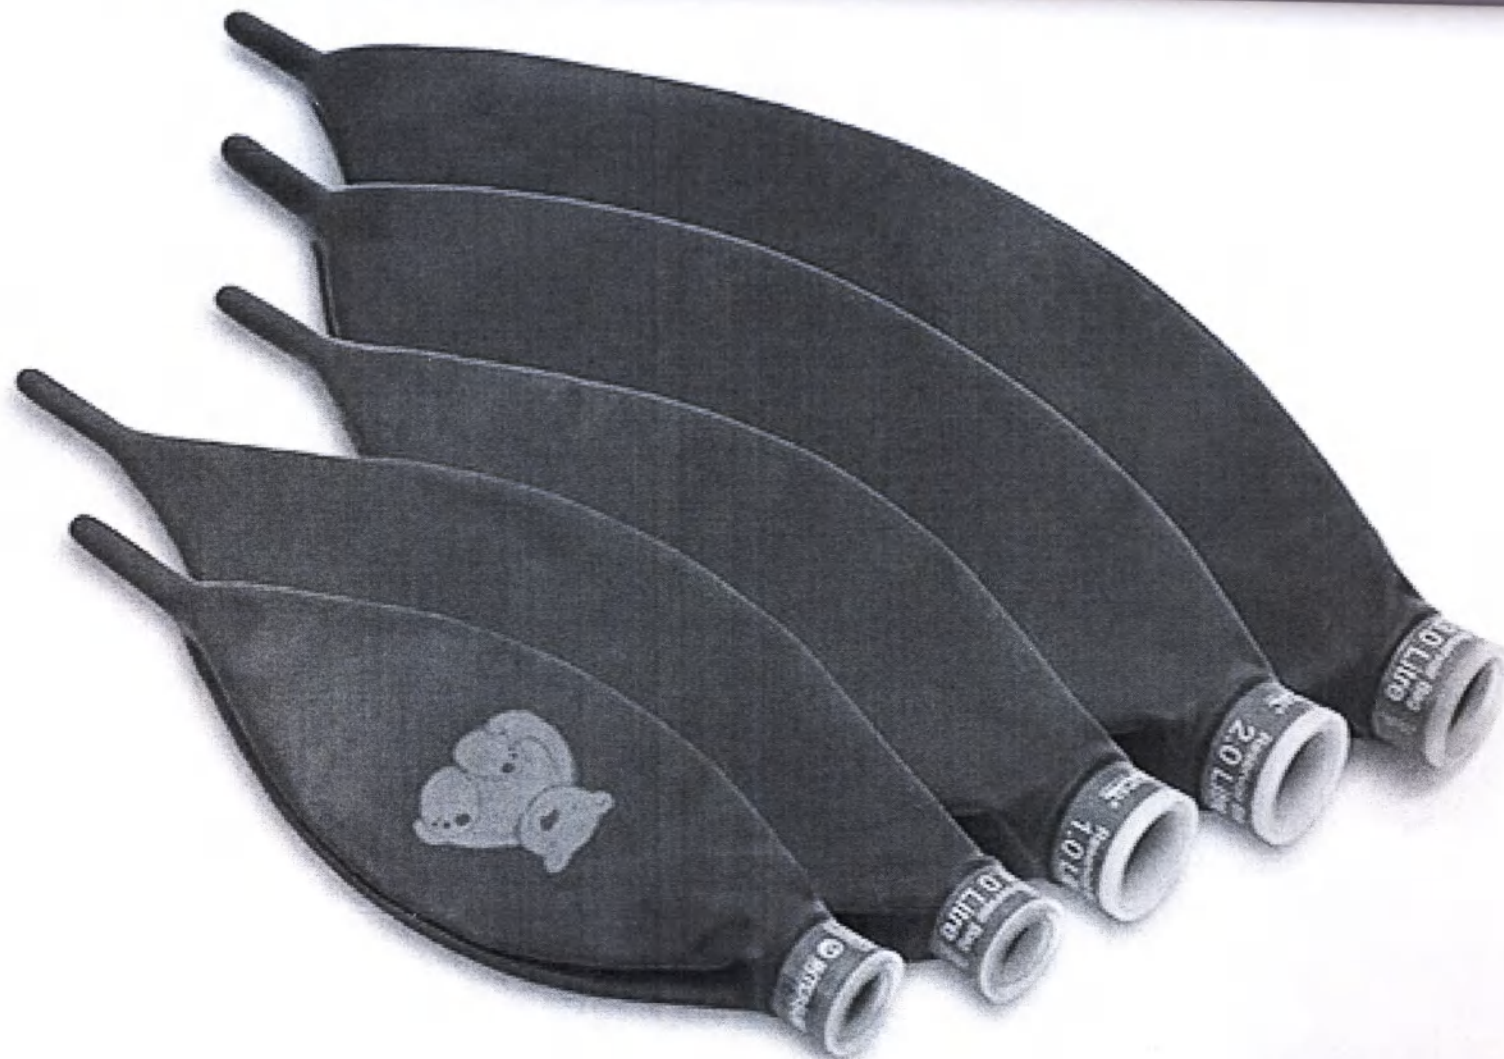

39. Дыхательные мешки объёмом: 0.5 л; 1.0 л; 1.3 л; 2.0 л; 2.3 л; 3.0 л; 5.0 л для анестезиологических или реанимационных дыхательных контуров с петлёй или без, с закрытым концом; для аппаратуры (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания

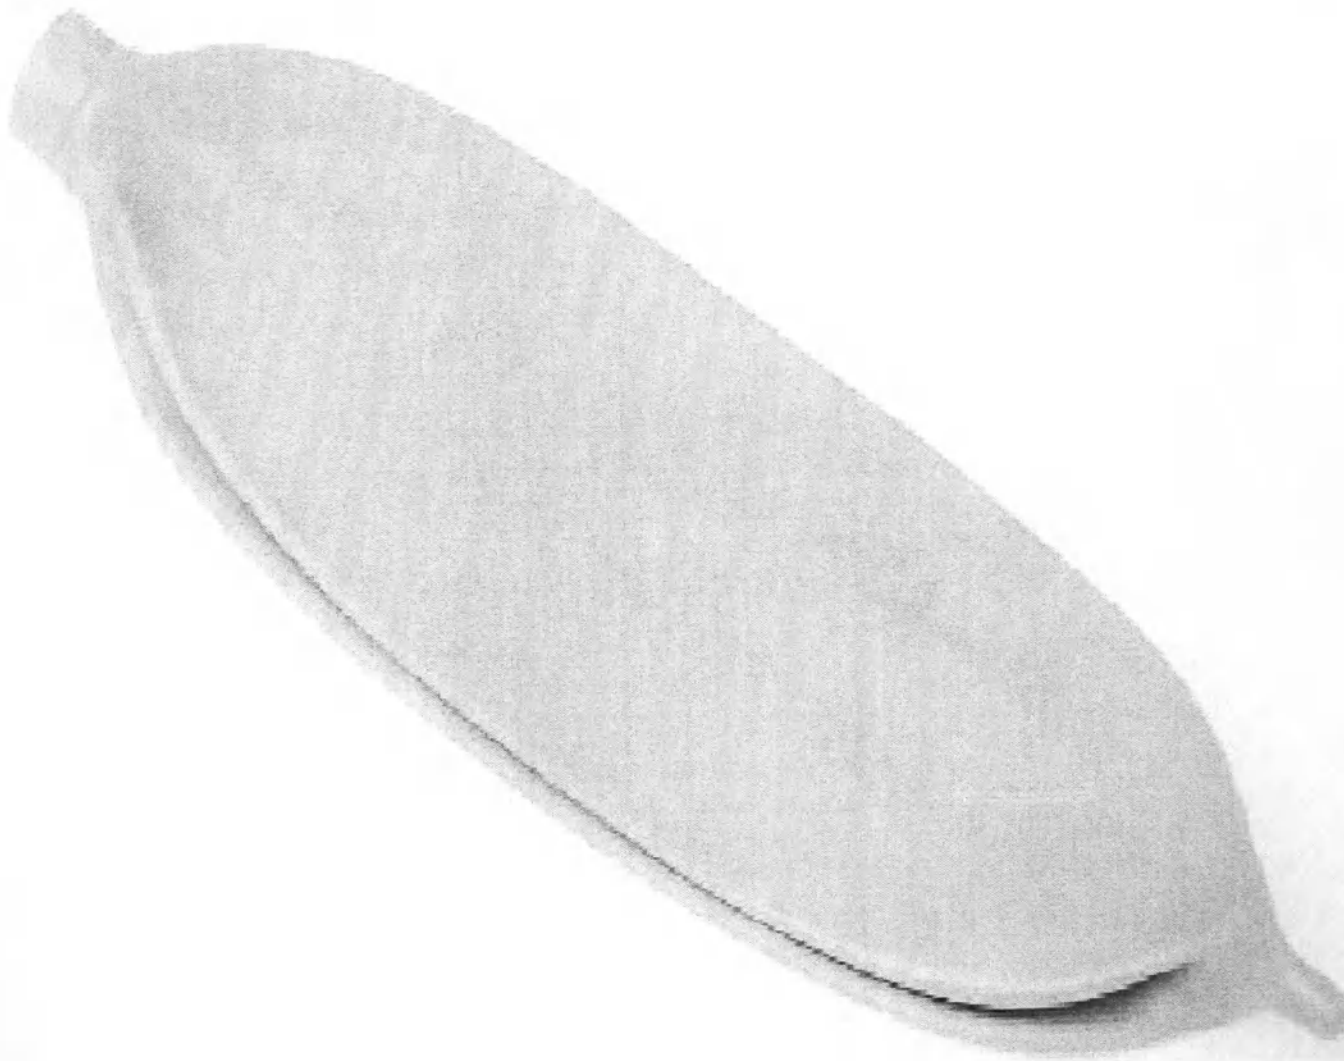

**39. Мешок дыхательный для вентиляции, РУ № ФСЗ 2012/12412,
пр-ва «Teleflex Medical», Ирландия.**

91568
17.11.2020



40. Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры без соединителей: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов (при необходимости), РУ № ФСЗ 2009/03551, пр-ва «Intersurgical Ltd», Великобритания.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

Rechargeable
Li-ion Battery Pack

mindray

CAUTION

Risk of fire, explosion, or burns.
Do not disassemble, crush, puncture the battery or cause it to short circuit.
Do not place the battery in fire or water.
Do not place the battery in an environment whose temperature is above 60°C(140°F).
Store the battery in the -20°C(-4°F) to 60°C(140°F) environment.
Use the specified charger only.
Read instructions for use.
Maximum Recommended Ambient is 45°C(125°F)



警告:

使用不当可能导致电池起火、爆炸或燃烧。
切勿拆卸、挤压、刺破或使电池短路。
切勿放置于火中或水中。
切勿放置于60°C(140°F)以上的高温环境中。
在-20°C(-4°F)到60°C(140°F)温度下存储。
只能使用指定的充电器。
阅读本产品的操作说明。
推荐使用的最高环境温度为45°C(125°F)。

可充电锂离子电池
Model(型号): LI23S002A
DC 11.1V $\approx$ 4500mAh
49.95Wh



MADE IN CHINA
中国制造


41. Батарея аккумуляторная Li-ion, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.




42. Набор для мониторинга концентрации кислорода: датчик кислородный, пр-ва EnviteC-Wismar GmbH, Германия; кабель для датчика кислородного, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.



43. Трубка пассивного вывода анестетического газа,
пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

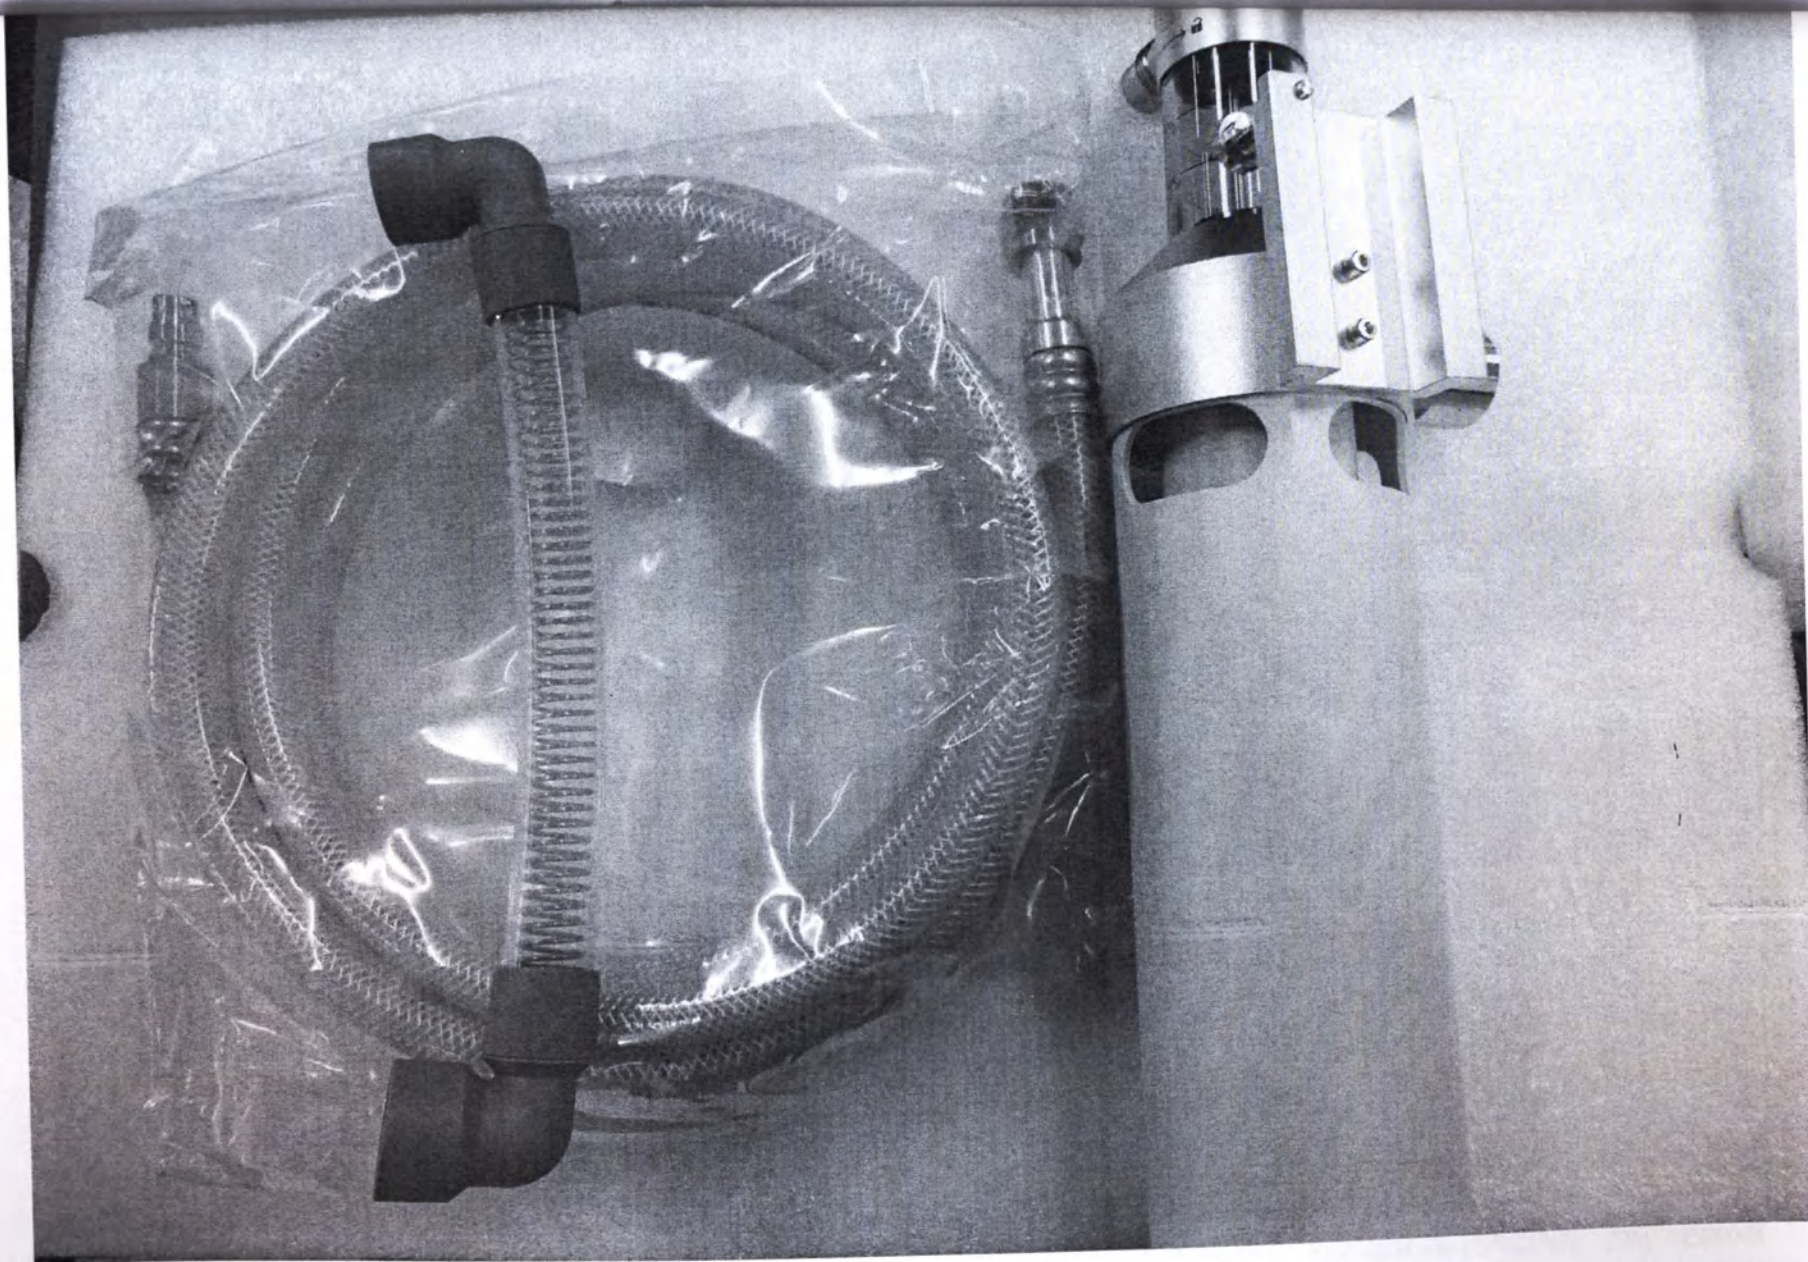


44. Система удаления газовых анестетиков (AGSS system) с высокопоточной системой утилизации, в составе: система утилизации высокопоточная; шланг газопередающий; шланг газывыводящий; пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

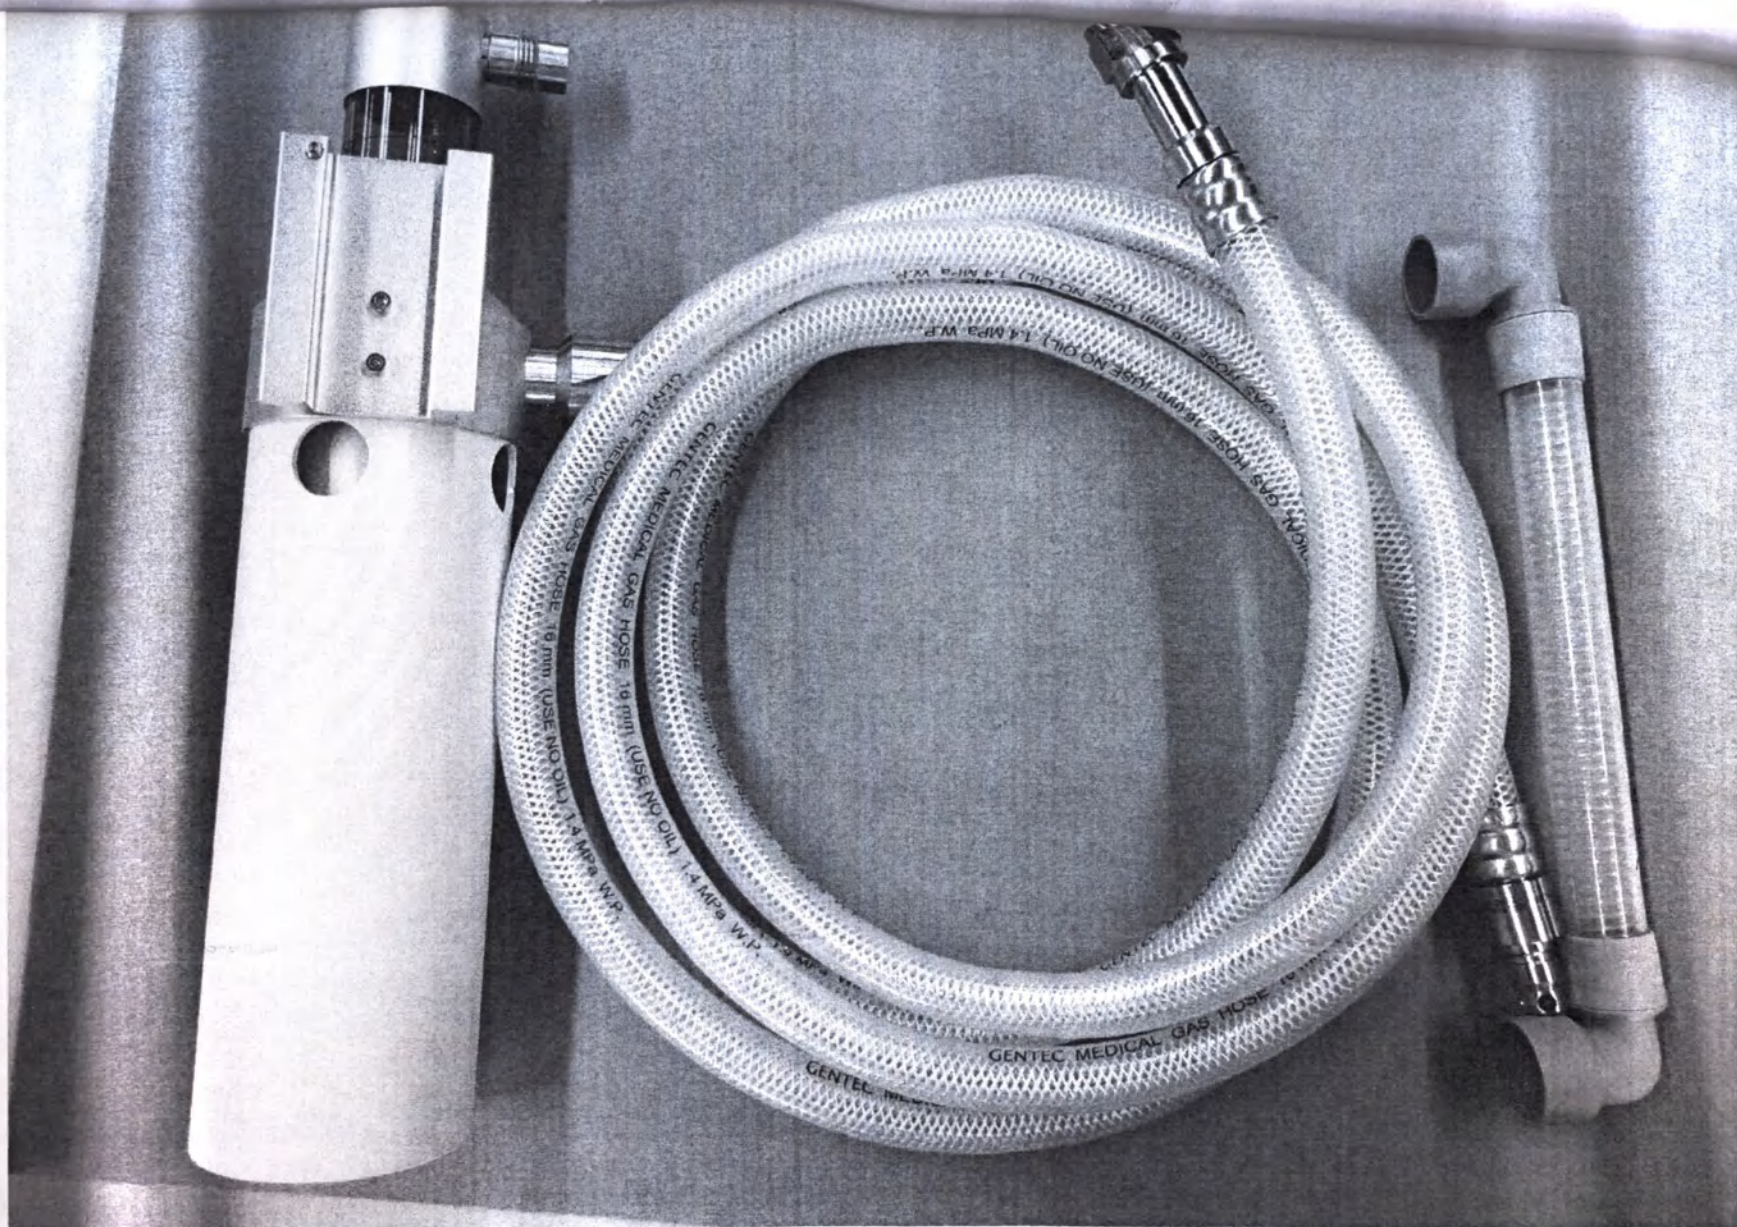


44. Система удаления газовых анестетиков (AGSS system) с низкотоочной системой утилизации, в составе: система утилизации низкотоочная, шланг газопередающий, шланг газывыводящий, пр-ва Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай


91568
17.11.2020

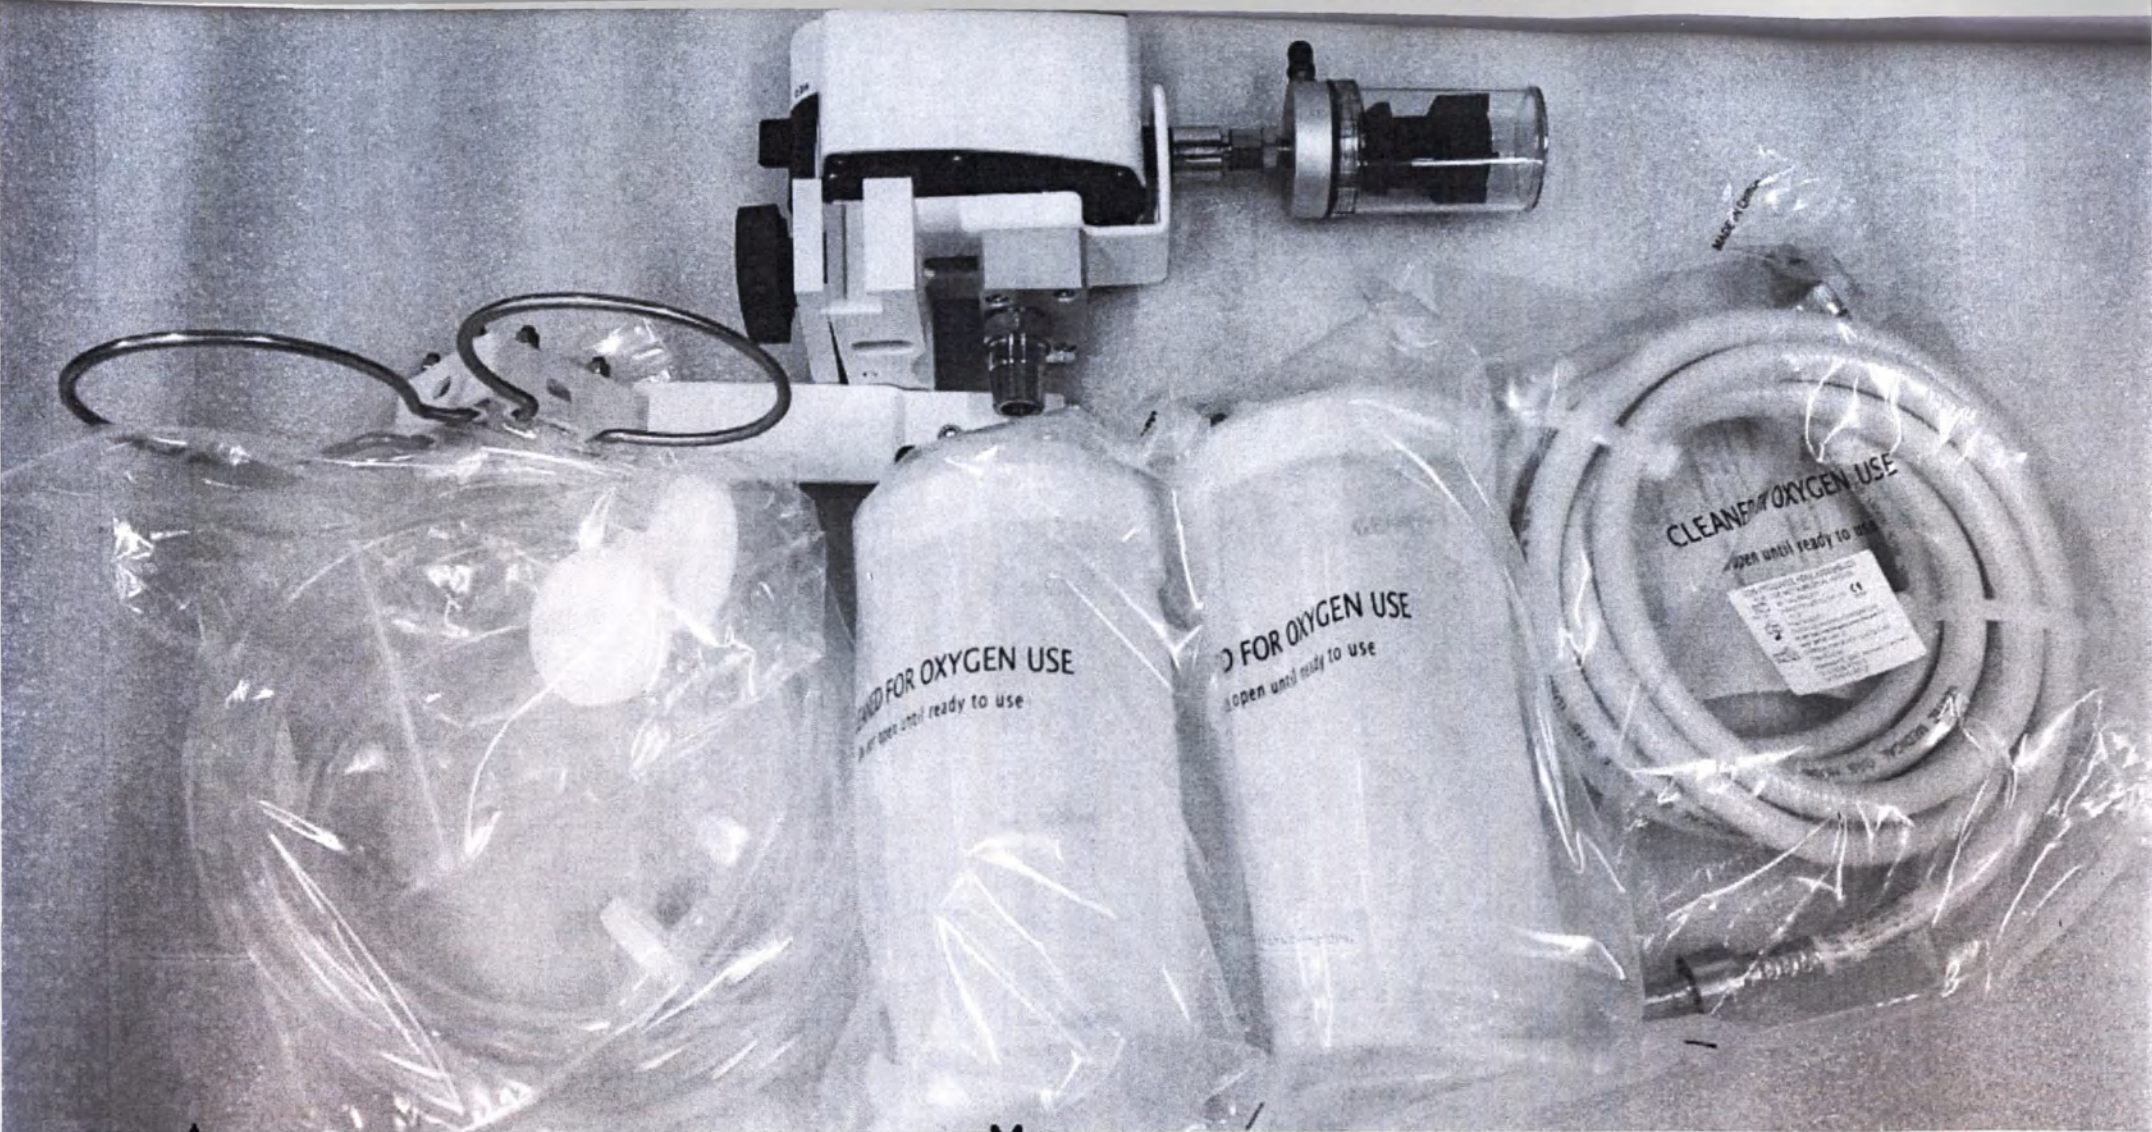

45. Аспиратор внешний (вакуумный привод), в составе: регулятор отрицательного давления, контейнер для защиты от переполнения, шланг для воздуха с Т-образным коннектором, контейнер-сборник жидкости, подставка контейнера-сборника, трубка отсасывающая, фильтр, пр-ва Genstar Technologies Company, Inc, США.

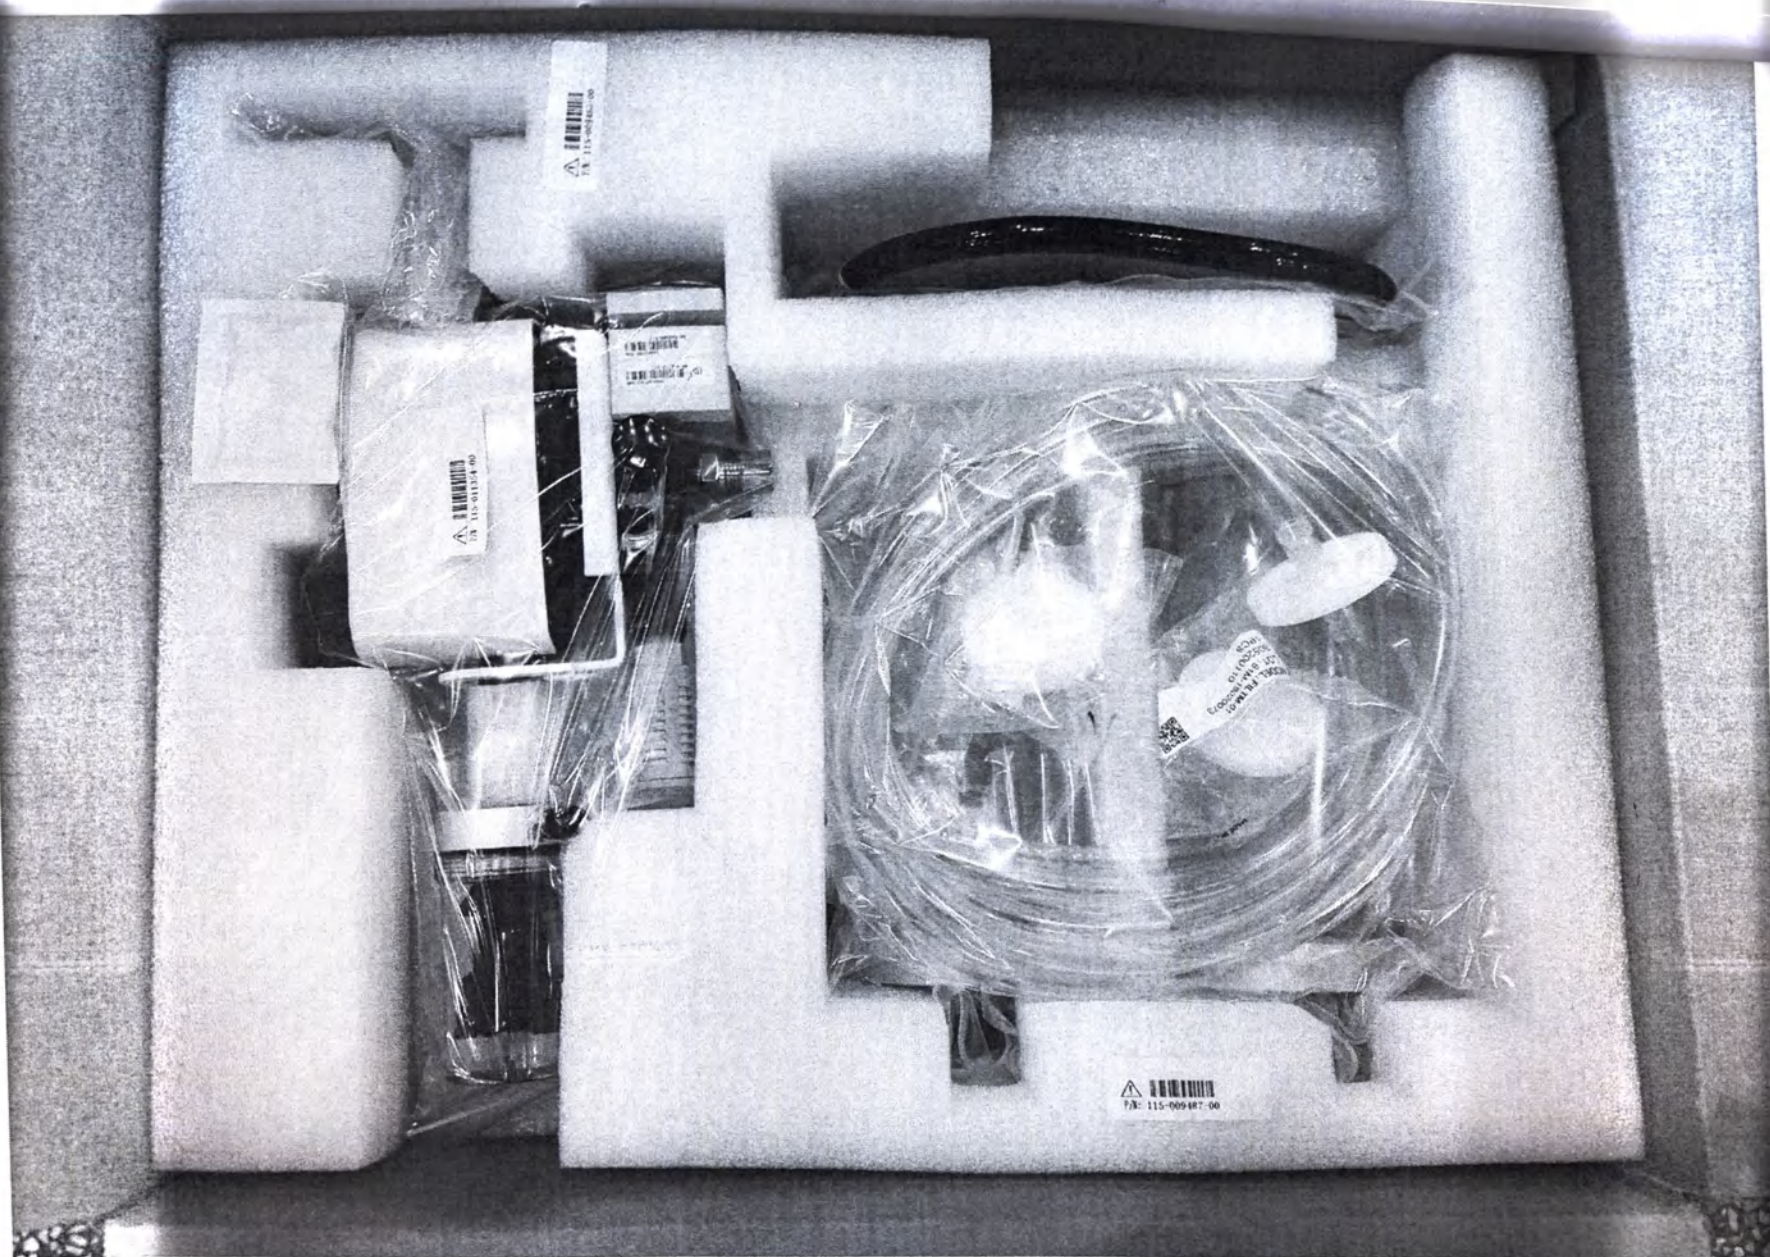

45. Аспиратор внешний (воздушный привод), в составе: регулятор отрицательного давления, контейнер для защиты от переполнения, шланг для воздуха с Т-образным коннектором, контейнер-сборник жидкости, трубка отсасывающая, фильтр, пр-ва Genstar Technologies Company, Inc, США.

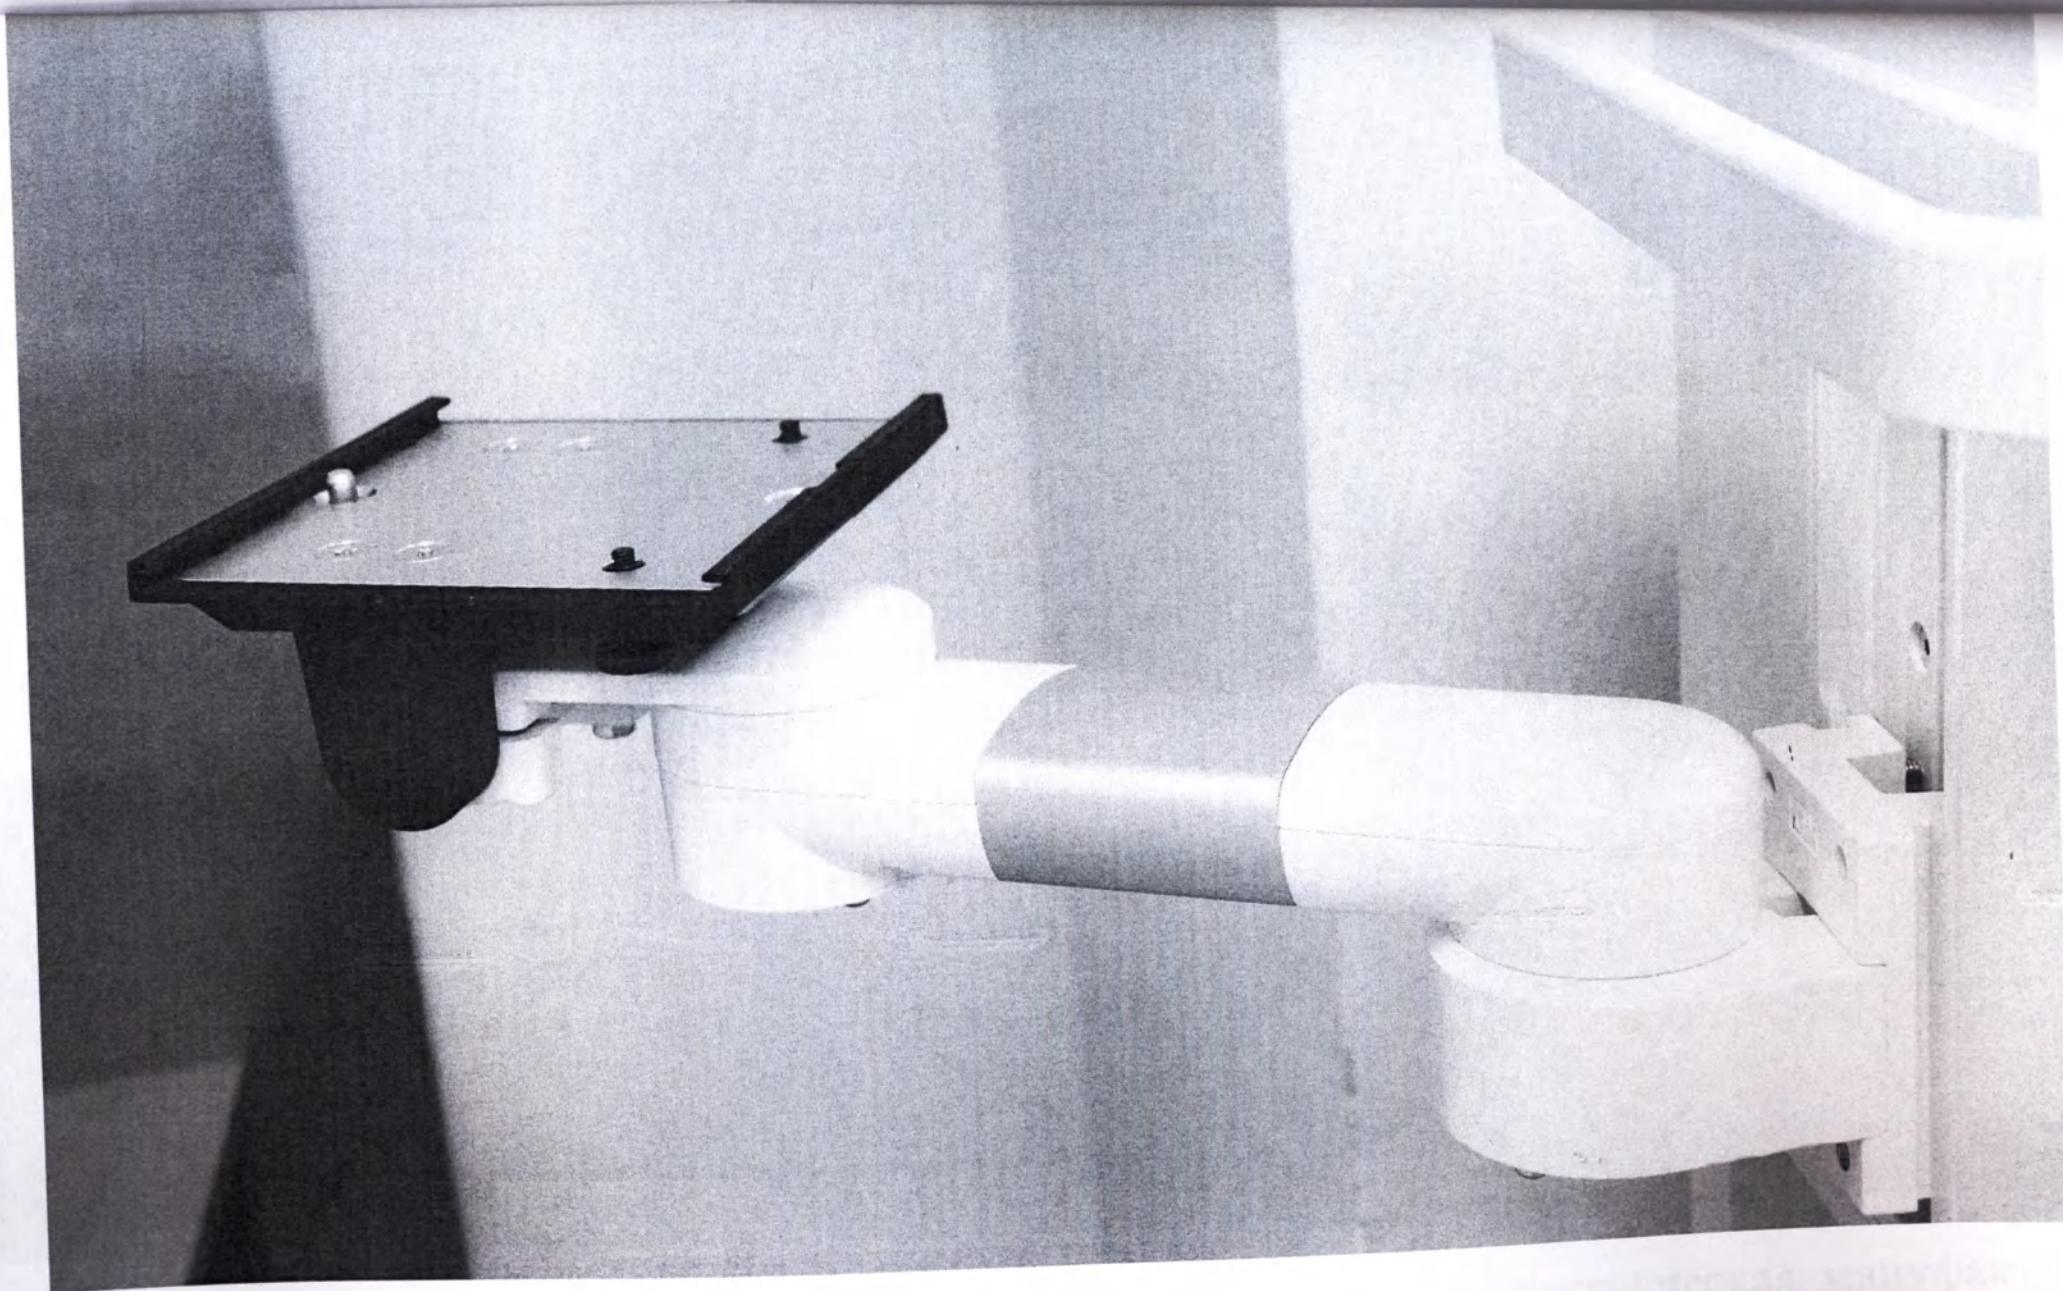

46. Установочное оборудование, пр-ва ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия.

45



47. Кабель питания, пр-ва Производственная компания «Электрическая мануфактура»
Россия.



17. Кабель питания, пр-ва Baohing Electric Wire & Cable Co., Ltd, Китай.



48. Компрессор медицинский стоматологический DK50, РУ
№ ФСЗ 2011/10543, пр-ва «ЭКОМ спол. с р.о.», Словацкая
Республика.



18. Компрессор медицинский DK50, РУ № ФСЗ 2008/03234, пр-ва «ЭКОМ спол. с р.о.», Словацкая Республика.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 61 лист

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



В.М. Полунин

2020г.