

УТВЕРЖДАЮ»
Индивидуальный предприниматель
Норкина М. В.


«26»

2020 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Аппарат стоматологический для костной хирургии PIEZOTOME CUBE,
производства SATELEC (САТЕЛЕК), Франция

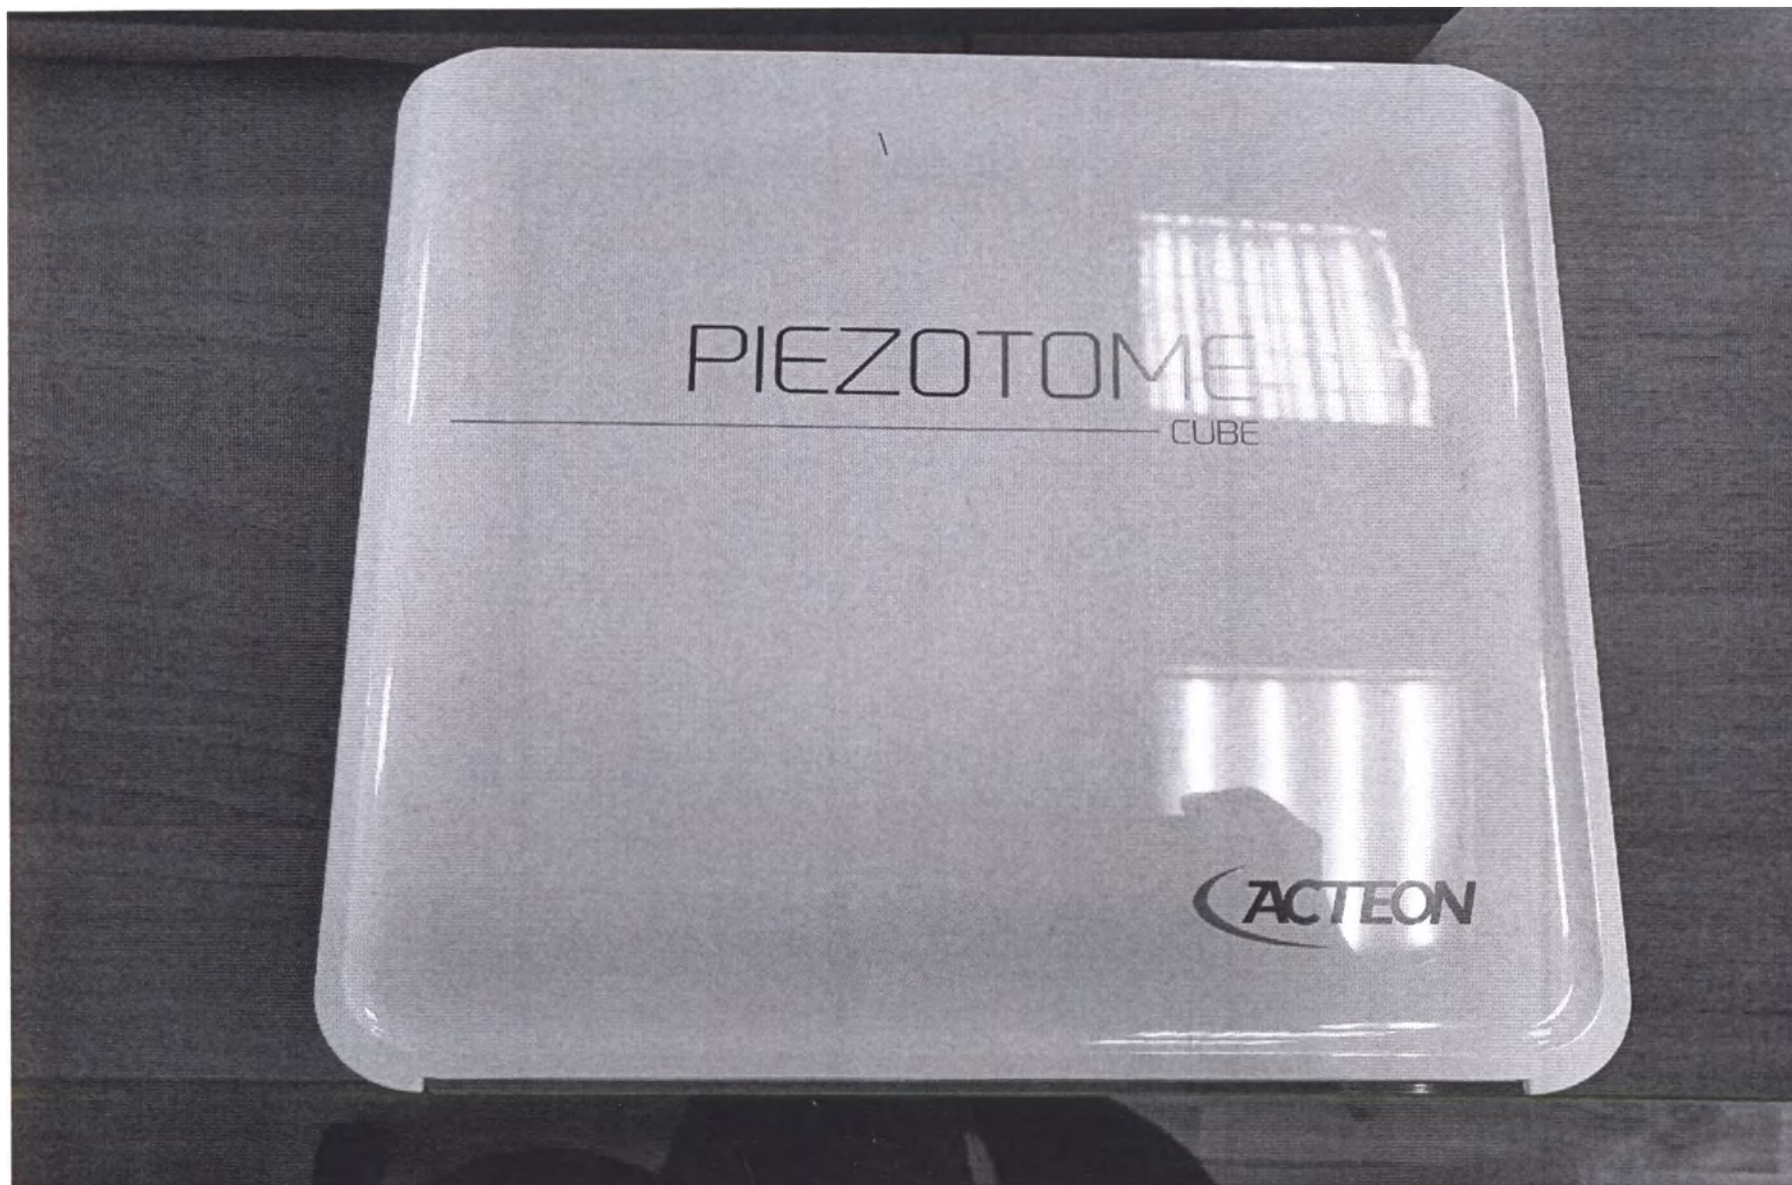

Базовый блок PIEZOTOME CUBE (вид сверху)

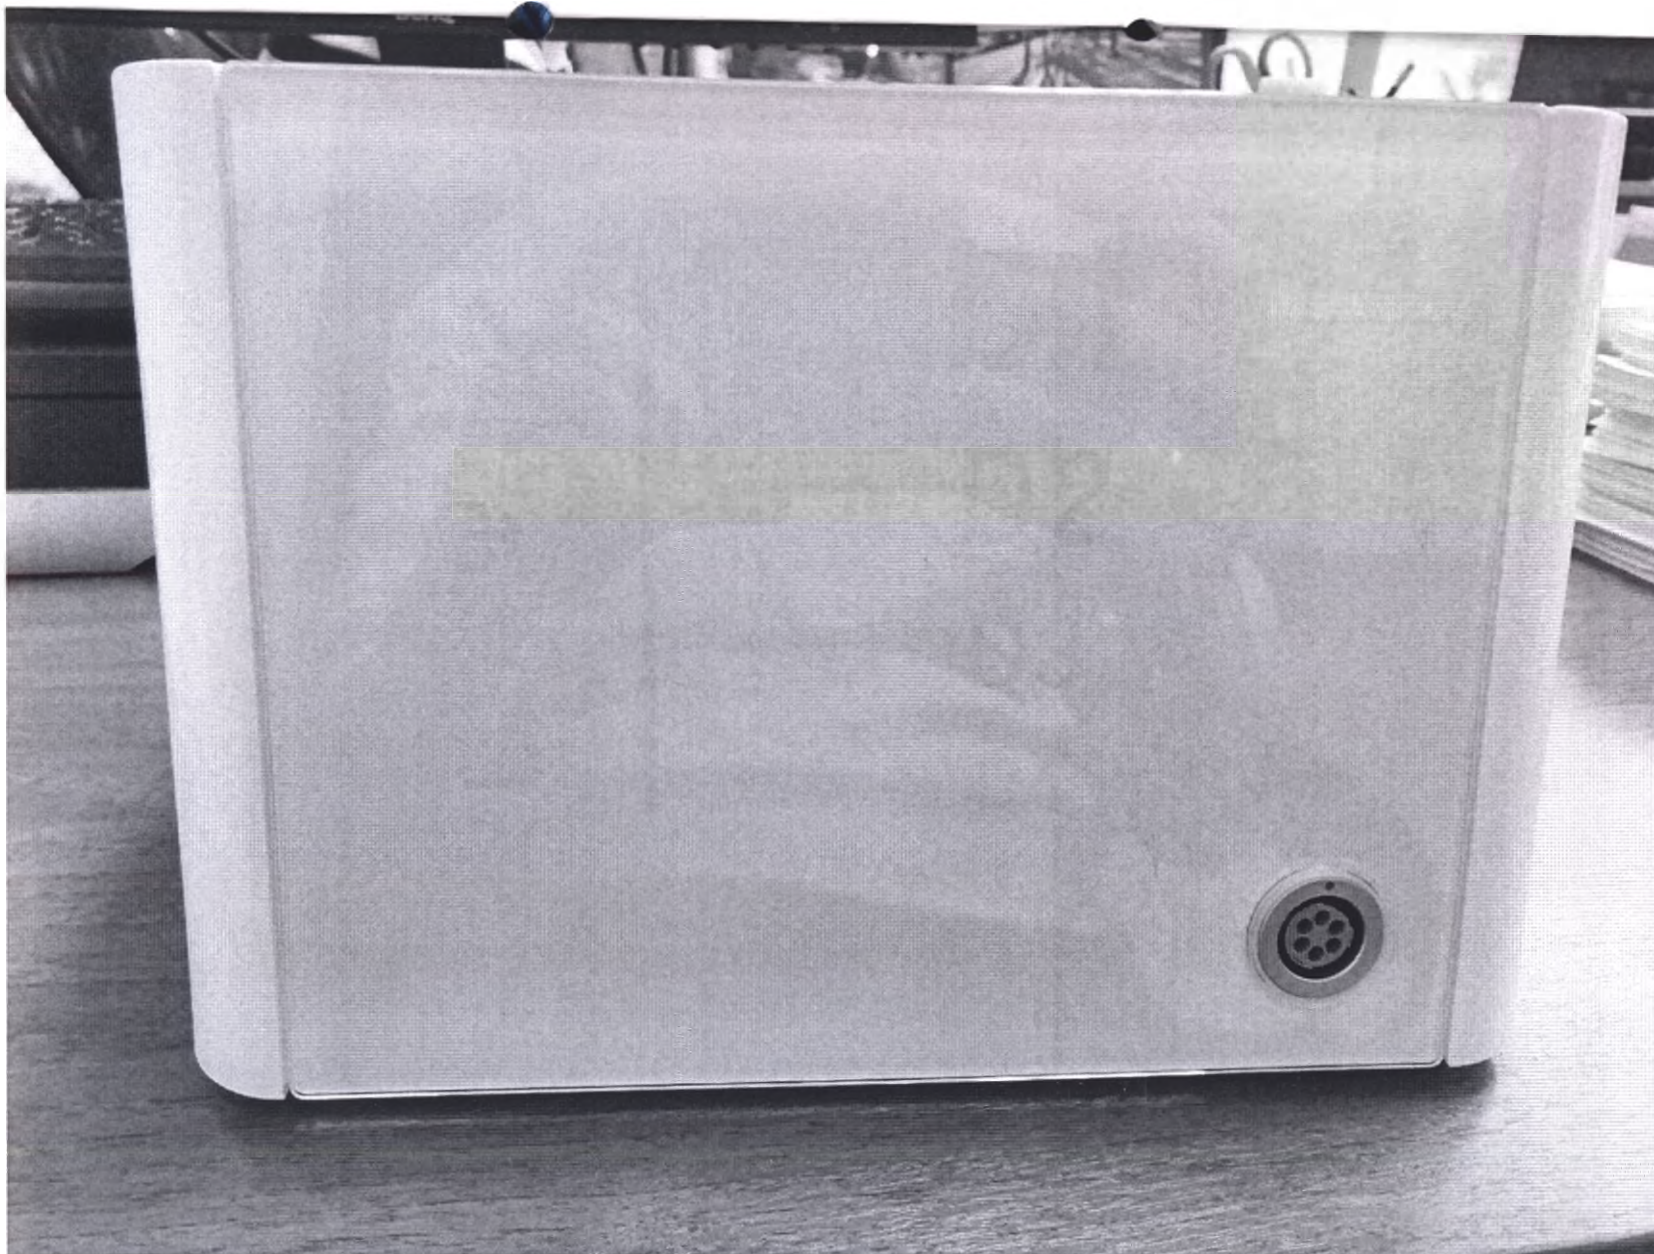

Базовый блок PIEZOTOME CUBE (вид спереди)

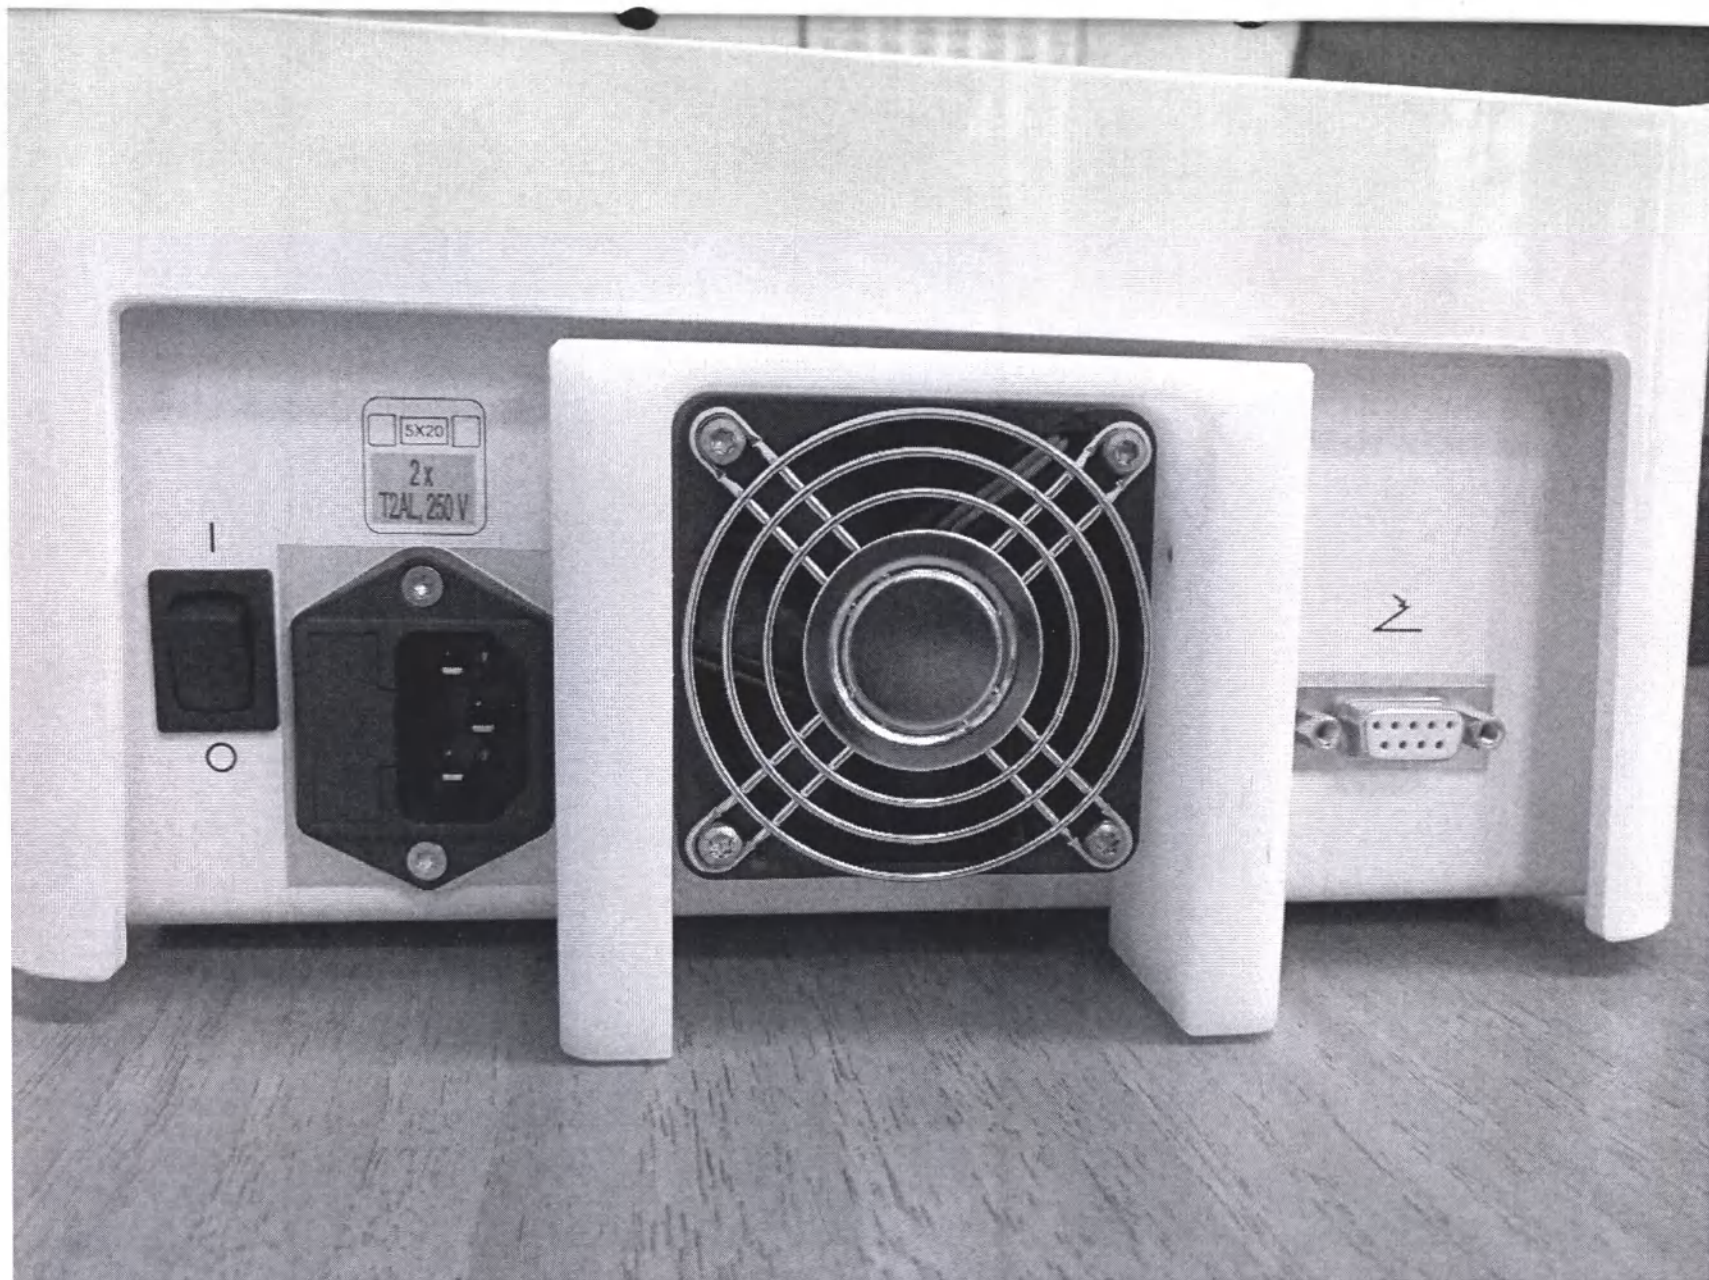

Базовый блок PIEZOTOME CUBE (вид сзади)

514

PIEZOTOME CUBE
 DENTAL BONE SURGERY DEVICE

514

BO370284D

100-240 V ~ 50/60 Hz 150-150 VA
10 min ON / 5 min OFF Rx only



 BF Type

Packing Number

PN 888786010

Refer to  Instruction Manual


Electric device
Do not dispose
in Domestic Bin

Serial number


0360982150100
SN 212952005
Date 190207


0459
CE Marking

Date of manufacture

2019 


Manufacturer

SATELEC, a company of **ACTEON** group, 17 av. Gustave Eiffel
Zi Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex, France

BBAB0284B

Базовый блок PIEZOTOME CUBE (маркировка)



Наконечник CUBE LED и клипсы резиновые для крепления линий для ирригации к шлангу от наконечника - 5 шт



F12816 PN: 888755010

CUBE LED Handpiece
CUBE LED HP



SATELEC
17 Av. Gustave Eiffel Zi Du Phare
33700 Mérignac Cedex France

(01)03609620128180111190218(21)888755010



Temperature
Limitation



Humidity
Limitation



Atmospheric
Pressure Limitation



CE Marking



Sterilize
Before Use



Consult Instructions
for Use



Fragile
Handle with Care

Rx Only - Caution : US Federal law
restrict this device to sale by or
on the order of a Physician



Packaging Unit




Do not dispose of Electronic user
as household waste




Keep Dry

BA204184C


Наконечник CUBE LED (маркировка)

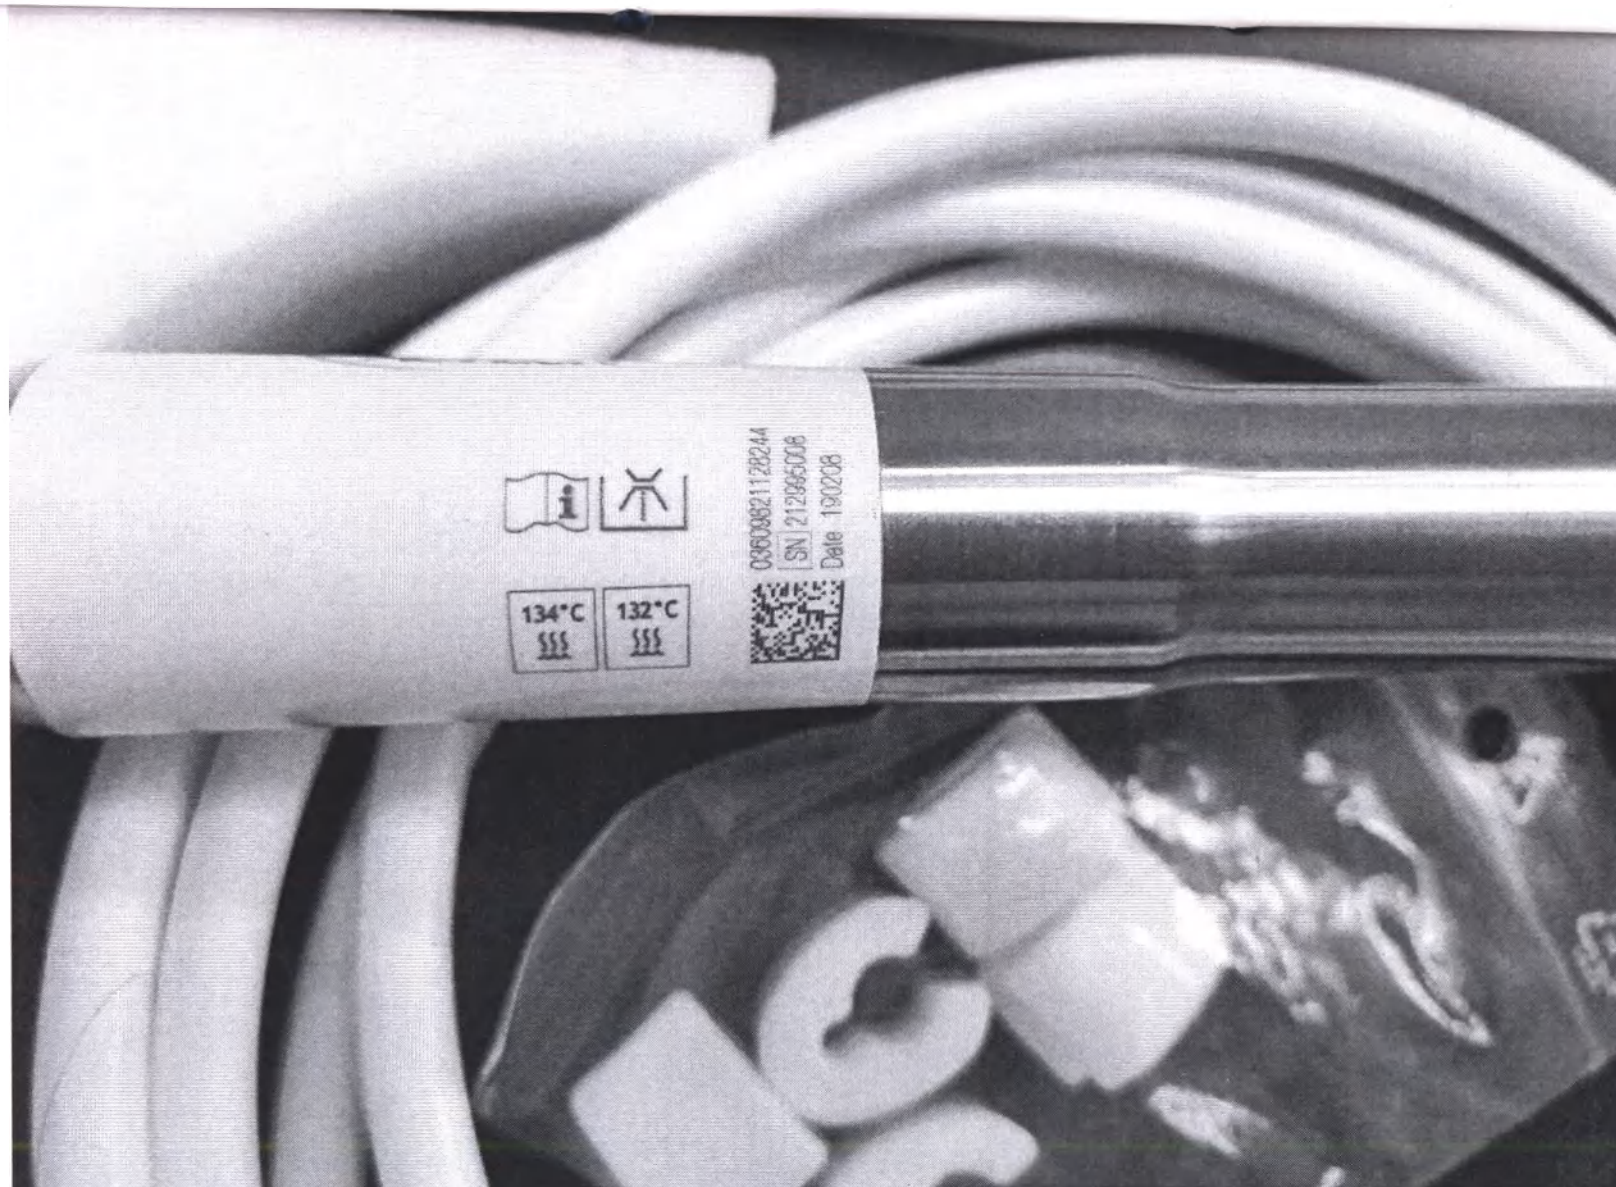

Наконечник CUBE LED (маркировка)

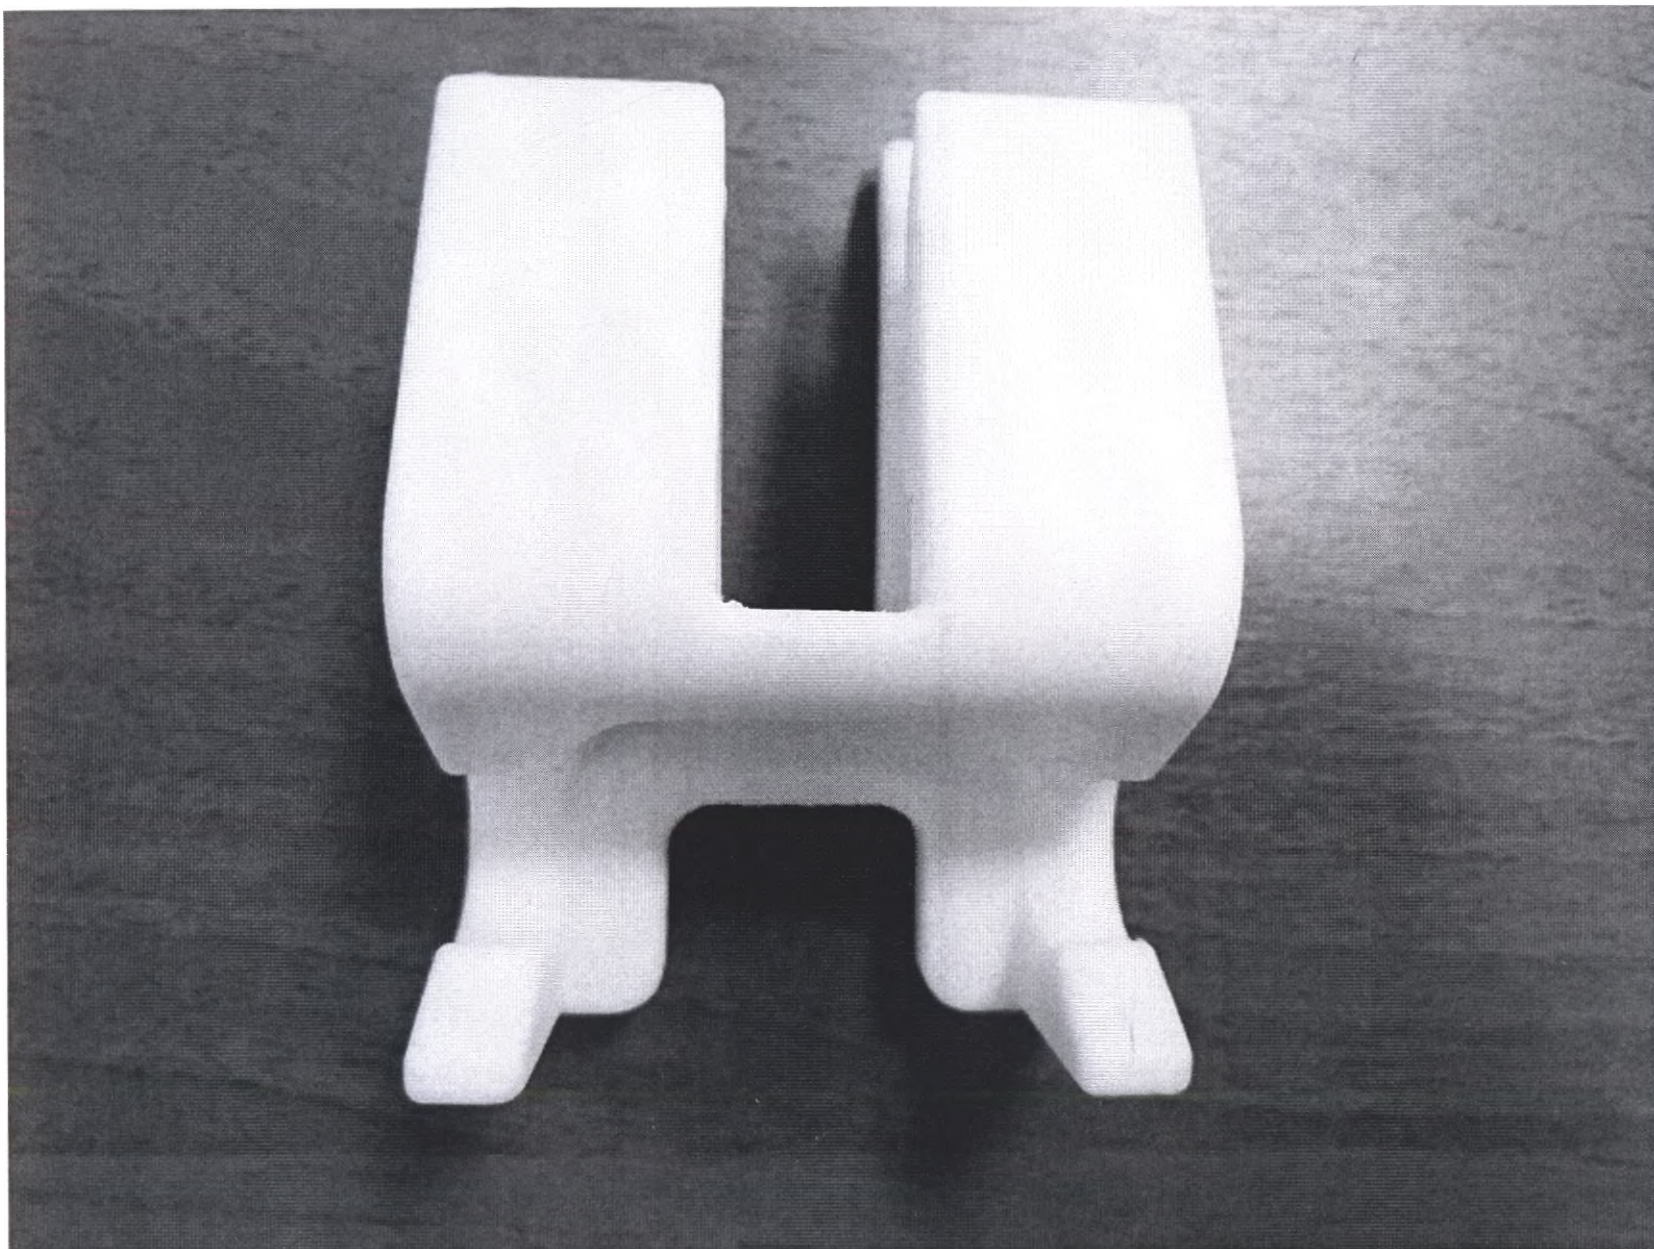

Подставка для наконечника, резиновая

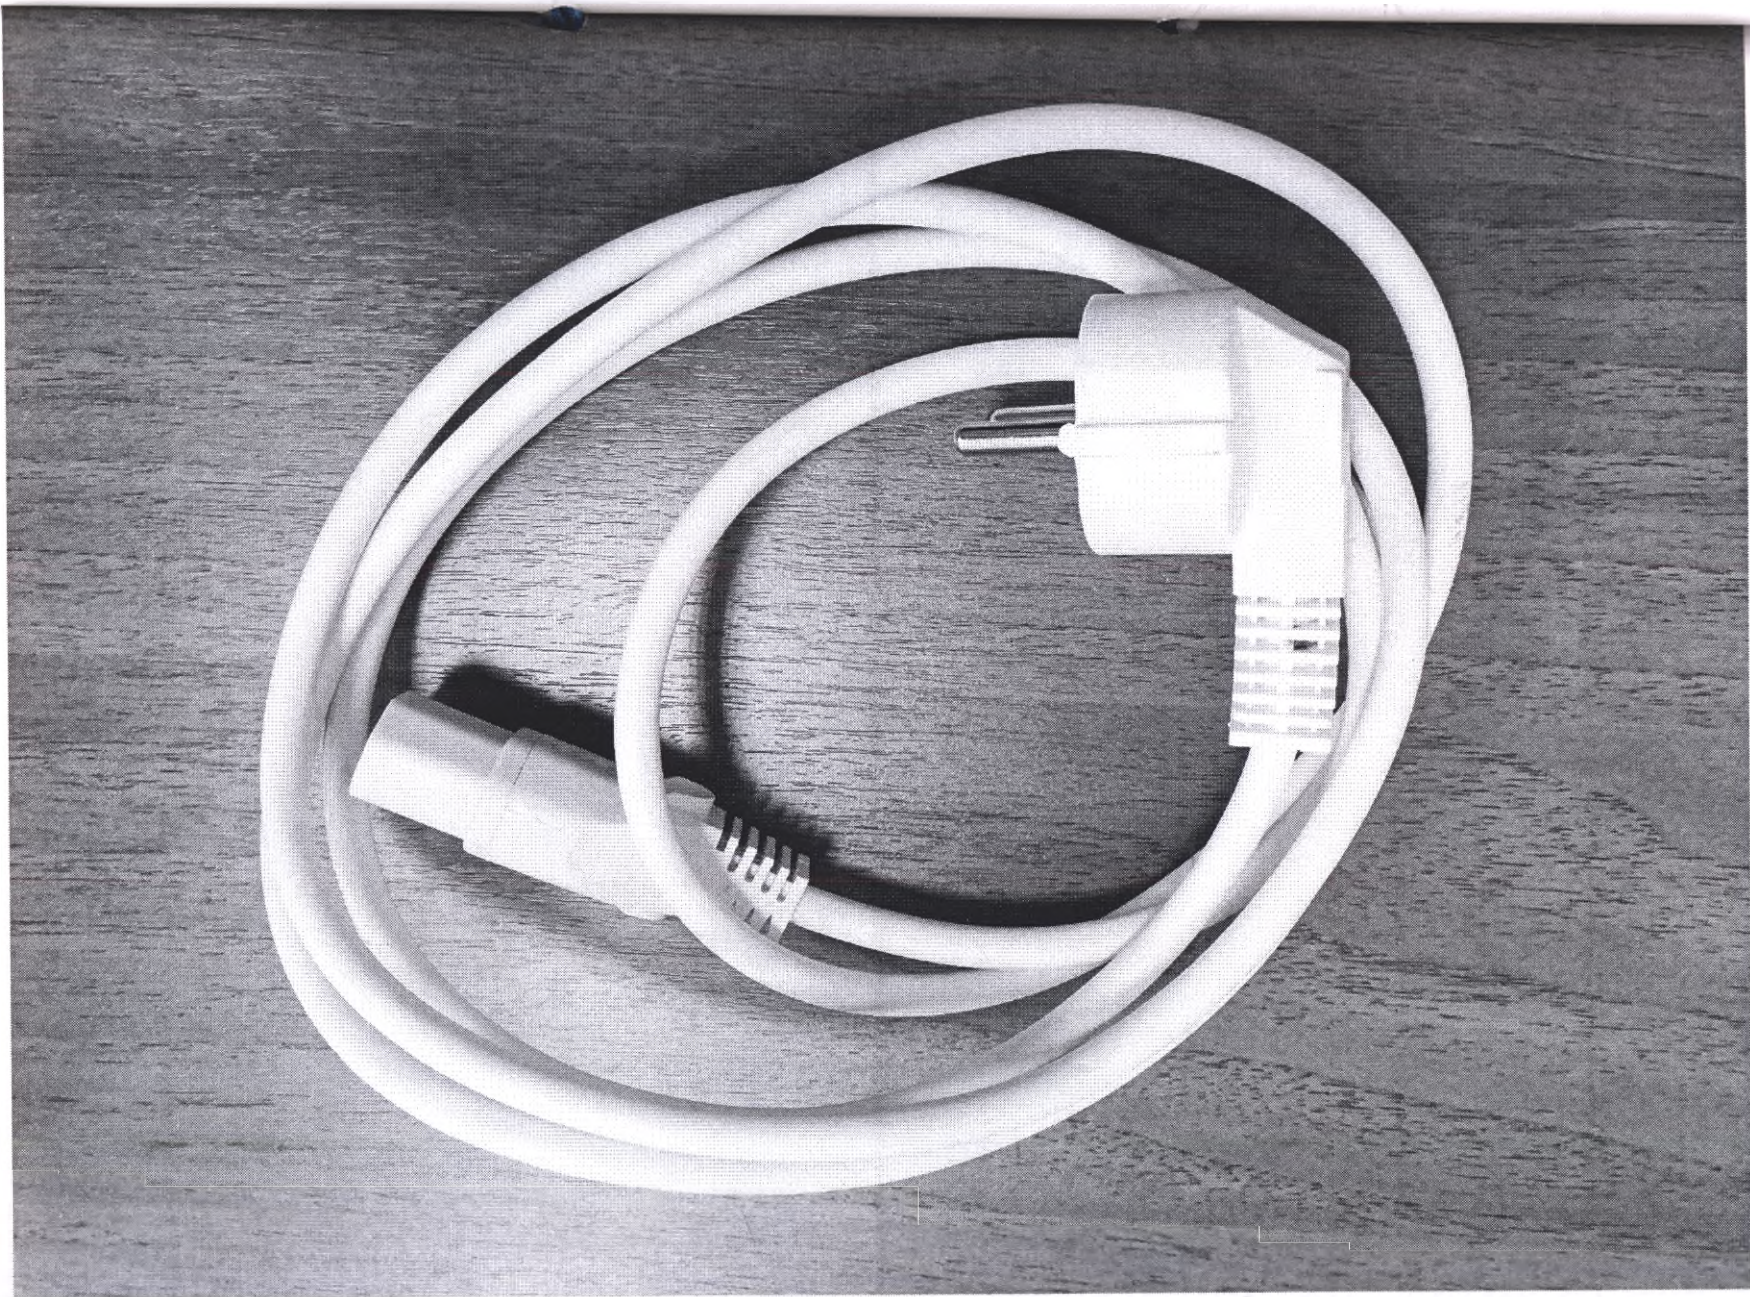


Сетевой шнур




Педадь управления PIEZOTOME CUBE




Педадь управления PIEZOTOME CUBE (маркировка)

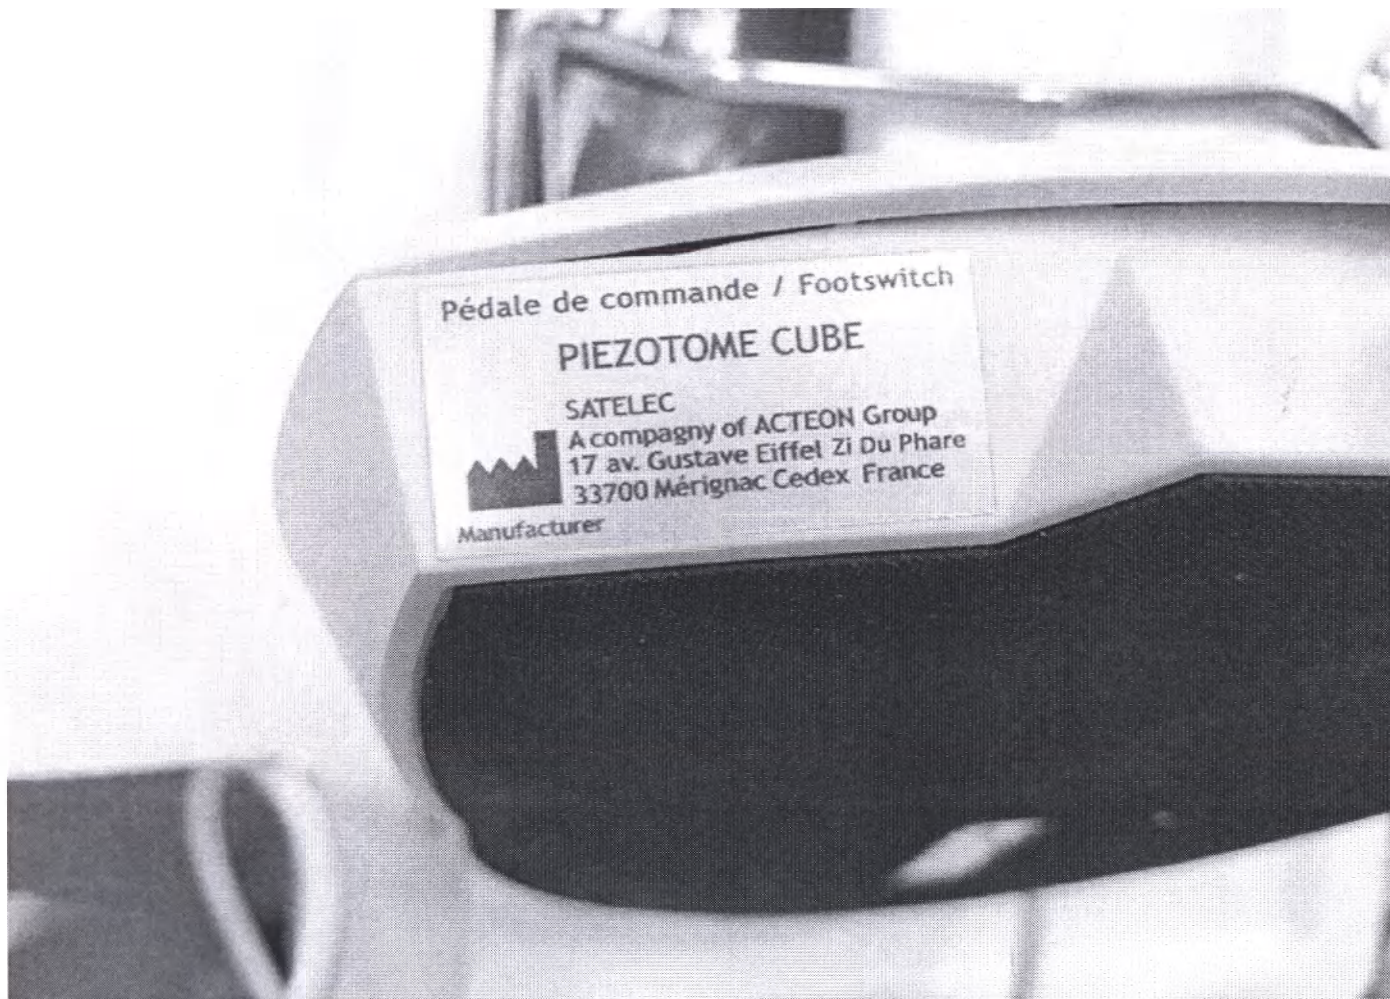

Педадь управления PIEZOTOME CUBE (маркировка

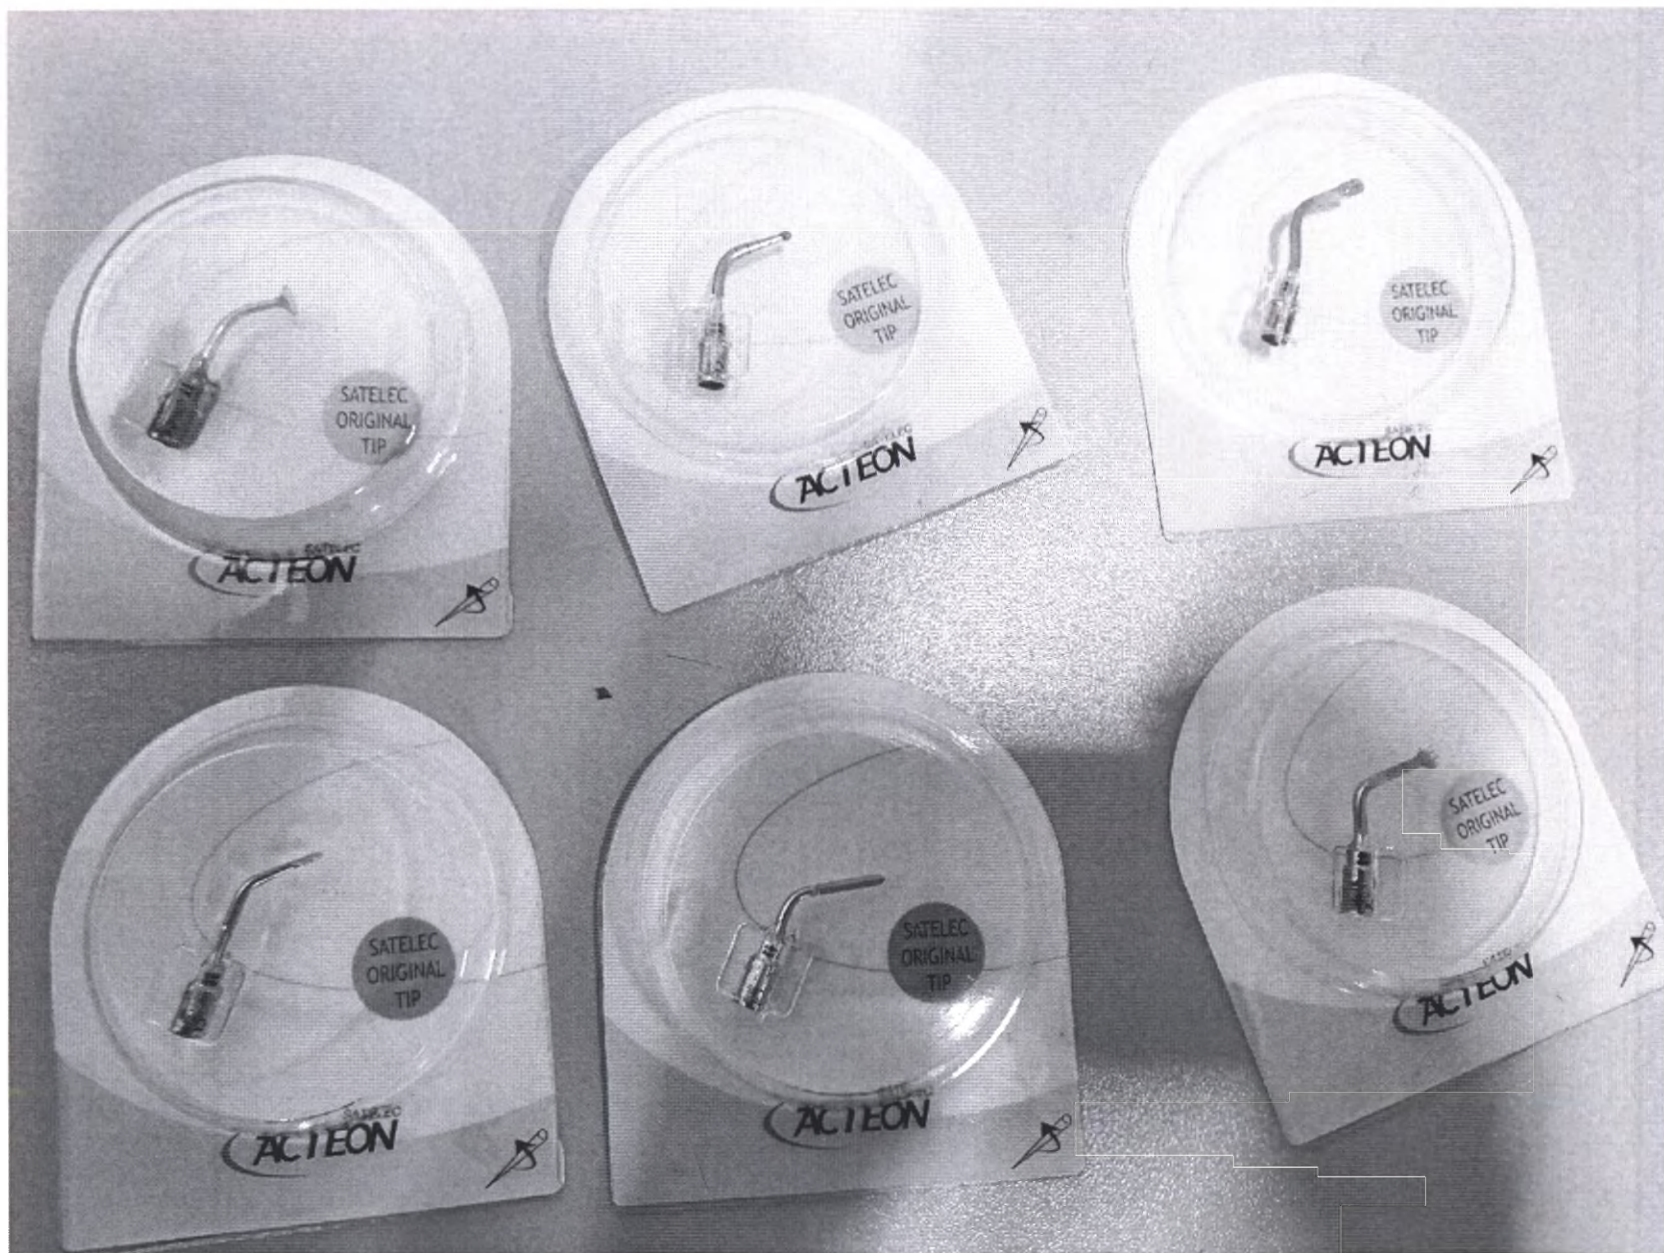

Насадки интраоральные хирургические: BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II - 6 шт.

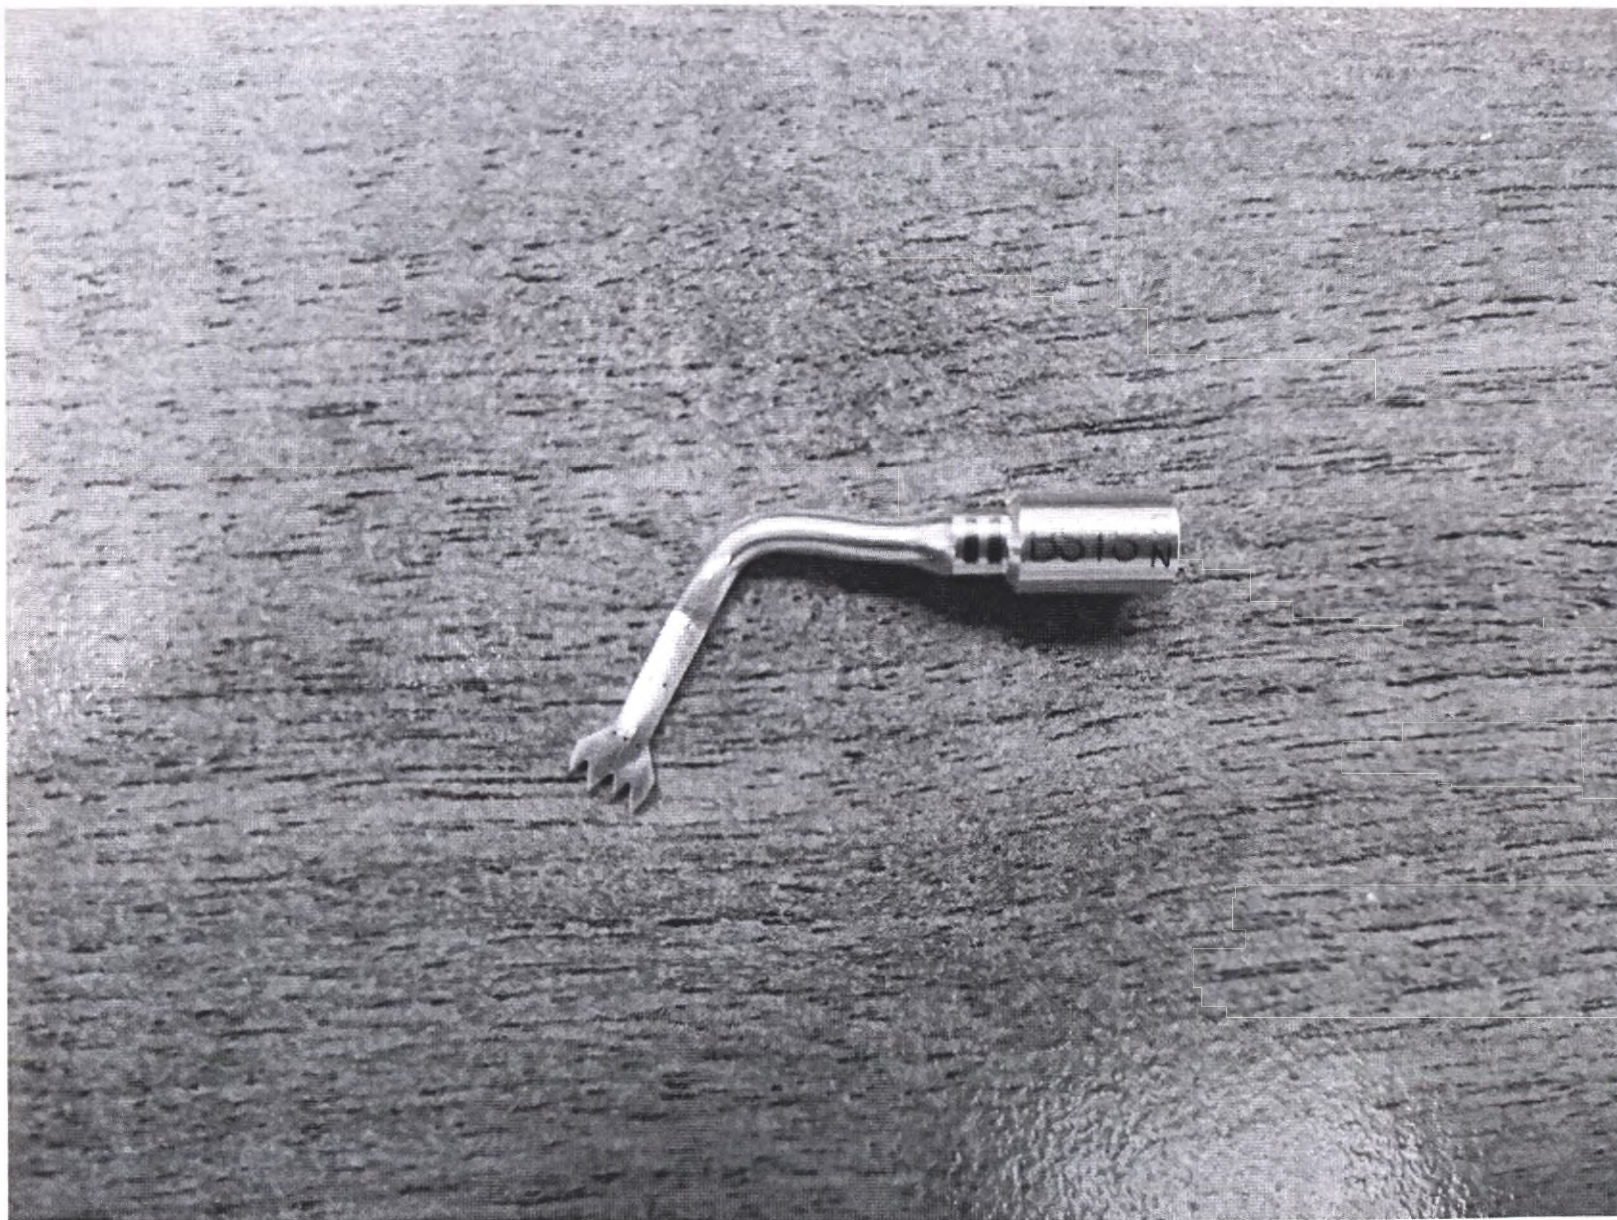

Насадка интраоральная хирургическая BS1S II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable Washer-disinfector
at 134°C for thermal disinfection



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use



Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/09



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel
Zi Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130564F



REF

F87525

LOT

604167/1

BS1S II

INTRAORAL SURGERY TIP


(01)03609820875255(11)190109(10)604167/1

Dental use only

Dental TIP

INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая BS1S II (маркировка)

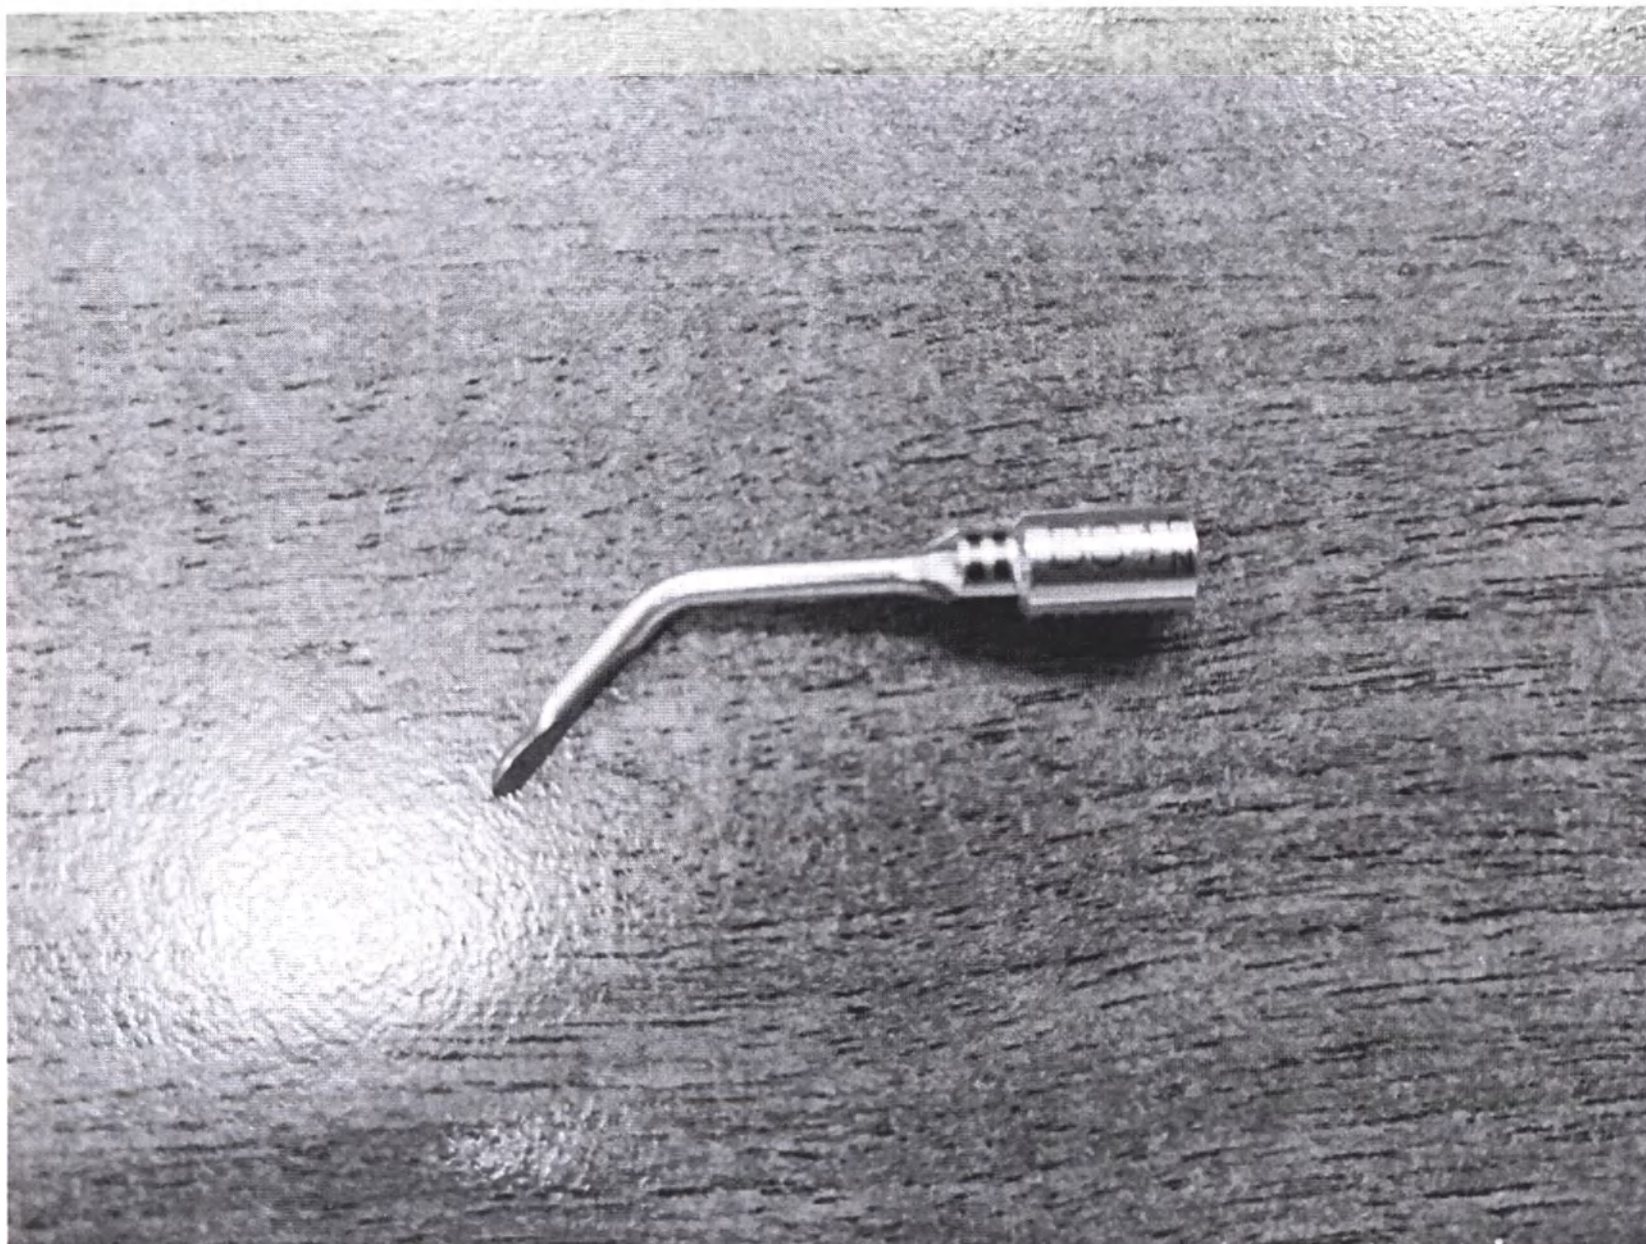

Насадка интраоральная хирургическая BS4 II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable Washer-disinfector
at 134°C for thermal disinfection



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use



Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/09



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel
ZI Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130504F



REF

F87504

LOT

603769/1

BS4 II

INTRAORAL SURGERY TIP


(01)03609820875040(11)190109(10)603769/1

Dental use only

Dental TIP

INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая BS4 II (маркировка)

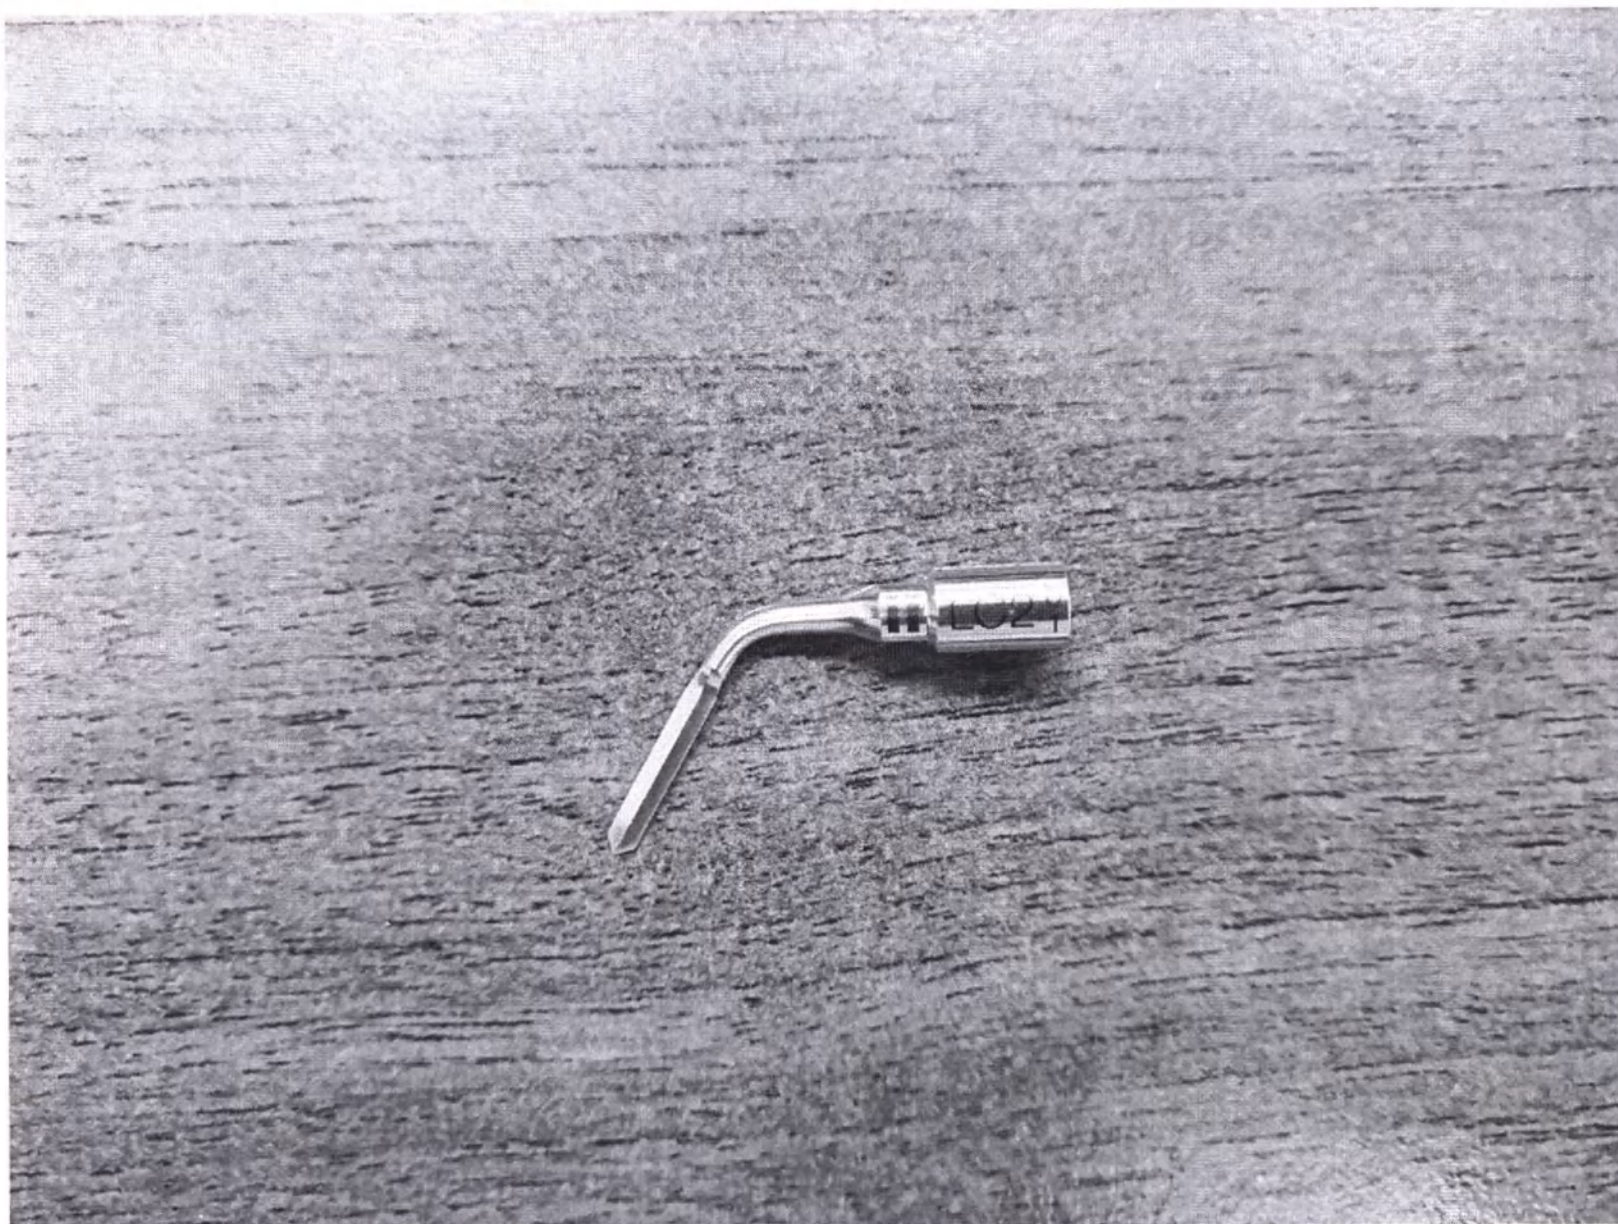

Насадка интраоральная хирургическая LC2 II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable
at 134°C for thermal disinfection



Washer-disinfector



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use




Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/21



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel

Zi Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130564F



REF

F87542

LOT

604209/1

LC2 II

INTRAORAL SURGERY TIP


(01)03609820875422(11)190121(10)604209/1

Dental use only

Dental TIP

INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая LC2 II (маркировка)

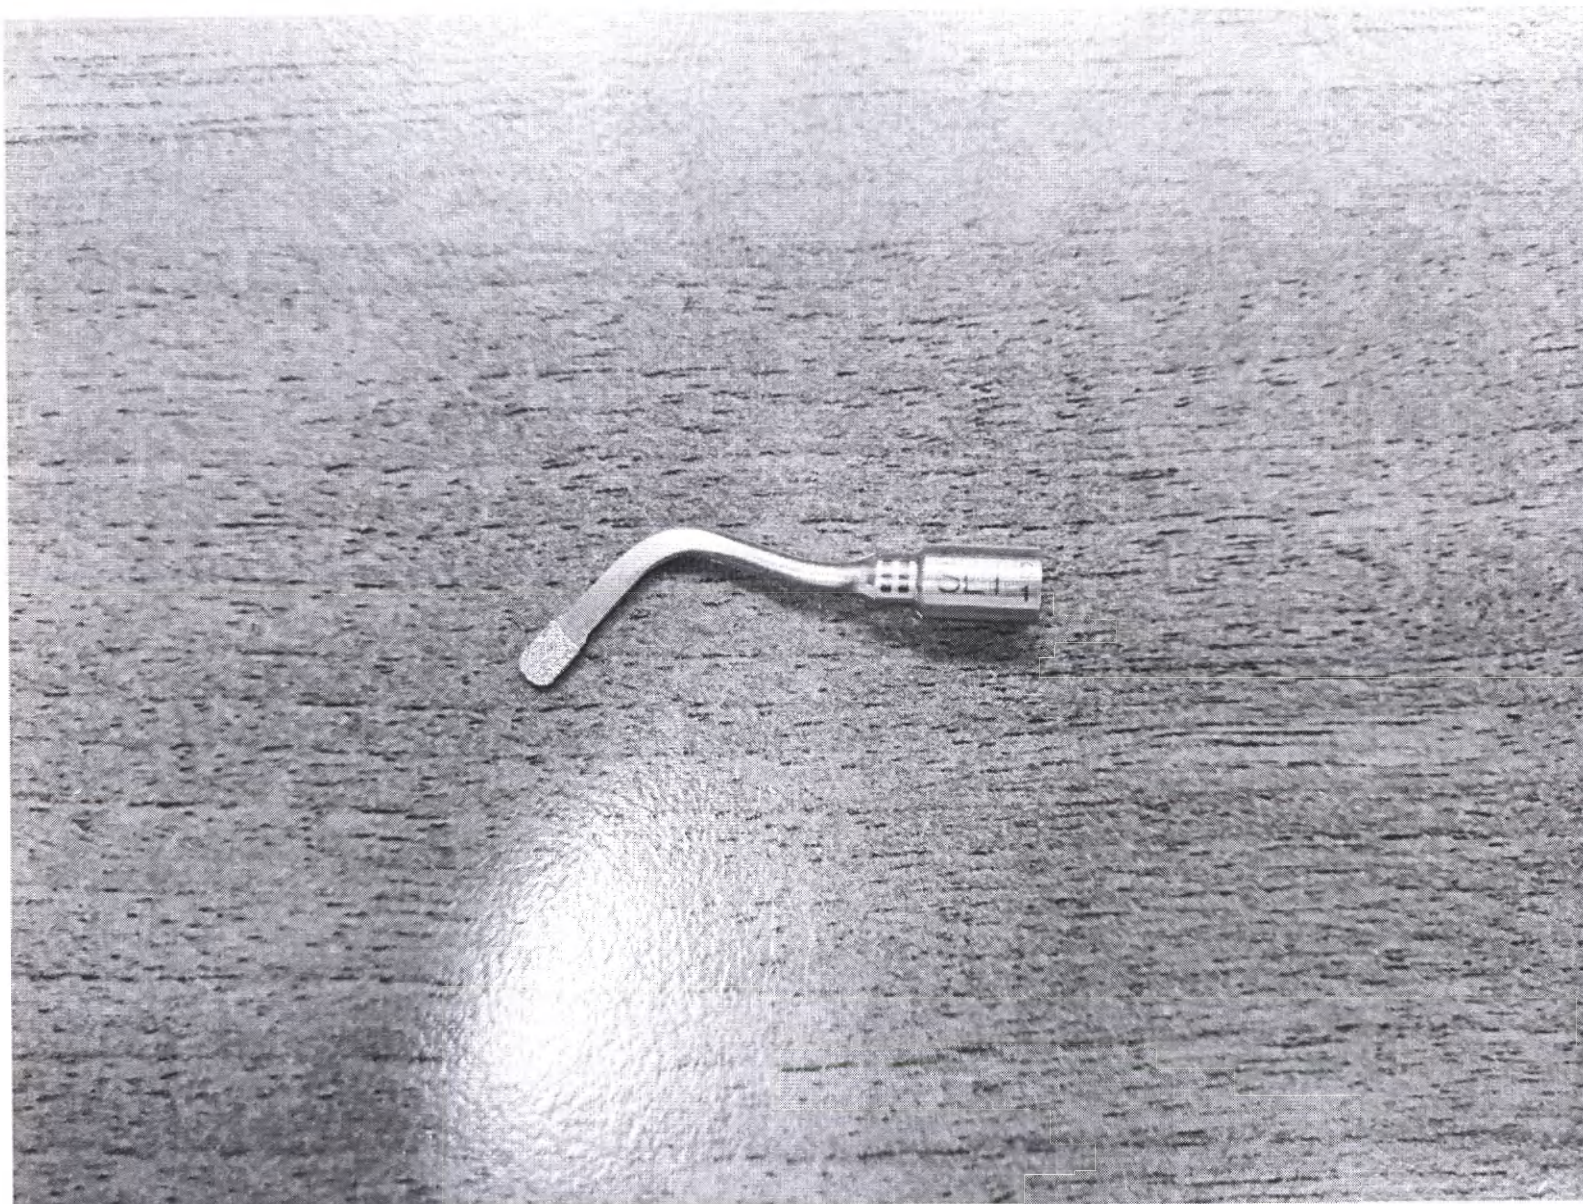

Насадка интраоральная хирургическая SL1 II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable Washer-disinfector
at 134°C for thermal disinfection



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use




Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/29



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel
Zi Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130564F



REF

F87511

LOT

604186/1

SL1 II

INTRAORAL SURGERY TIP

(01)03609820875118(11)190129(10)604186/1

Dental use only

Dental TIP

INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая SL1 II (маркировка)



Насадка интраоральная хирургическая SL2 II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable
at 134°C



Washer-disinfect
for thermal disinfection



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use




Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/09



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel
Zi Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130564F



REF

F87512

LOT

604162/2

SL2 II

INTRAORAL SURGERY TIP


(01)03609820875125(11)190109(10)604162/2

Dental use only

Dental TIP

INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая SL2 II (маркировка)

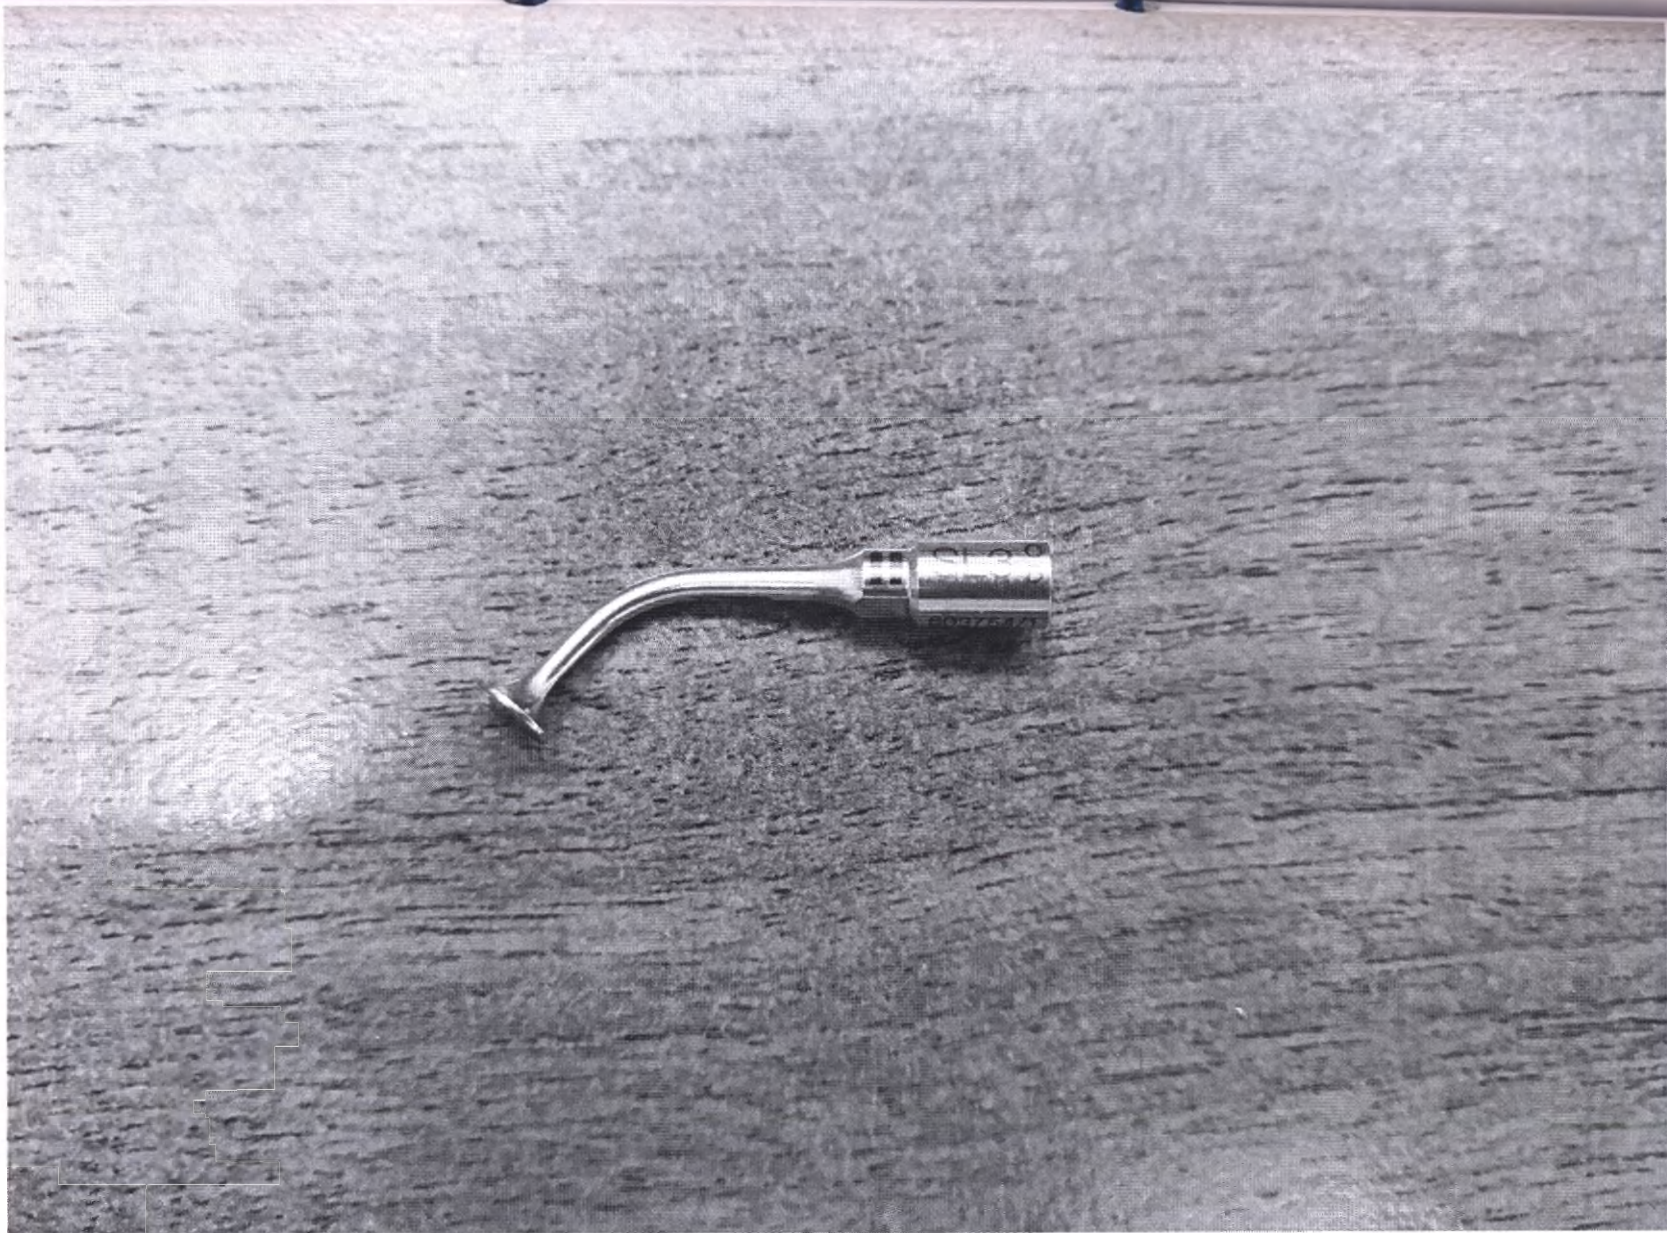

Насадка интраоральная хирургическая SL3 II

www.acteongroup.com

Use only SATELEC® genuine
or authorized tips on our generators



Autoclavable
at 132°C



Autoclavable Washer-disinfector
at 134°C for thermal disinfection



Sterilize
Before Use



Consult instructions
for use




Electronic
Instruction
Manual

Rx only



Quantity

www.satelec.com/documents



Date of manufacture

2019/01/09



CE marking



Do not use if
package is damaged



Manufacturer

SATELEC

A Company of ACTEON Group 17 av. Gustave Eiffel
ZI Du Phare 33700 MERIGNAC Cedex - France

BA130564F



REF

F87513

LOT

603754/1

SL3 II

INTRAORAL SURGERY TIP

(01)03609820875132(11)190109(10)603754/1

Dental use only
Dental TIP
INSERT dentaire

Насадка интраоральная хирургическая SL3 II (маркировка)




Металлическая подставка для насадок




Динамометрический ключ CUBE для насадок



Динамометрический ключ CUBE для насадок (маркировка)

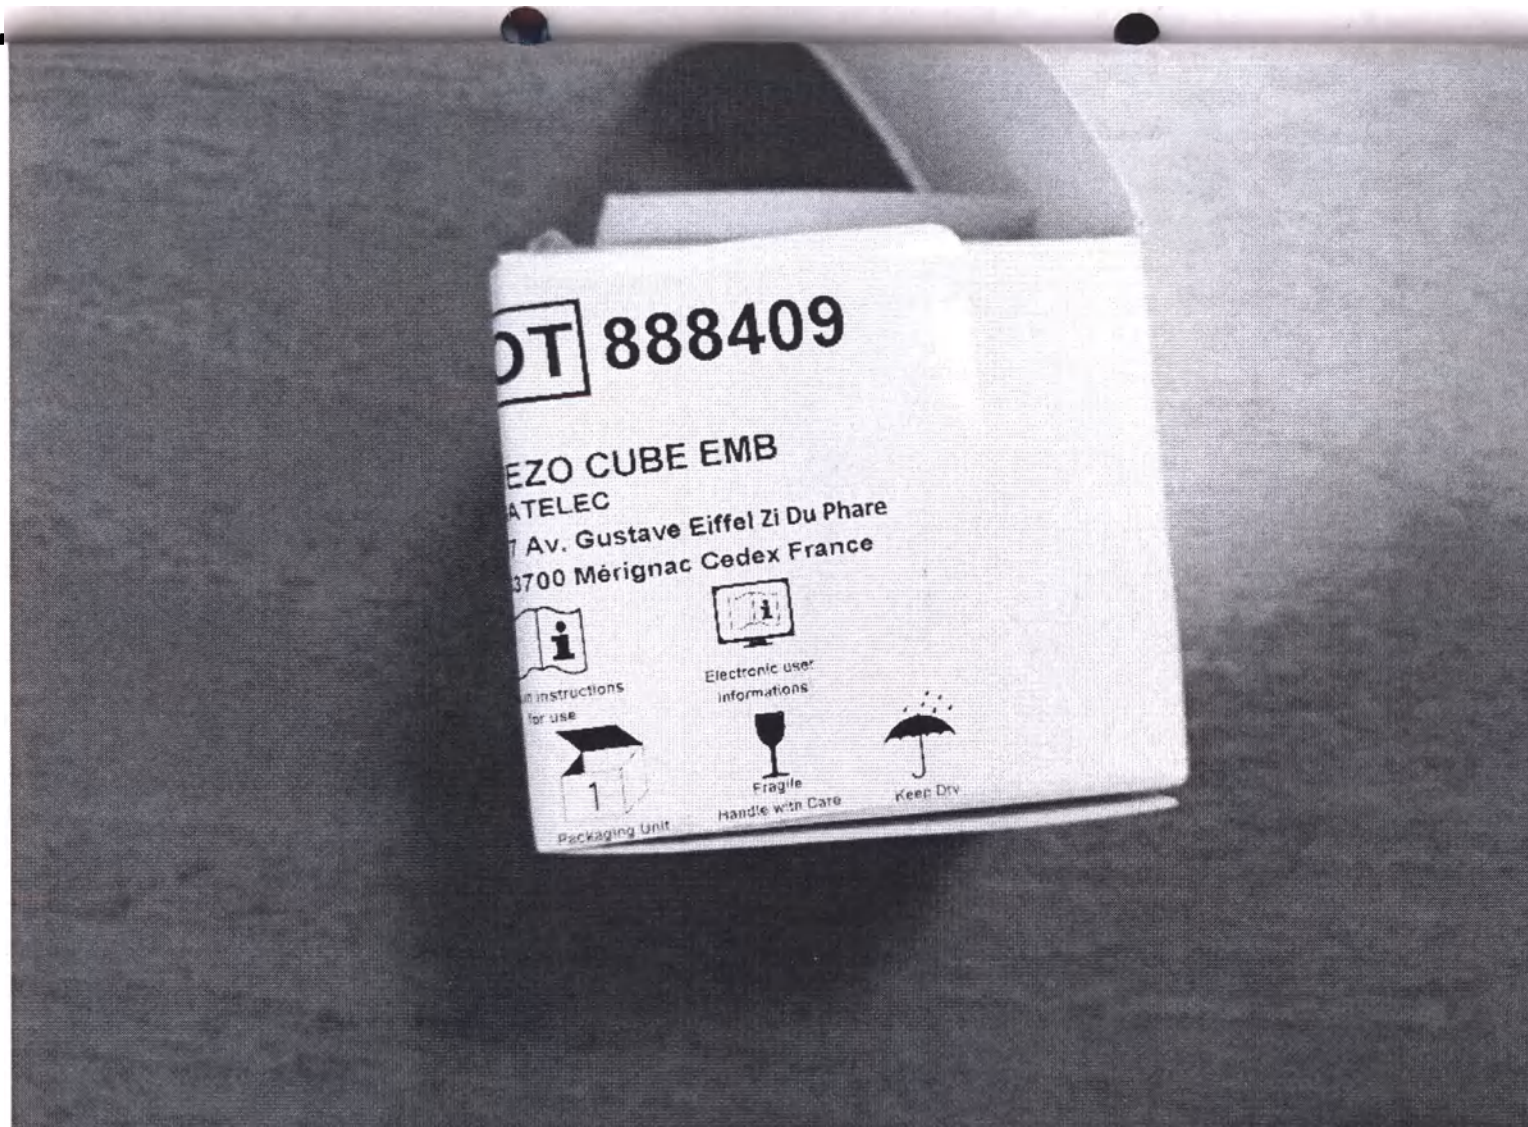


Динамометрический ключ CUBE для насадок (маркировка)

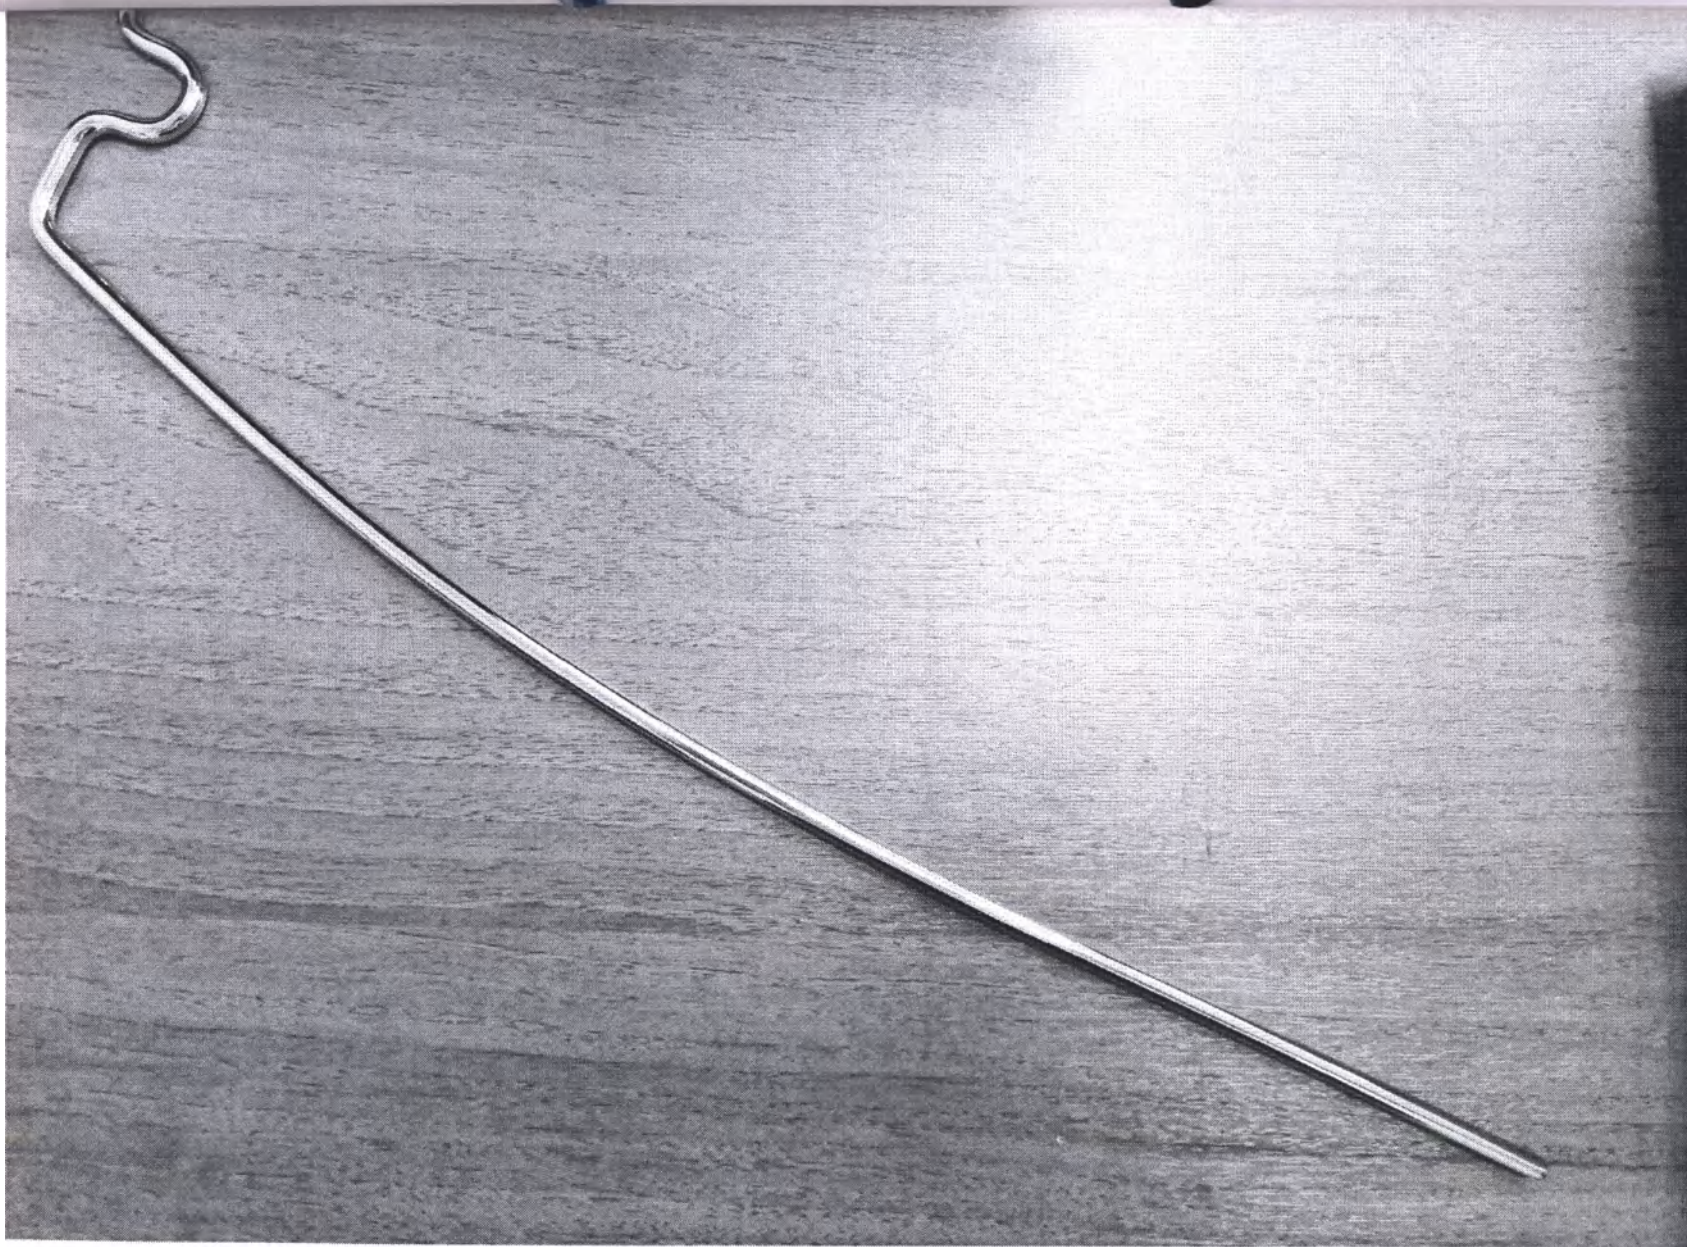


Кронштейн для ирригационного раствора съемный




Стерилизуемая линия для хирургических аппаратов Satelec (в упаковке)

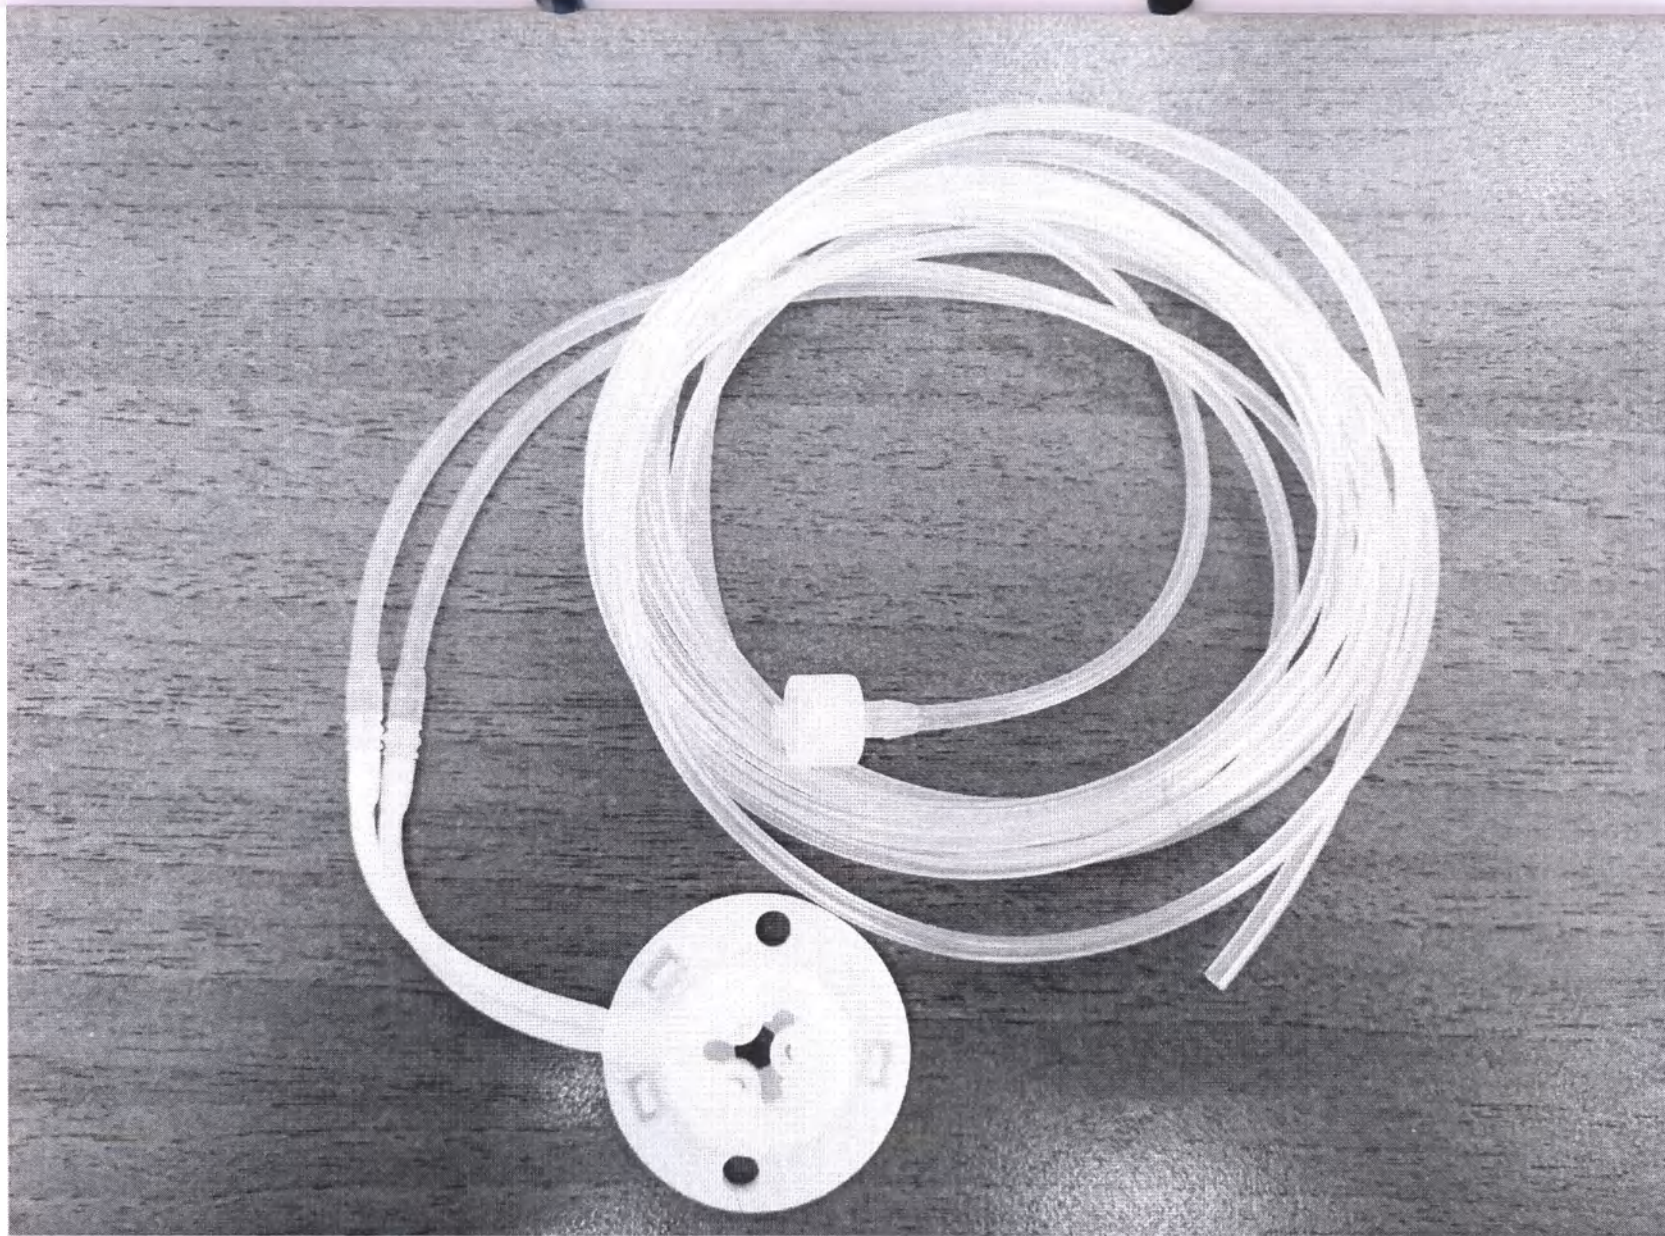

Стерилизуемая линия для хирургического аппарата Satelec

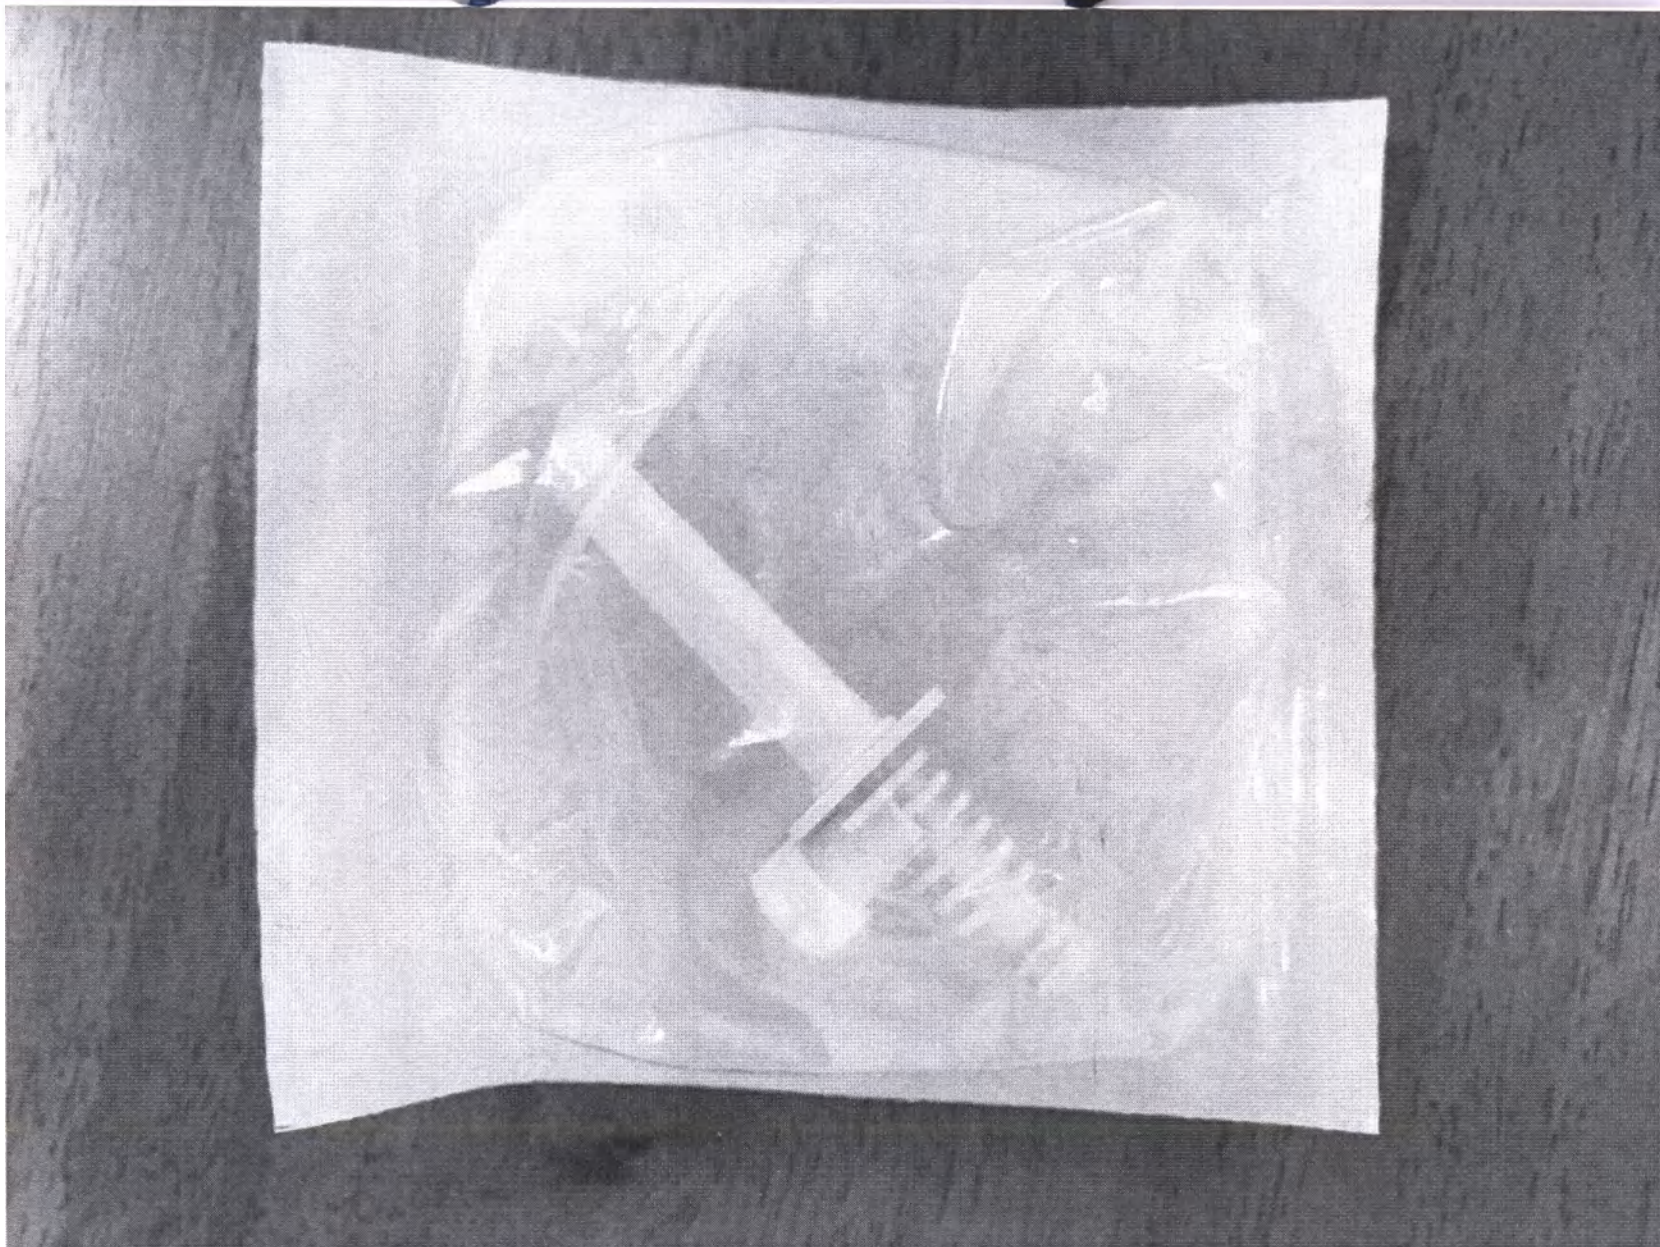

Перфоратор (в упаковке)

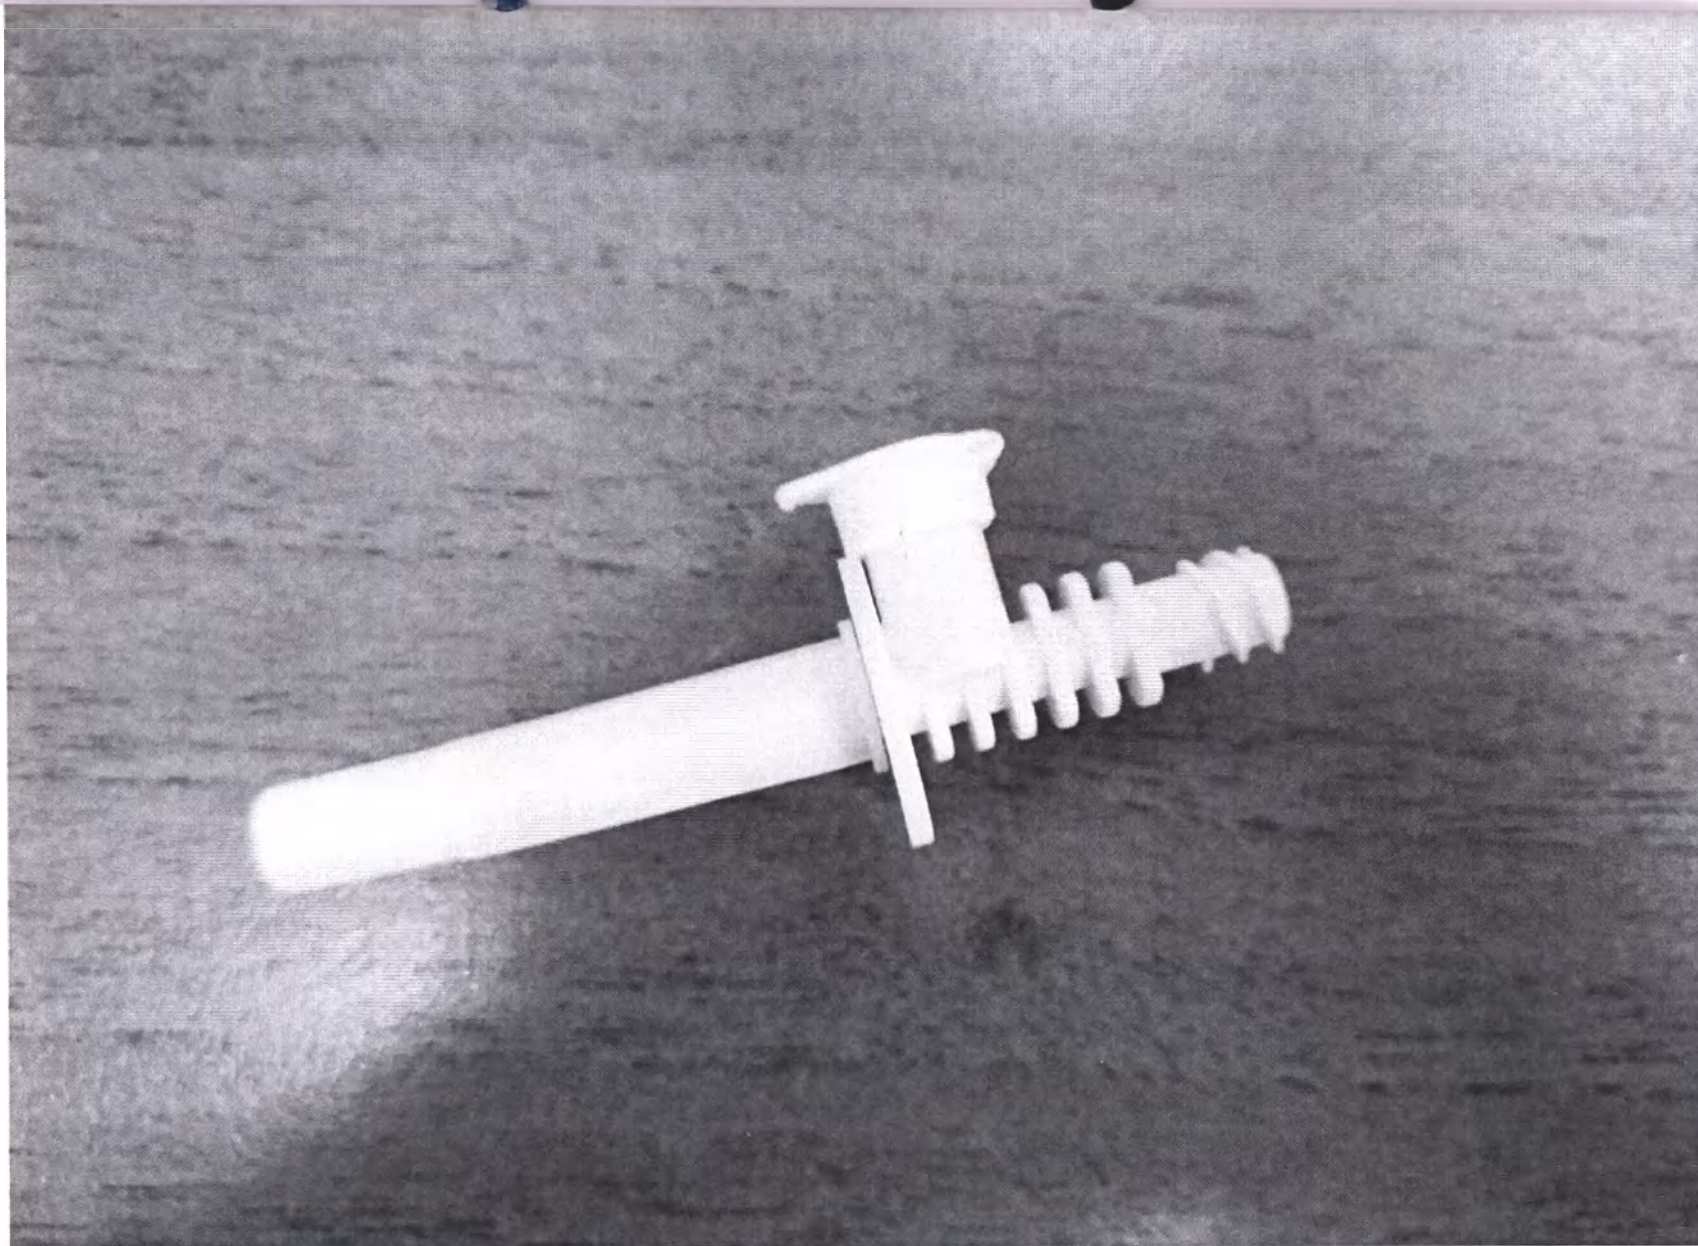


Перфоратор

REF. (x1) : E57372
REF. (x10) : F57372
Distribution
: SATELEC
Perforateur 2 voies avec cape
2 ways vented spike with protector
CE 2
STERILE EO
LOT G001879
2023/12
PROMELA SAM - 9 Avenue Albert II - 98000 MONACO

REF. (x1) : E57372
REF. (x10) : F57372
Distribution
: SATELEC
Perforateur 2 voies avec cape
2 ways vented spike with protector
CE 2
STERILE EO
LOT G001879
2023/12
PROMELA SAM - 9 Avenue Albert II - 98000 MONACO

REF. (x1) : E57372
REF. (x10) : F57372
Distribution
: SATELEC
Perforateur 2 voies avec cape
2 ways vented spike with protector
CE 2
STERILE EO
LOT G001879
2023/12
PROMELA SAM - 9 Avenue Albert II - 98000 MONACO

Перфоратор -15 шт. (маркировка)

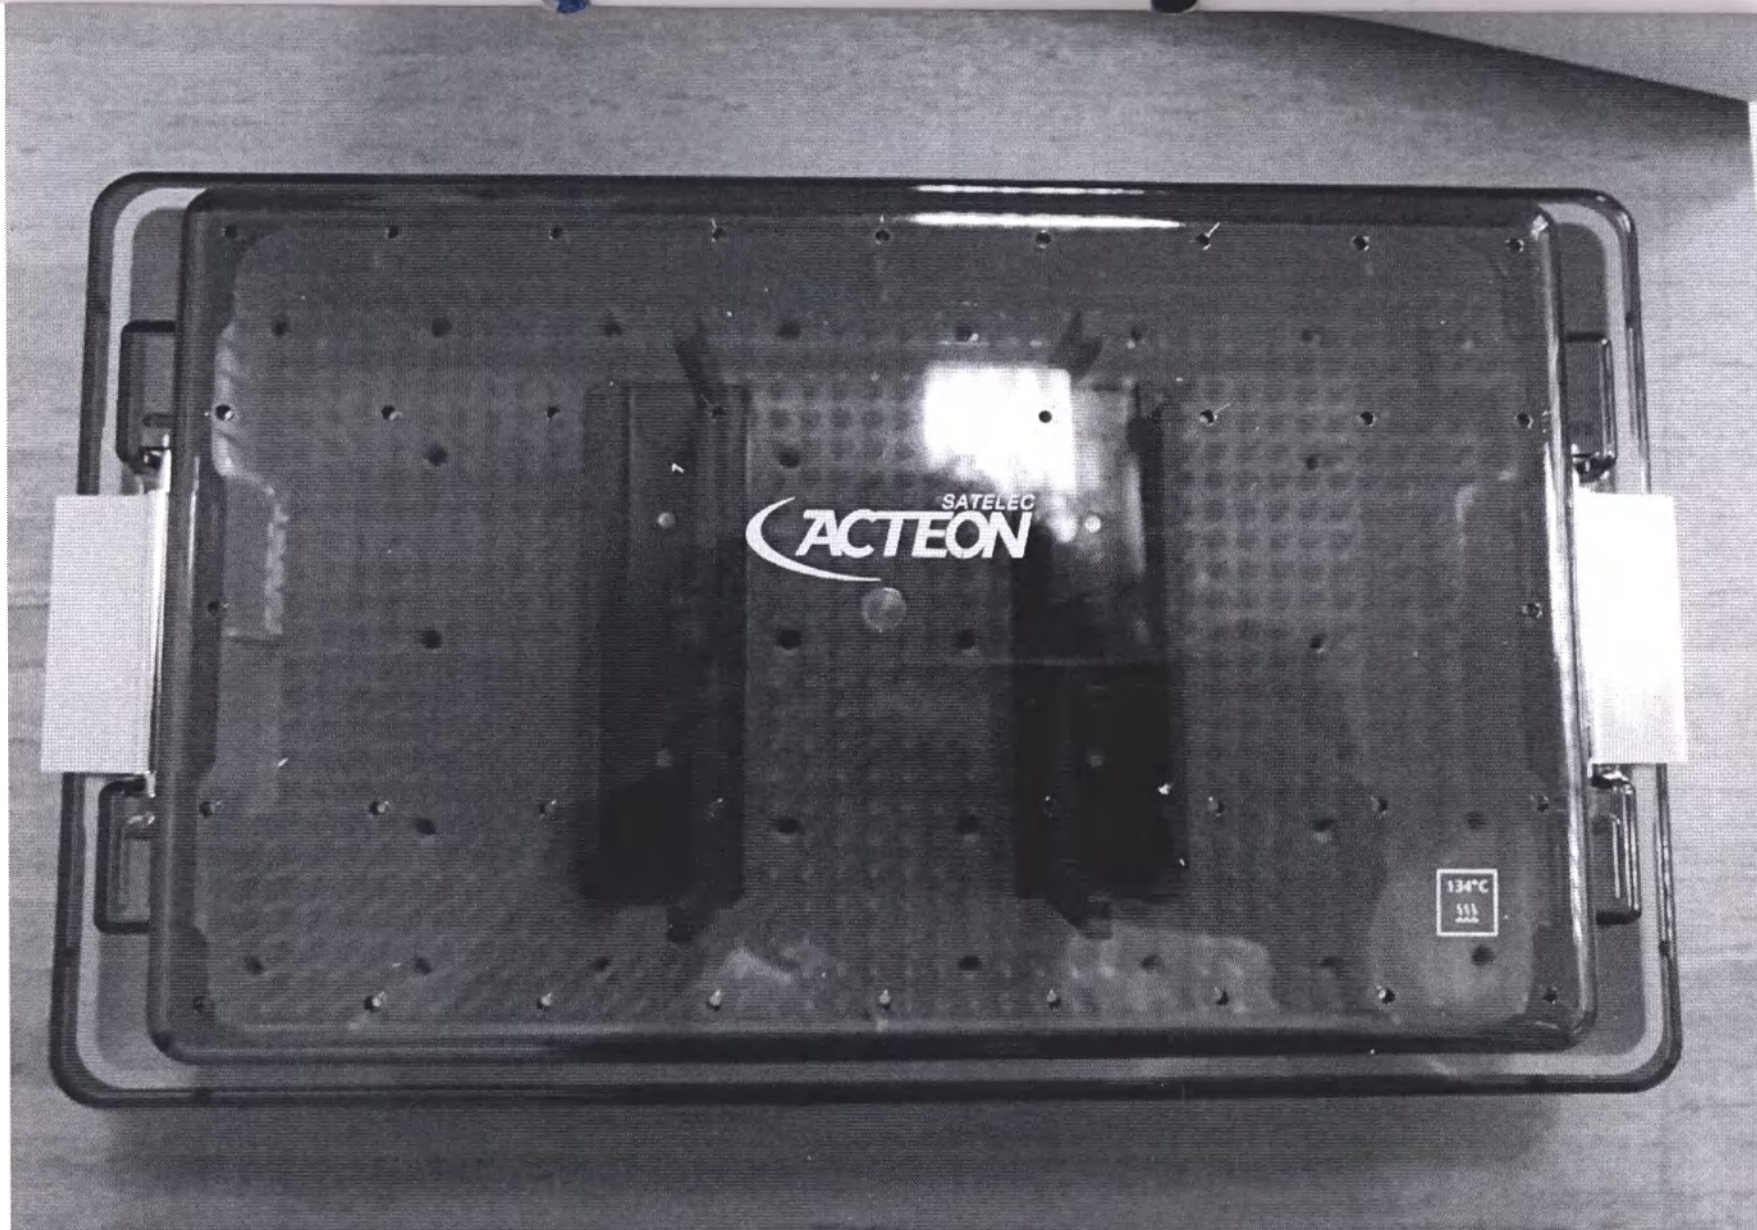

Бокс для стерилизации

F27156

LOT : 888692.000

BOITE STER PZT2-IC2
BOITE STER PZT2-IC2

190211

 **SATELEC**
17 Av. Gustave Eiffel Zi Du Phare
33700 Mérignac Cedex France



SATELEC® S.A.S | A Company of ACTEON® Group
17 av. G. Eiffel | Zi Du Phare | 33700 MERIGNAC cedex | France
Tel. +33 (0) 556 340 607 | Fax. +33 (0) 556 349 292
info@acteongroup.com | www.acteongroup.com

  
Temperature
Humidity
Pressure
Rx Only - Caution - US Federal law
restricts this device to sale by or
on the order of a Physician


  
Packaging Unit
Caution
Fragile
Handle with care



Маркировка бокса для стерелизации

Tubing for Satelec peristaltic pump
 Tubulure pour pompe péristaltique Satelec
 Linea para bomba peristáltica Satelec
 Schlauch für Peristaltik-Pumpe von Satelec
 Tubo per pompa peristáltica Satelec
 Irrigatie lijnen voor Satelec peristáltische pomp
 Συληνδοί για περισταλτική αντλία Satelec

REF. (x1) : ES7370 / REF. (x10) : F57370



Do not use if package is damaged



Rx only

2018-12



Caution:
 US federal law restricts
 this device to sale by or
 on the order of a physician

G002315



Do not re-use




2023-12



Caution, consult
 accompanying documents

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide



A Company of ACTEON Group - 17 av. B. Etel 71 Du Pharo 33700 MÉRIGNAC cedex France
 Tel. +33 (0) 556 34 06 57 - Fax. +33 (0) 556 34 90 92
 E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com

Satelec
 Satelec
 Satelec

Грубка для перистальтической помпы Satelec, упаковка -10 шт. (упаковка)



Трубка для перистальтической помпы Satelec (в упаковке)

Tubing for Satelec peristaltic pump
 Tubulure pour pompe péristaltique Satelec
 Línea para bomba peristáltica Satelec
 Schlauch für Peristaltik-Pumpe von Satelec
 Tubo per pompa peristáltica Satelec
 Irrigatie lijnen voor Satelec peristáltische pomp
 Σωληνίδες για περιστάλτική αντλία Satelec

REF. (x1) : E57370 / REF. (x10) : F57370



2018-12



Do not use if package
 is damaged

Rx only

LOT

G002315

Caution:
 US federal law restricts
 this device to sale by or
 on the order of a physician



2023-12



Do not re-use



Caution, consult
 accompanying documents

STERILE EO


Sterilized using ethylene oxide




SATELEC
ACTEON

A Company of ACTEON Group - 17 av G. Eiffel - BP 30216 - 33708 MERIGNAC cedex France
 Tel. +33 (0) 556 34 06 07 - Fax. +33 (0) 556 34 92 92
 E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com

Трубка для перистальтической помпы Satelec в упаковке (маркировка)

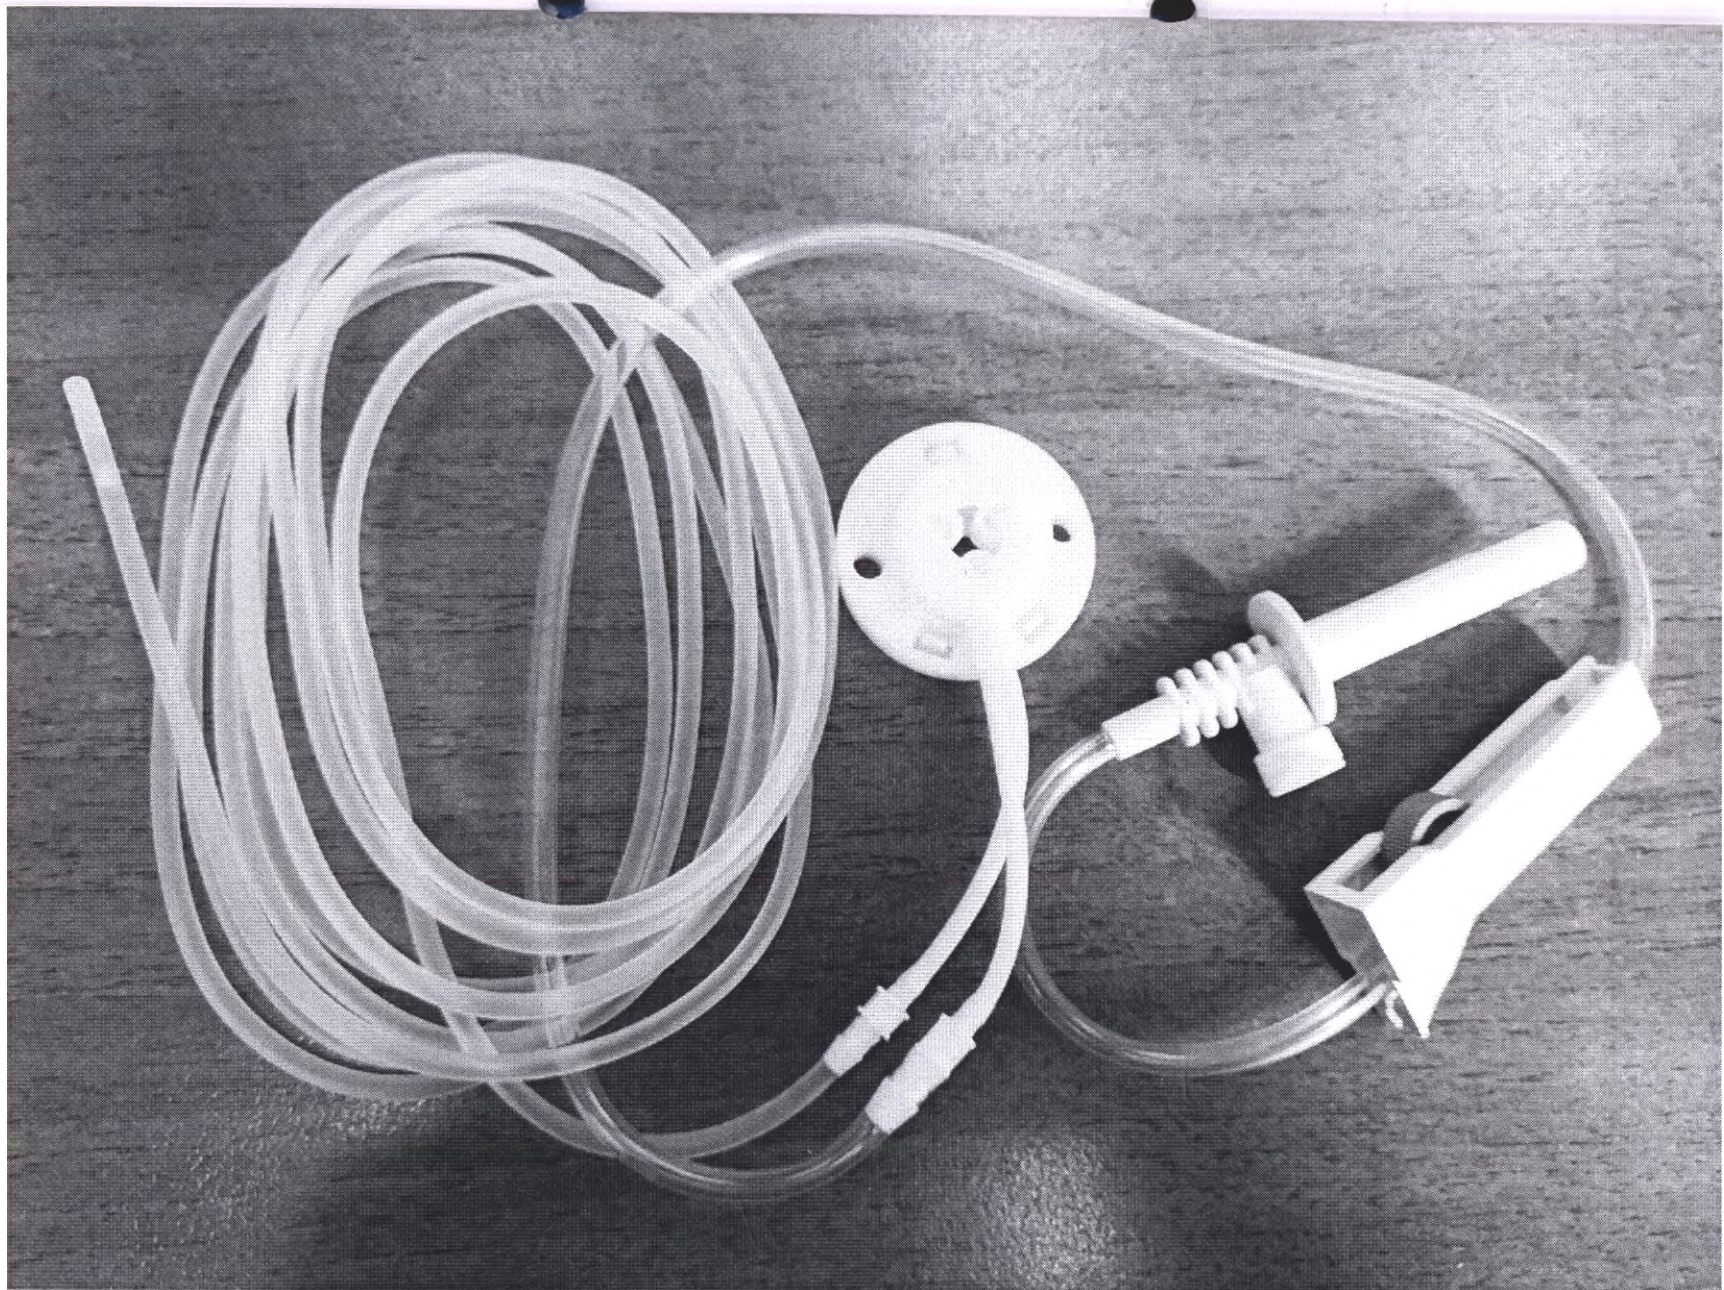


Трубка для перистальтической помпы Satelec

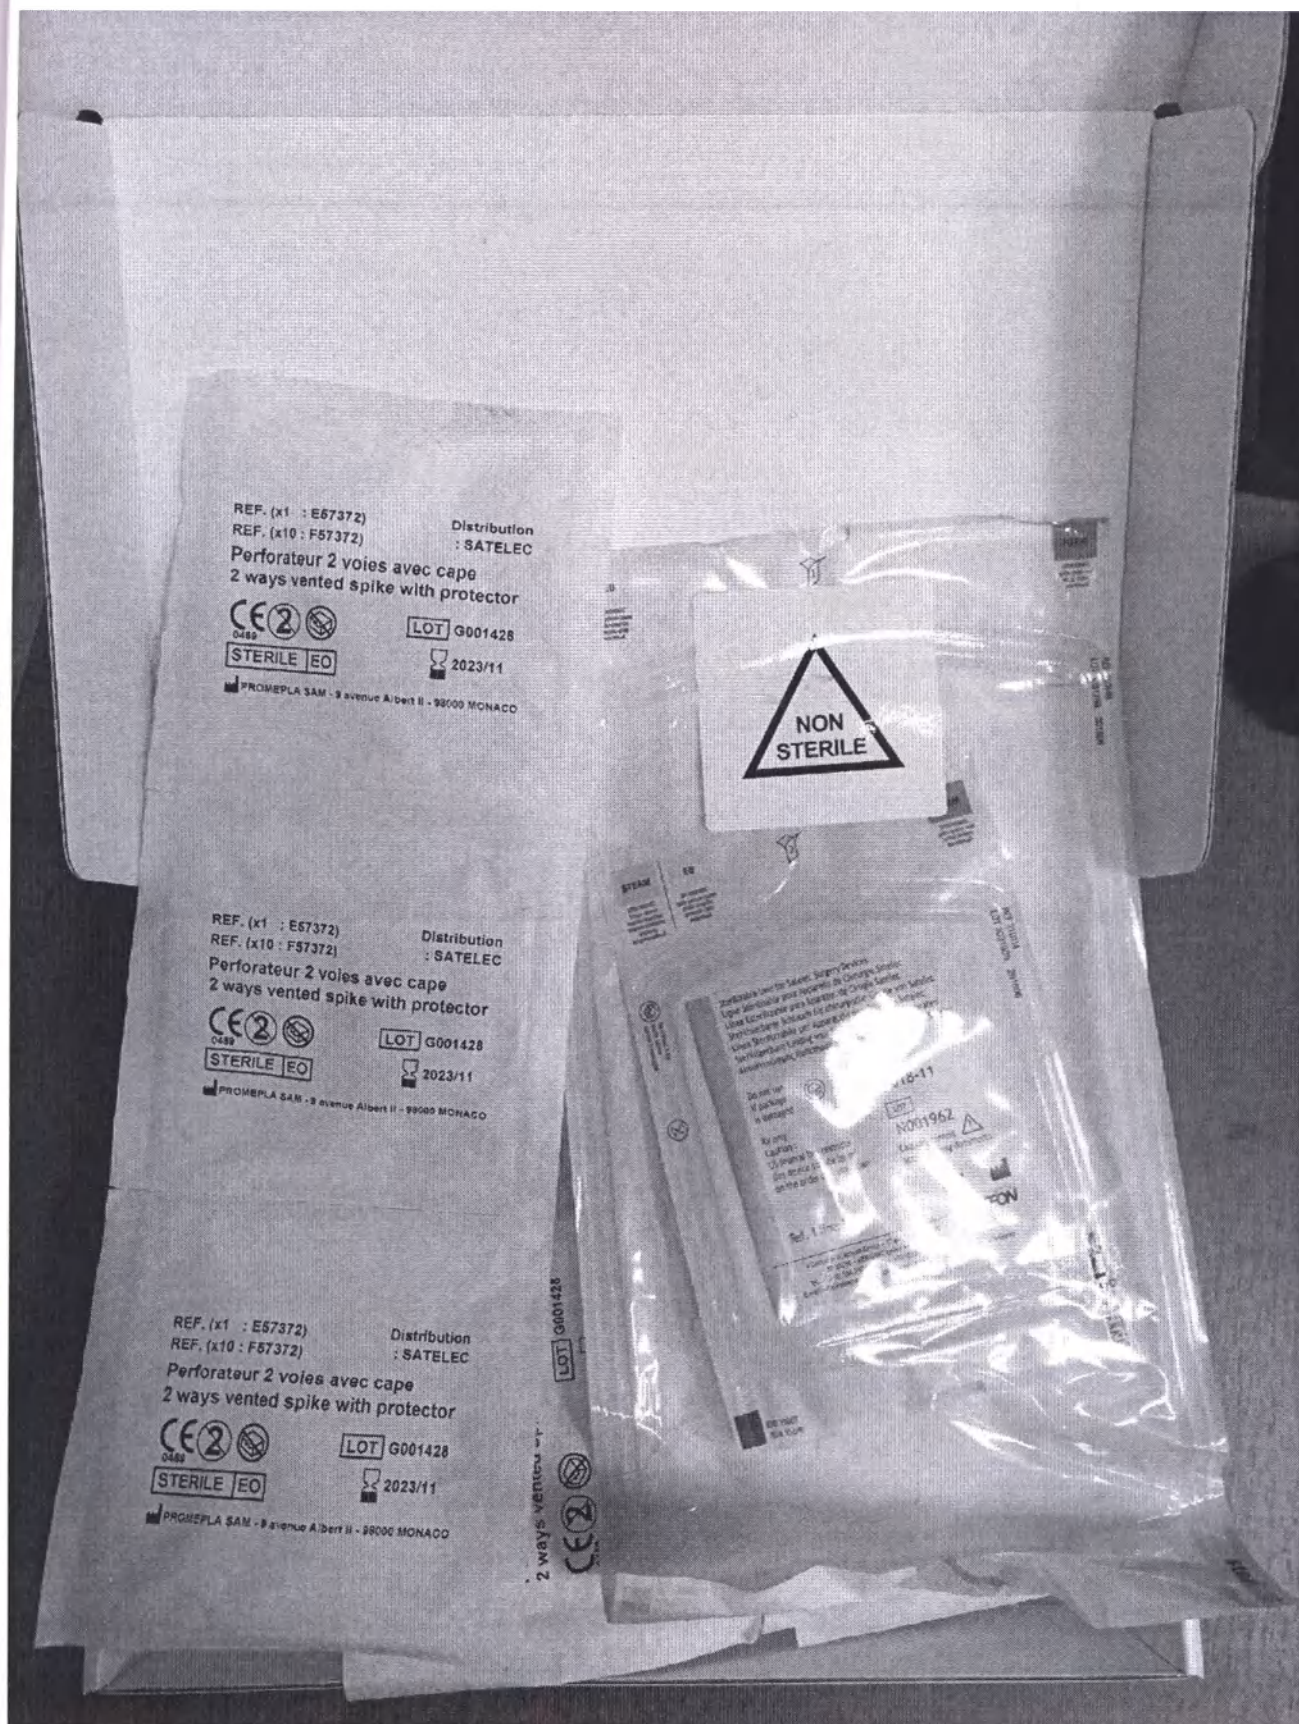

Набор стерилизуемой линии и перфораторов:

- Стерилизуемая линия для хирургического аппарата Satelec (1 шт.)
- Перфораторы (10 шт.)

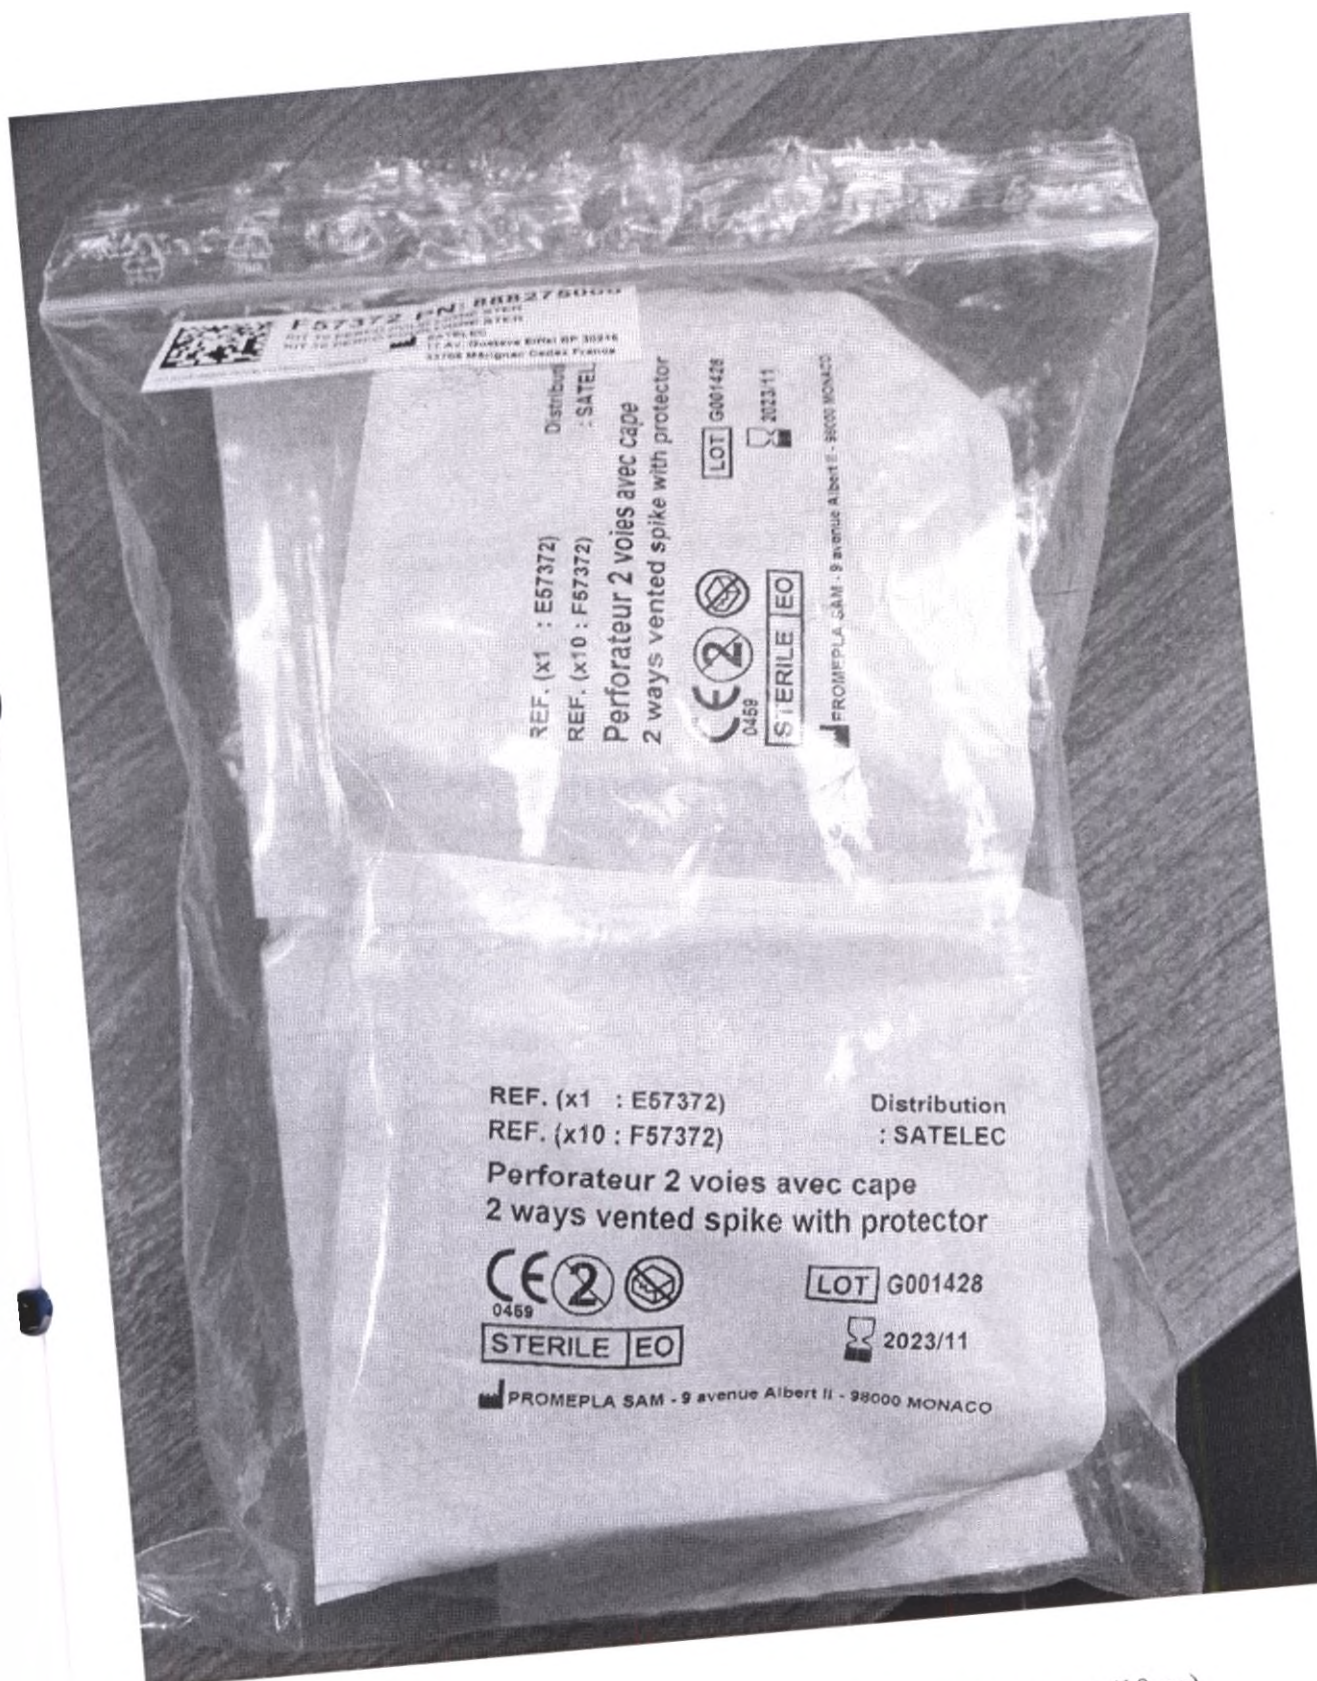

Набор перфораторов для стерилизуемой линии (10шт)

Аппарат стоматологический для костной хирургии PIEZOTOME CUBE

Производитель:

САТЕЛЕК

17 Авеню Гюстав Эйфеля, 3и Ду Фэр 33700 Мерињак, Франция

Тел.: +33 (0) 556 34 06 07

Факс +33 (0) 556 34 92 92

E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com

Страна происхождения:

Франция

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ИП Норкина Маргарита Валентиновна

Тел.: +7 495 1501323

**Регистрационное
удостоверение**

№

от

Макет стикера с расшифровкой основной информации на русском языке, наносимый на
коробку с изделием

Бокс для стерилизации	
Производитель:	САТЕЛЕК 17 Авеню Гюстав Эйфеля, 3и Ду Фэр 33700 Мериньяк, Франция Тел.: +33 (0) 556 34 06 07 Факс +33 (0) 556 34 92 92 E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com
Страна происхождения:	Франция
Уполномоченный представитель в РФ:	ИП Норкина Маргарита Валентиновна Тел.: +7 495 1501323
Регистрационное удостоверение	№ от

Макет стикера с расшифровкой основной информации на русском языке, наносимый на коробку с боксом для стерилизации

Трубка для перистальтической помпы Satelec

Производитель:	САТЕЛЕК 17 Авеню Гюстав Эйфеля, Зи Ду Фэр 33700 Мериньяк, Франция Тел.: +33 (0) 556 34 06 07 Факс +33 (0) 556 34 92 92 E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com
Страна происхождения:	Франция
Количество	10 штук
Уполномоченный представитель в РФ:	ИП Норкина Маргарита Валентиновна Тел.: +7 495 1501323
Регистрационное удостоверение	№ _____ от _____

Макет стикера с распиской основной информации на русском языке, наносимый на коробку с трубкой для перистальтической помпы Satelec

Набор стерилизуемой линии и перфораторов**Производитель:****САТЕЛЕК**

17 Авеню Гюстав Эйфеля, 3и Ду Фэр 33700 Мериньяк. Франция

Тел.: +33 (0) 556 34 06 07

Факс +33 (0) 556 34 92 92

E-mail: satelec@acteongroup.com www.acteongroup.com**Страна происхождения:**

Франция

Количество

Стерилизуемая линия 1 шт.

Перфоратор 10 шт.

**Уполномоченный
представитель в РФ:**

ИП Норкина Маргарита Валентиновна

Тел.: +7 495 1501323

**Регистрационное
удостоверение**

№ от

Макет стикера с расшифровкой основной информации на русском языке, наносимый на
коробку с набором стерилизуемой линии и перфораторов

