

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

« 30 » _____ 2019 г.



**Набор реагентов
Моно-РИД-Г,А,М
Сыворотки диагностические моноспецифические
против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие
по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
МОНО-РИД-Г,А,М
СЫВОРОТКА ПРОТИВ
Ig G ЧЕЛОВЕКА
1 мл
ТИТР В РИД
С
ГОДЕН ДО

МИКРОГЕН
МОНО-РИД-Г,А,М
СЫВОРОТКА ПРОТИВ
Ig A ЧЕЛОВЕКА
1 мл
ТИТР В РИД
С
ГОДЕН ДО

МИКРОГЕН
МОНО-РИД-Г,А,М
СЫВОРОТКА ПРОТИВ
Ig M ЧЕЛОВЕКА
1 мл
ТИТР В РИД
С
ГОДЕН ДО

МИКРОГЕН
МОНО-РИД-Г,А,М
КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ЧЛОВЕКА
1 мл
С
ГОДЕН ДО

**Набор реагентов
Моно-РИД-G,A,M**
**Сыворотки диагностические моноспецифические
против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие
по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x23x86 мм



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

2019 г.

**Набор реагентов
Моно-РИД-G,A,M**
**Сыворотки диагностические моноспецифические
против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие**
по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019



3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

Не кантовать!	Серия: Дата изготовления: Годен до:
Число единиц потребит. упак. изделия:	
Набор реагентов Моно-РИД-G,A,M Сыворотки диагностические моноспецифические против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019	
БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортировать при температуре от 9 до 25 °С не более 14 сут. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.	АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44 тел. (831) 434-42-77
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий



МИКРОГЕН

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Нижне
«Нижегородское предприятие по п.

Паспорт № 27

Издано для диагностики и контроля Набор реагентов Моно-РИД-Г, А, М

	Лот	Серия	171
	Дата изготовления	05/20	
	Годен до:	06/23	
Число единиц потребит. упак. изделий: 60			

Набор реагентов
Моно-РИД-G,A,M
 Сыворотки диагностические моноспецифические
 против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие
 по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019

РАТЫ **ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**


и видами крытого
 температуре от 2 до 8 °С.
 хранить при температуре
 14 сут.
 до истечения в течение всего срока годности
 8 °С в защищенном от света месте.

г.упак. 0,04

МИКРОХИТЕ


АО «НПО «Микроген»
 Россия, 115088, г. Москва,
 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
 тел. (495) 710-37-67

Адрес производства:
 Россия, 603006, Нижегородская область,
 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44
 тел. (831) 434-43-77

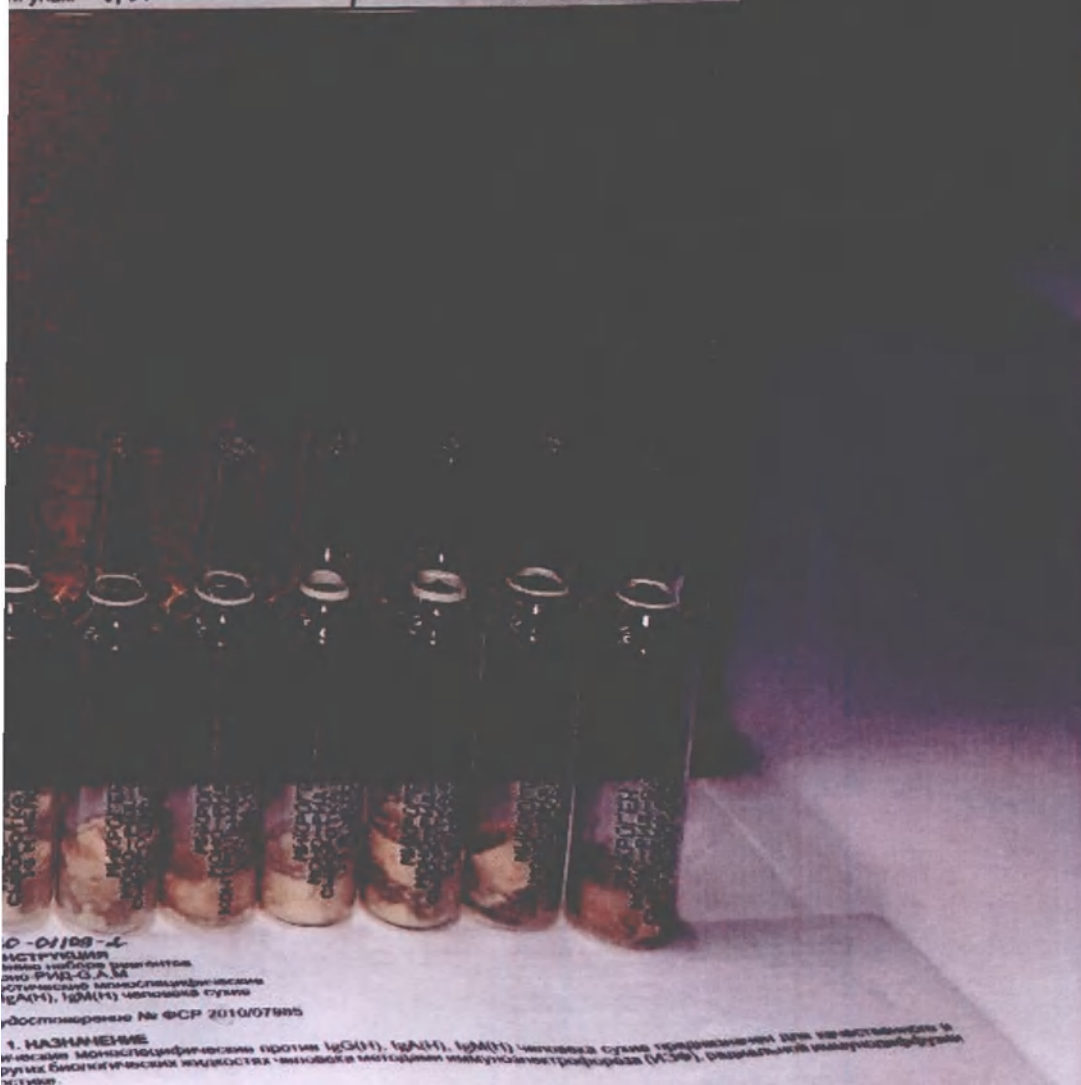

0-0108-4
 Инструкция
 к набору реагентов
 Моно-РИД-G,A,M
 Сыворотки диагностические моноспецифические
 против IgG(H), IgA(H), IgM(H) человека сухие
 по ТУ 21.20.21-145-20401675-2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов Моно-РИД-G,A,M предназначен для определения в
 сыворотке крови человека иммуноглобулинов класса G (IgG), A (IgA), M (IgM) с помощью
 метода иммунодиффузии в геле.

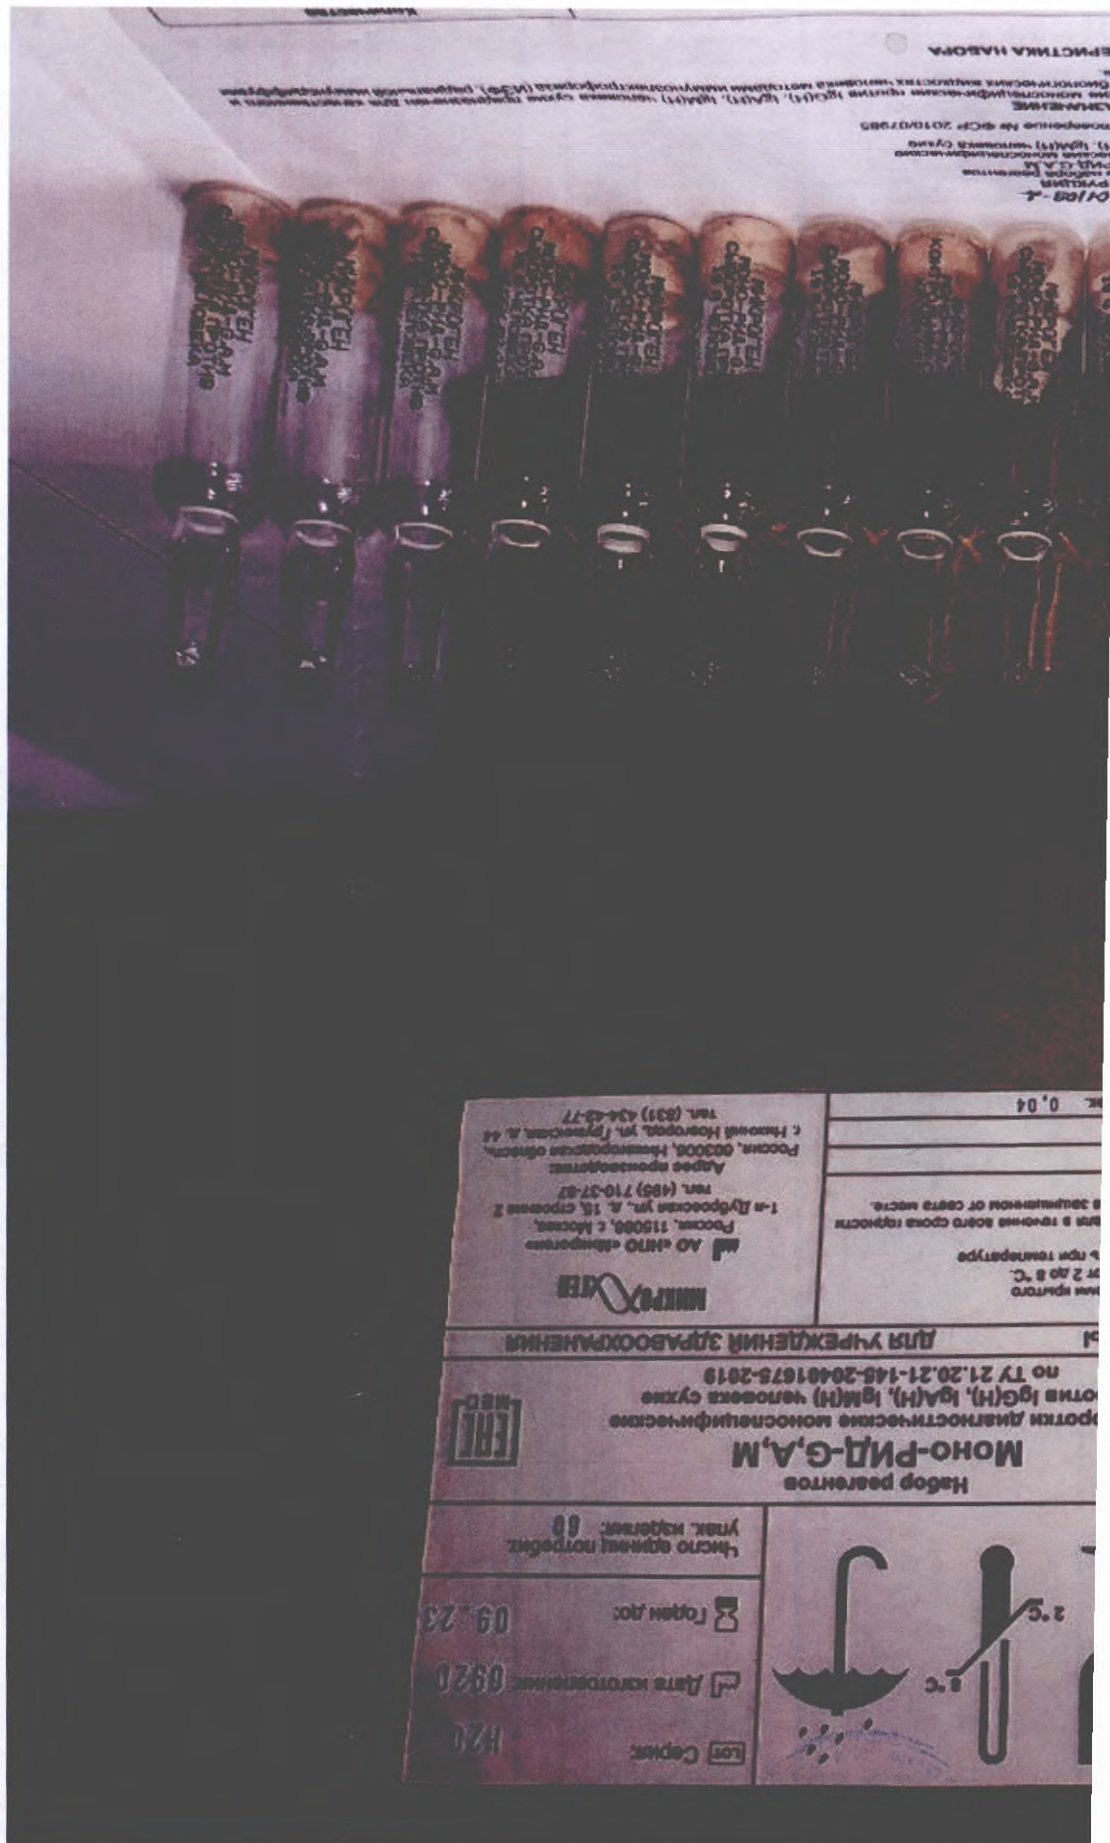

Начальник
Управления регистрации
и лицензирования
40 «1» 01.11.2011 г. ЕРШОВ



Не кантовать

БИО

Транспортировка
транспорта по
Допускается
от 9 до 25 °C
Хранить в упаковке
при температуре

Масса брутто

Масса нетто

Масса нетто

Акционерное общество «Научно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»
АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 603006, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44
тел. (831) 434-42-77

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатитов С и HBsAg отсутствуют

Контрольная сыворотка крови человека

IgG -	171,1 ME/мл	13,76	мг/мл
IgA -	151,9 ME/мл	2,16	мг/мл
IgM -	152,4 ME/мл	1,29	мг/мл

Годен до 09.23 КОМПЛЕКТ С Н27-0920



МИКРОГЕН

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Нижний Новгород
«Нижегородское предприятие по производству бактериальных препаратов «Ниббио»

Паспорт № 27

**Набор реагентов Моно-РИД-С
моноспецифические против Ig**

Комплект сер. Н27-0920

Количество, ед. изм. 458 шт.

Ссылка
прото
Результат

Назначение для диагностики in vitro Набор реагентов Моно-РИД-С.А.М. Сыворотки
количественного определения иммуноглобулинов G, A, M в сыворотке крови, препараты
(РИД) и преципитации в геле. Флуориметрическое измерение — вспомогательное средство

Набор состоит из 4 компонентов