

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»
А.Е. Ершов
« 19 » _____ 20 19 г.

Поли-ИЭФ
Сыворотка для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крови человека сухая
по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
ПОЛИ-ИЭФ
СЫВОРОТКА ДЛЯ ИЭФ
ПРОТИВ СЫВОРОТОЧНЫХ
БЕЛКОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
1 мл
С
ГОДЕН ДО

Поли-ИЭФ
Сыворотка для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крови человека сухая
по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x23x86 мм



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

20 19 г.

Место для нанесения
средства идентификации


Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

*Средство идентификации – будет наноситься после принятия решения Правительством Российской Федерации о маркировке медицинских изделий средствами идентификации

Поли-ИЭФ
Сыворотка для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крови человека сухая
по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

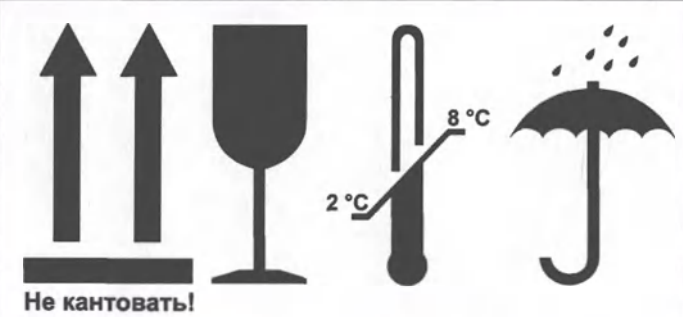 Не кантовать!	Lot Серия: Дата изготовления: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
Поли-ИЭФ Сыворотка для иммуноэлектрофореза против сывороточных белков крови человека сухая по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019 EAC MED	
БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортировать при температуре от 9 до 25 °С не более 14 сут. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте.	МИКРОХГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44 тел. (831) 434-42-77
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий



Акционерное общество «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген»

АО «НПО «Микроген»

Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:

Россия, 603006, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 44
тел. (831) 434-42-77

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатитов С и HBsAg отсутствуют

LOT C

H20

Дата изготовления

1020

Годен до

10.23



МИКРОГЕН

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Нижний Новгород
«Нижегородское предприятие по производству бактериальных препаратов «ИмБио»

Паспорт № 20


Набор реагентов Поли-НЭФ Сыворотки для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крс

Серия № H20-1020

Количество, ед. изм. 62 шт.

Адрес изготовителя: ТУ 9389-147-14237183-200

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
Полн-ИЗФ
иммуноэлектрофореза против сыпноточных белков крови
«человечья сухая»
ке удостоверения № ФСР 2010/07984 от 7 мая 2018 года

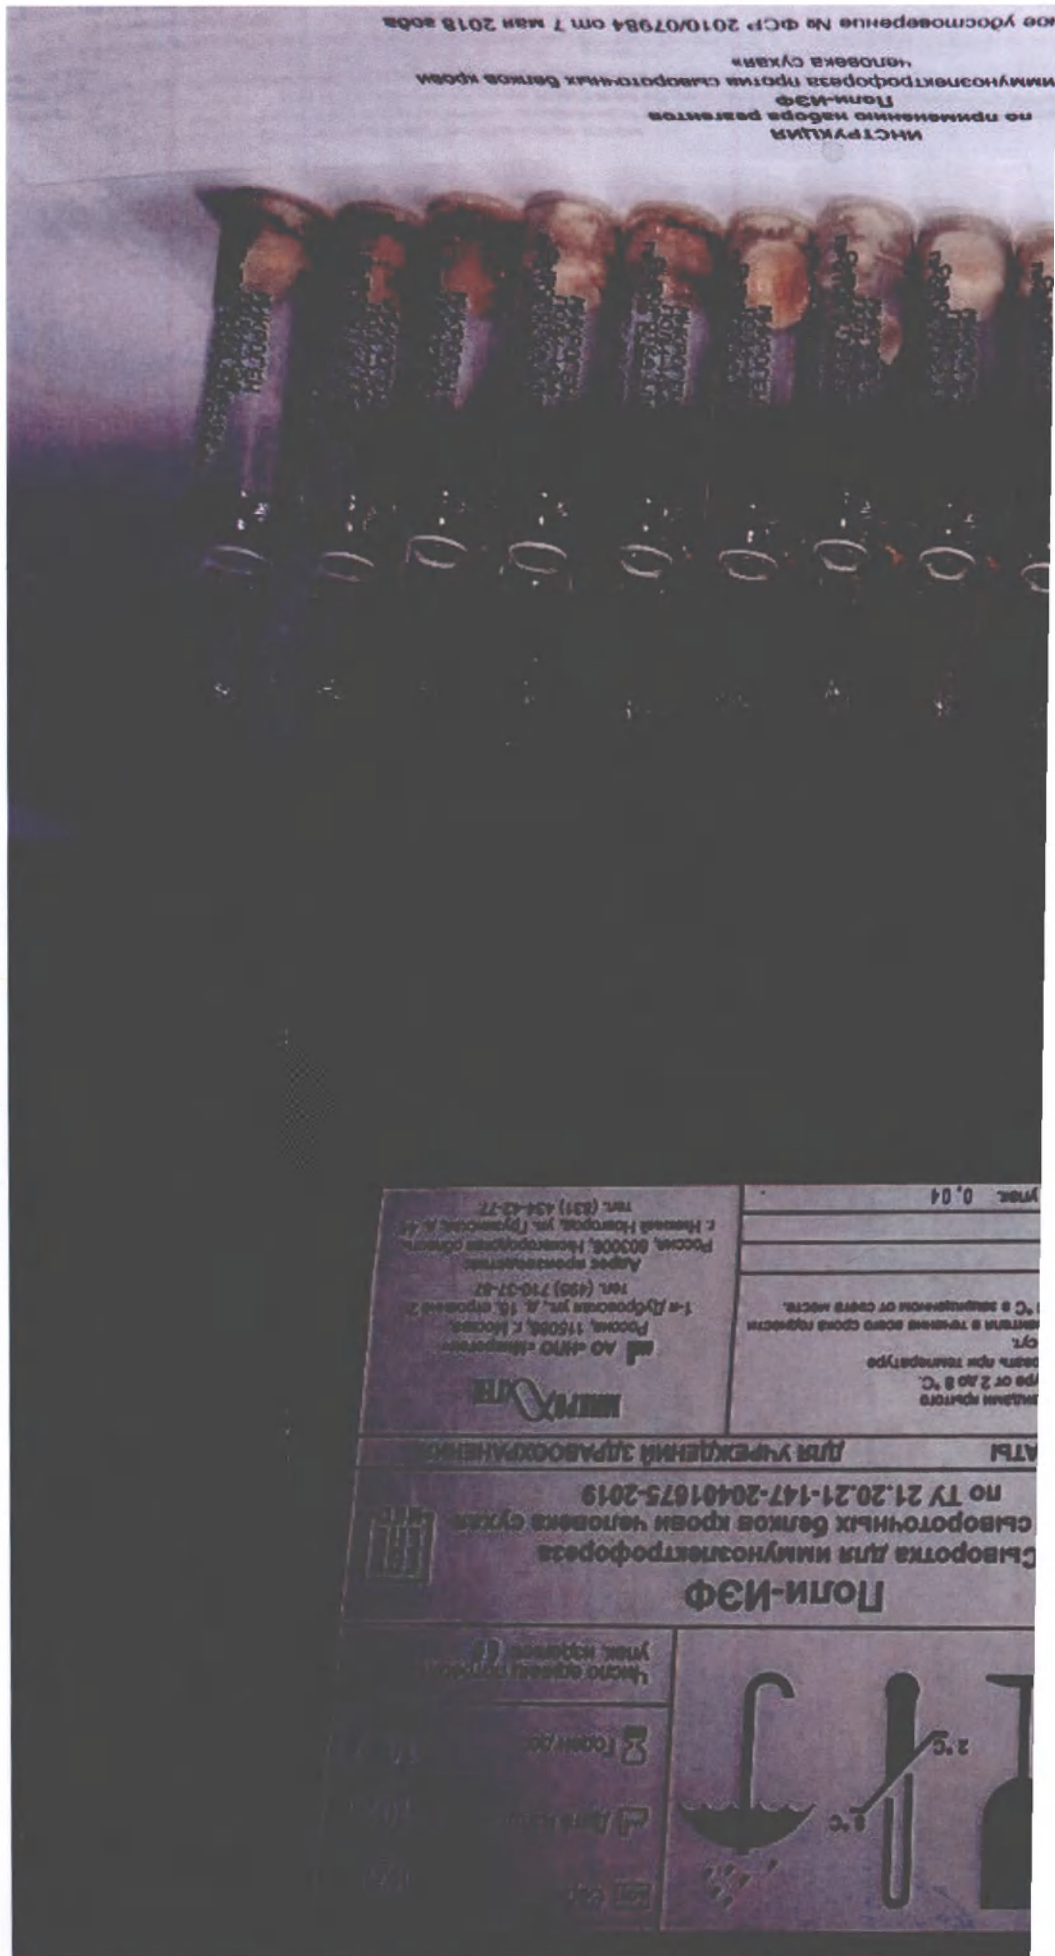

Упаковка: 0,04 Внимание! В течение всего срока годности хранить в темном месте при температуре +2 до +8 °C в защищенной от света среде.		Адрес производителя: Россия, 603008, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гусарская, д. 45 тел. (831) 424-42-77
Адрес дистрибутора: Россия, 116088, г. Москва, г-н Александров ул. д. 18, строение 2 тел. (495) 710-57-47		АО «НПО «Биомед» Россия, 116088, г. Москва, г-н Александров ул. д. 18, строение 2 тел. (495) 710-57-47
Полн-ИЗФ сыпноточных белков крови человека сухая по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019		
АТЫ для учреждений здравоохранения		
Число проб на одну пробу: 10		Упаковка: 0,04

Начальник
Управления регистрации
и медицинских исследований
АО «НПО «МИКРОГЕН»



↑ ↑
Не кантовать
БИО
Транспортировка
транспорта при
Допускается т
от 9 до 25 °С и
Хранить в упак
при температу
Масса брутто
Масса нетто
Масса нетто

МИКРОГЕН

Поли-ИЭФ
Сыворотка для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крови человека
сухая
по ТУ 21.20.21-147-20401675-2019

Состав медицинского изделия:
Сыворотка для иммуноэлектрофореза против
сывороточных белков крови человека 10 ампул, лиофилизат из
*содержит биологические материалы
Меры предосторожности: см. Инструкцию по применению
Для проведения 45-50 определений в ИЭФ
Для профессионального применения

МИКРОГЕН

Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Нижний Новгород
«Нижегородское предприятие по производству бактериальных препаратов «ИмБио»

Паспорт № 20

Набор реагентов Поли-ИЭФ Сыворотка для иммуноэлектрофореза
против сывороточных белков крови человека сухая

Серия № Н20-1020
Количество, ед.изм. 62 шт.

«Сыворот



Серия: 1120
Дата изготовления: 10.20
Годен до: 10.23

Число единиц потребит.
упак. изделий: 60

Поли-ИЭФ

Порошок для иммуноэлектрофореза
сывороточных белков крови человека сухая
форма
ТУ 21.20.21-147-20401675-2019



для учреждений здравоохранения

Хранить
до 6 °C.
при температуре

в течение всего срока годности
при защите от света moisture

0,04

МИКРОХИТ

АО «НПО «Сибиреан»
Россия, 115008, г. Москва,
1-я Дубравская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87
Адрес производства:
Россия, 603006, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Гурьевская, д. 44
тел. (831) 434-43-77



ИНСТРУКЦИЯ
применению набора реагентов
Поли-ИЭФ
для иммуноэлектрофореза против сывороточных белков крови
человека сухая форма