

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

2020 г



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Система томографическая комбинированная для
получения магнитно-резонансных и позитронно-
эмиссионных медицинских изображений SIGNA
PET/MR**





GE Medical Systems LLC

3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI 53188 USA



REF

SIGNA PET/MR

380/400/415 V3~, 50/60 Hz

480 V3~, 60 Hz

≤ 103 kVA_{cont.}, ≤ 133 kVA_{nom}



2019-04

CE 0459



UDI:



(01)00840682105378(11)190409(21)PGPET1900017SC



Intertek
3029491

ETL CLASSIFIED

**MEDICAL
EQUIPMENT**

CISPR 11 / EN 55011

CLASS: A GROUP: 2

CLASSE: A GROUPE: 2



EAC

Segurança



Compulsório



Scanner
not assigned to a patient

MR Service Desktop - Insite_Browser

MR PET

Error Logs

Diagnostics

Image Quality

Calibration

Configuration

Utilities

Replacement

PM

Home

Time Zone : Europe/Amsterdam
CET-1:00CEST-2:00 EU

x86_64

Suite Id : EMC

Language : English

Magnet Serial Number : UA1267

Host IP : 172.19.27.139

FE Laptop IP : 192.168.4.2

Gradient Amplifier : 8921

Field Strength : 30000

Build number for MrpApps is MP26.0_R01_1824.b

Build number for OnlineHelp is Help_MP26.0_R01_English

Build number for PostSdC is MP26.0_R01_1824.b

Build number for TERRA is nuevo-CSERelease_3_1_16-RFV1_V7.x86_64

Build number for VREOS is helios_6.6.2

Build number for apps3p is MP26.0_R01_1824.b

Build number for cclass is MP26.0_R01_1824.b

Build number for hrdascrip is MP26.0_R01_1824.b

Build number for insite is MP26.0_R01_1824.b

Build number for install is MP26.0_R01_1824.b

Build number for mx_apps is MP26.0_R01_1824.b

Build number for mx_plat is MP26.0_R01_1824.b

Build number for patch_MP26.0_R01_eASL_ATSM is
IP012707_EASL_DELENC_PA6_ATSM_MP26.0_R01_WAU2_18FW31.3.006

Build number for patch_MP26.0_R01_research_CEST3_Dev-19fw10-3 is
MP26.0_R01_1824.b

Build number for recon is MP26.0_R01_1824.b

Build number for securemode is 2

MR Software release: MP26.0_1824b

Install In Spec Key : Installed

PET Software Details


Build number for PetSoftwareVersion is netmr k1.99.1386

C Shell


Unmount CD




Копировать информацию

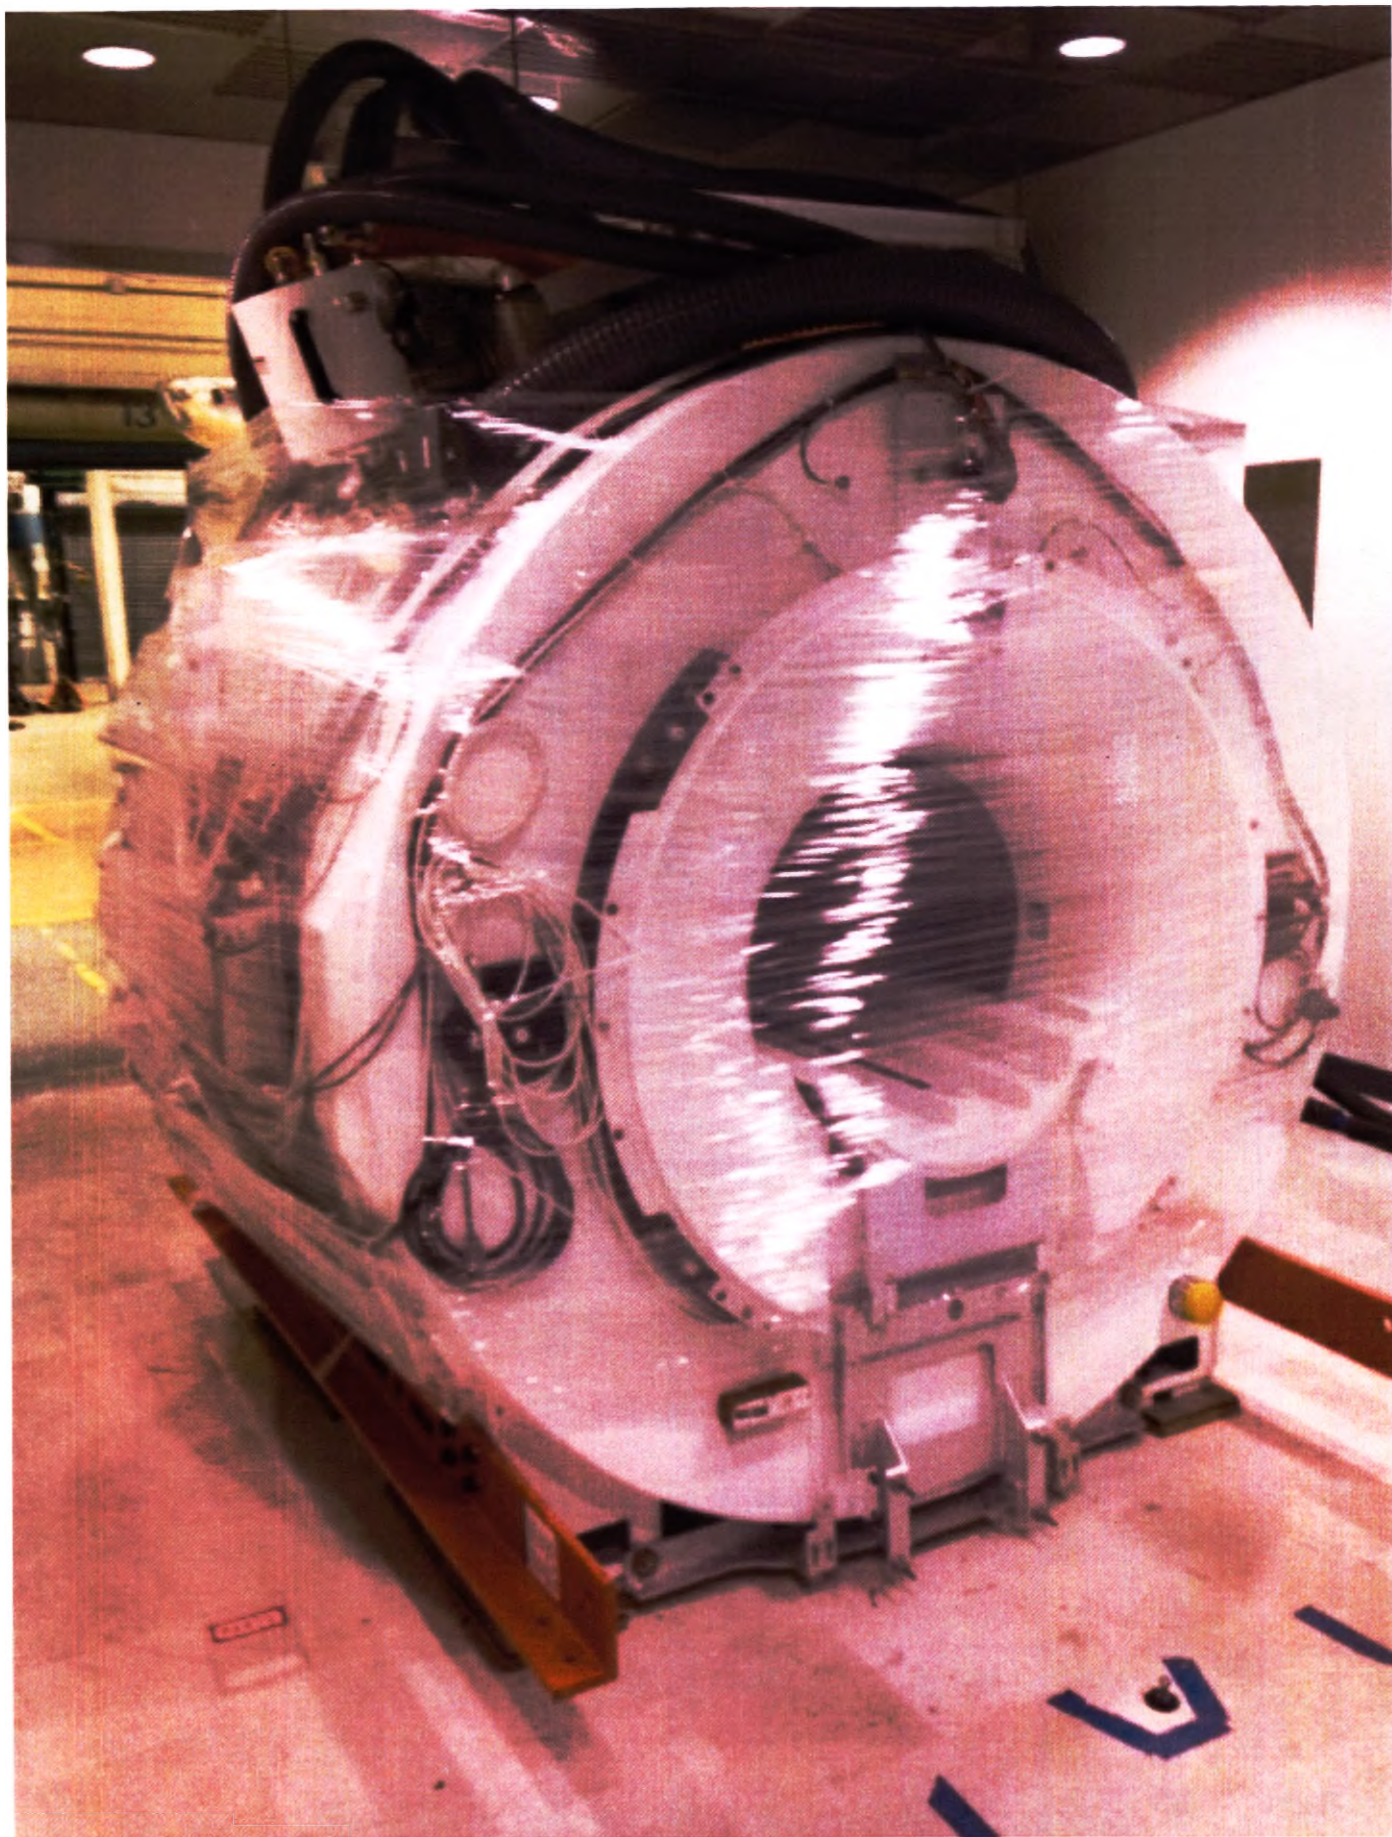


Магнит с активным экранированием, со встроенными РЧ катушками.

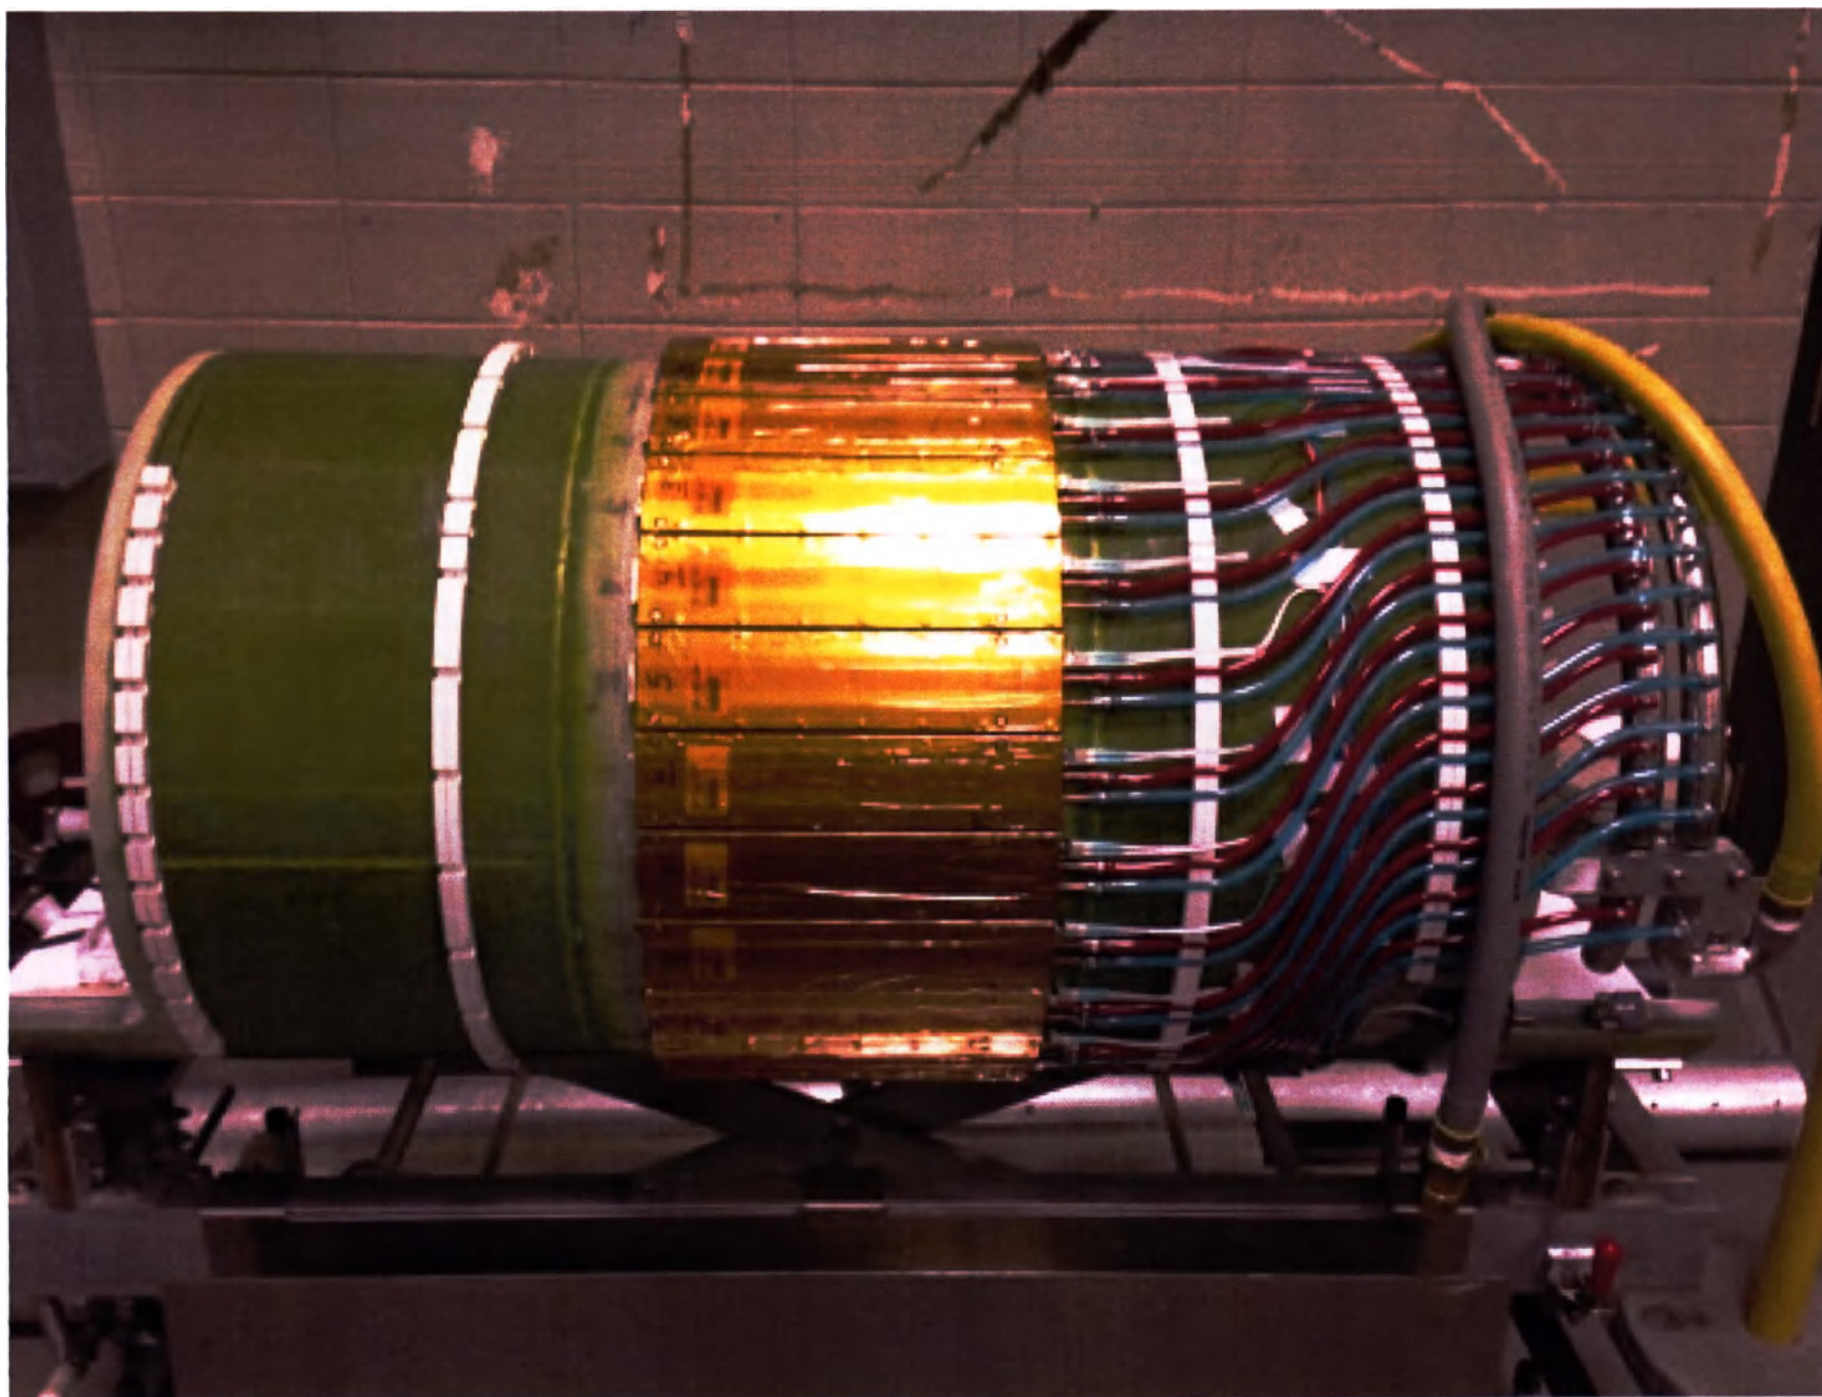

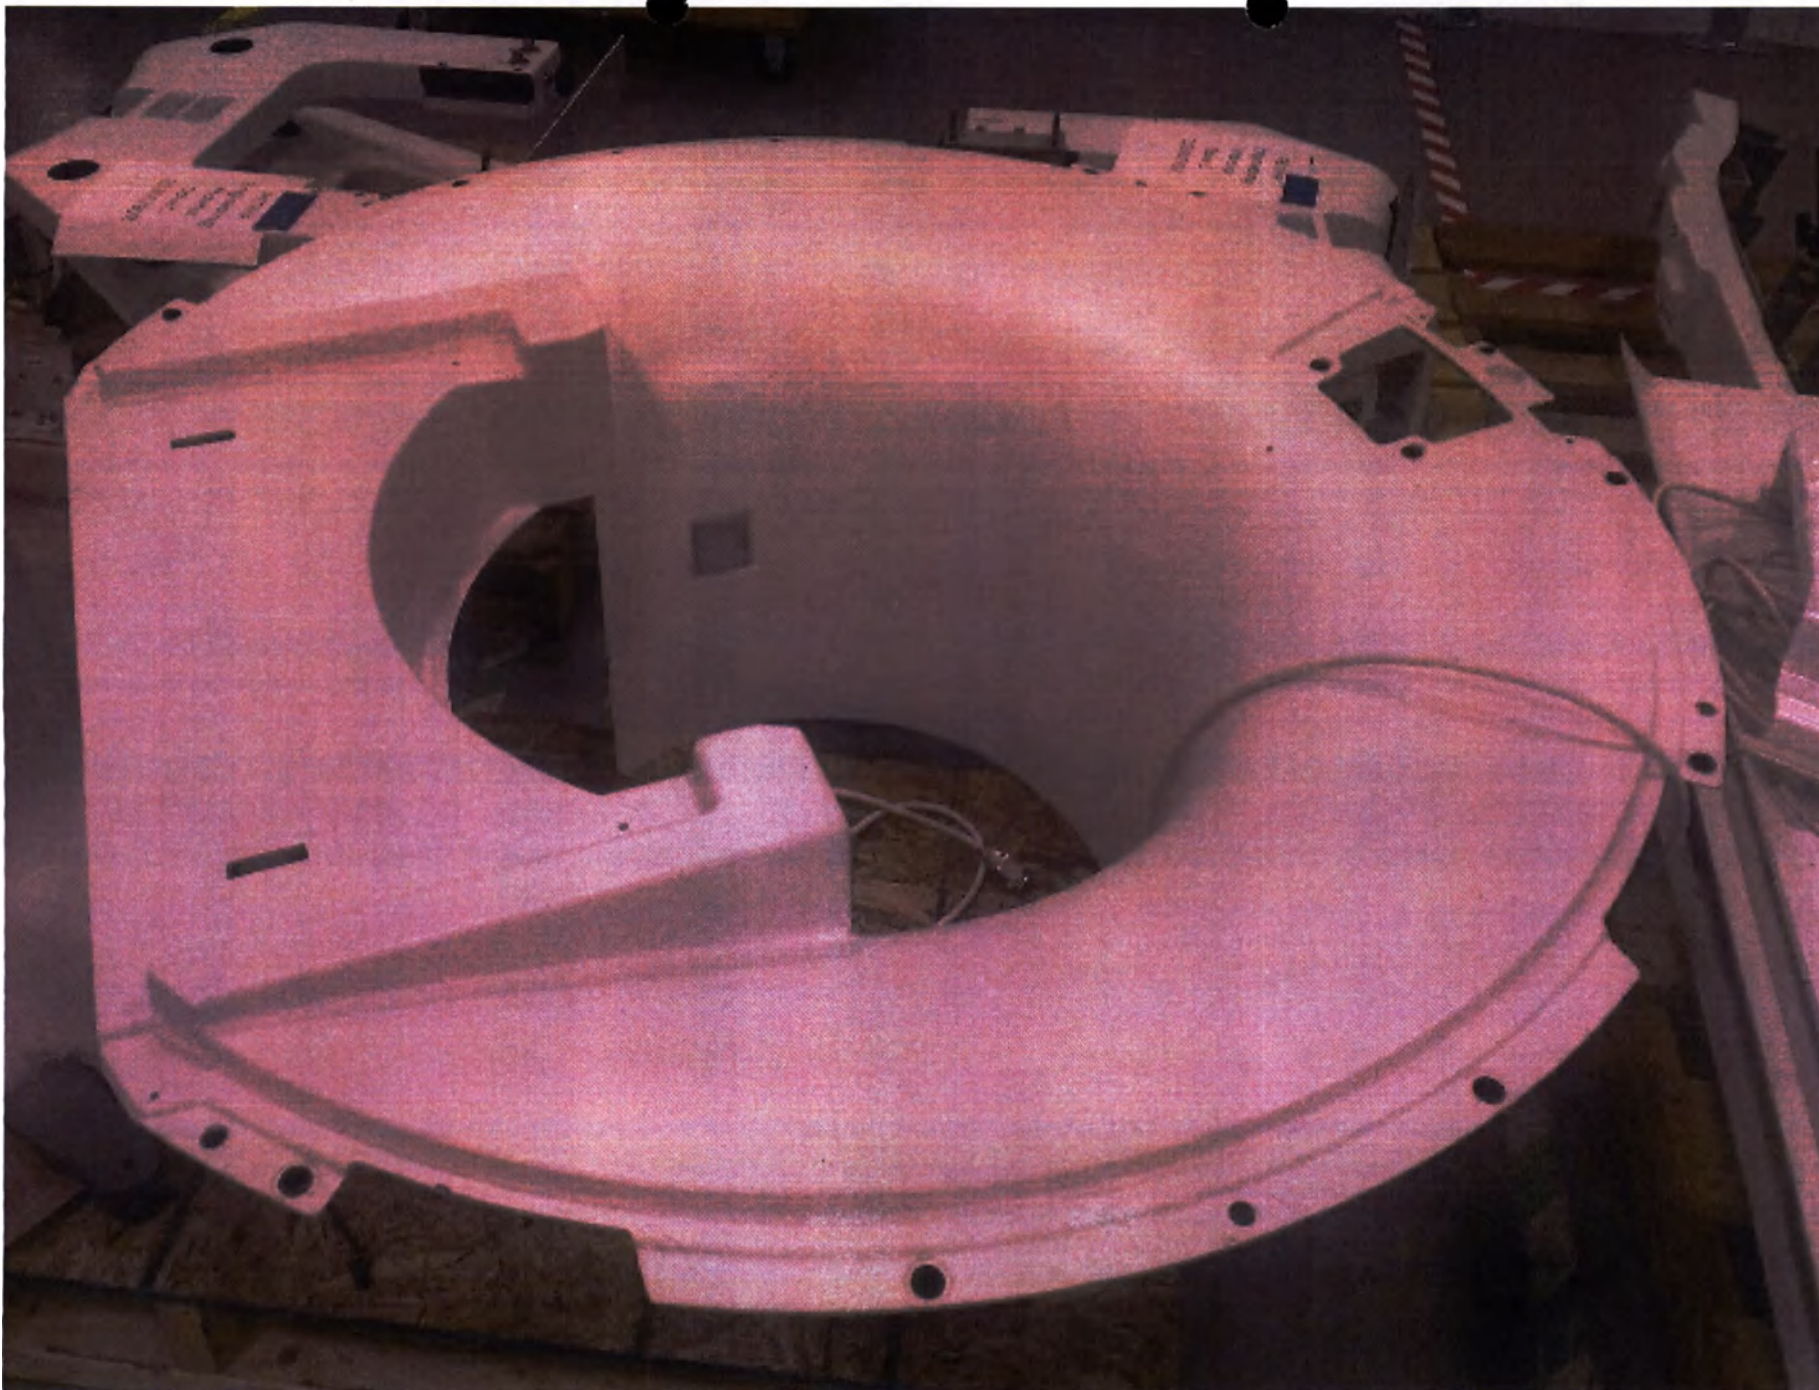

Кожухи магнита со встроенными системой связи с пациентом, системой вентиляции и освещения в туннеле.

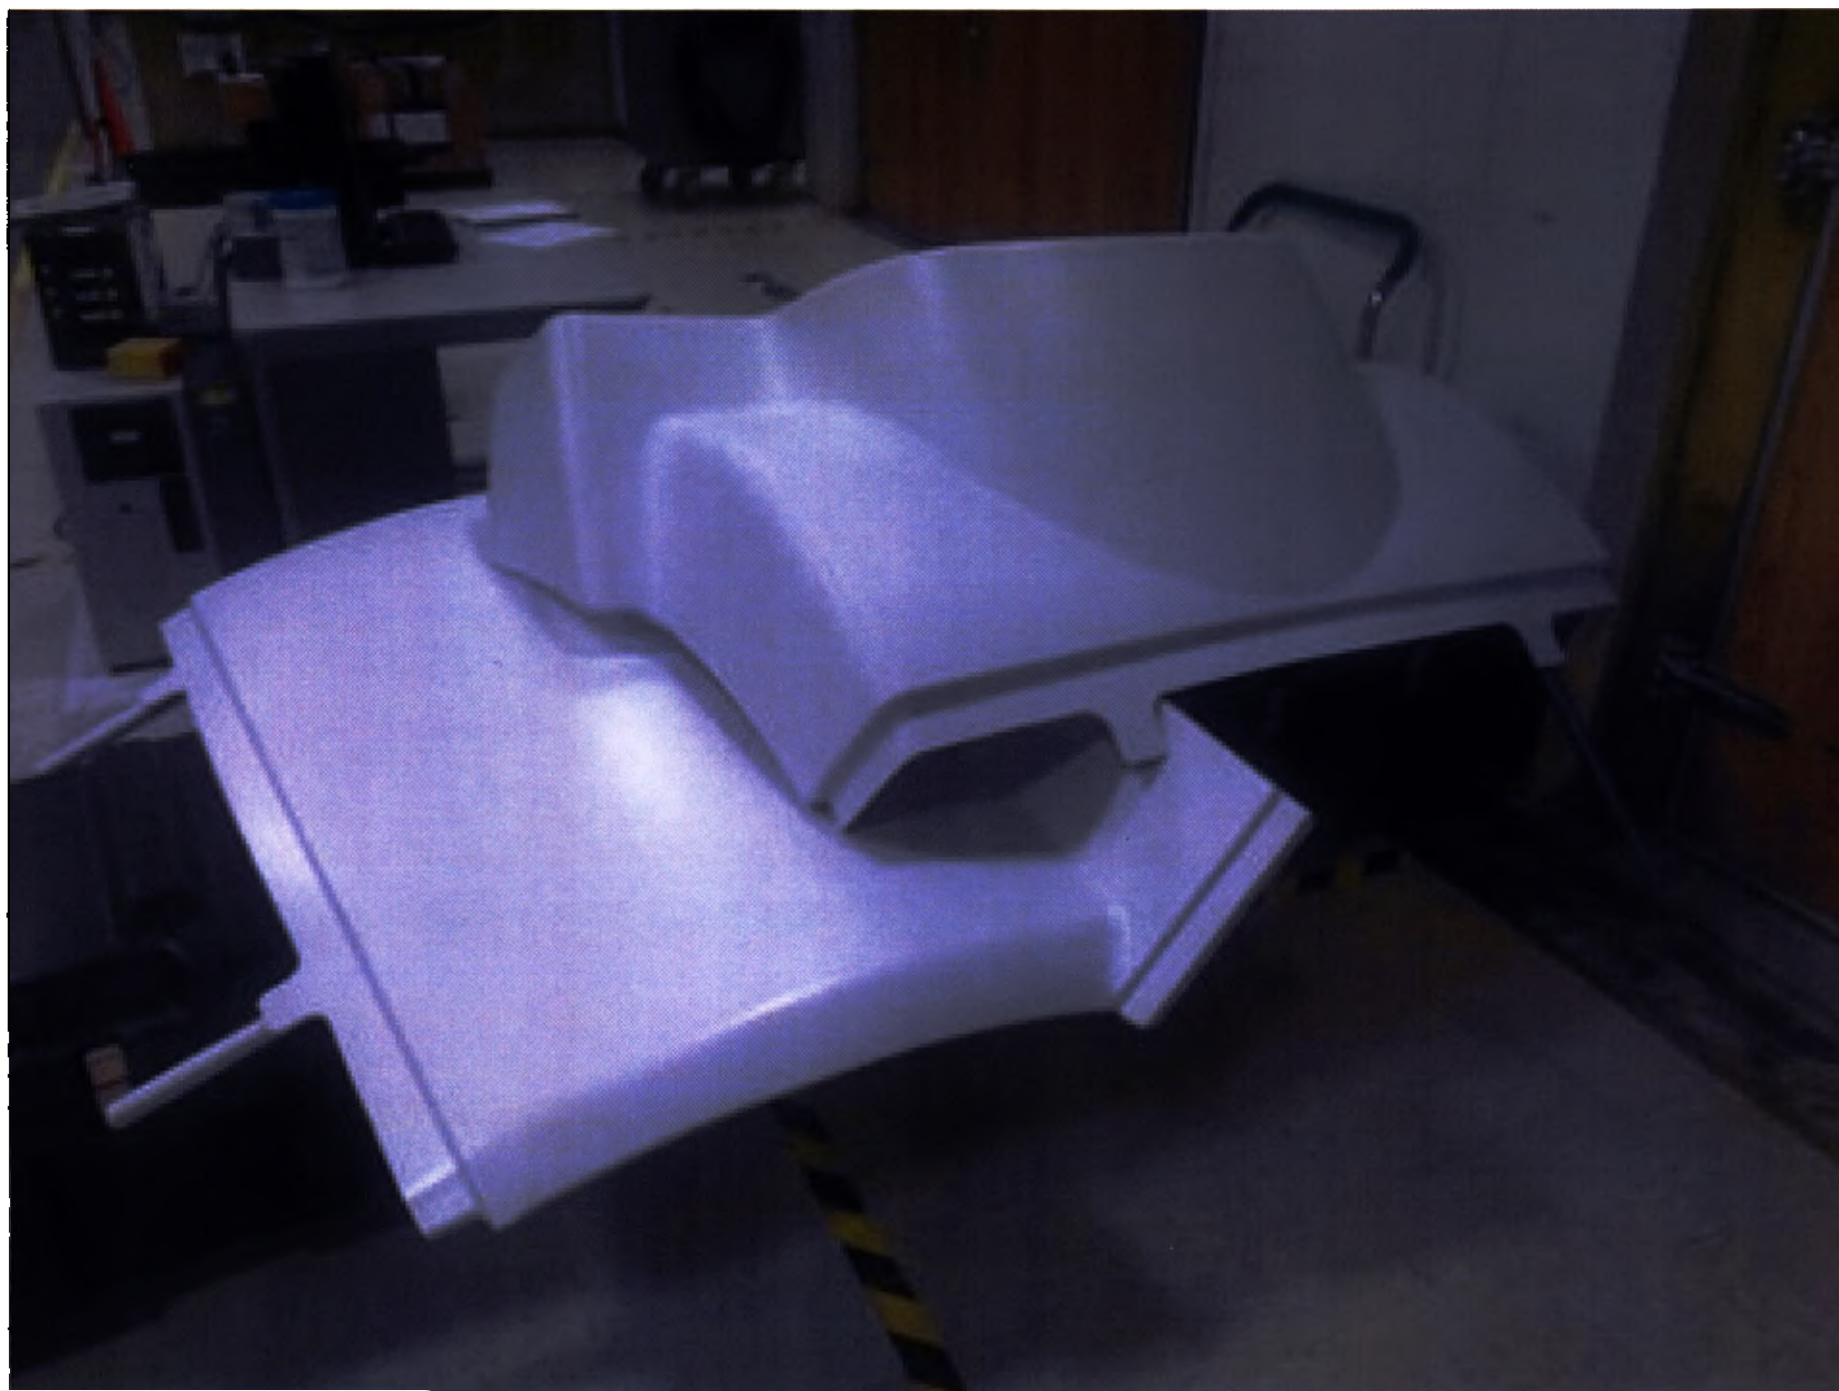




Кожухи магнита со встроенными системой связи с пациентом, системой вентиляции и освещения в туннеле.



Блок водяного охлаждения градиентов.



Блок реконструкции данных.

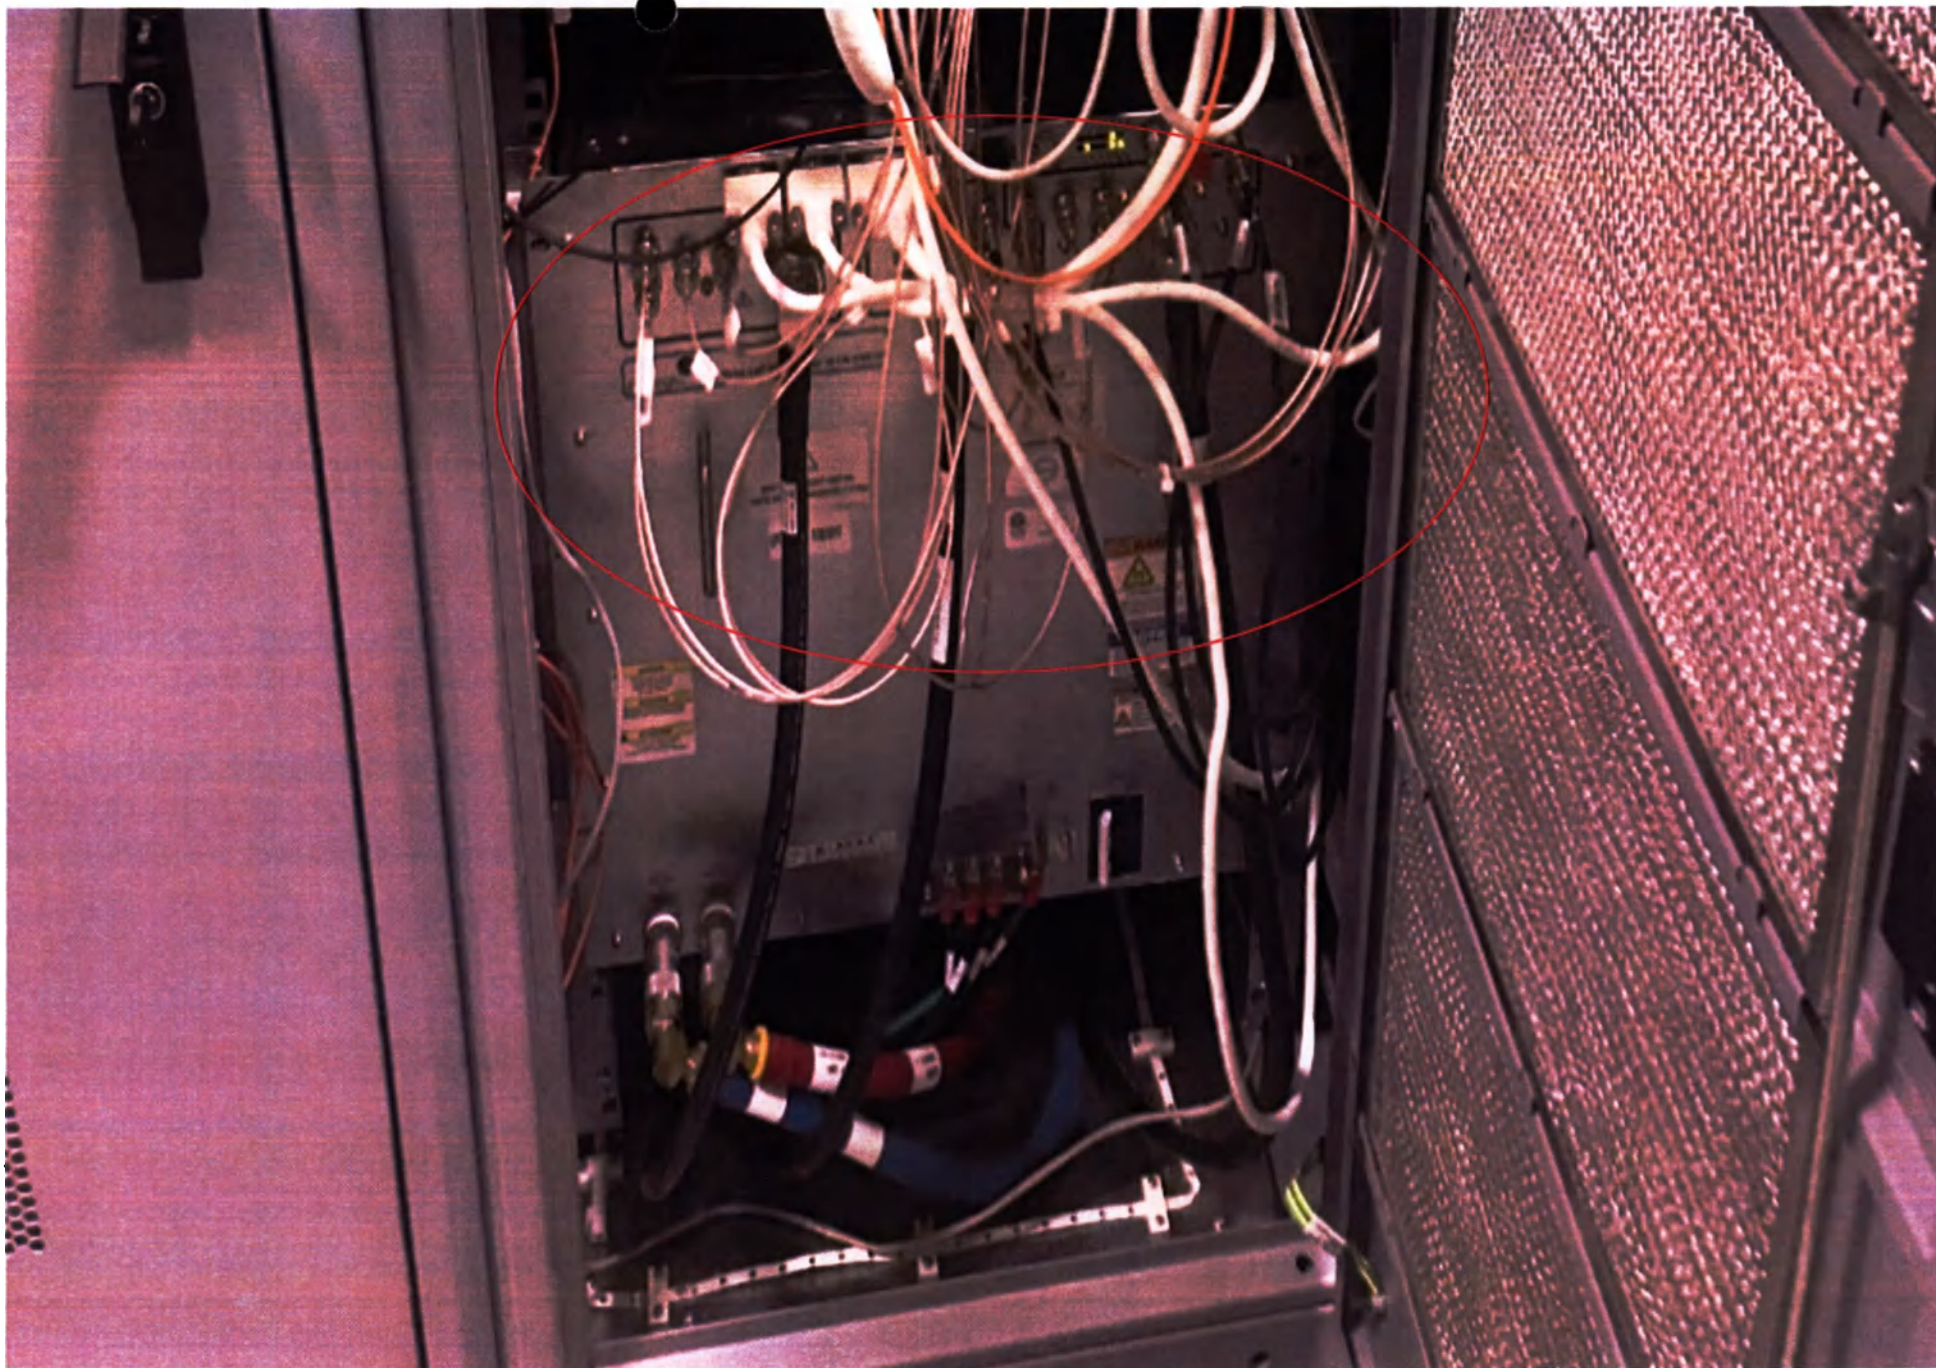

Генератор с частотой 50 Гц.

SIGNA™ PET/MR

Руководство оператора SIGNA™ PET/MR с QuantWorks™



SIGNA™ PET/MR


26.0 Руководство оператора, на русском языке



5770625-1RU (2019/05) Ред. 3

© 2019 General Electric Company


Все права защищены.


Эксплуатационная документация SIGNA PET/MR на бумажном или электронном носителе

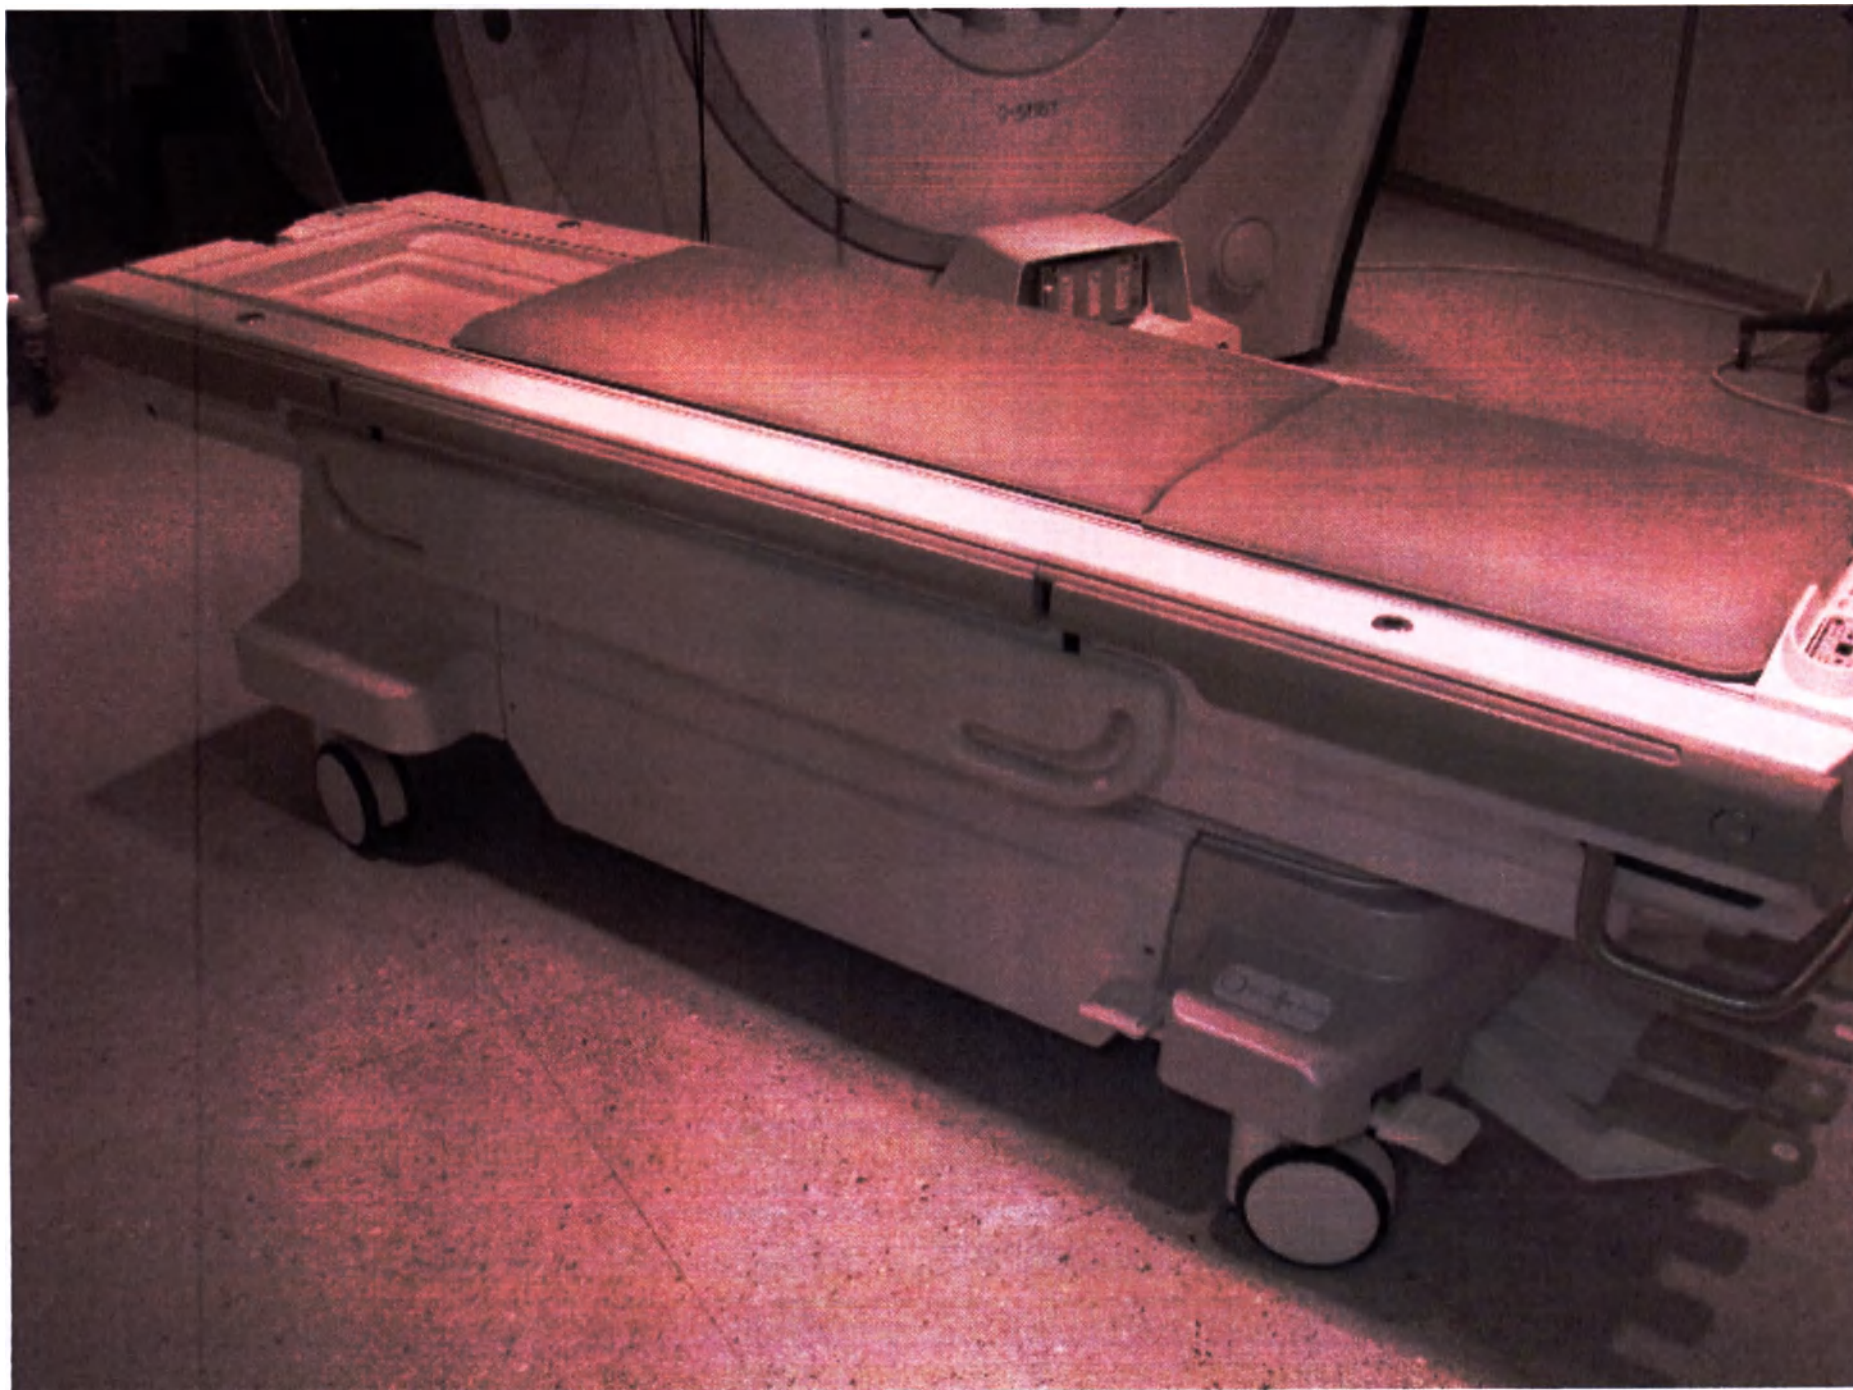


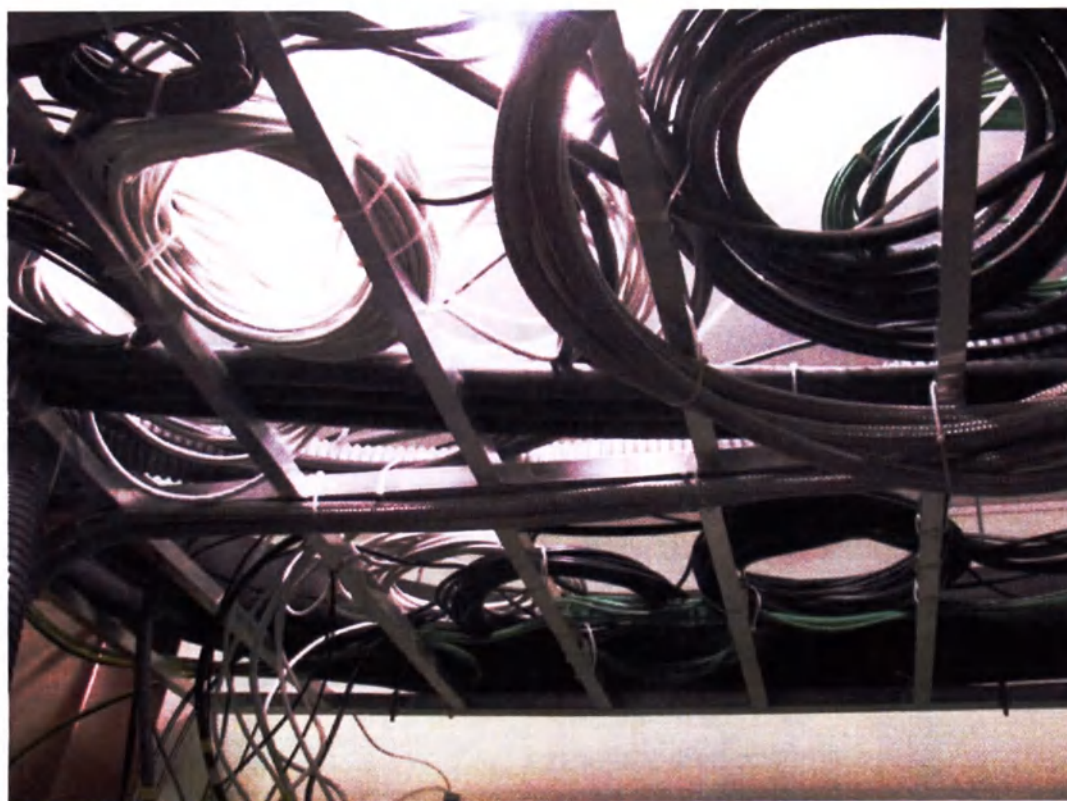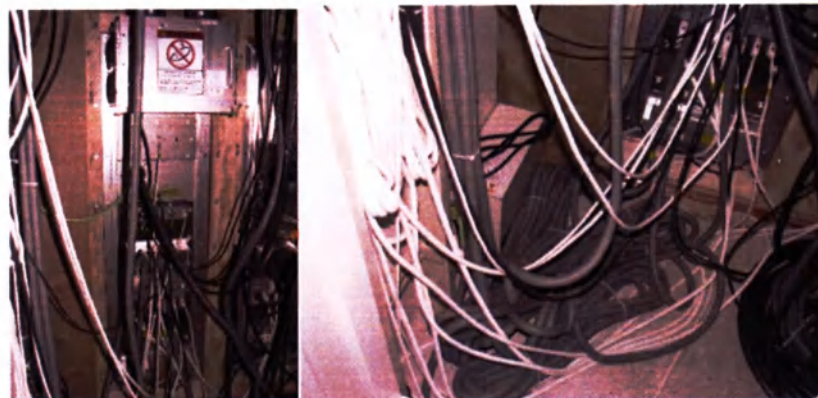



Кабели соединительные

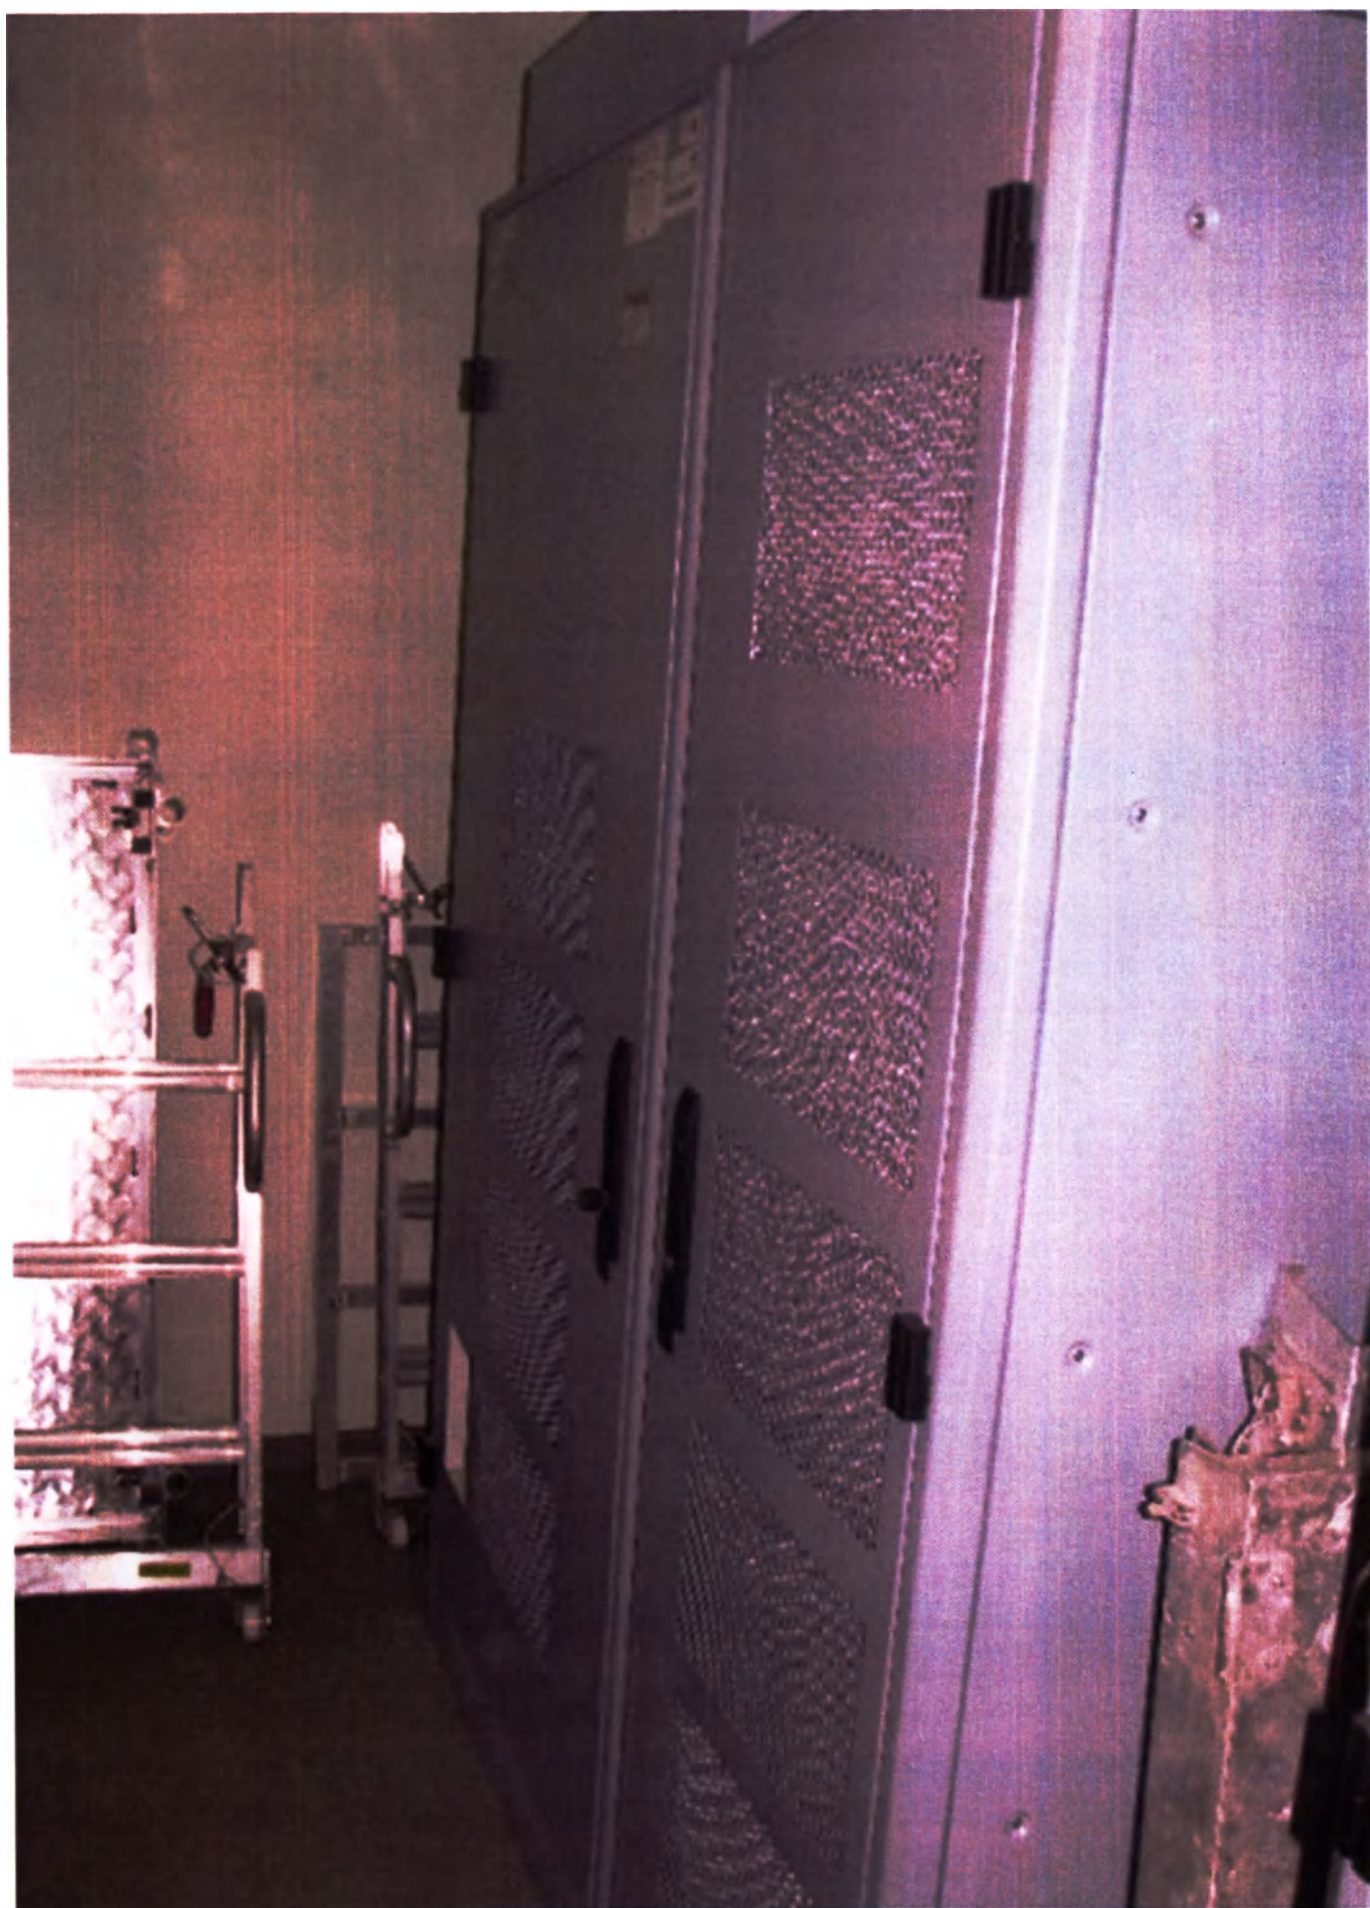

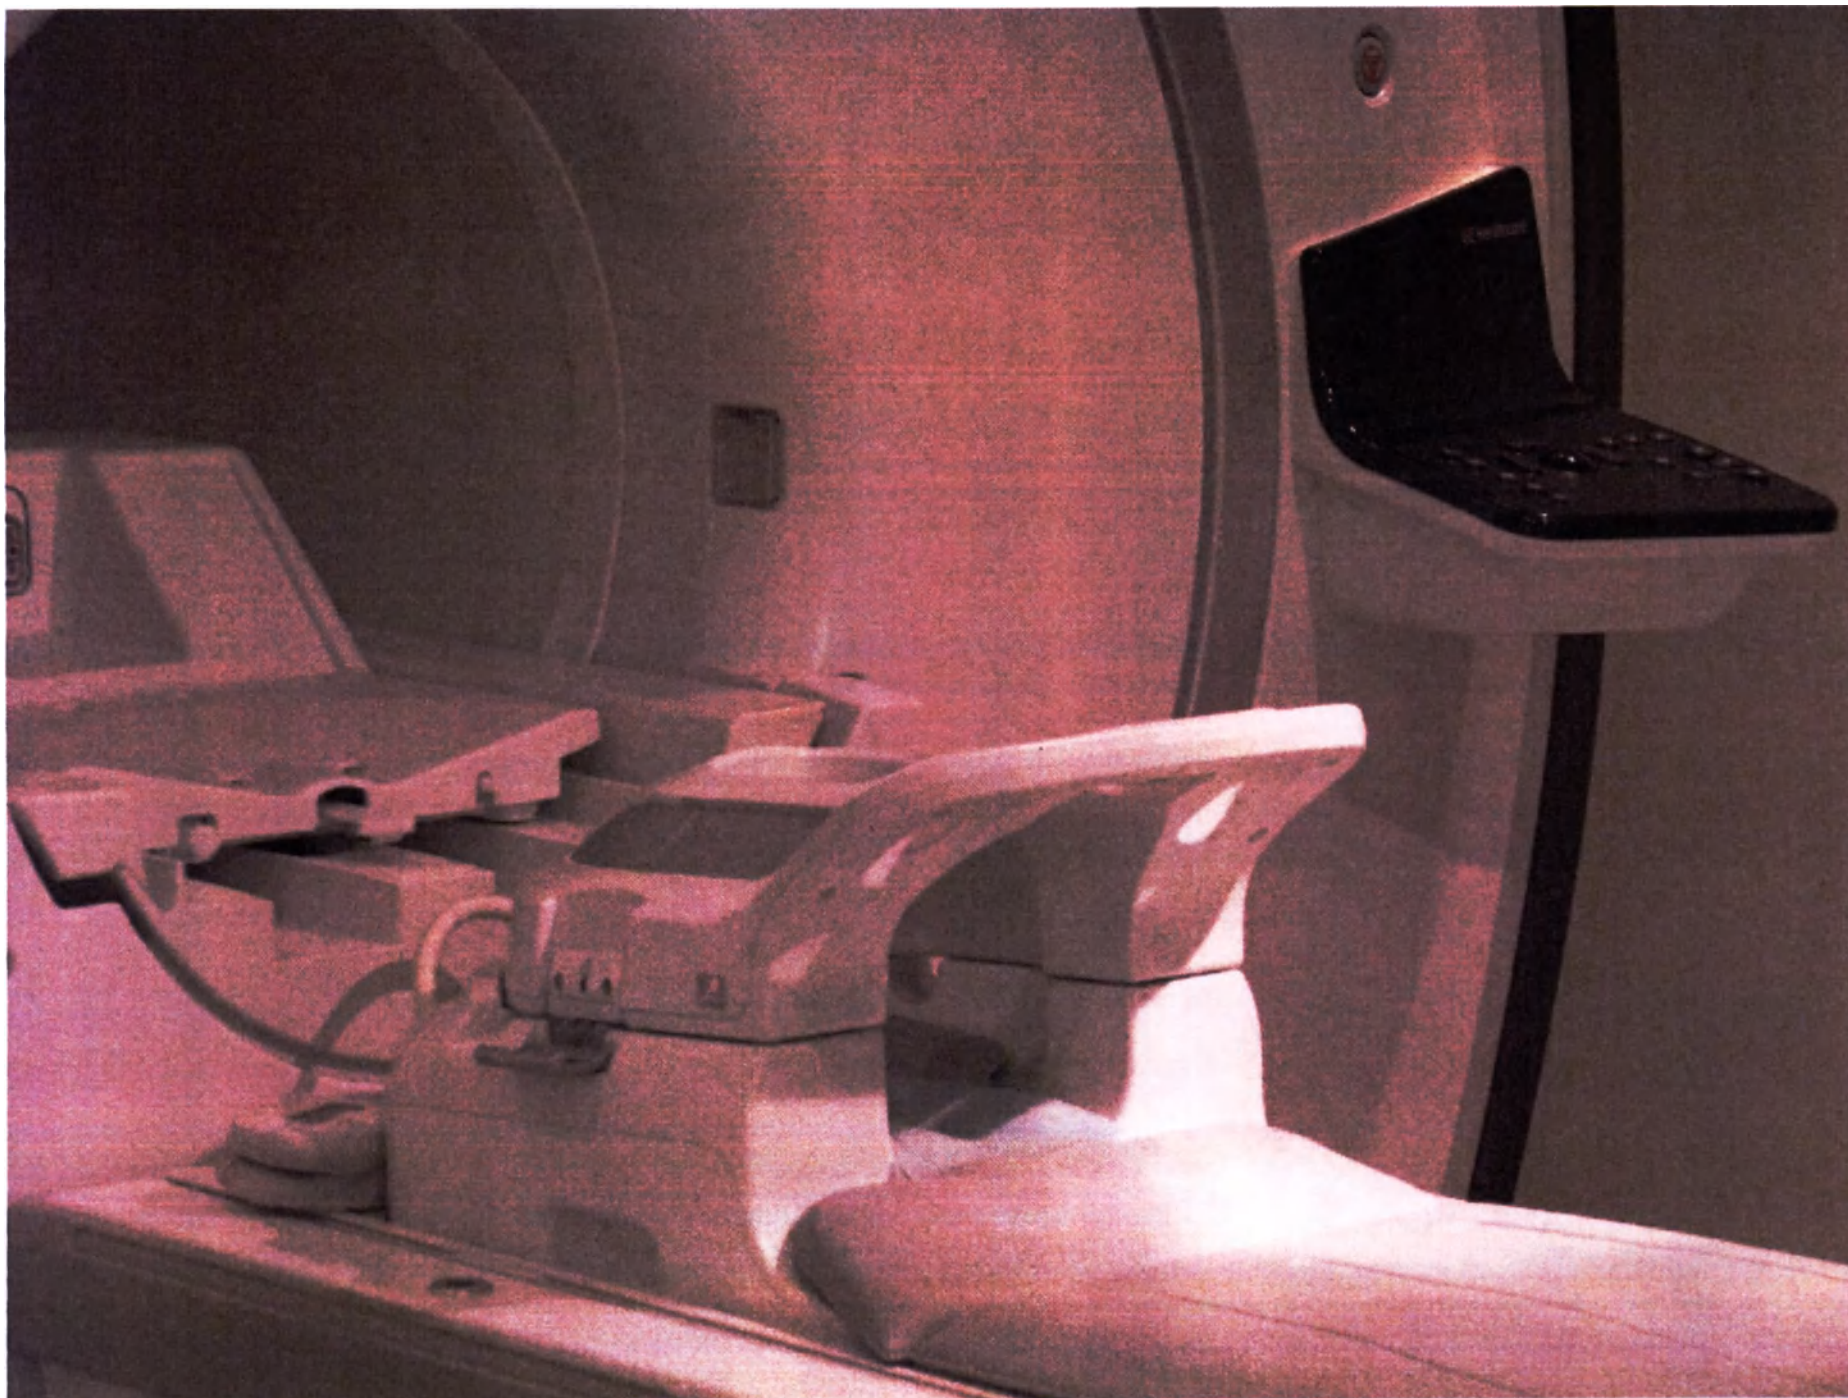


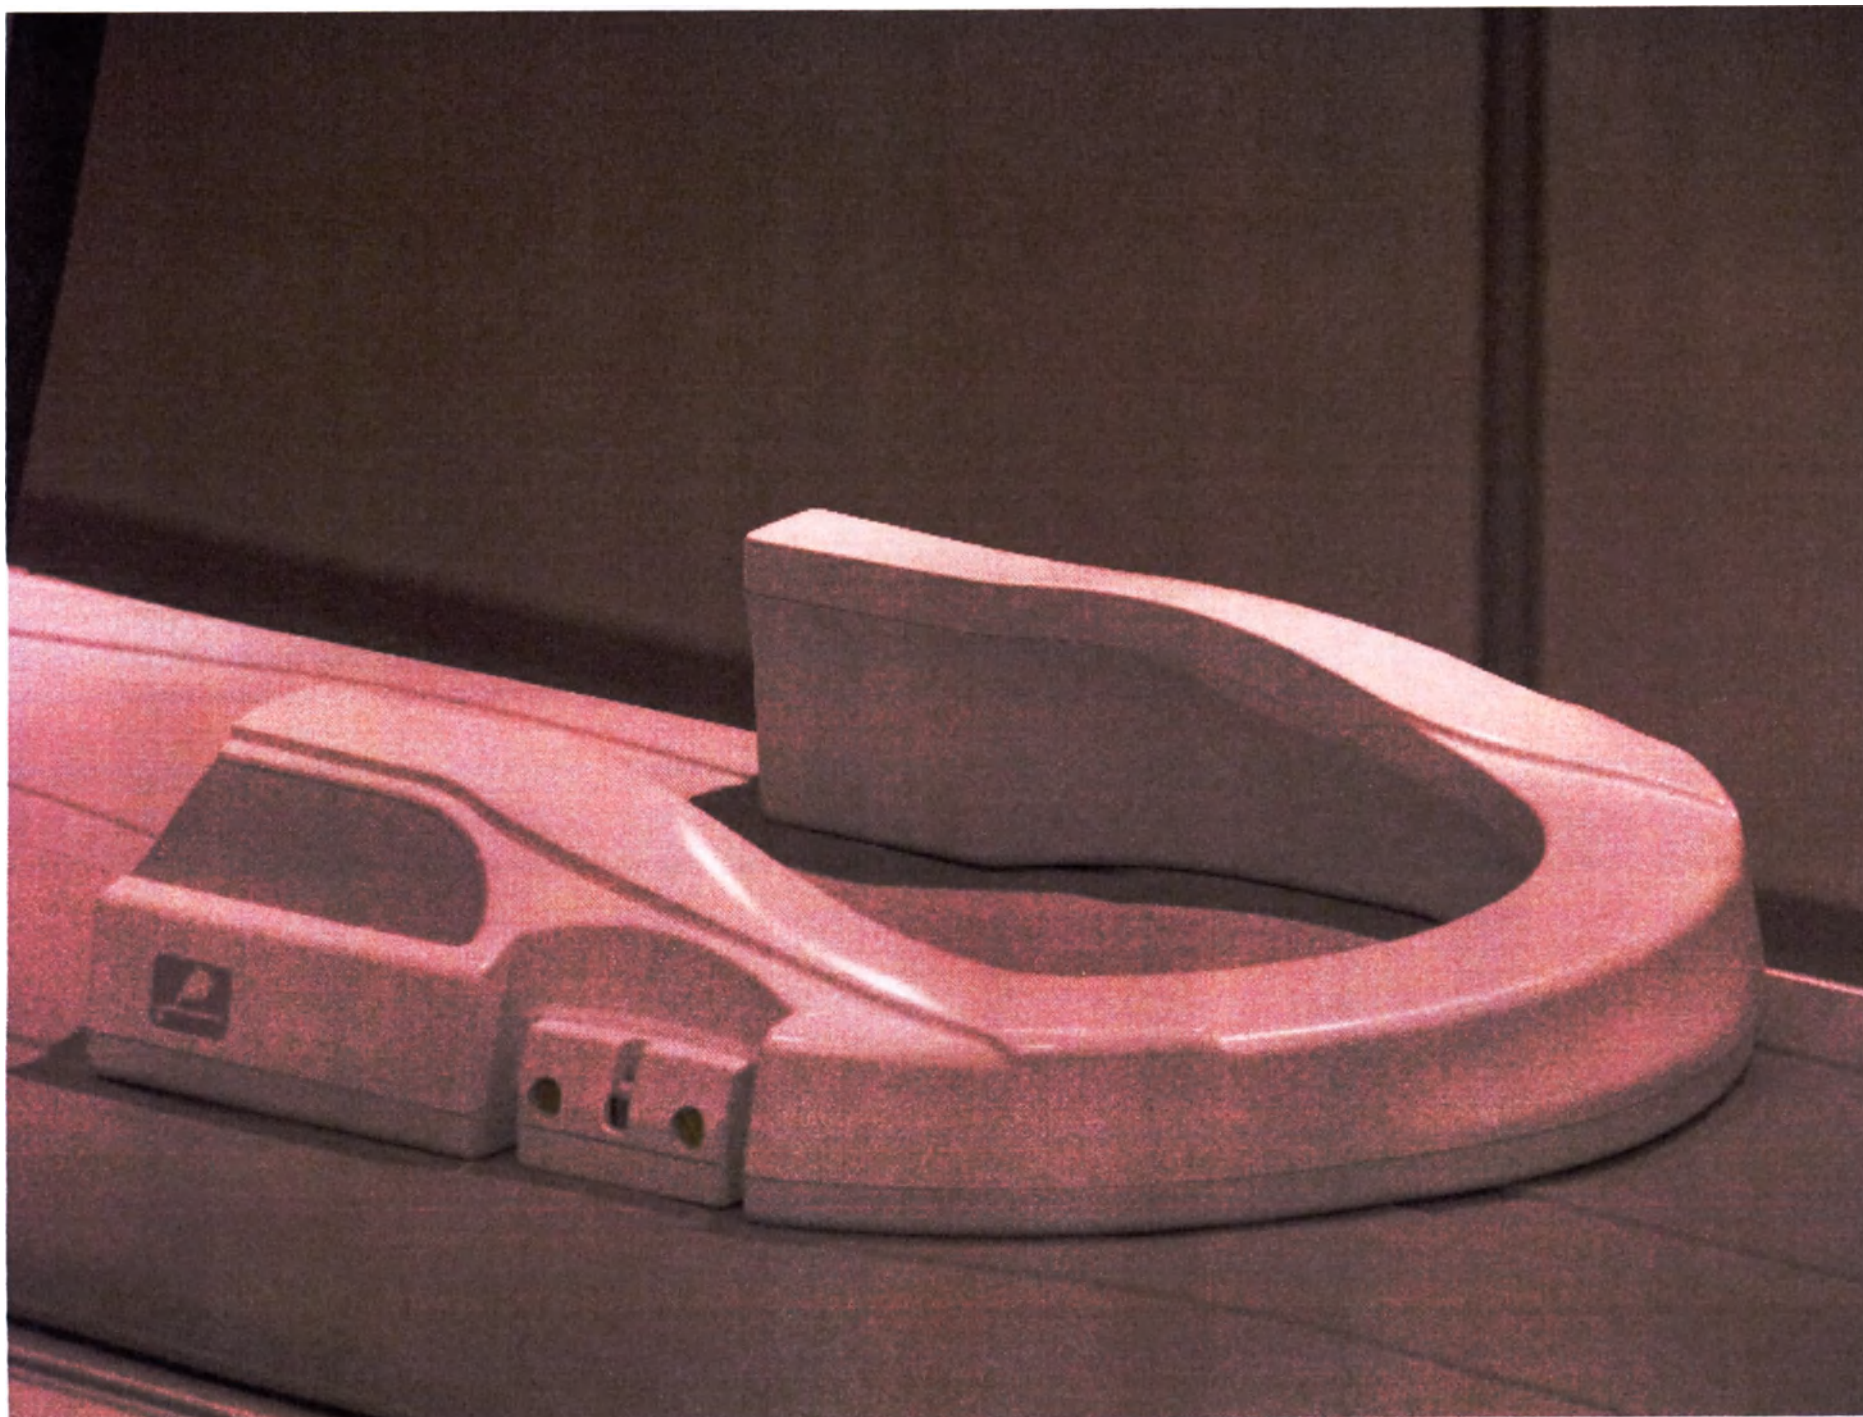

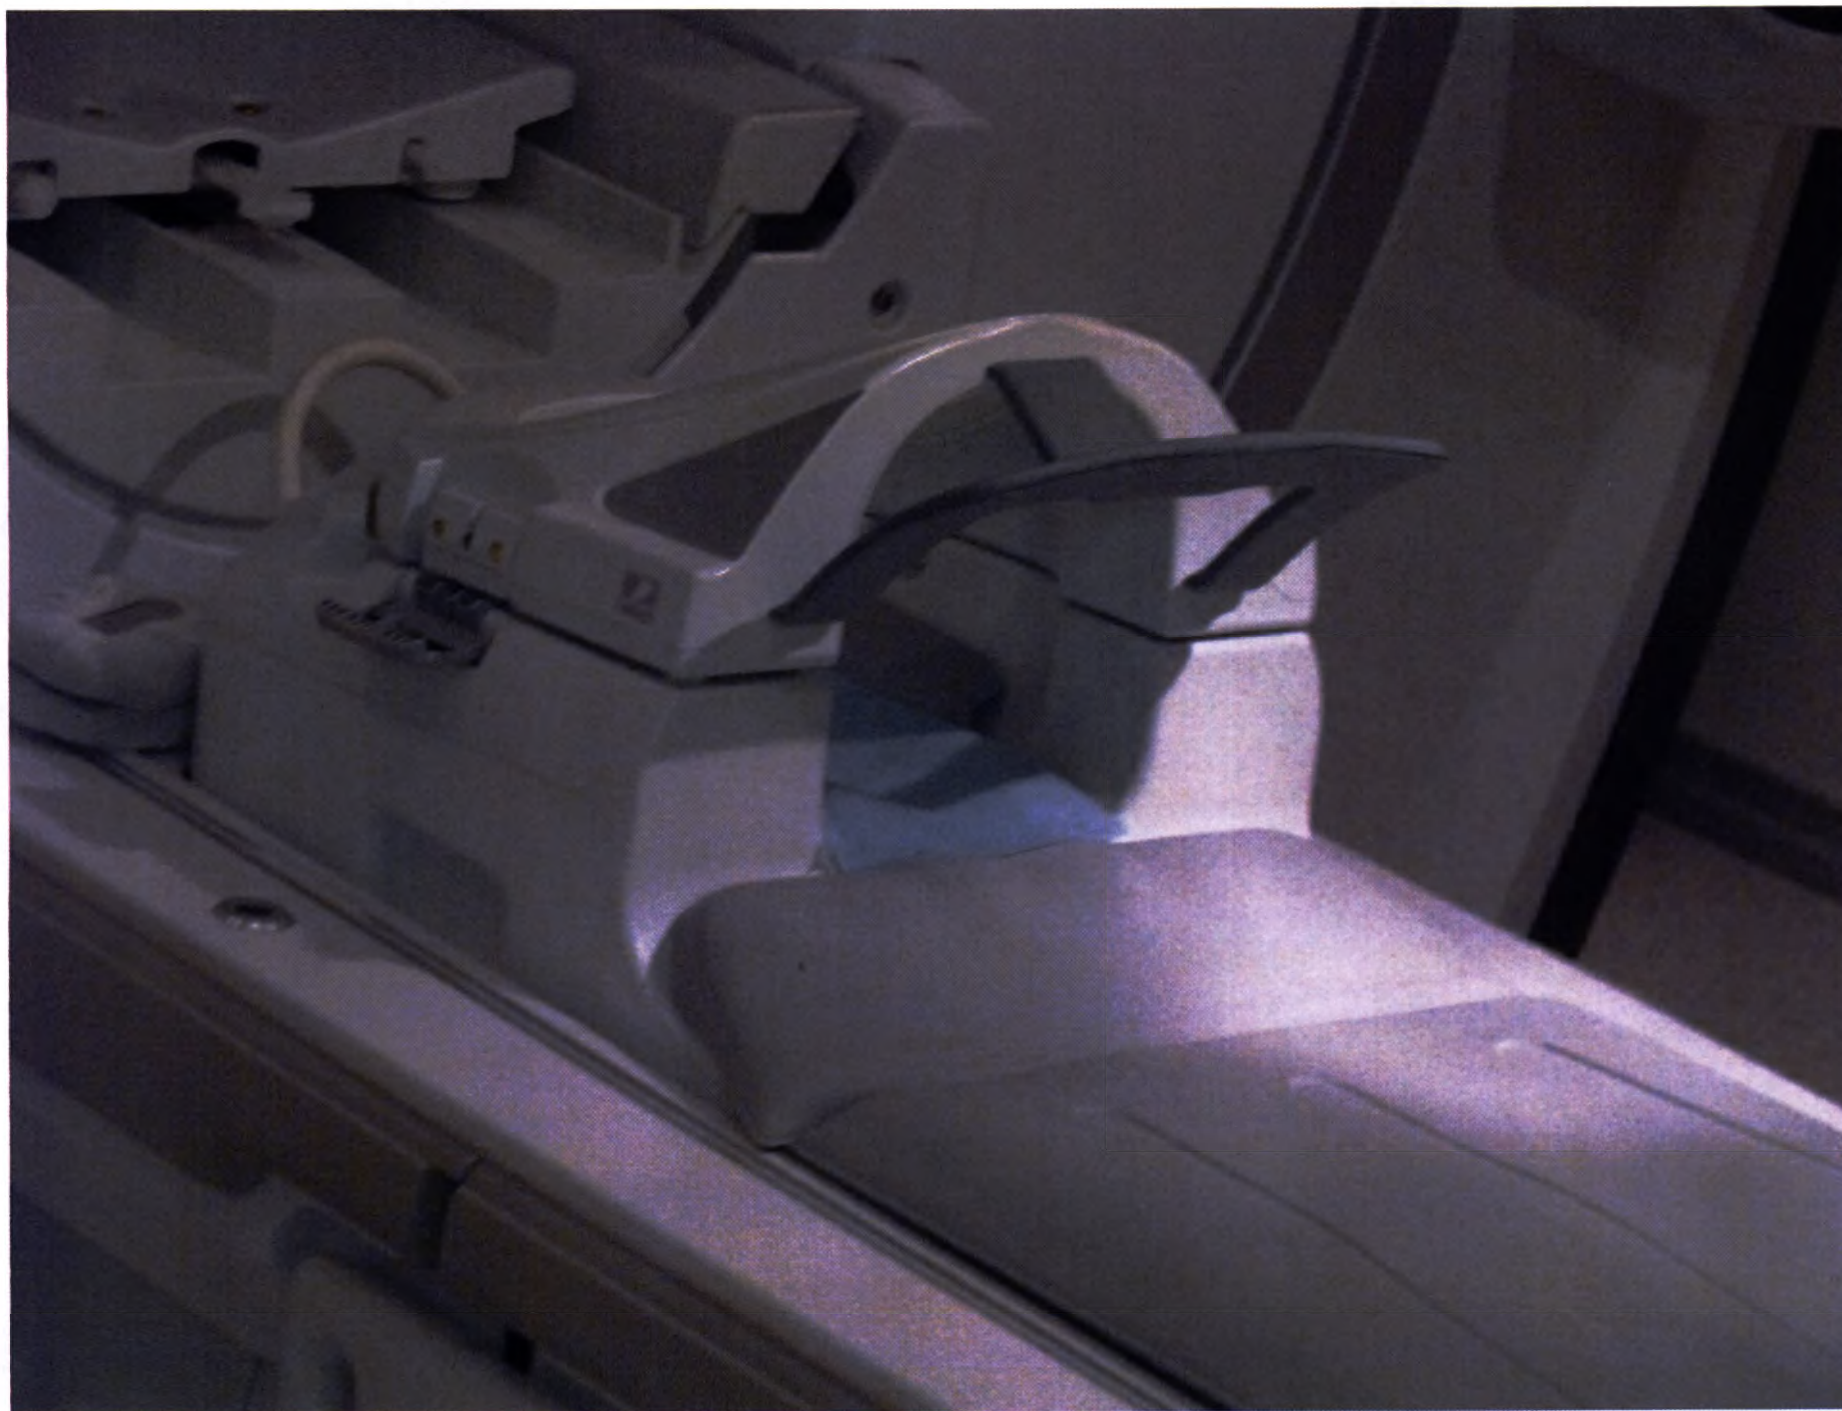


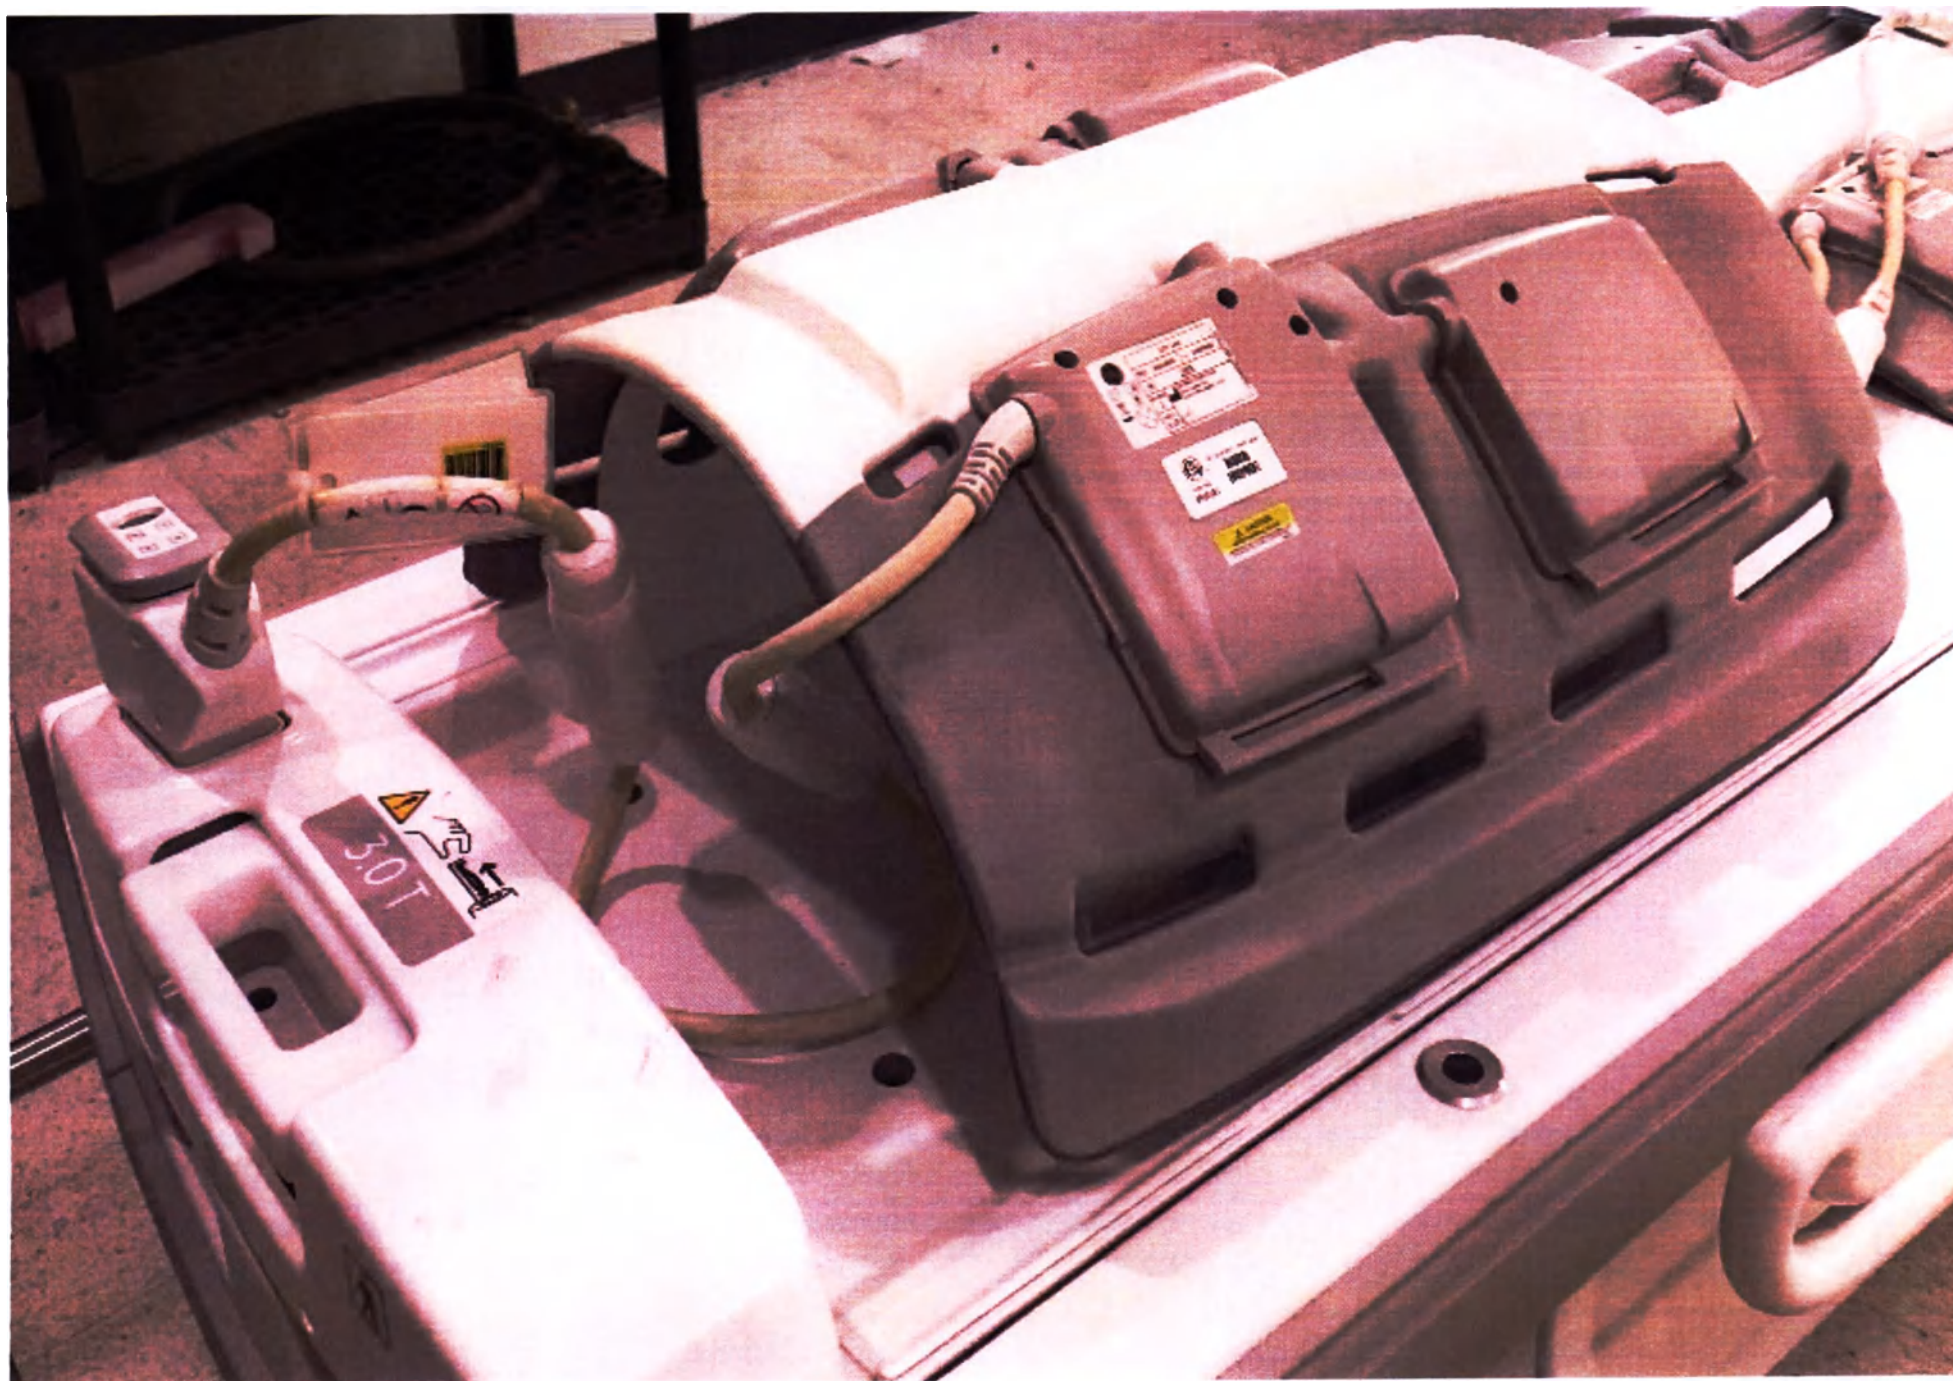




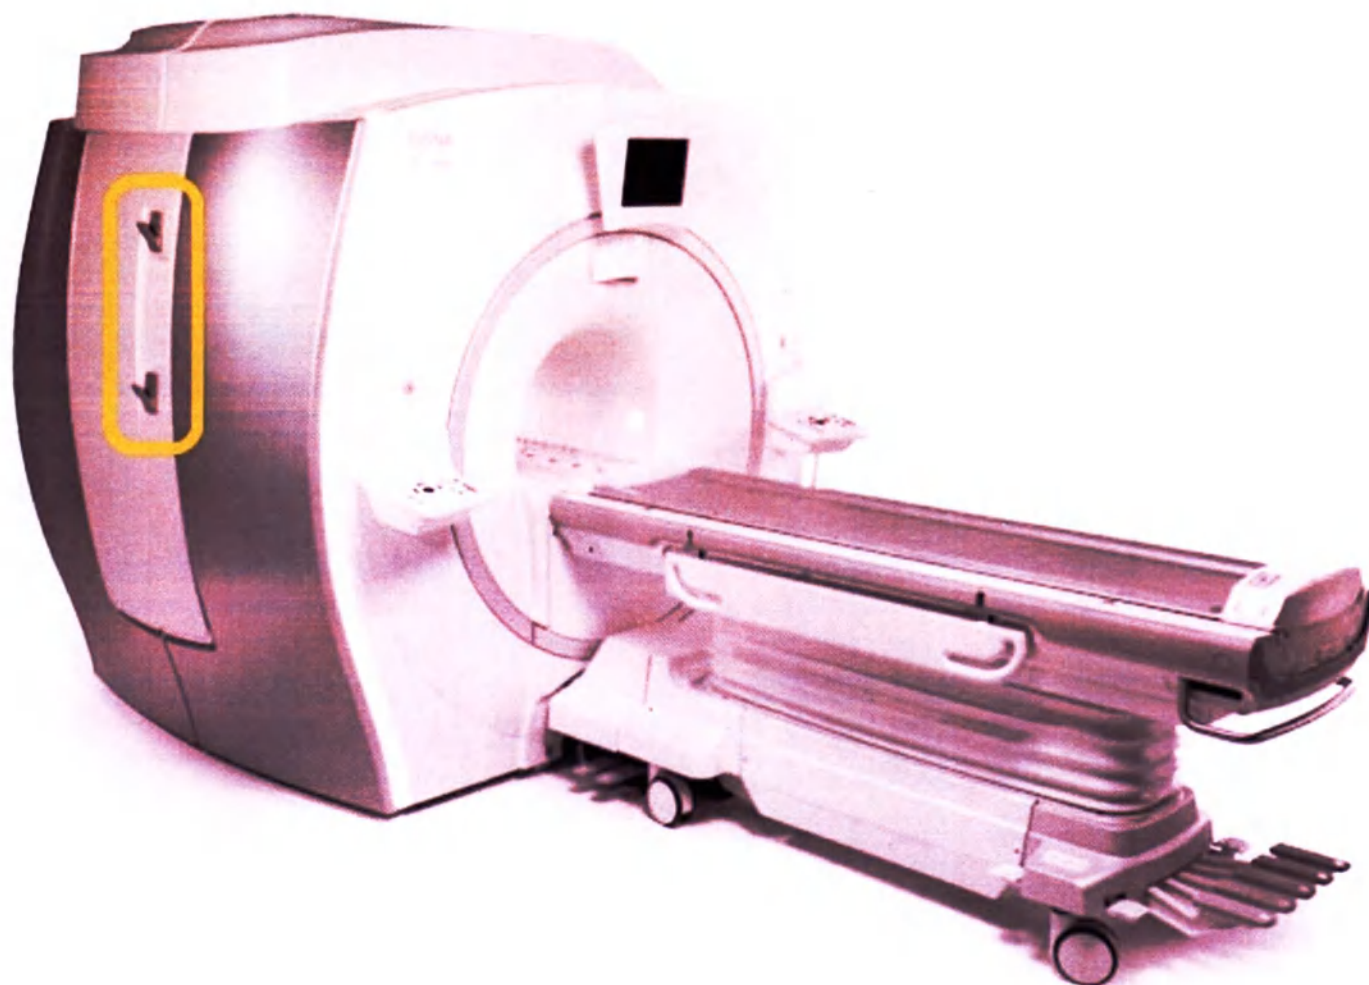

Устройство РАС.

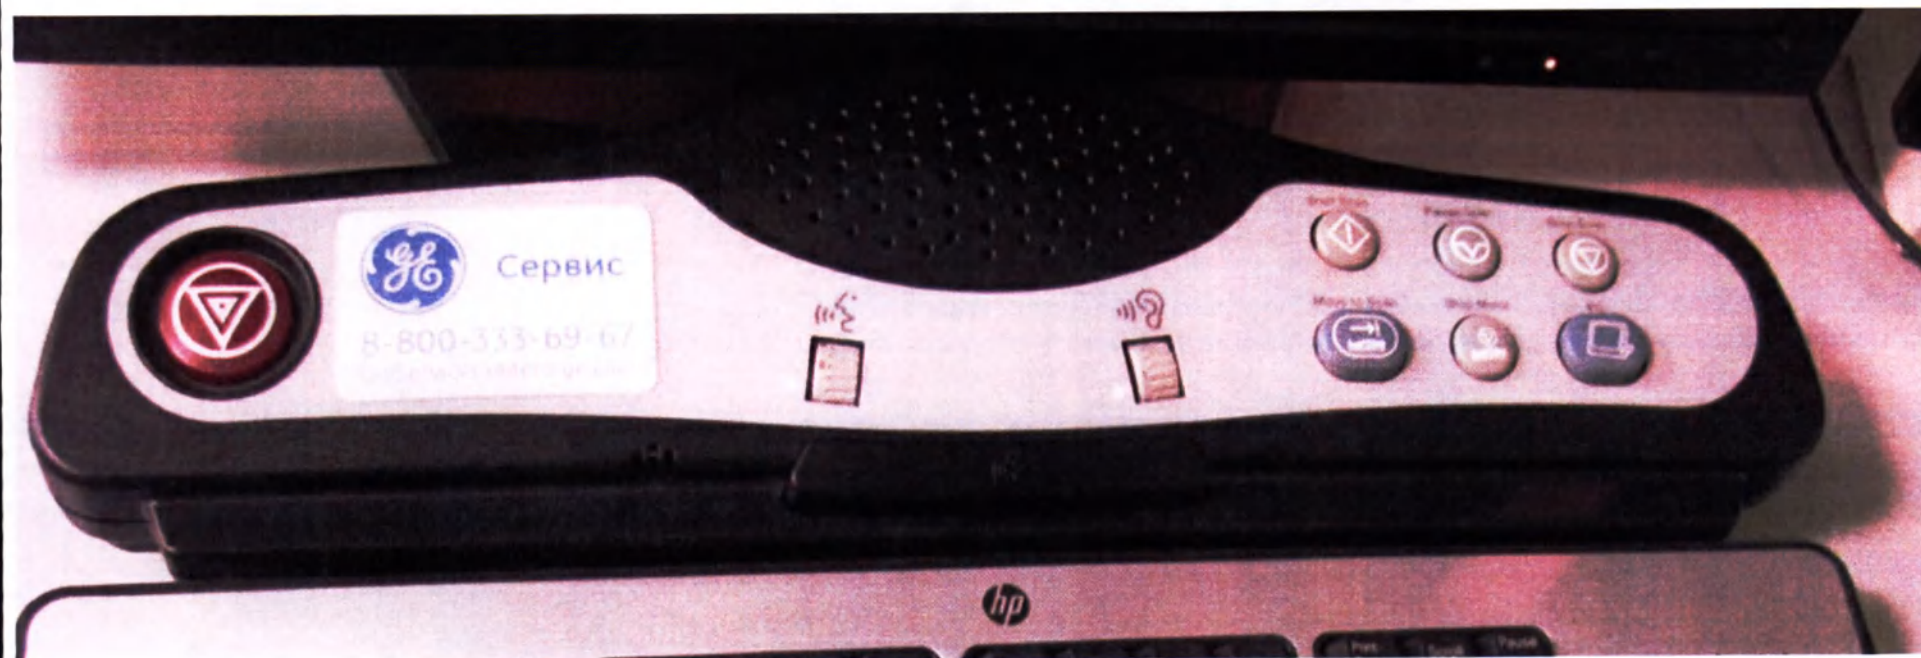

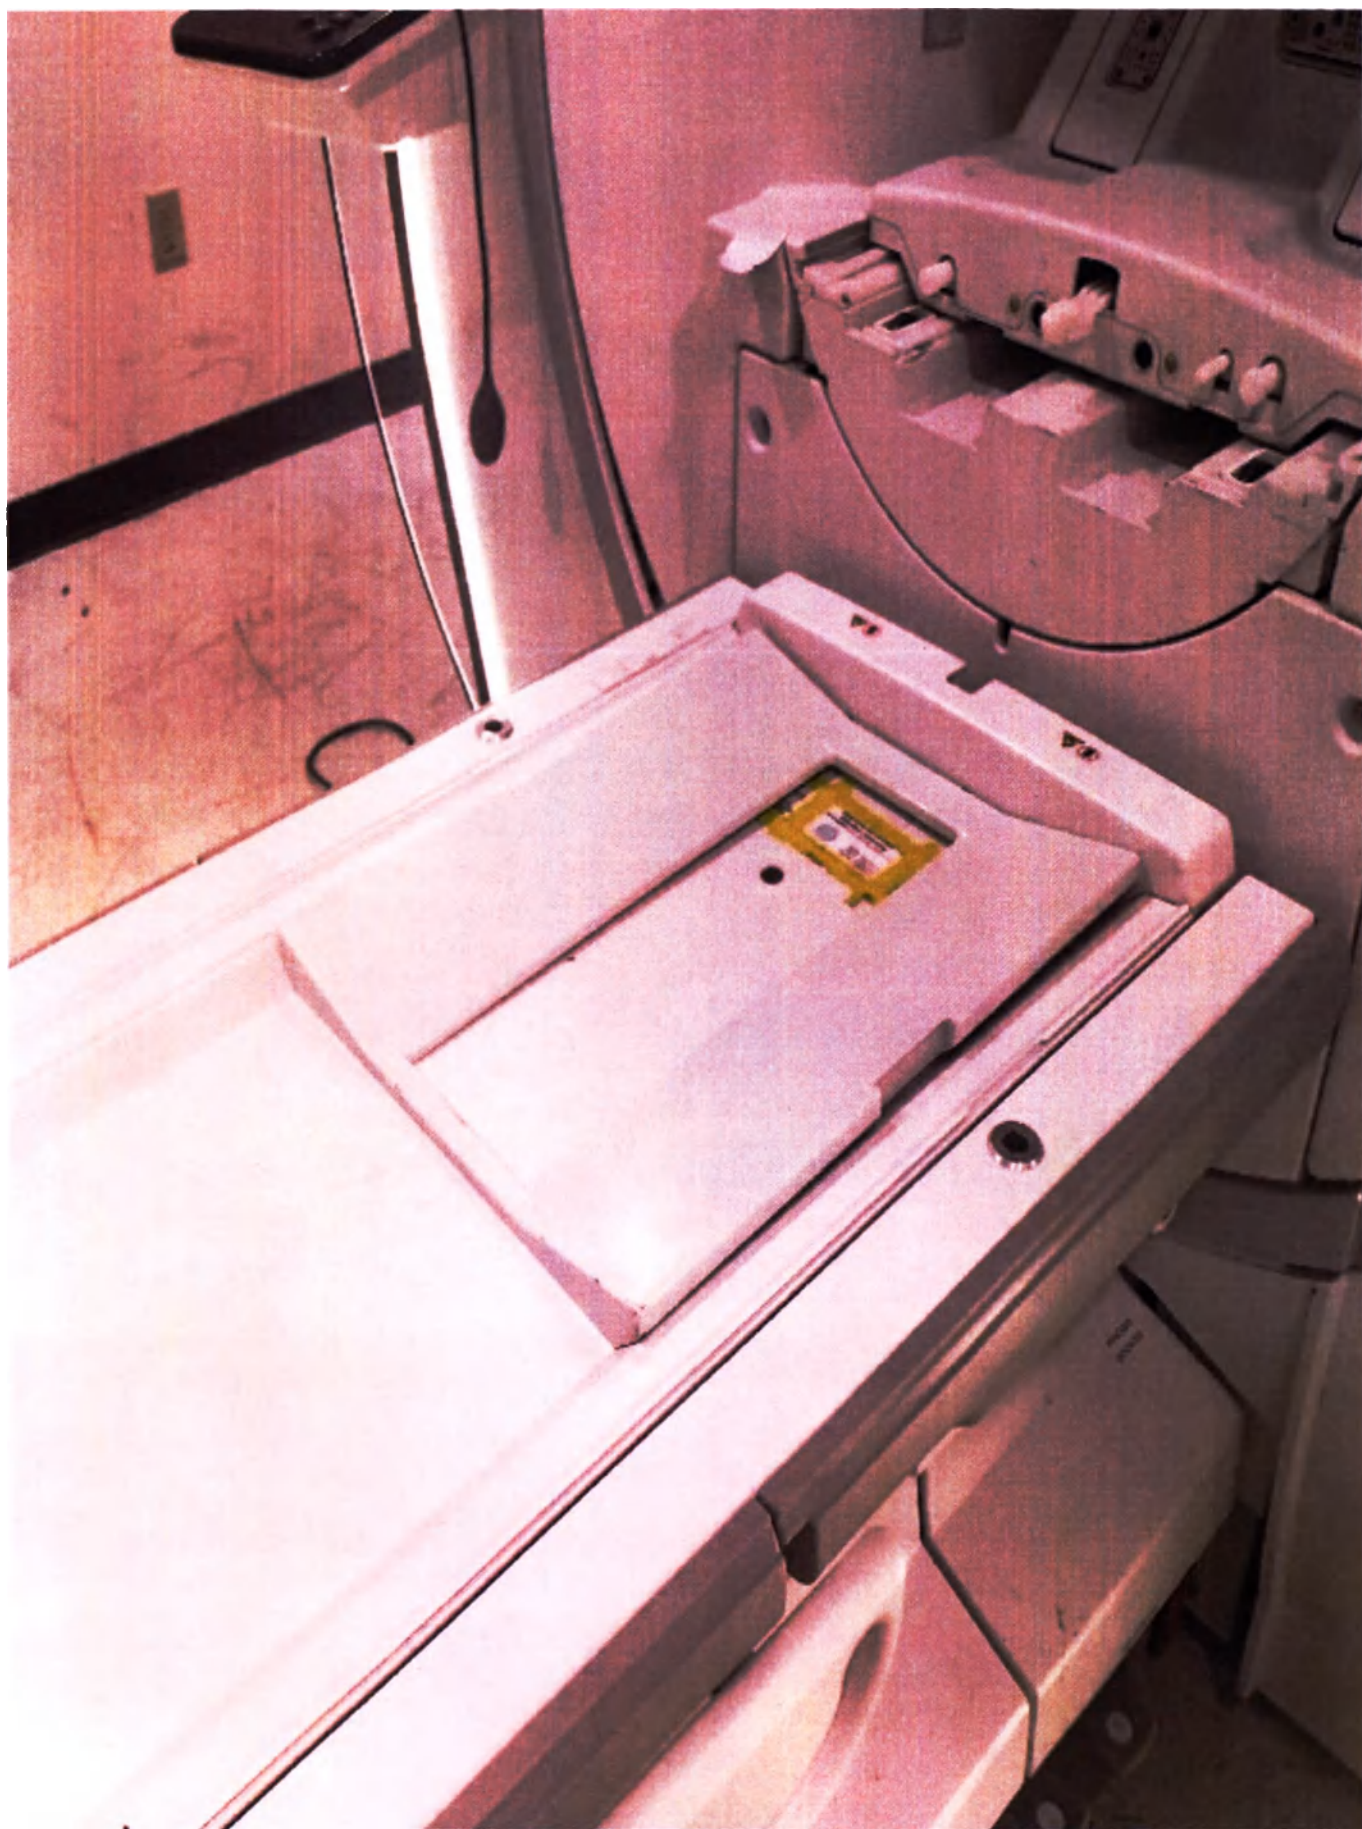


Адаптеры интерфейсные для катушек





Адаптеры интерфейсные для катушек




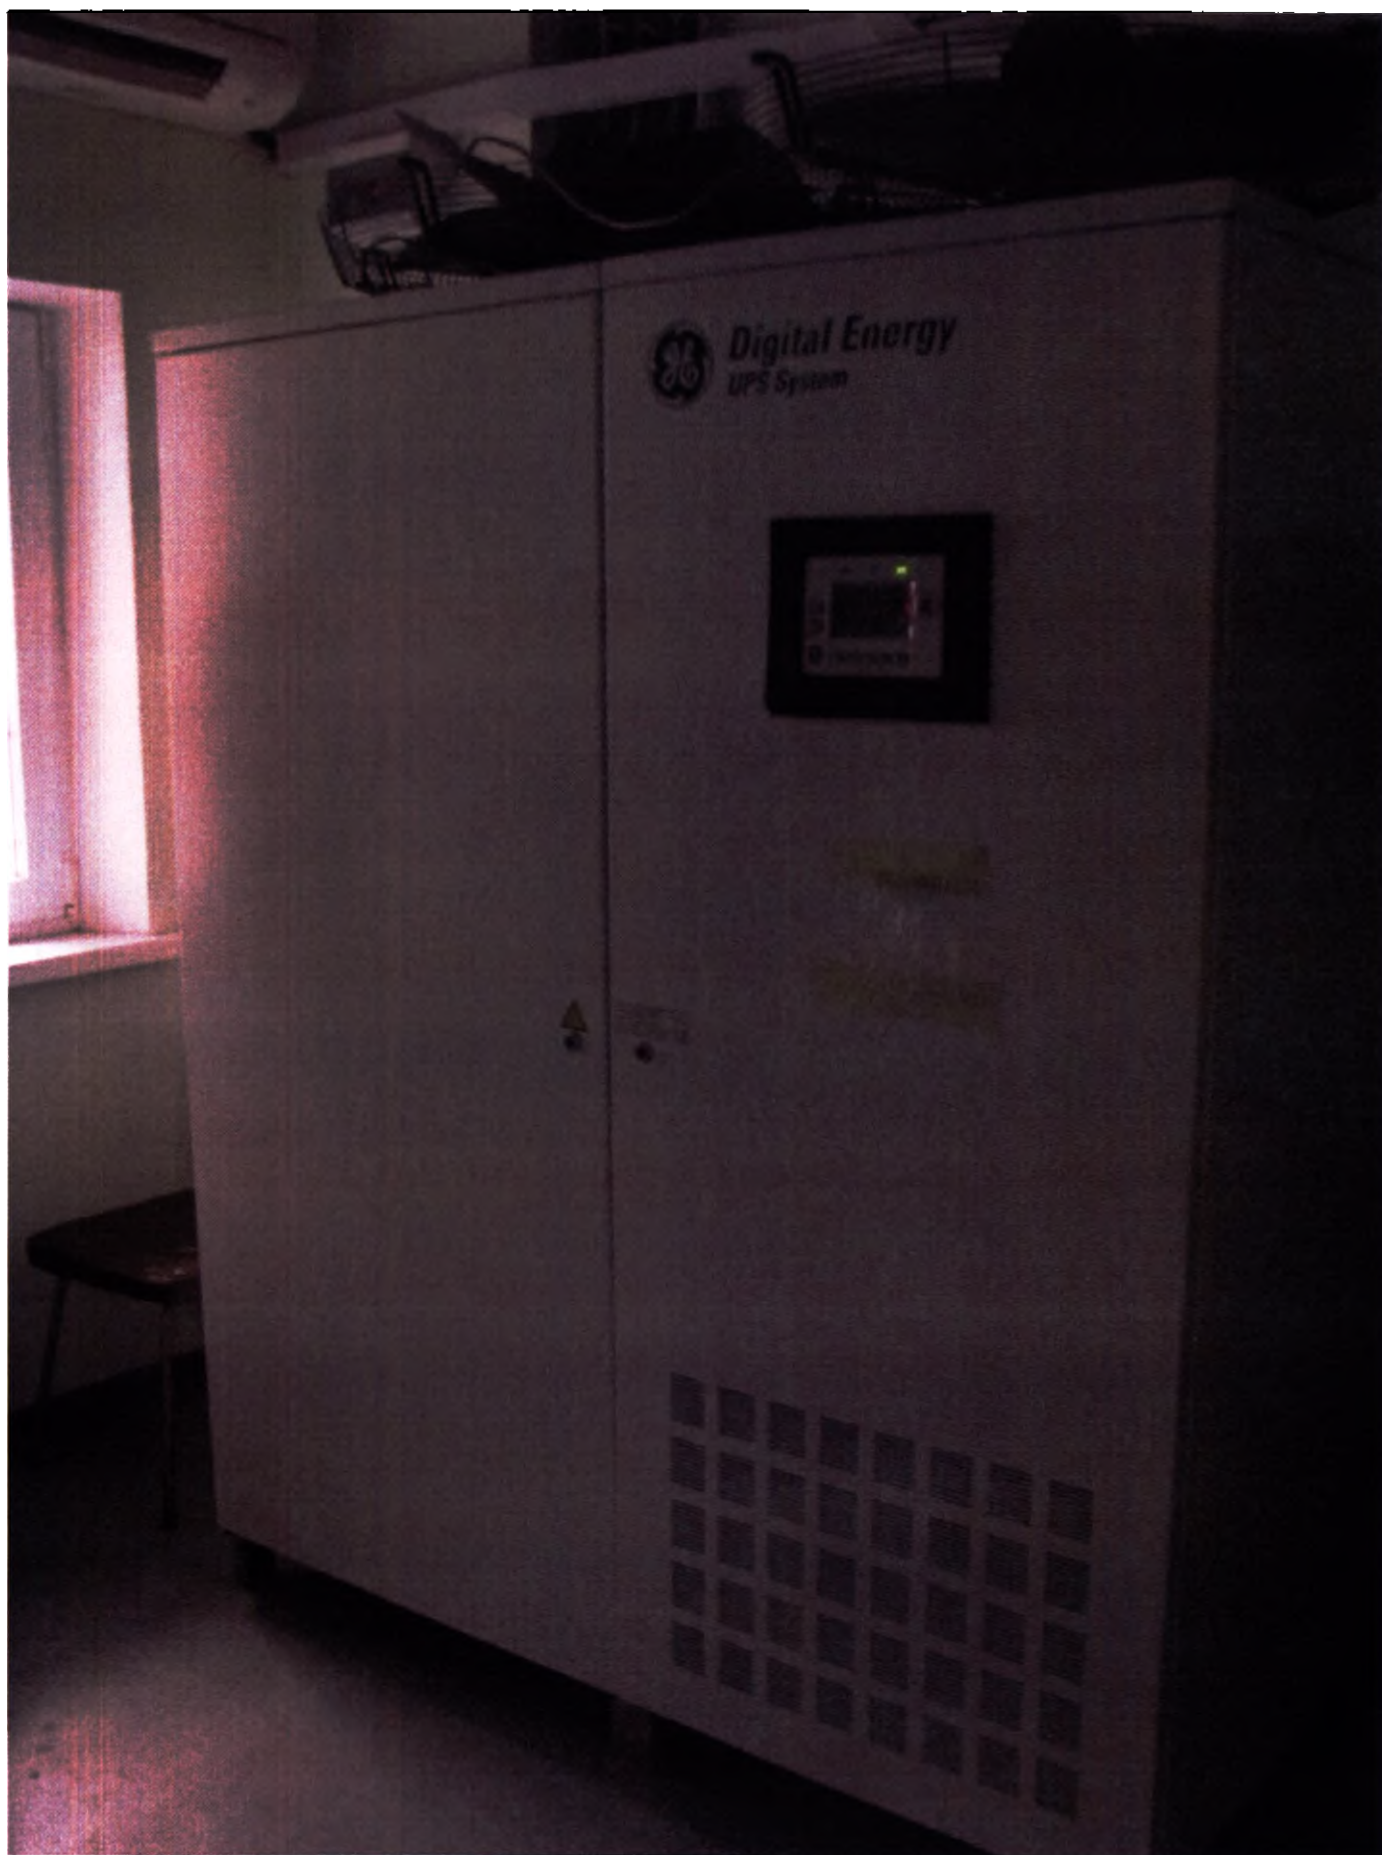

Источники бесперебойного питания

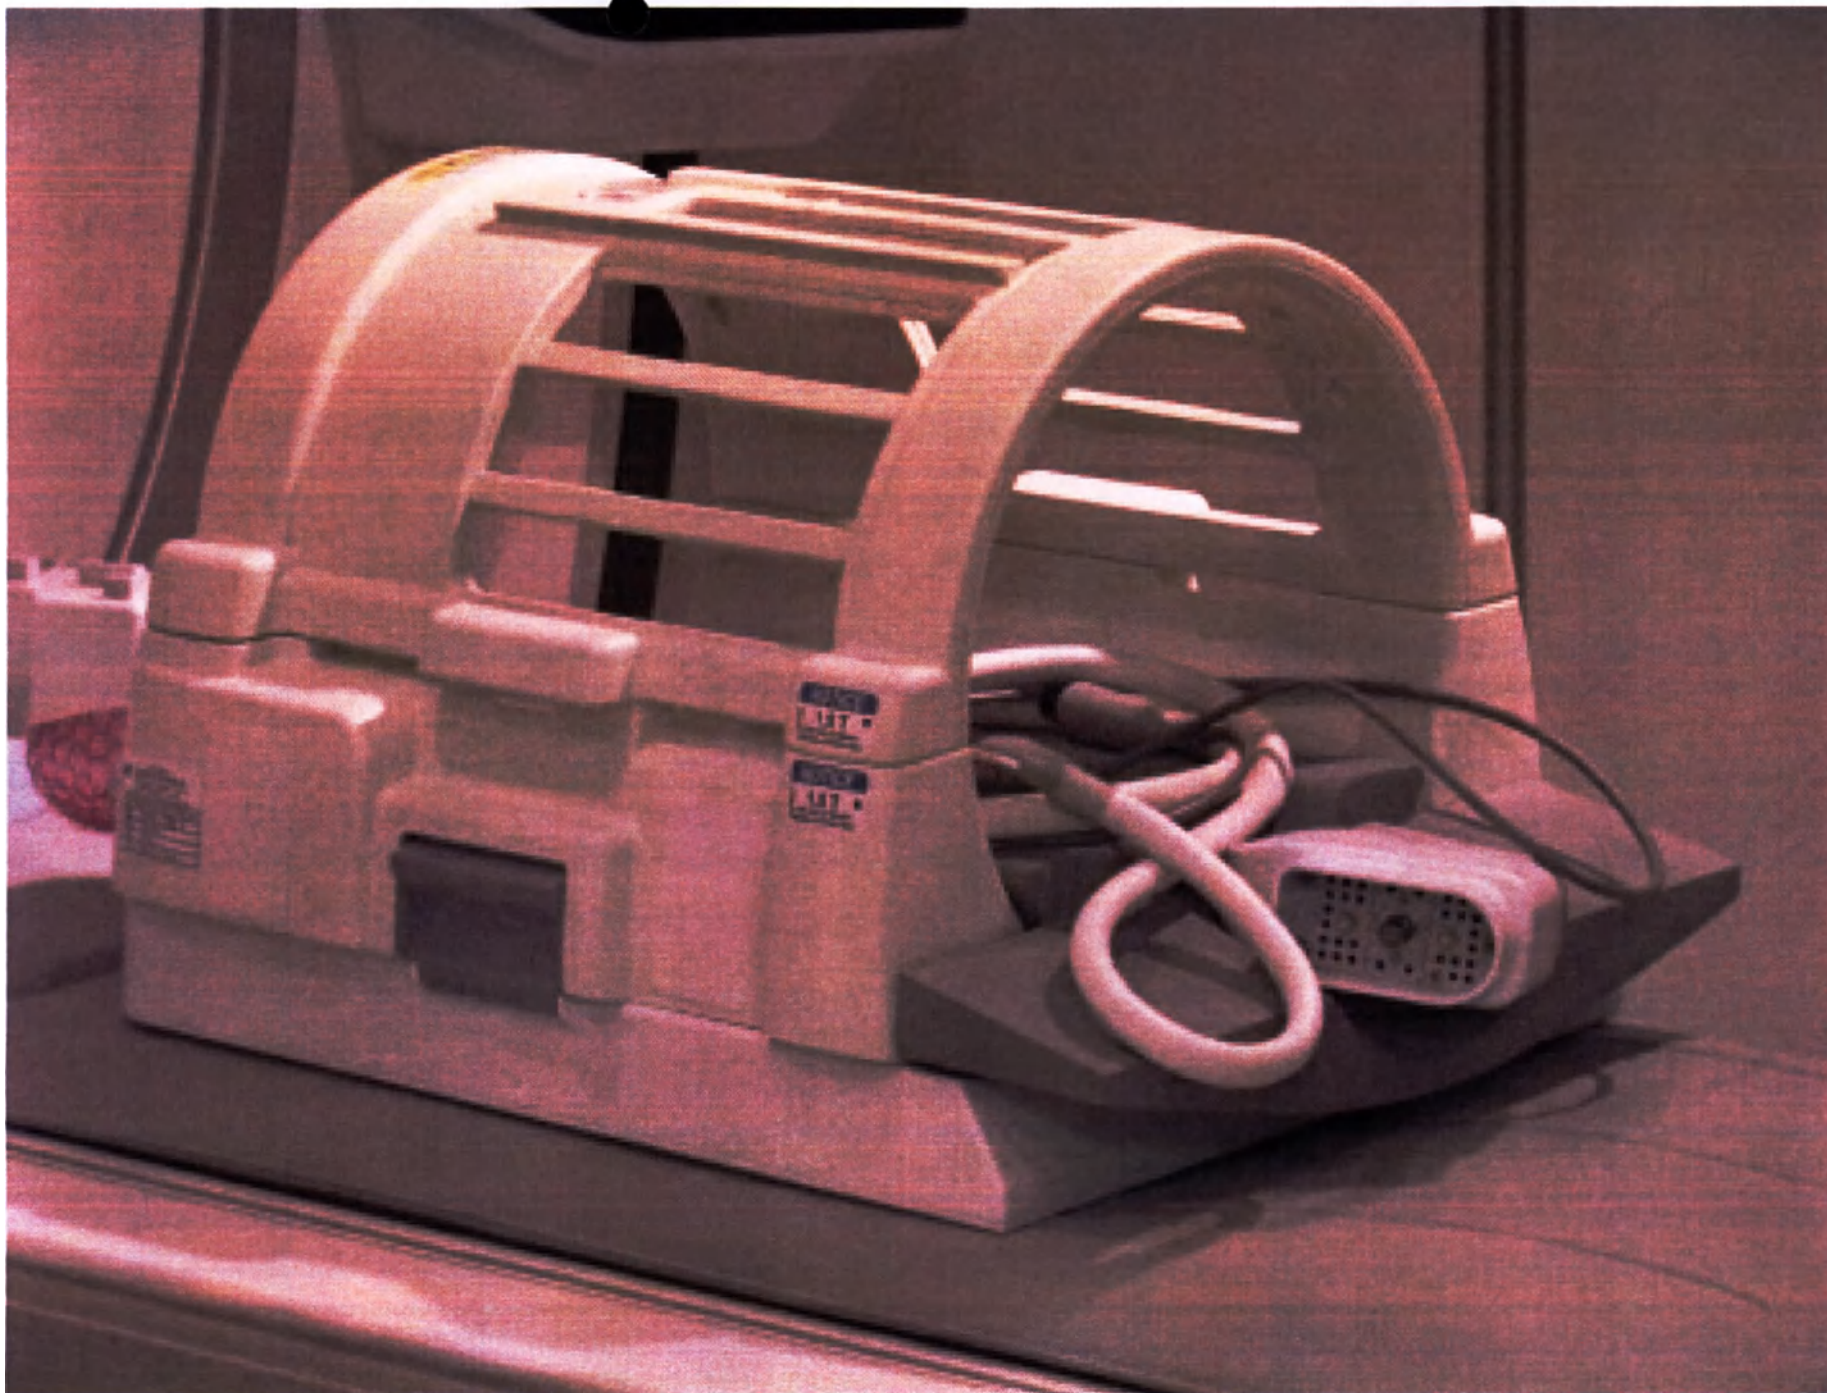


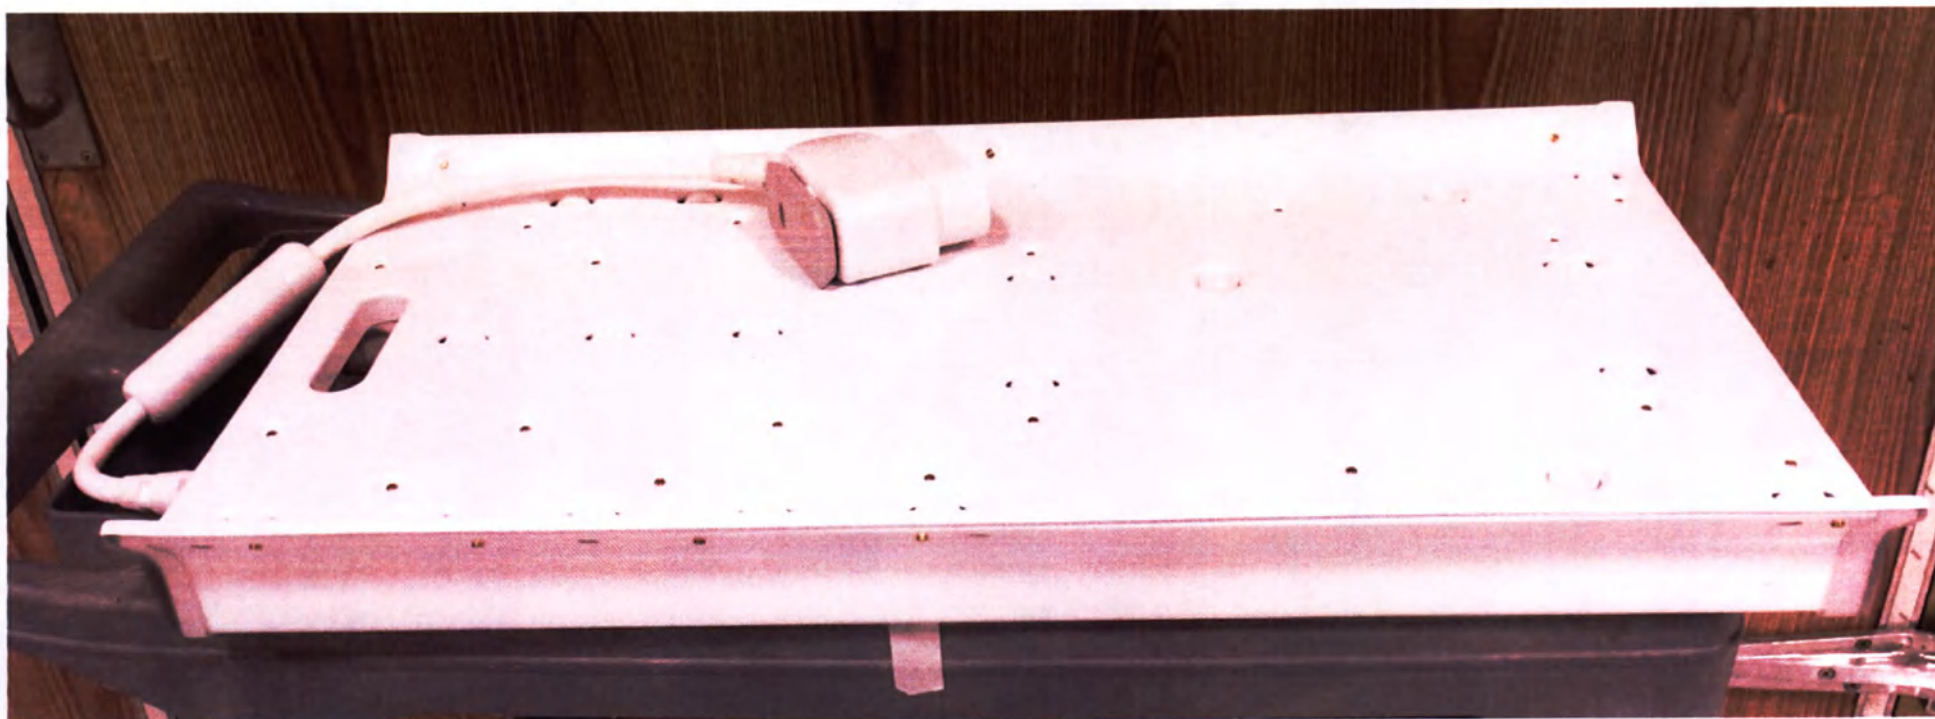

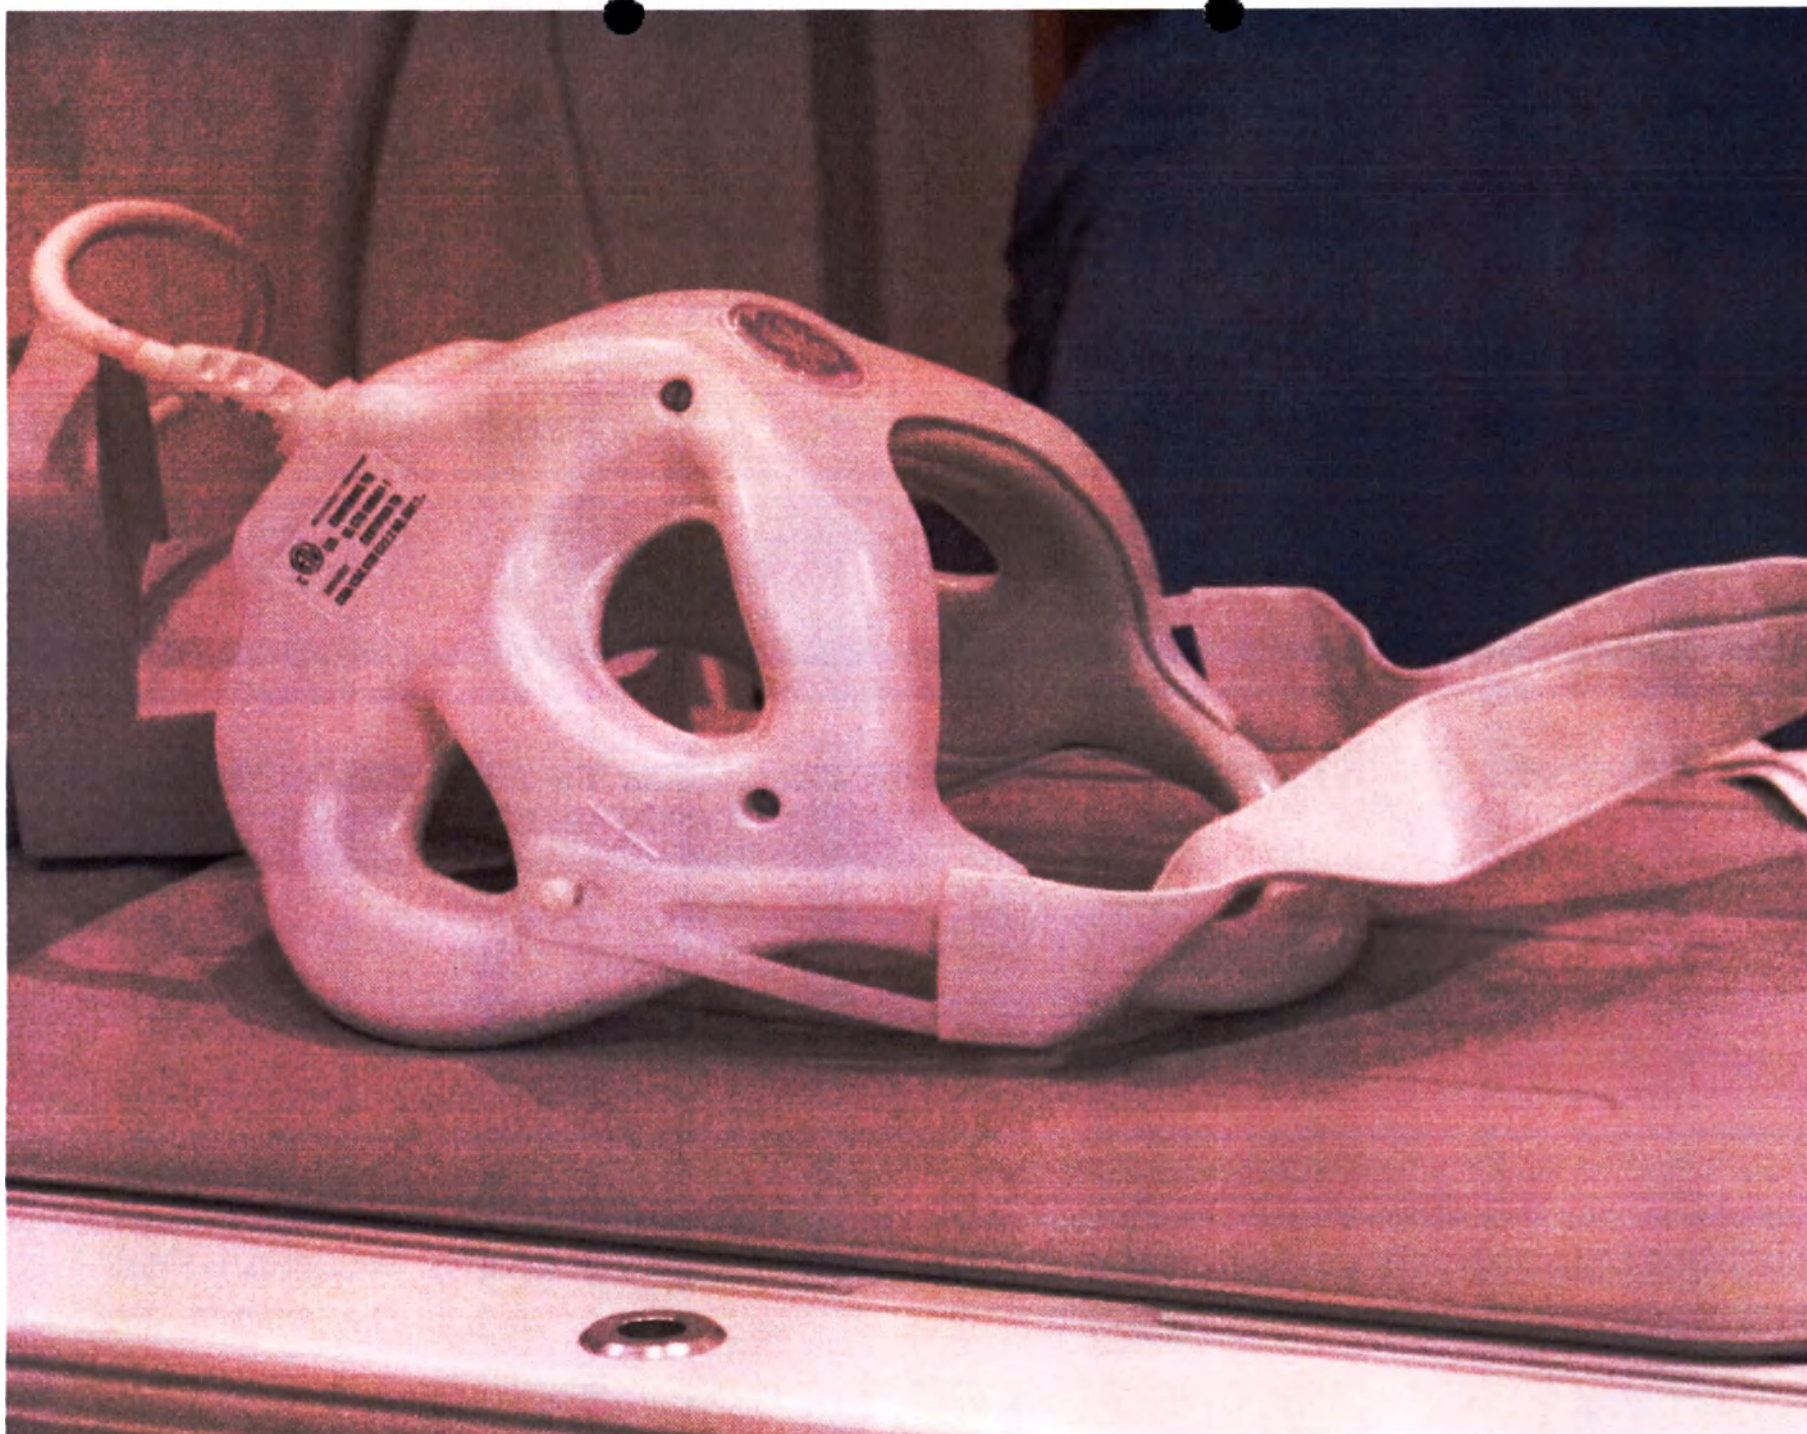



Катушки для кисти Wrist Coil

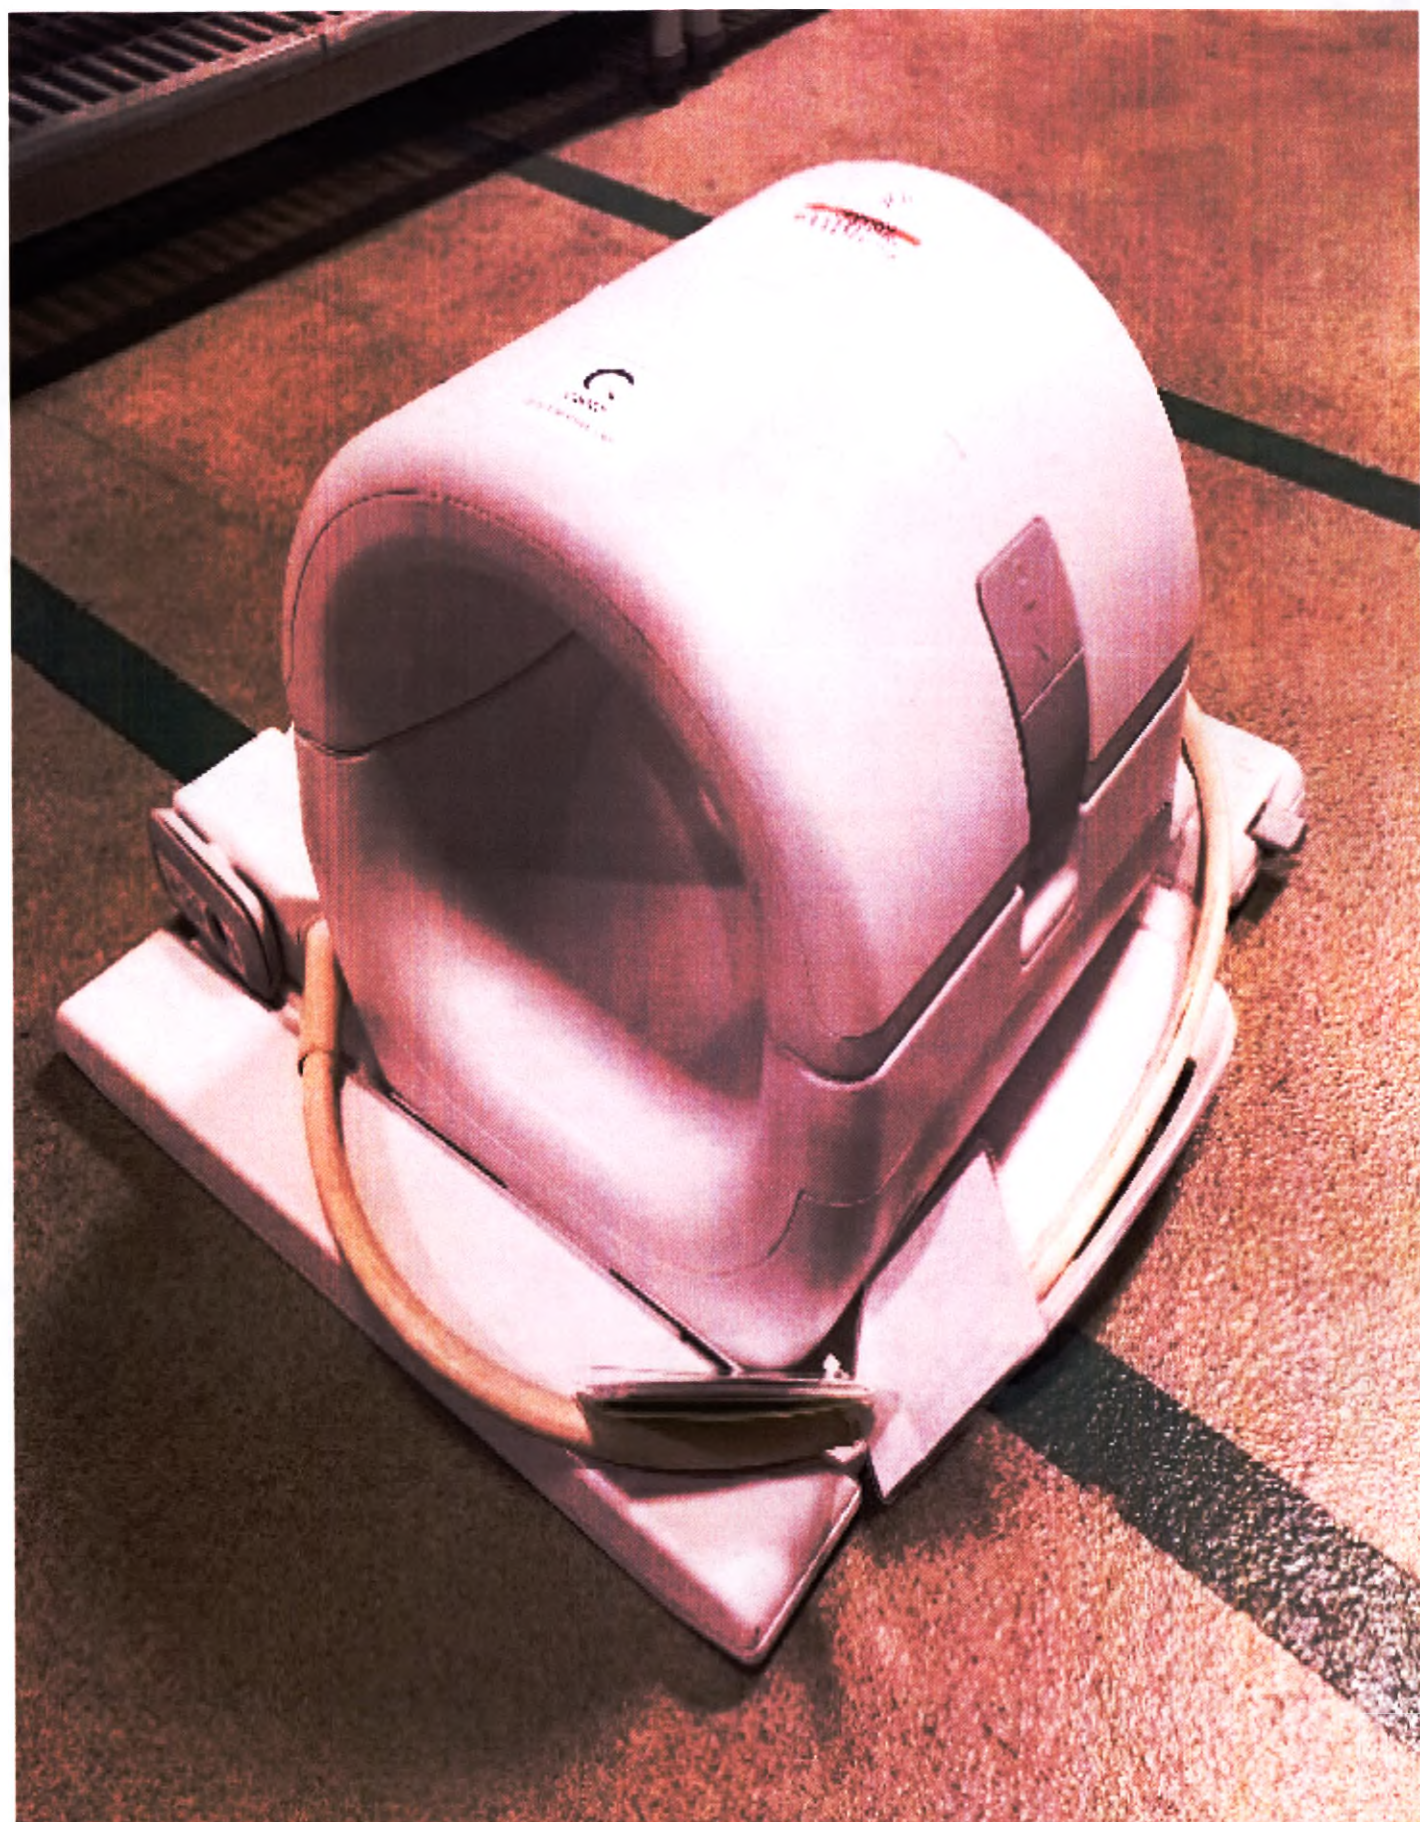

Катушки для исследования голеностопного и коленного суставов Knee Coil















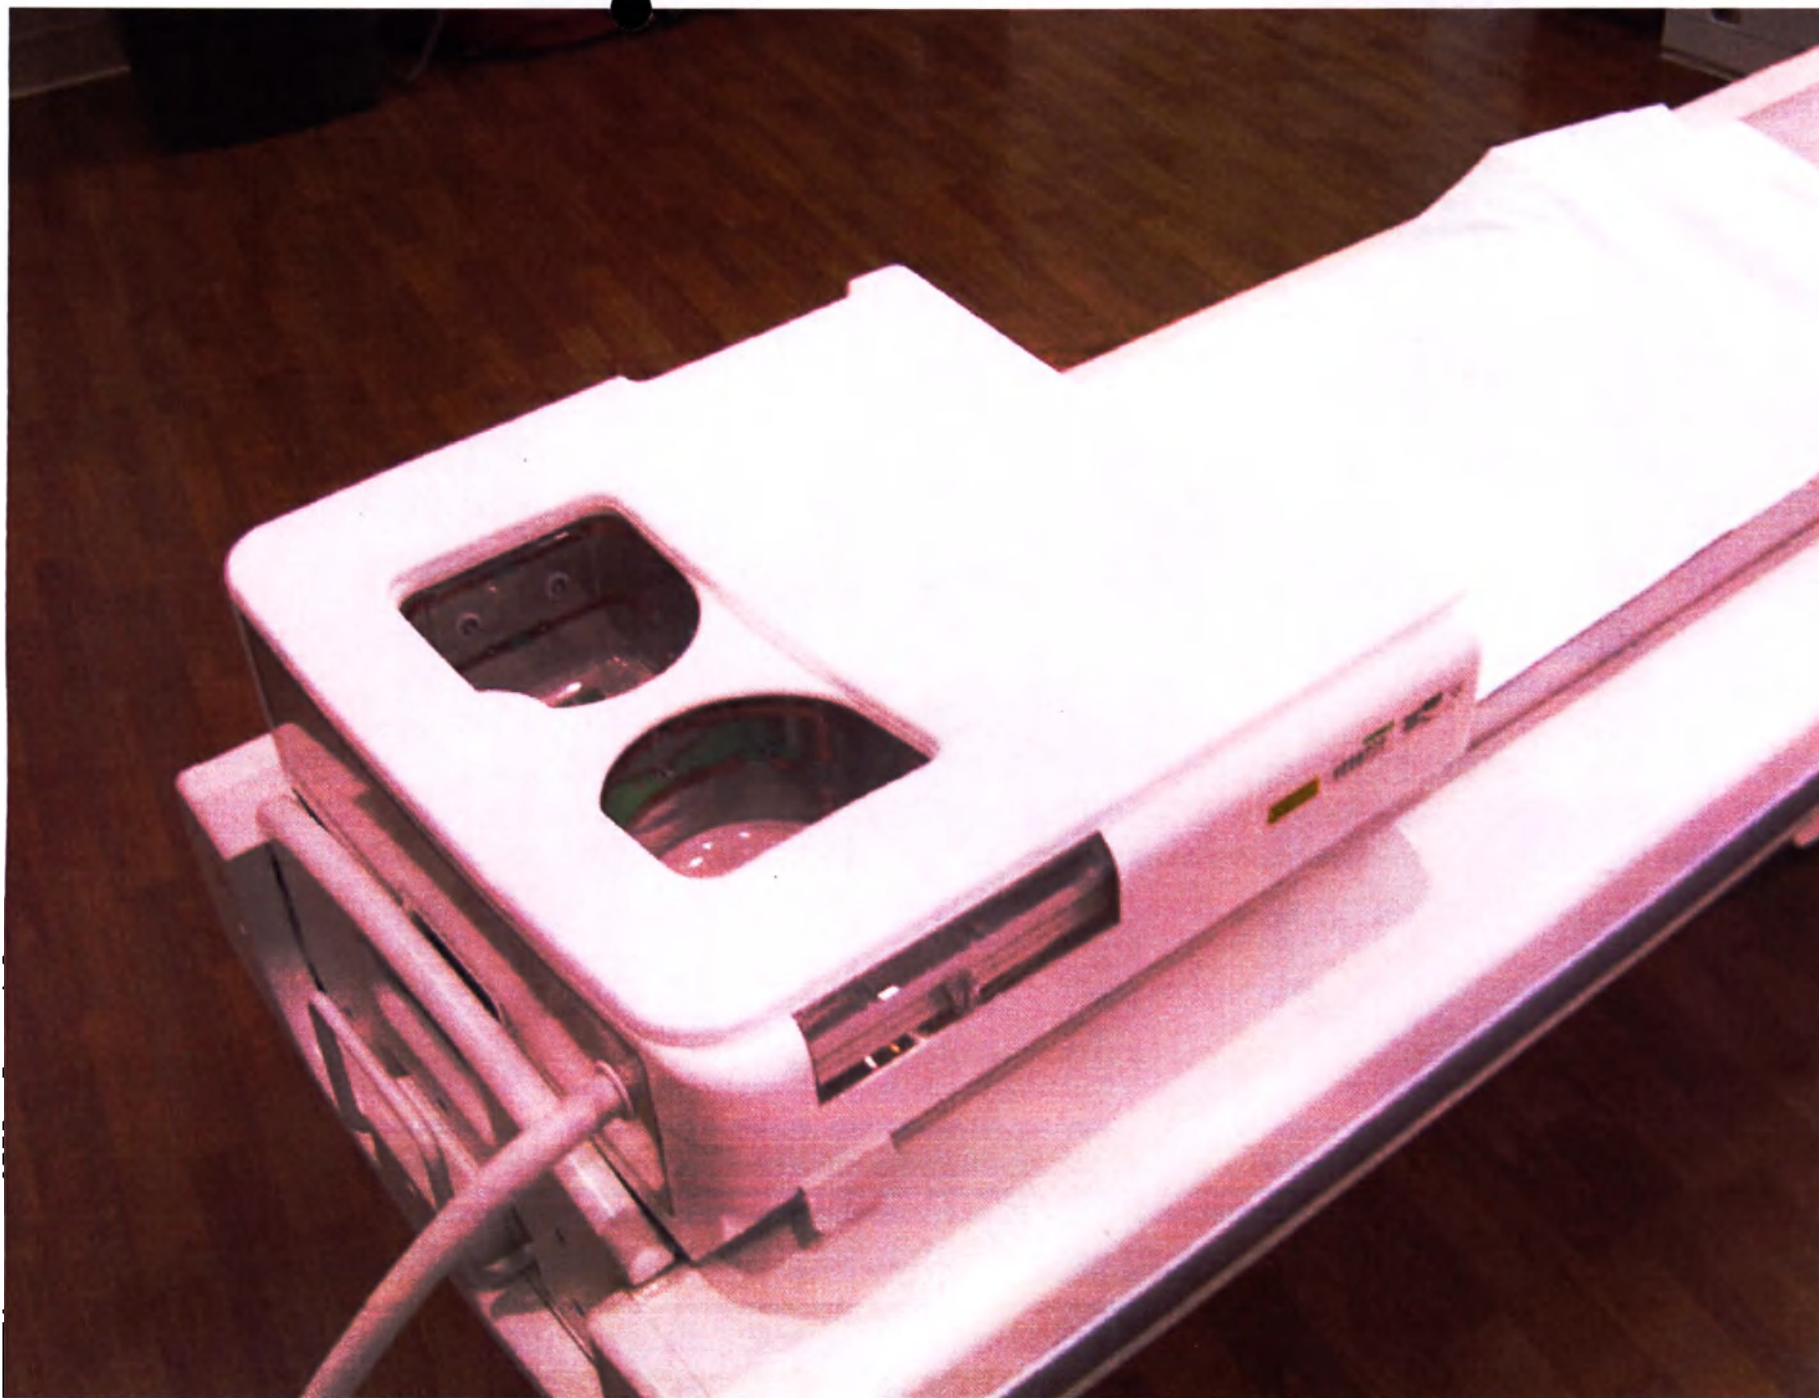

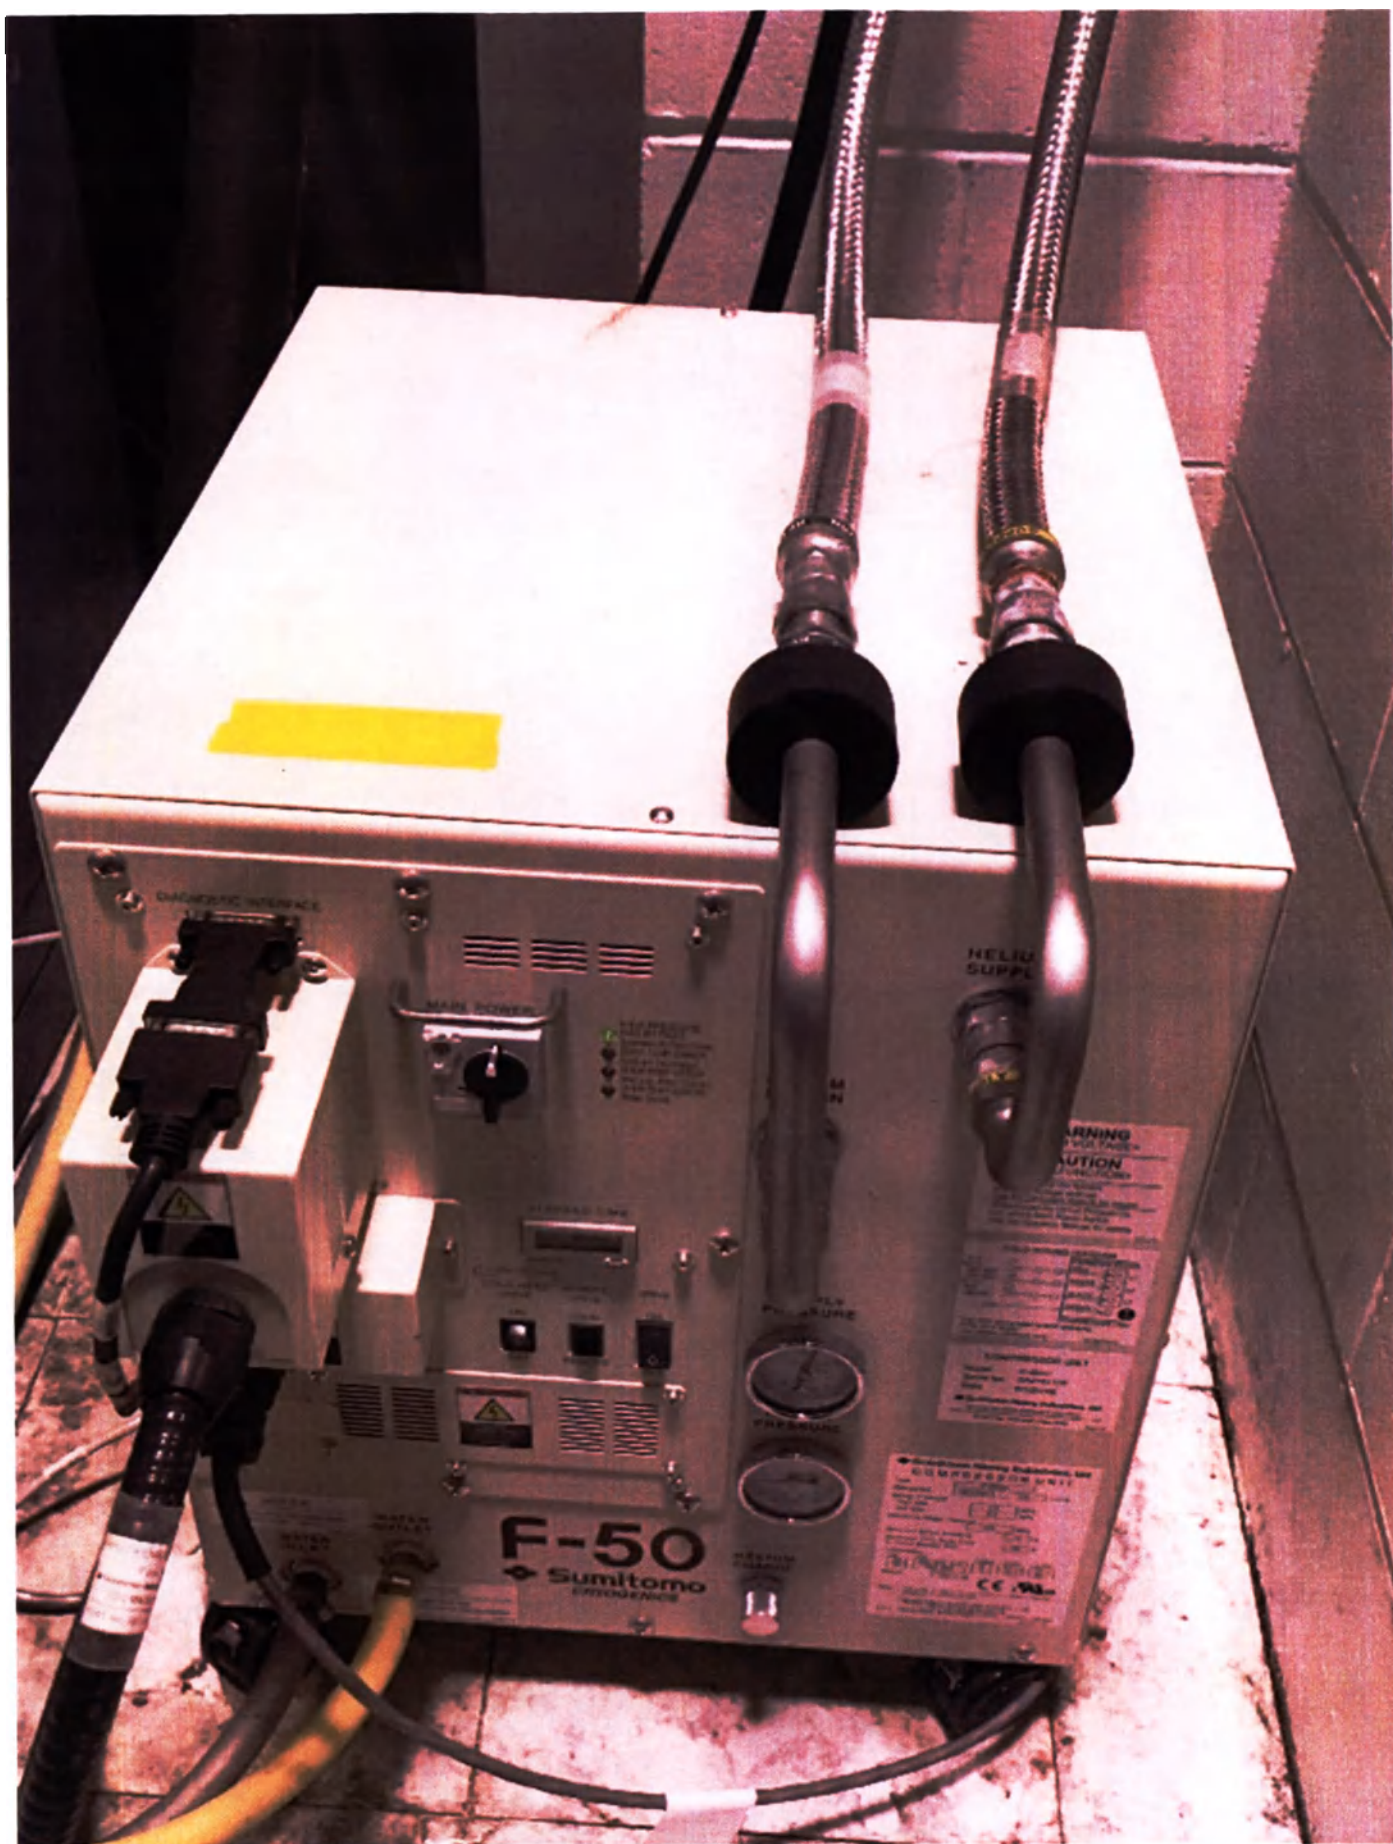


Компрессор гелиевый системы охлаждения МР-томографа.

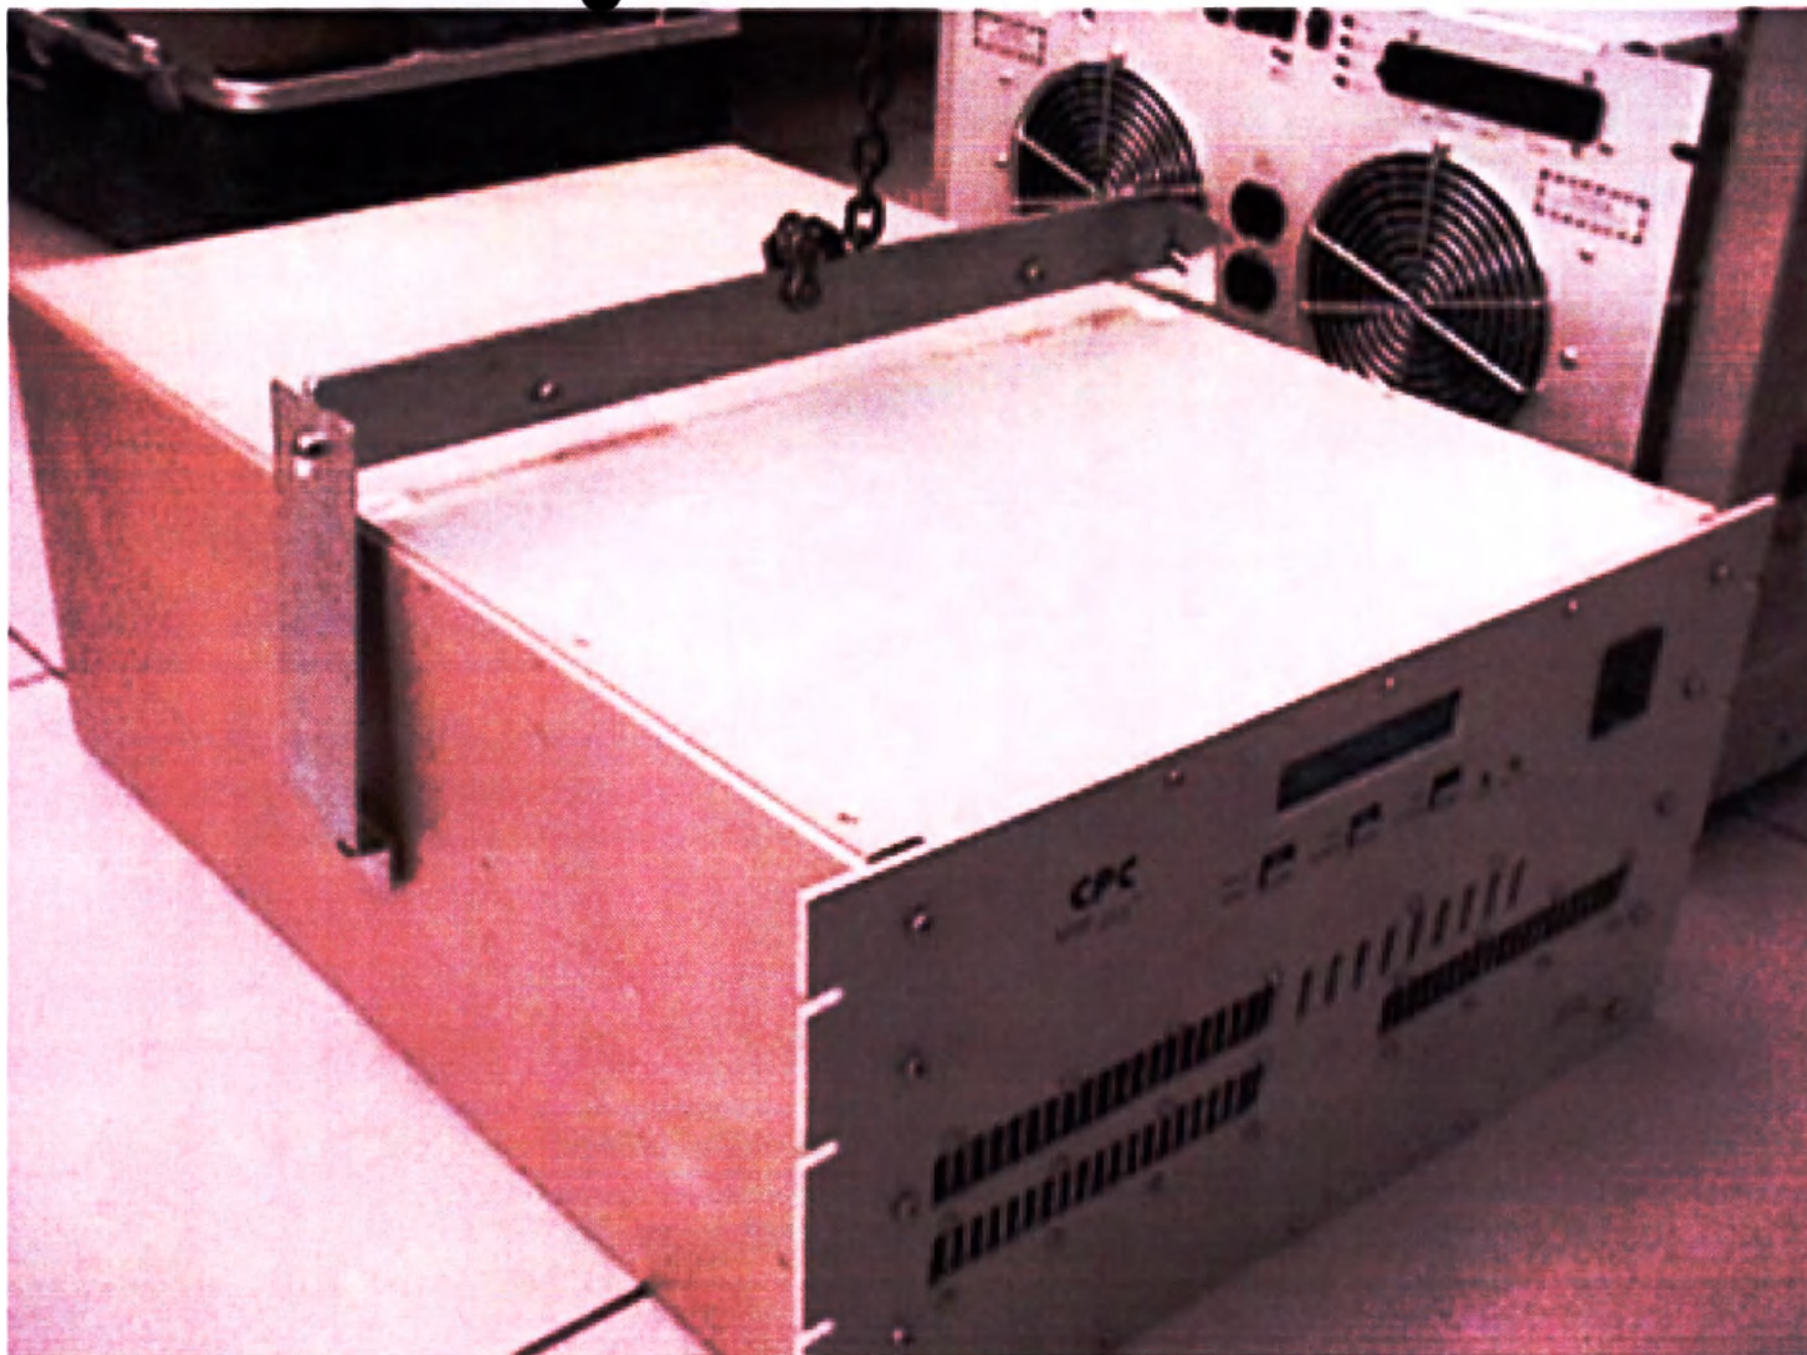


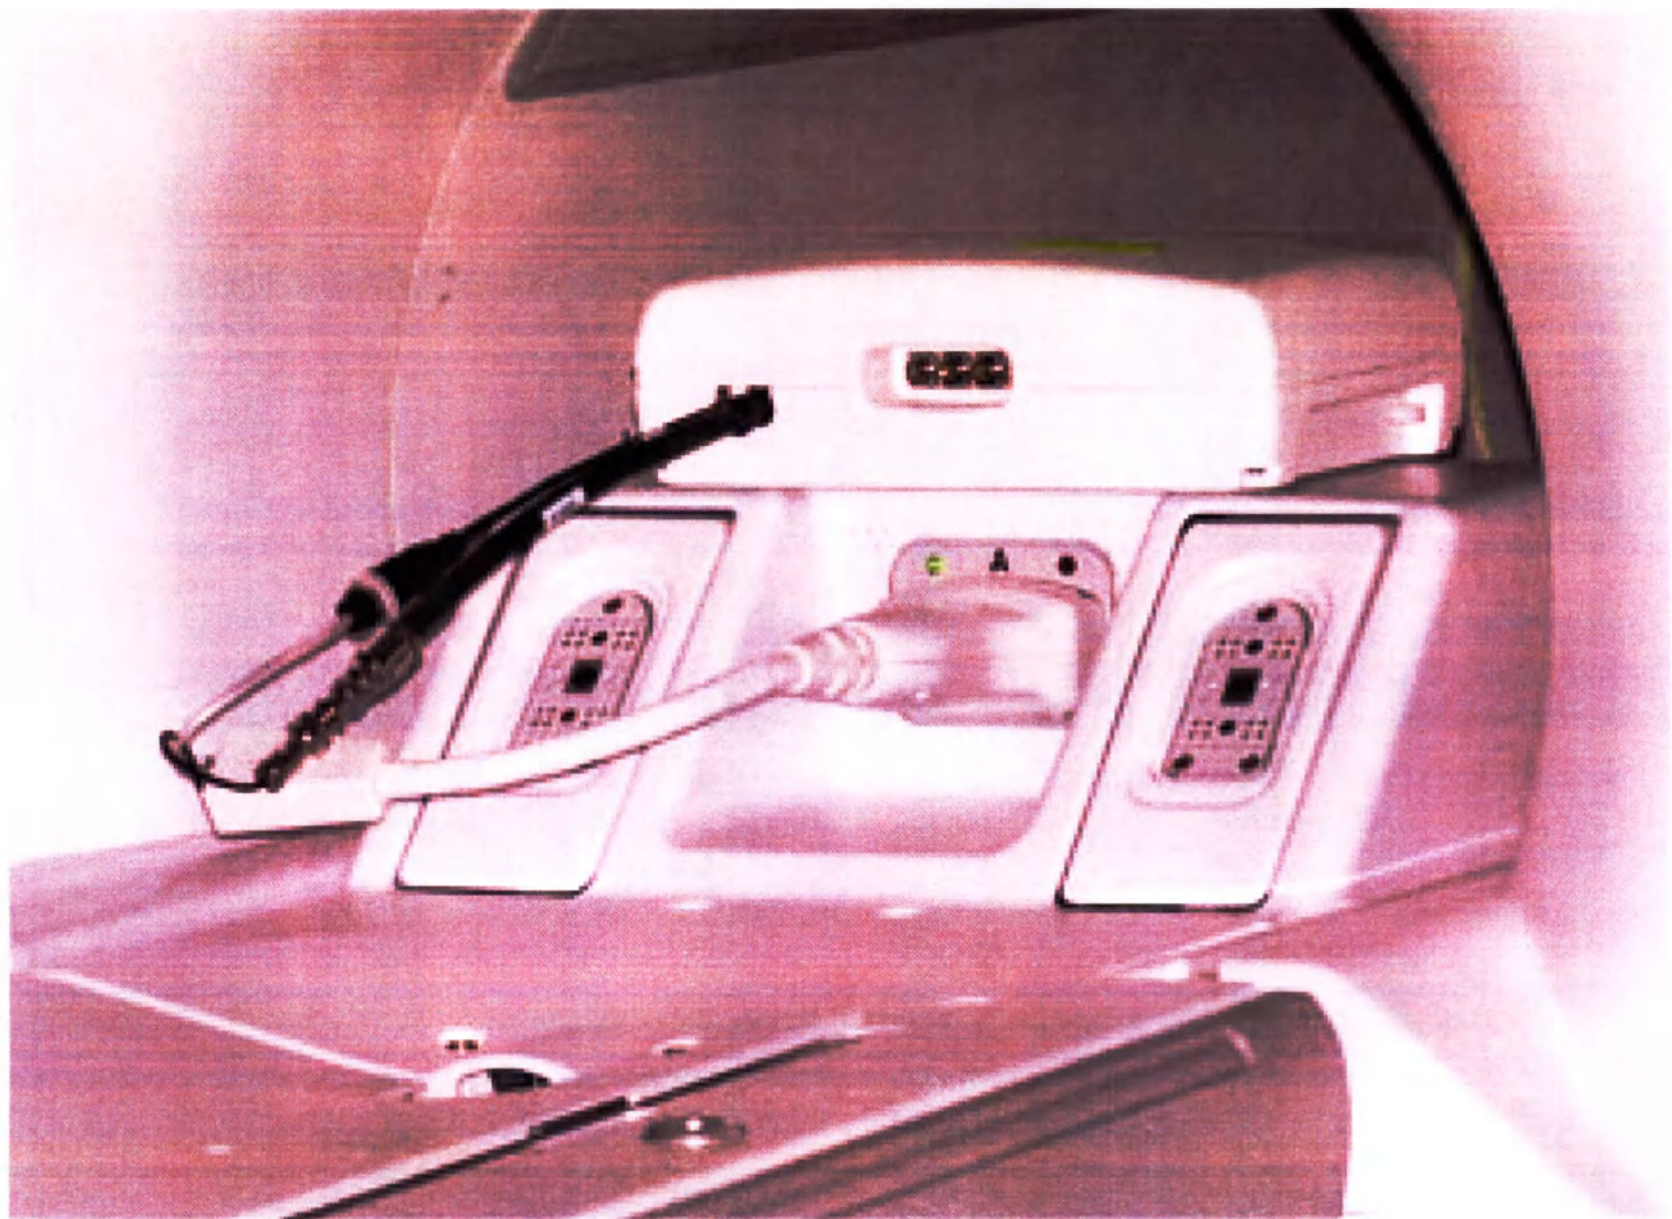




Переключатель передача/прием для многоядерной спектроскопии.

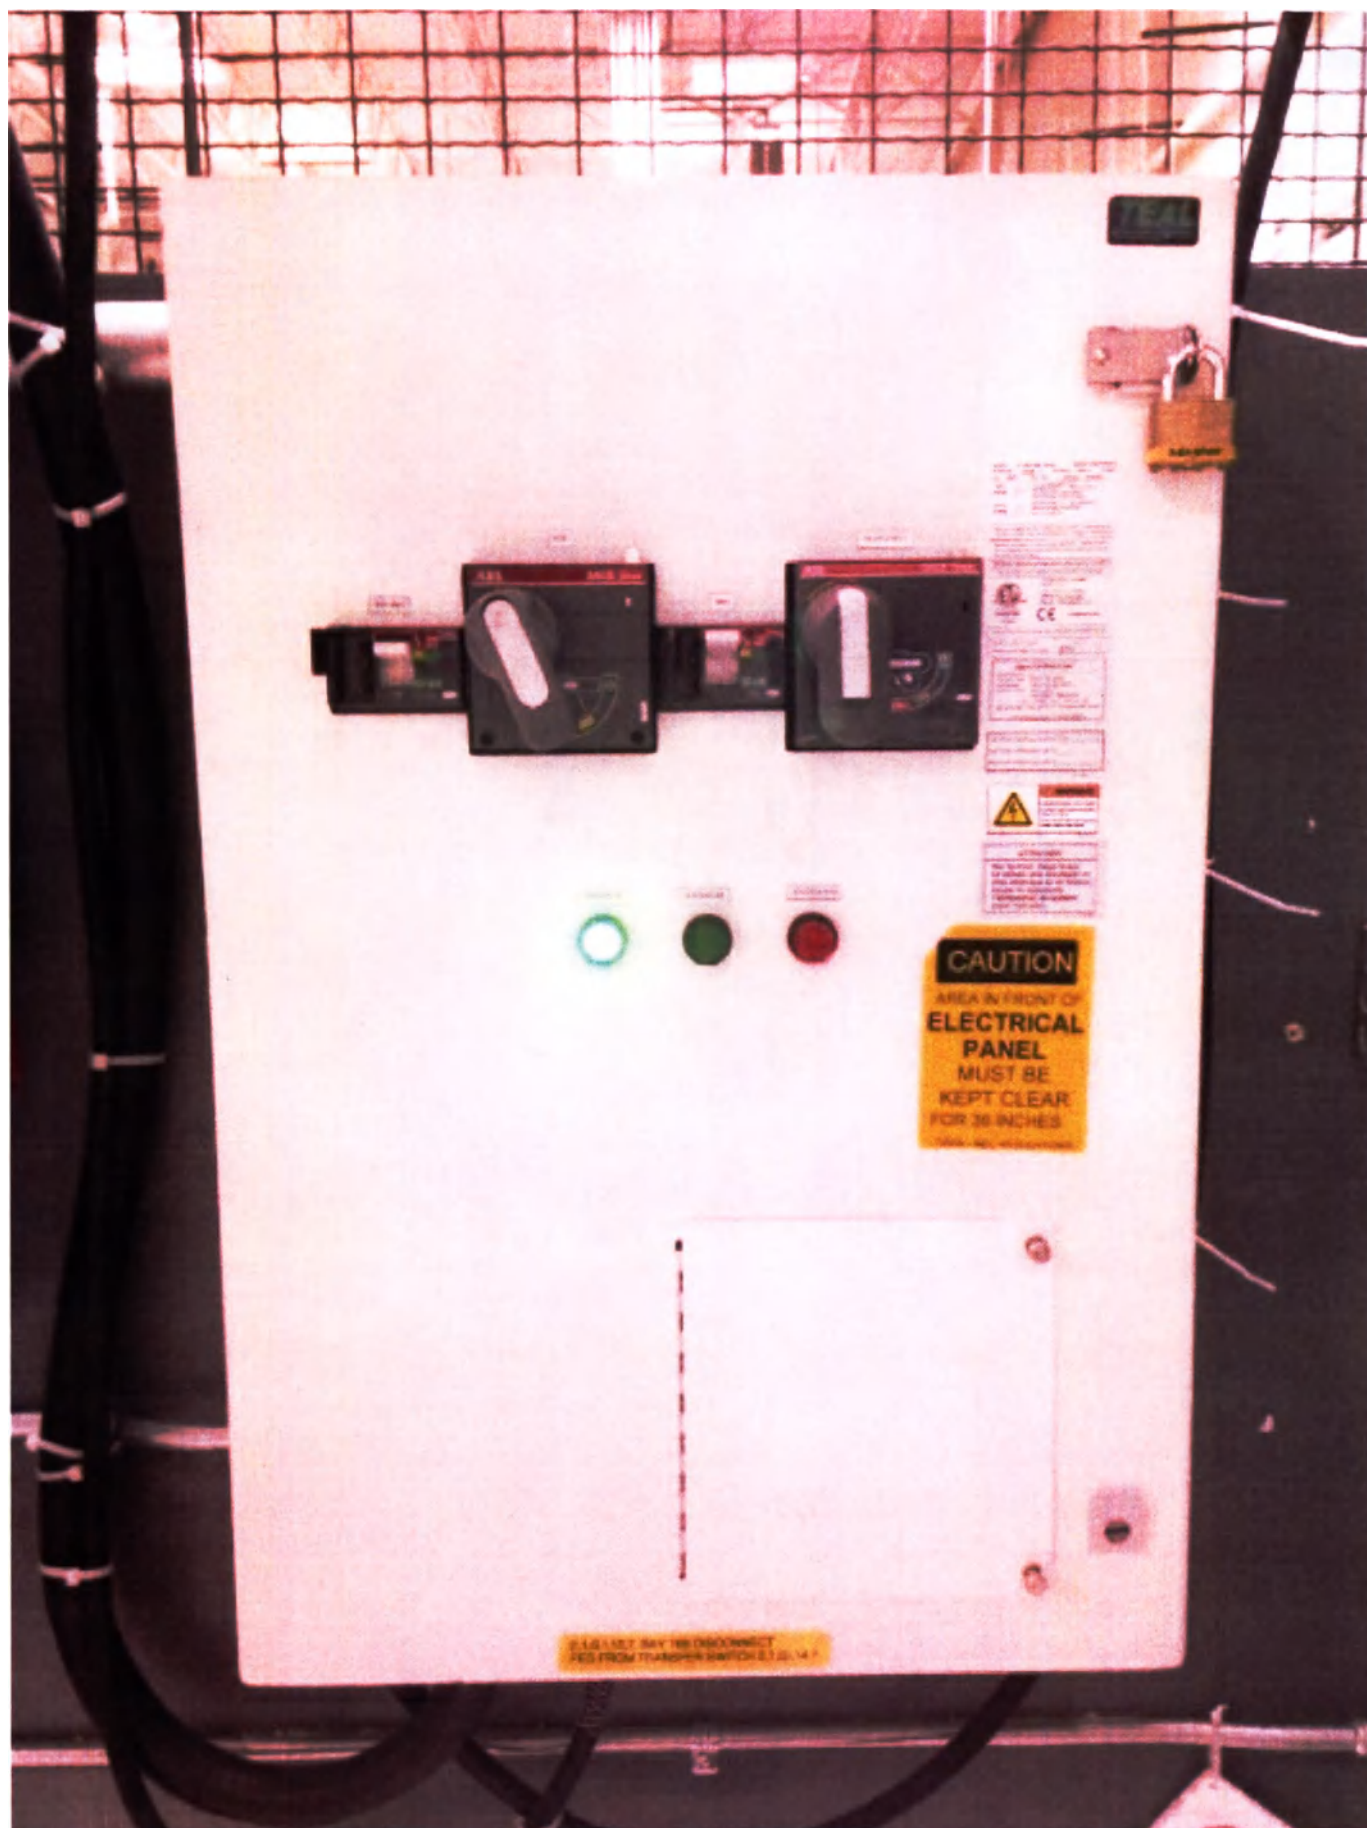


Щит питания силовой распределительный специальный.

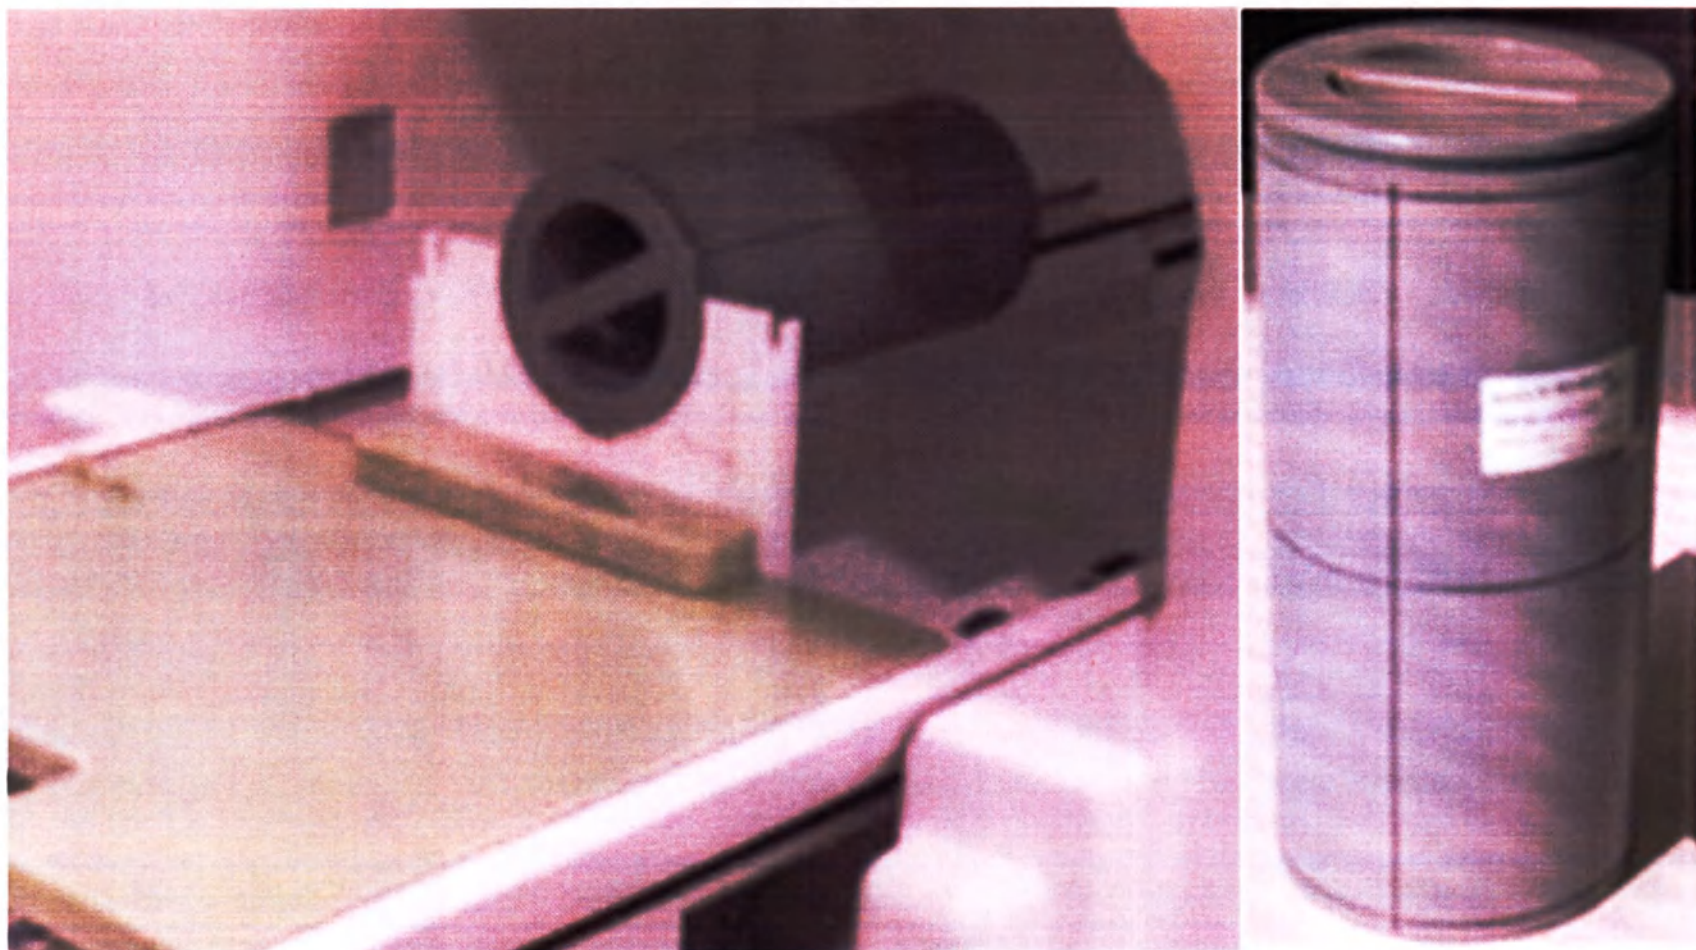

Кольцевидный фантом

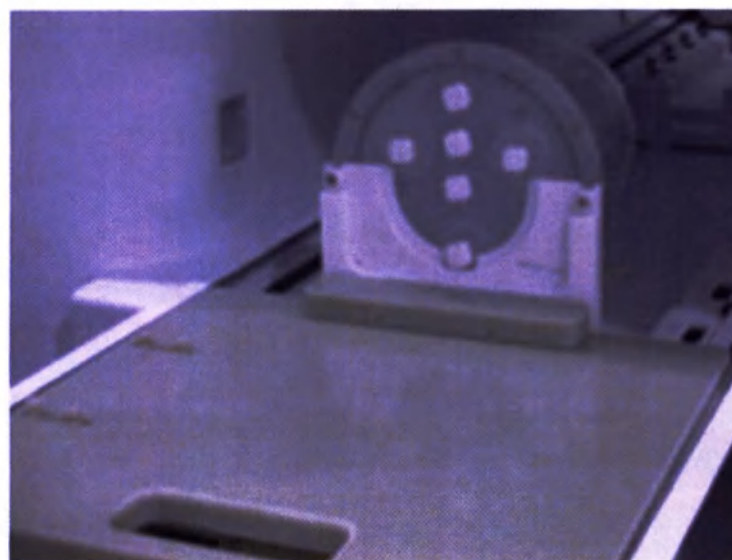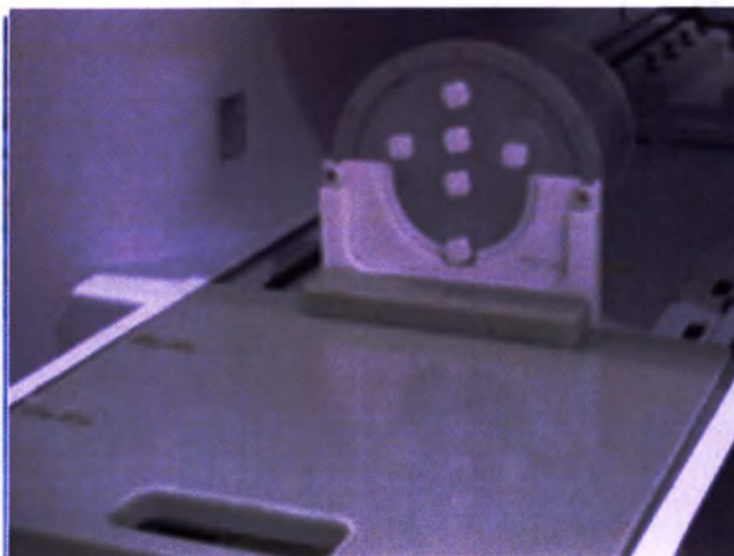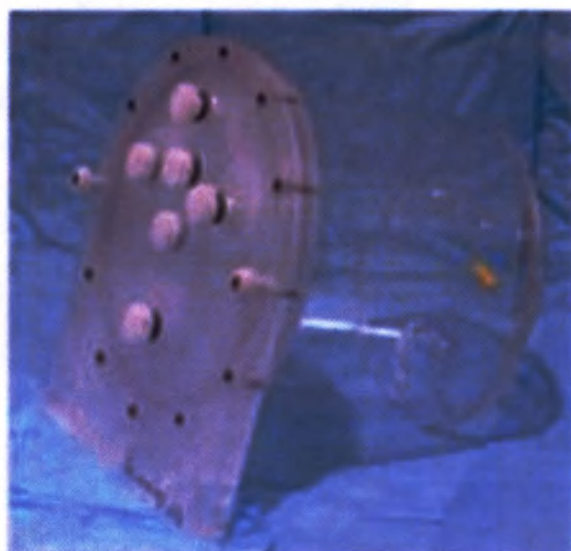

Плоский фантом

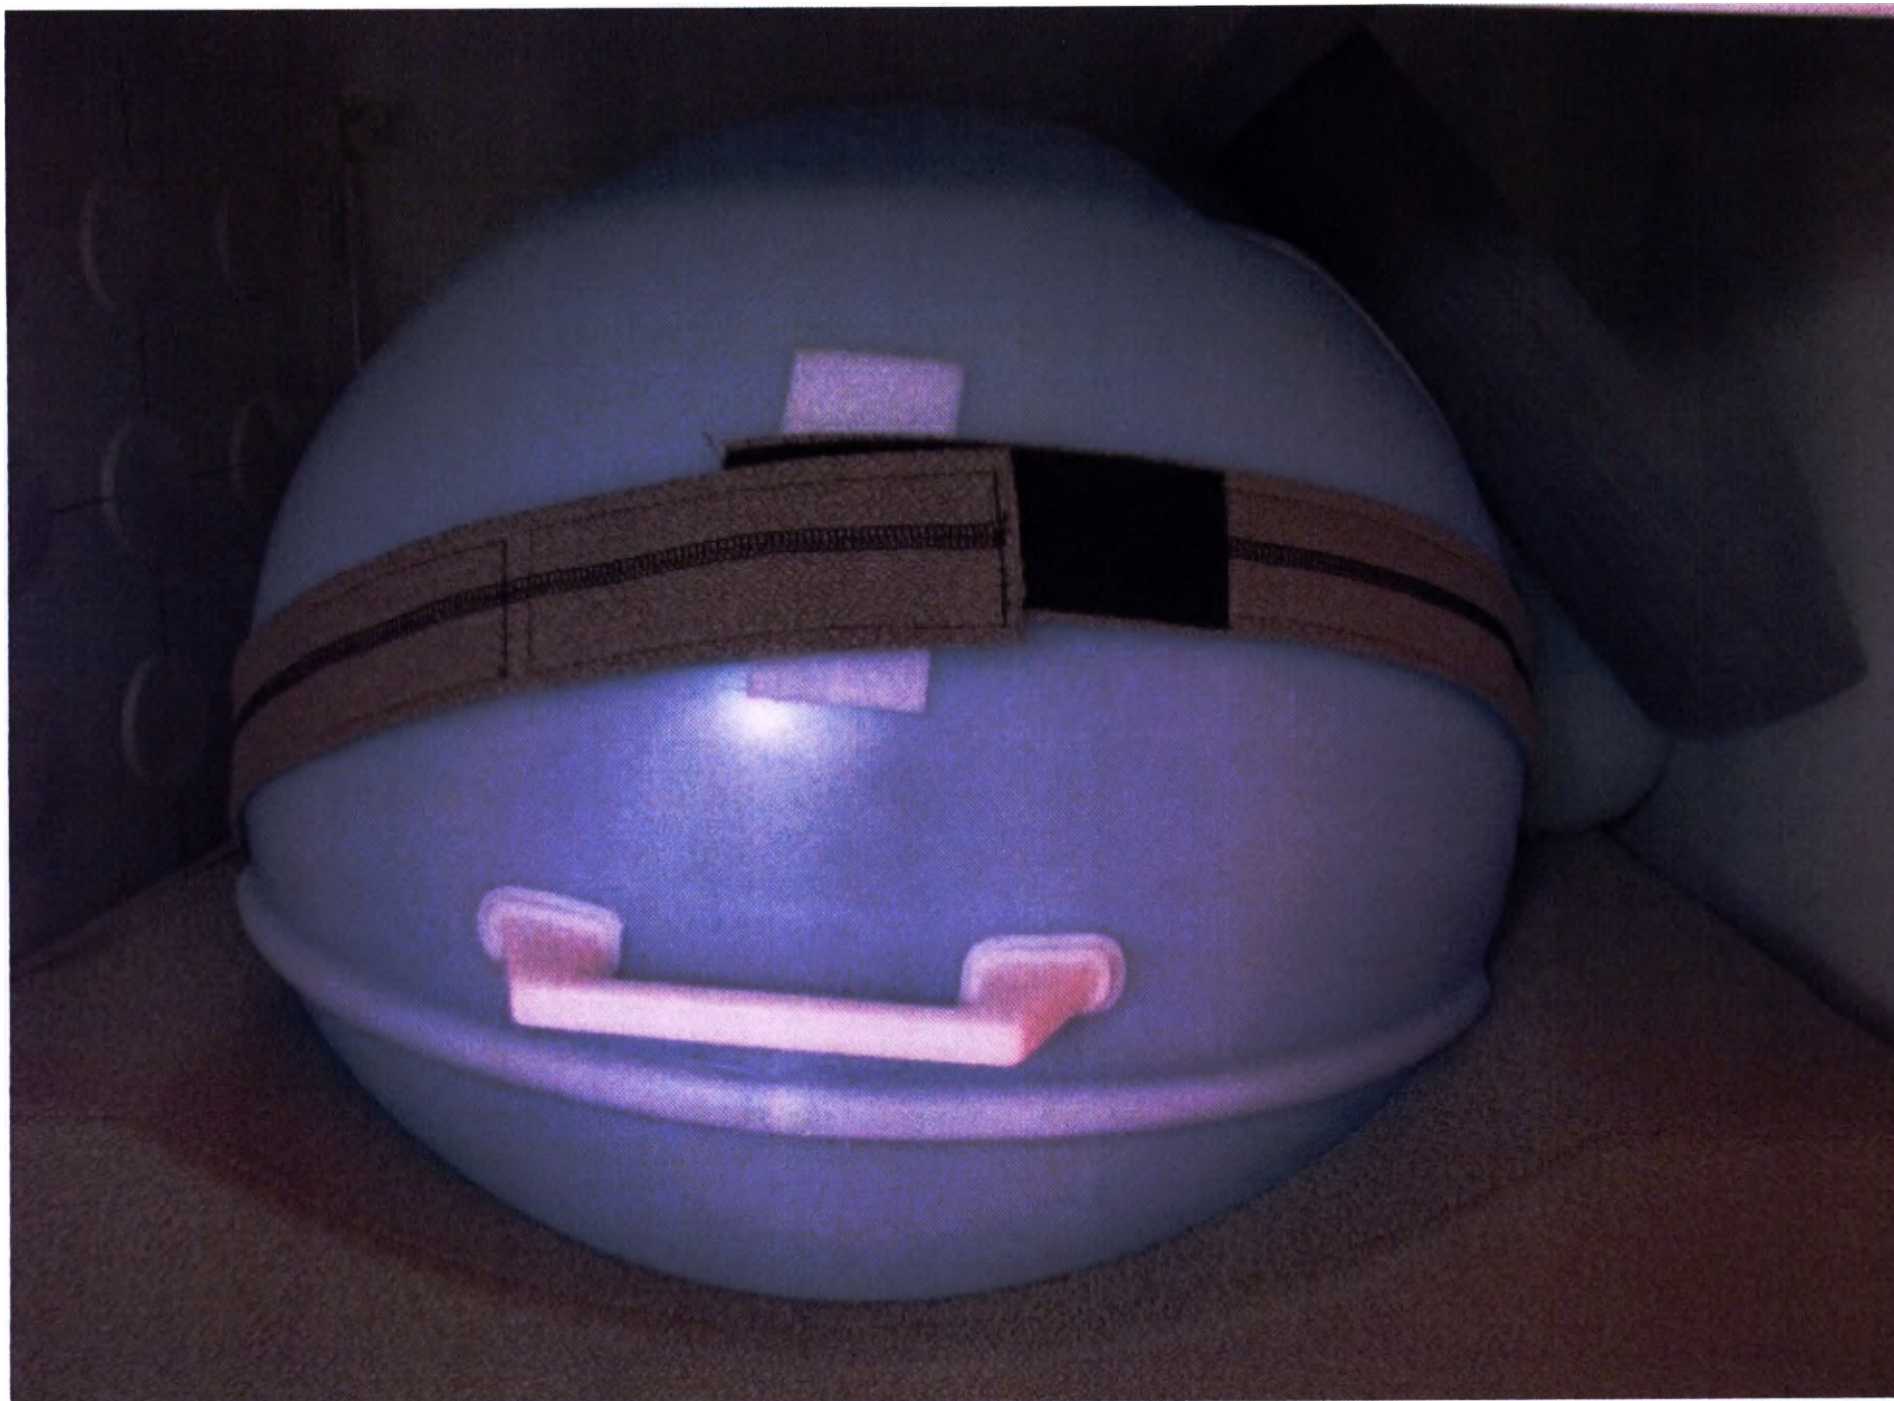




Сферический фантом тела TLT



Стул оператора






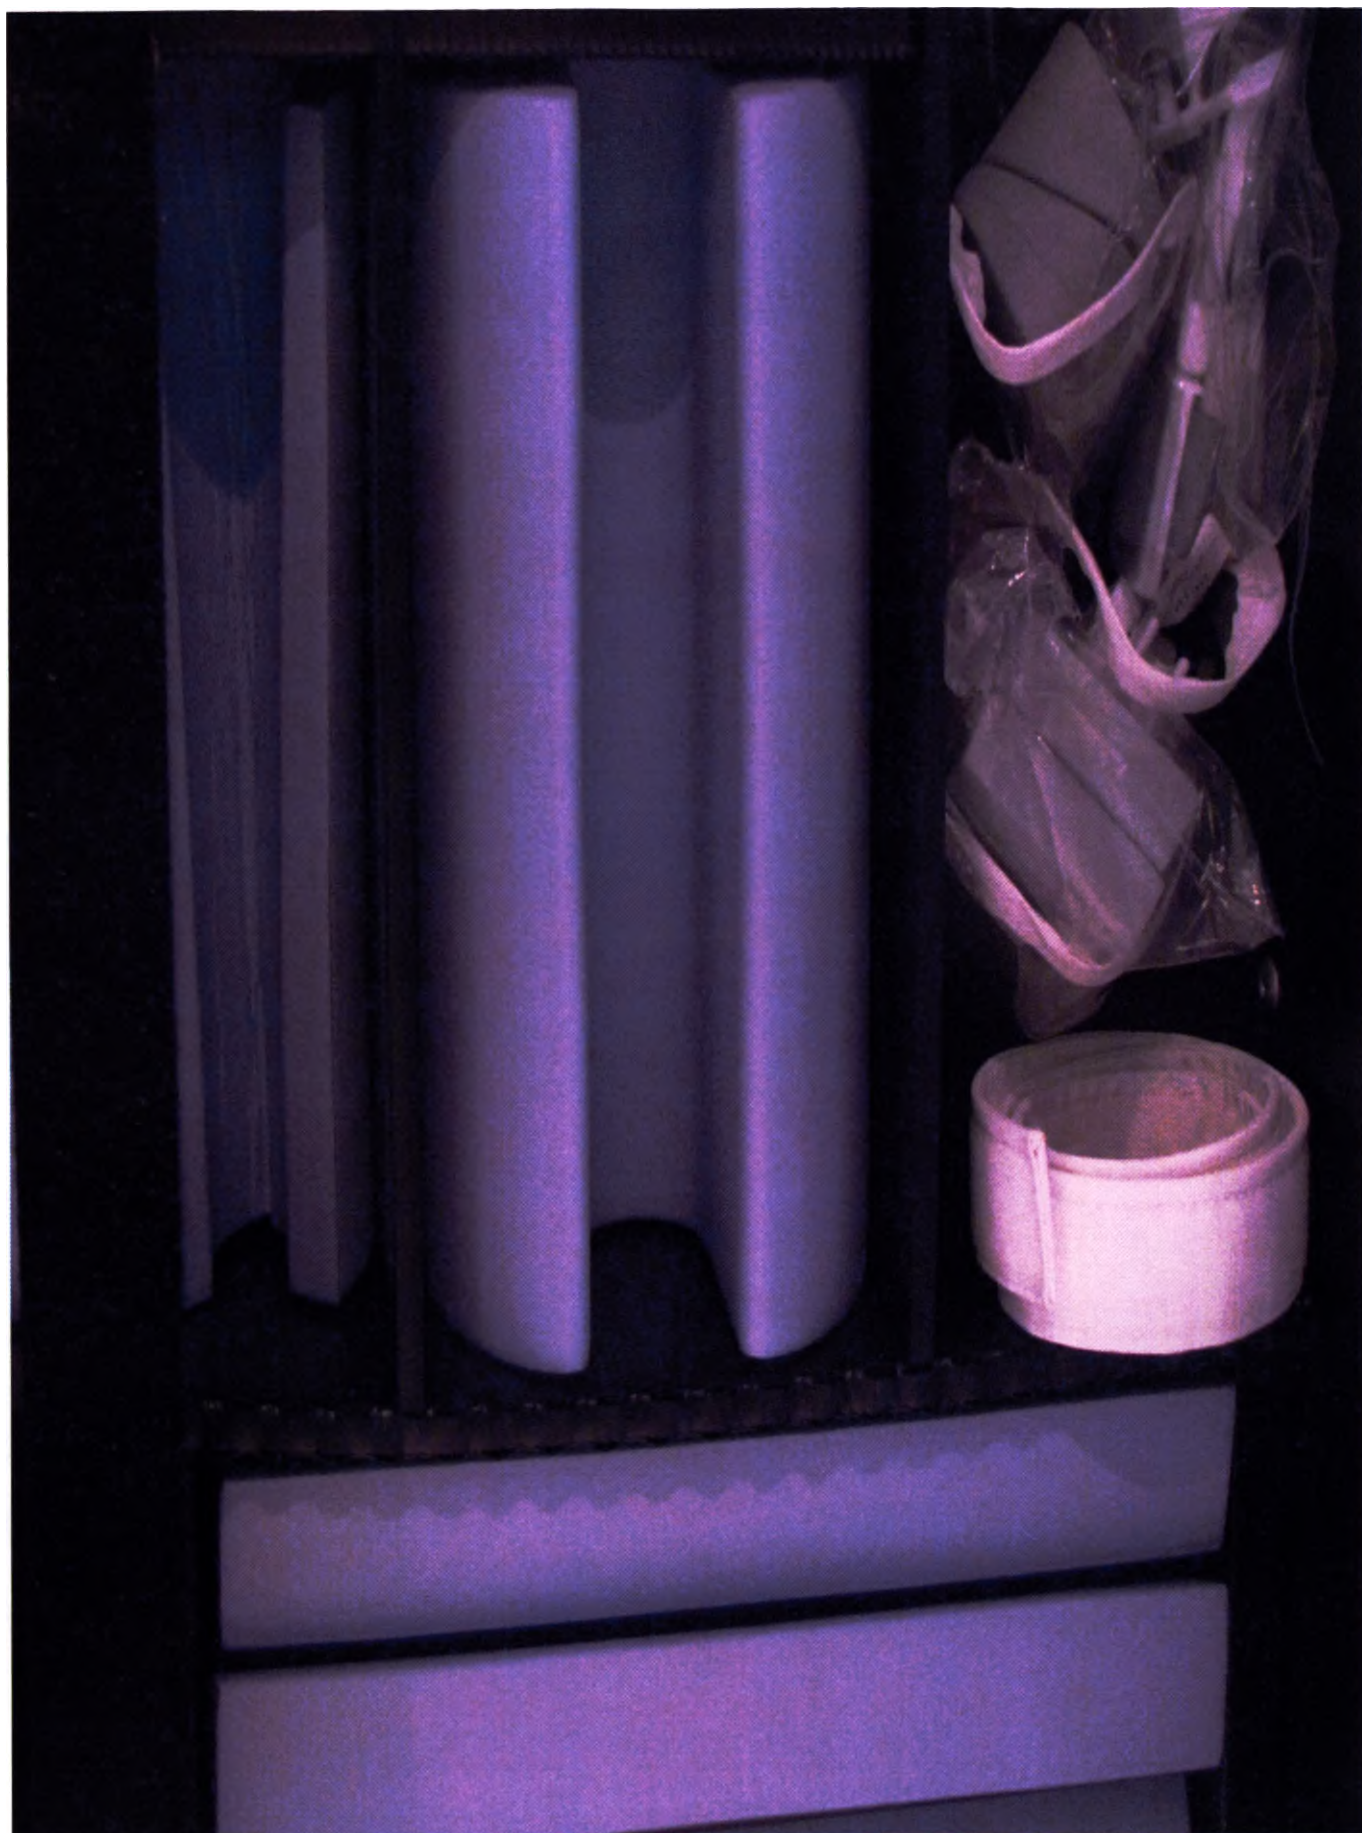


Валики для позиционирования




Блок электронный силовой.

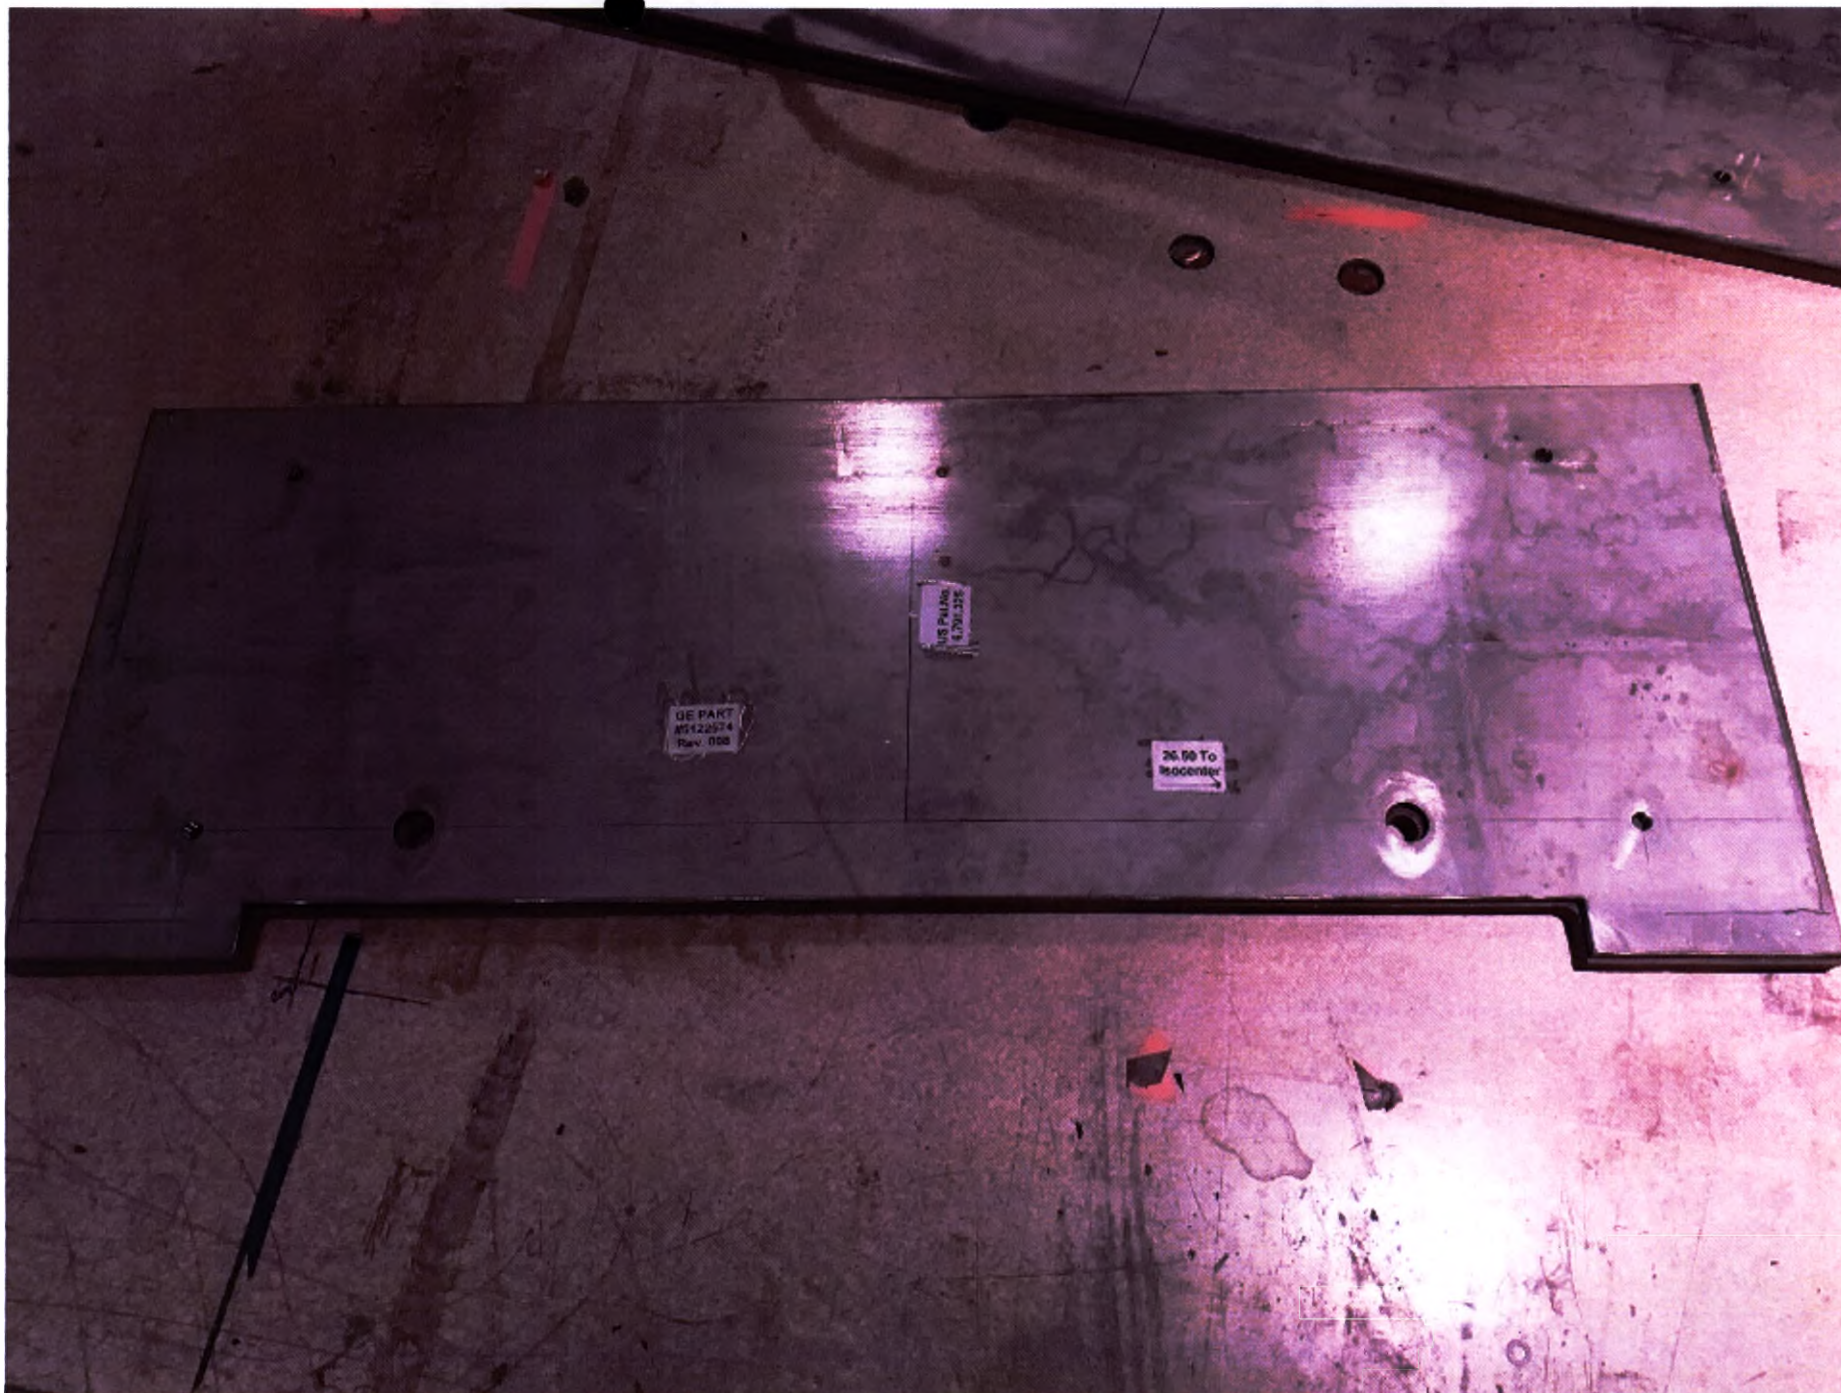


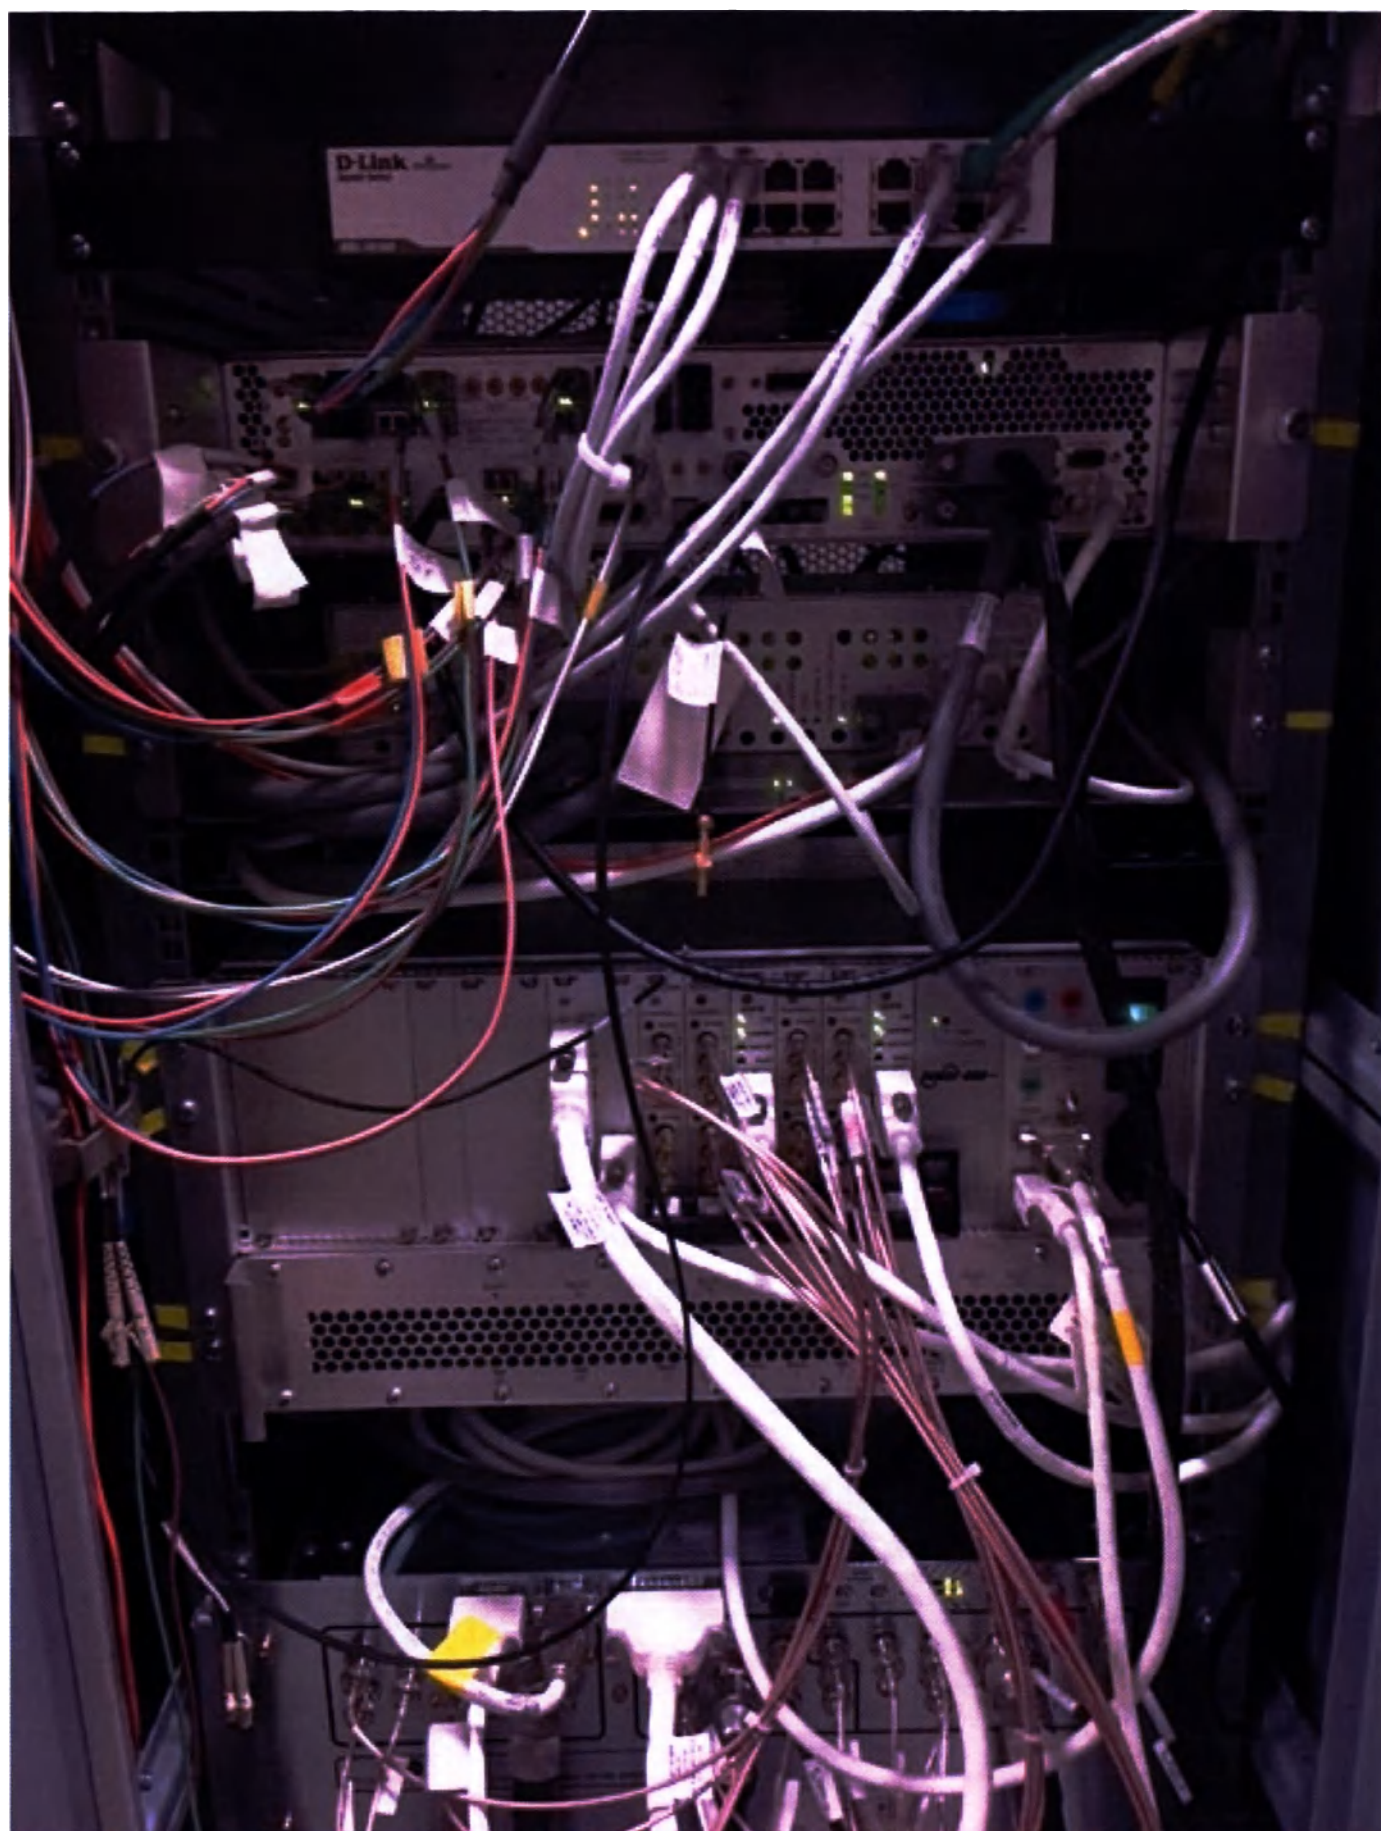

Устройства для модернизации МР-томографа



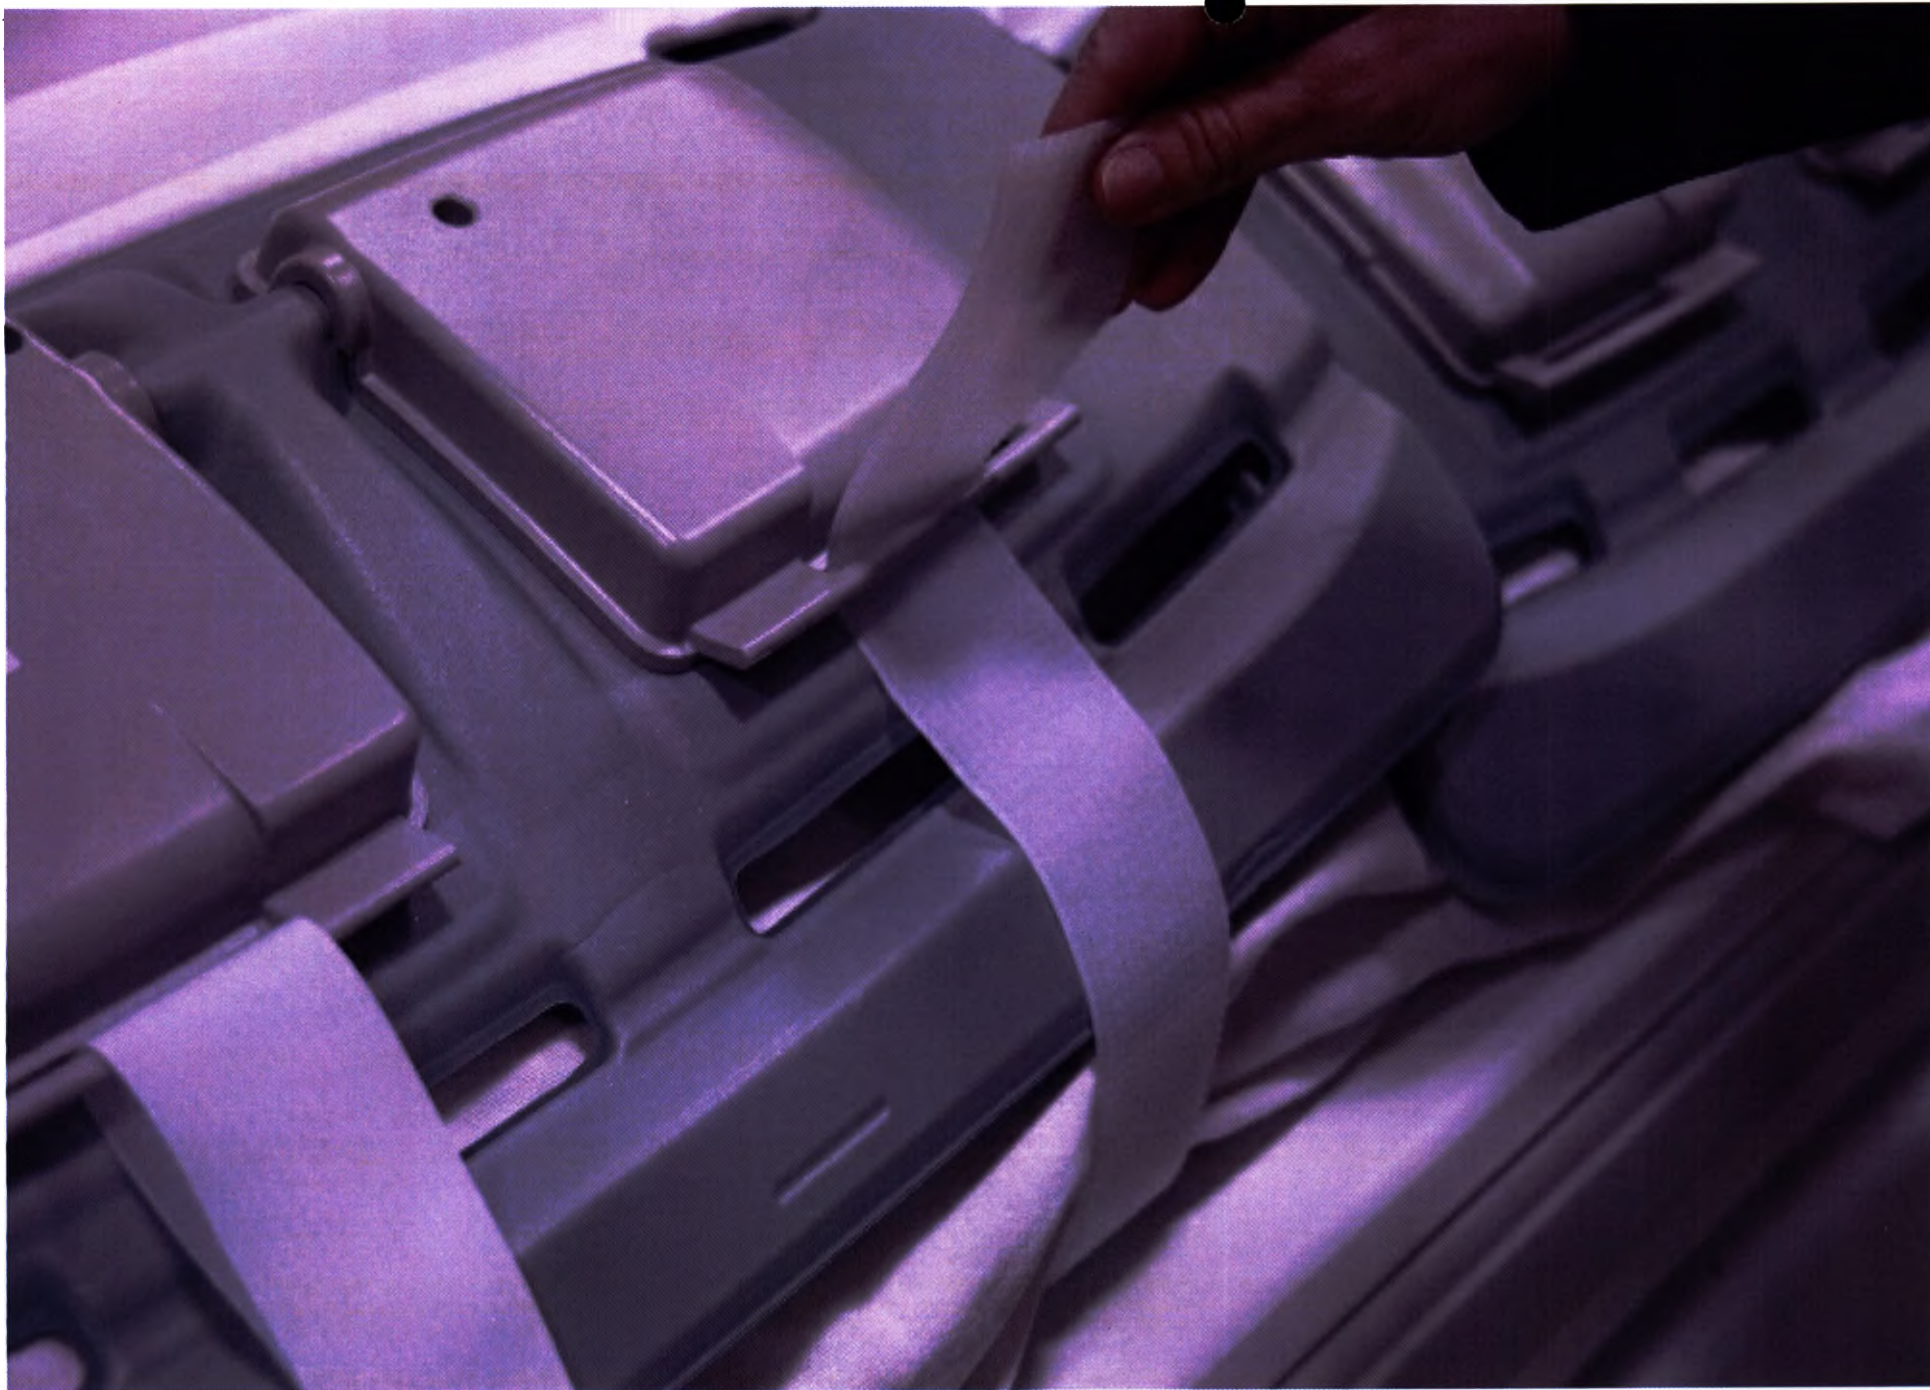

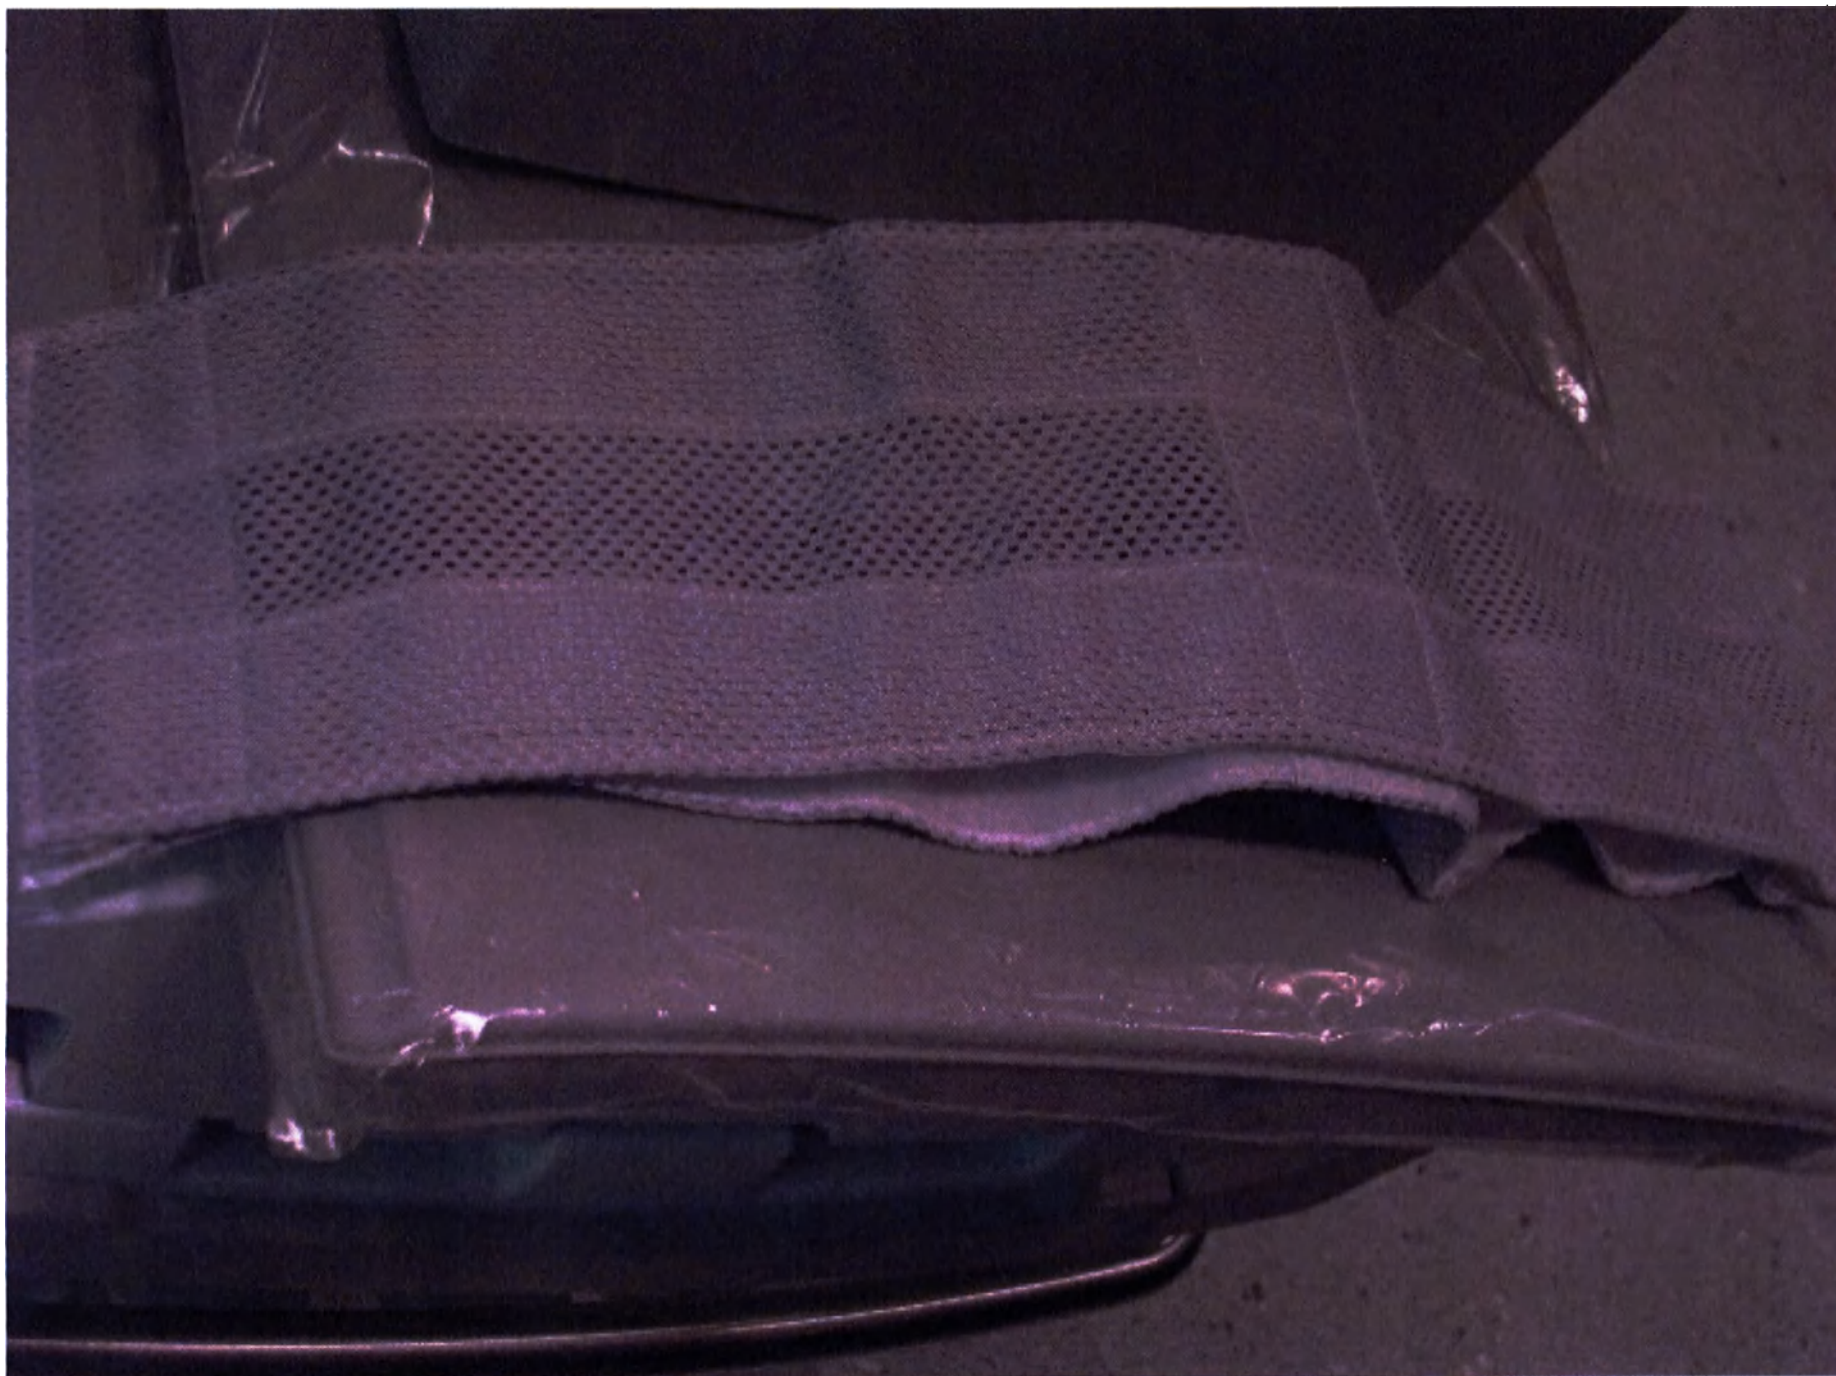




Тележки специальные для хранения фантомов




Тележки для перемещения шкафов электроники

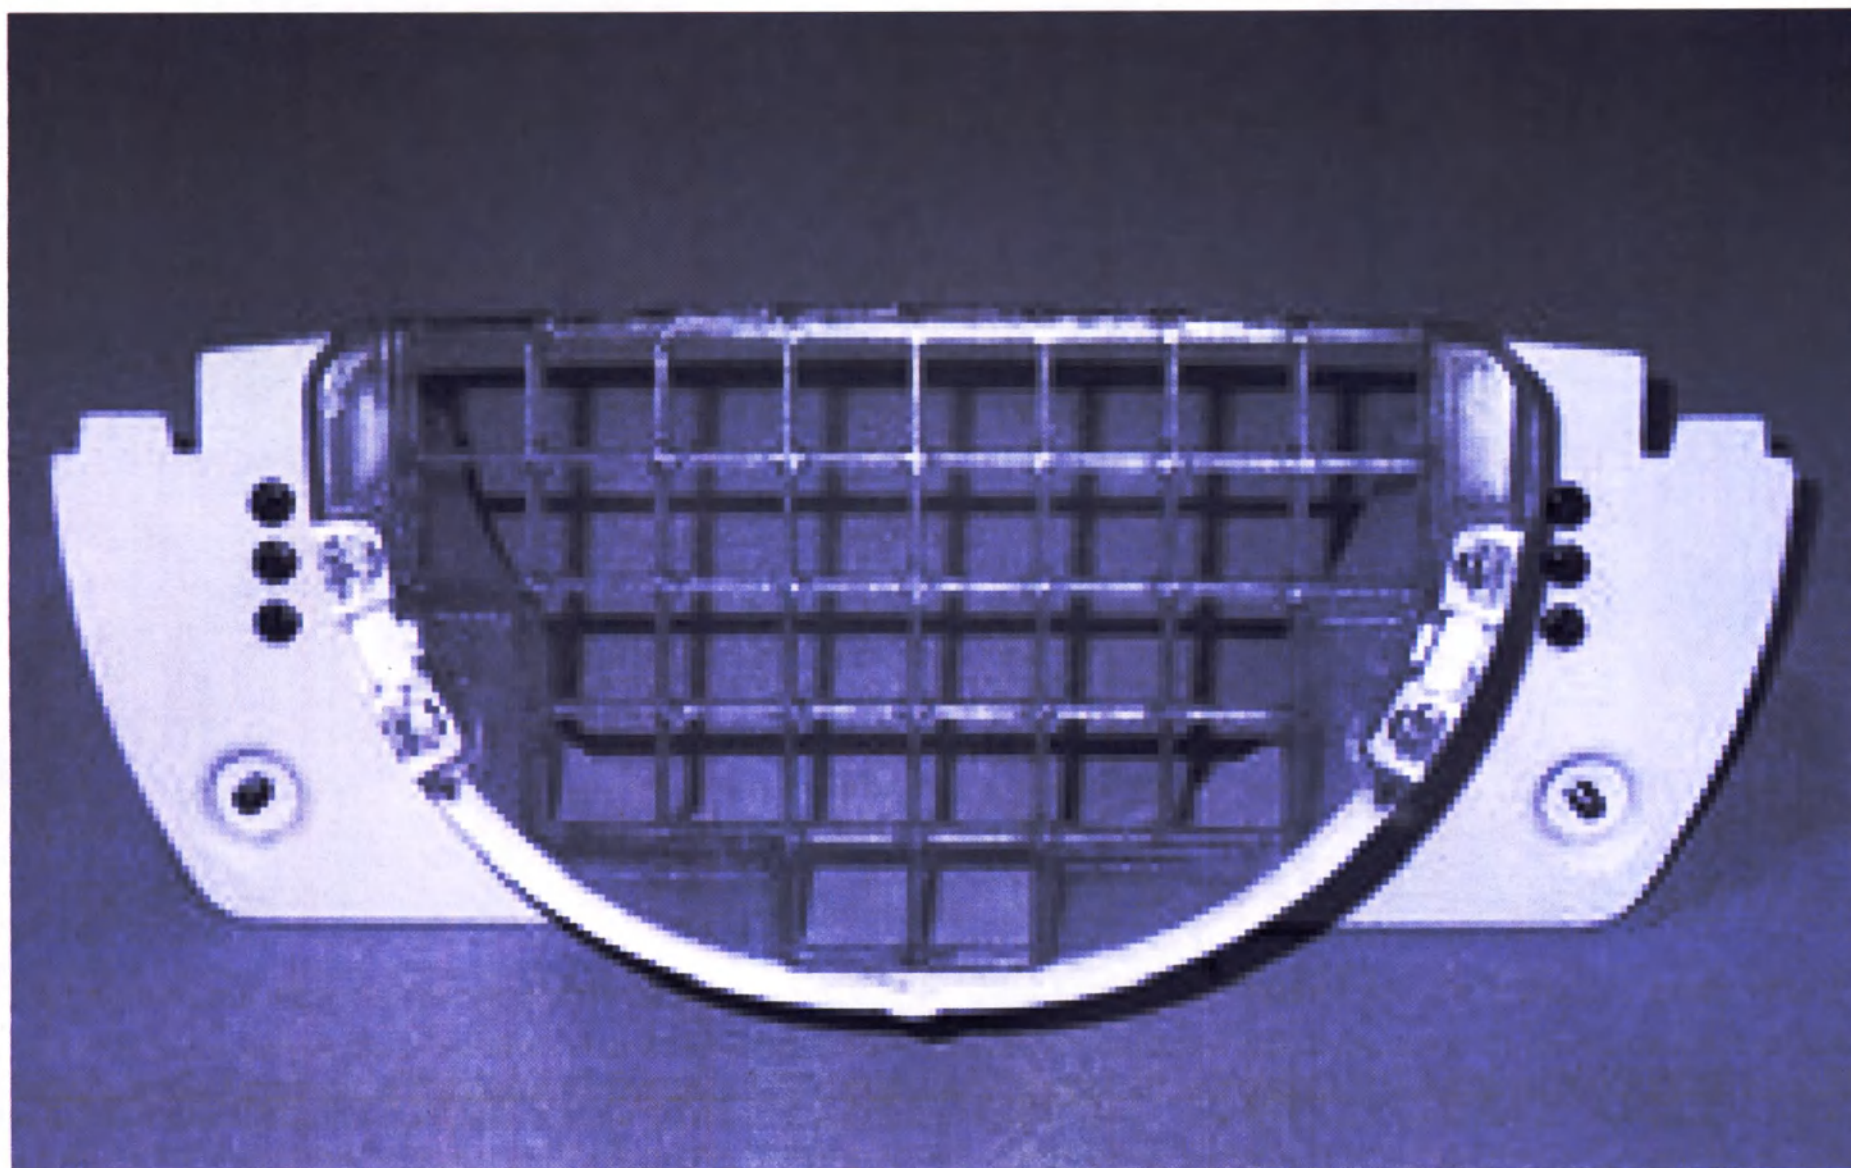





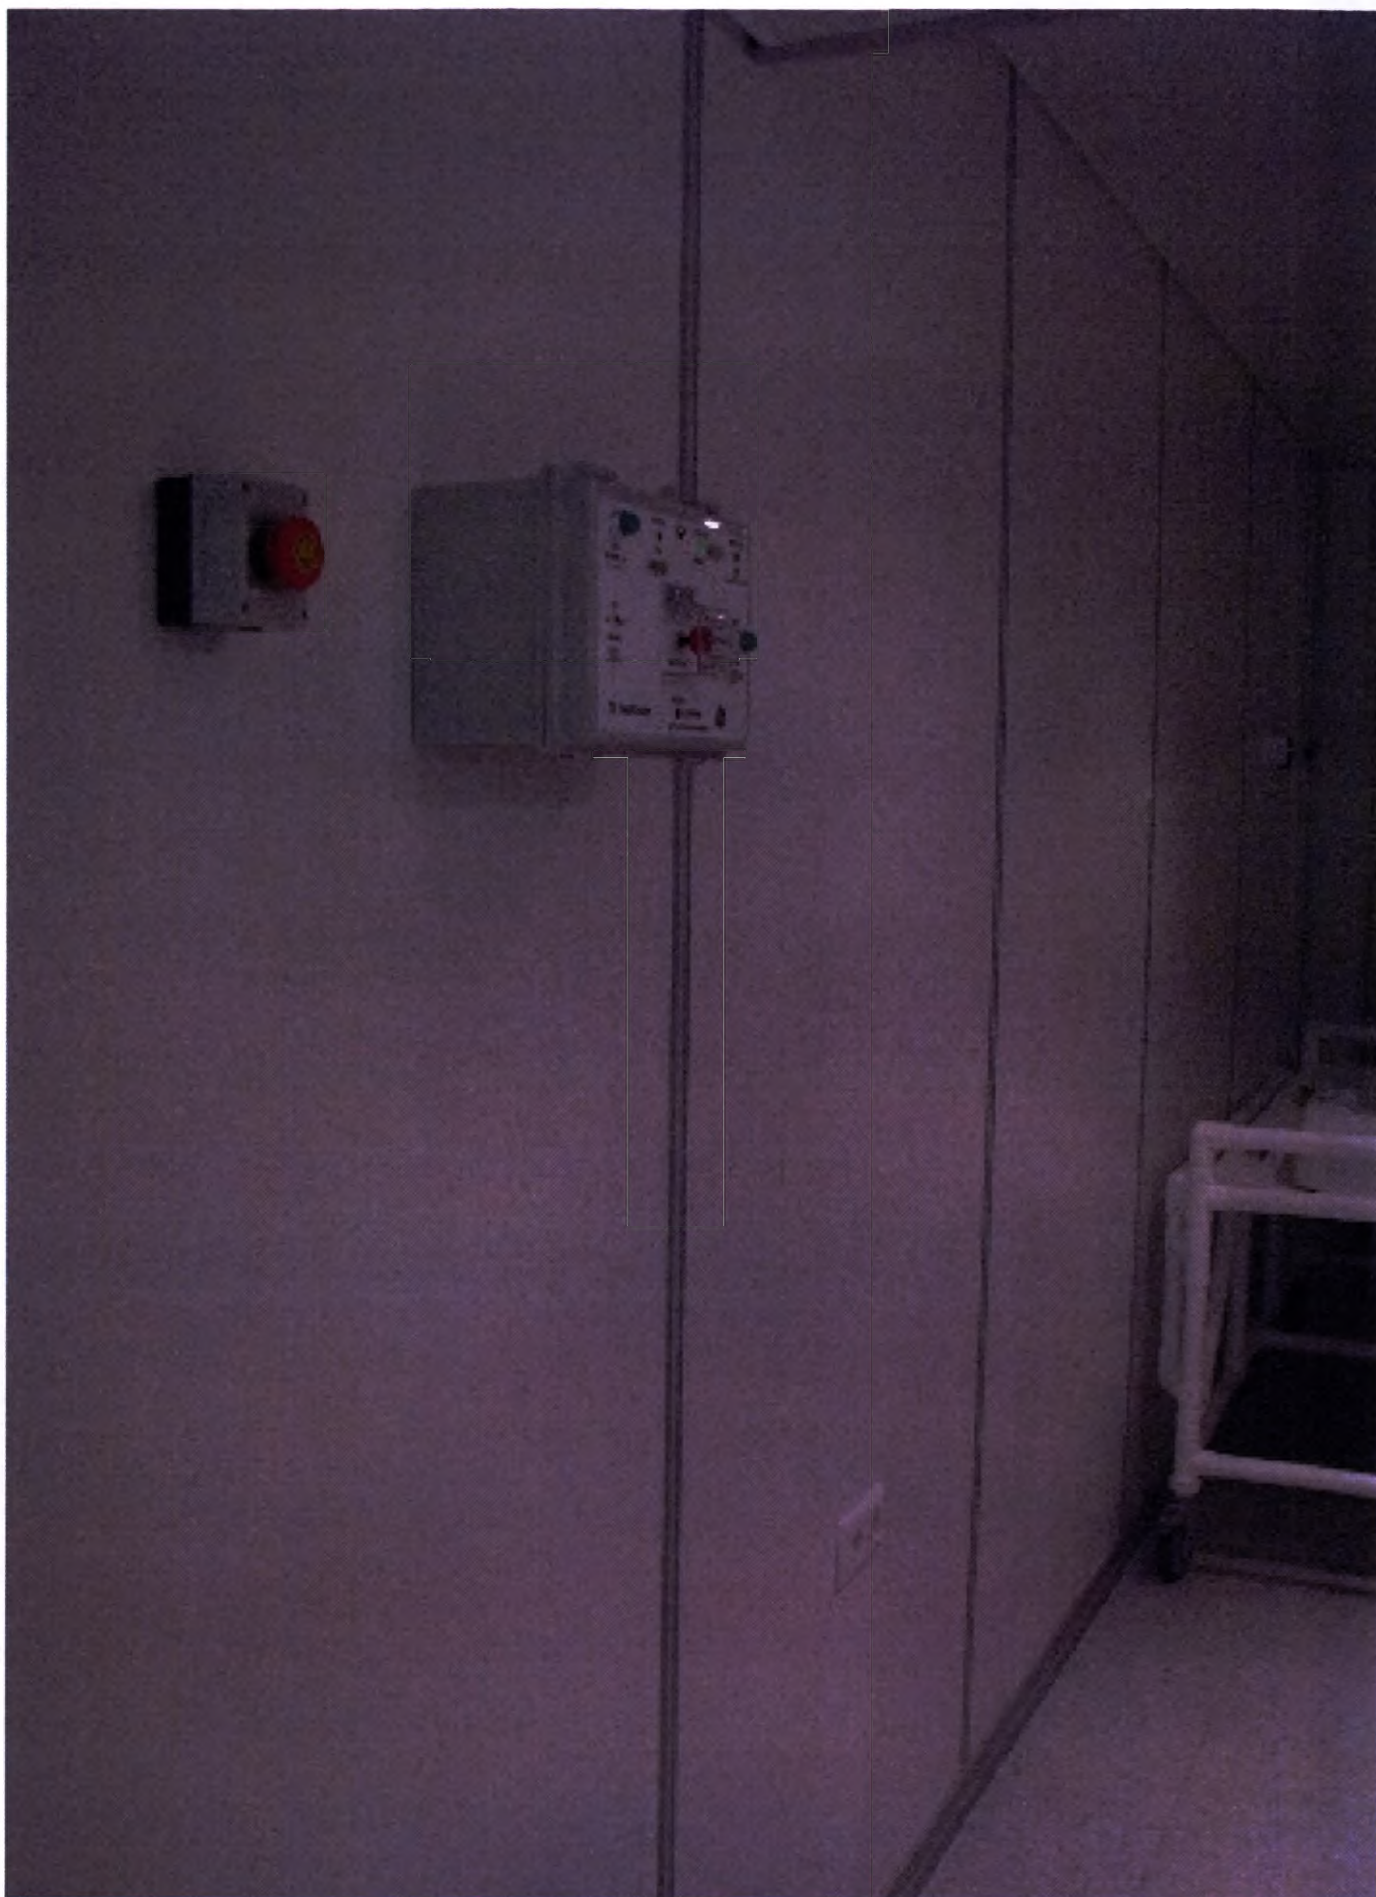

Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).




Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



Устройства для стабилизации напряжения (не более 20 шт.).



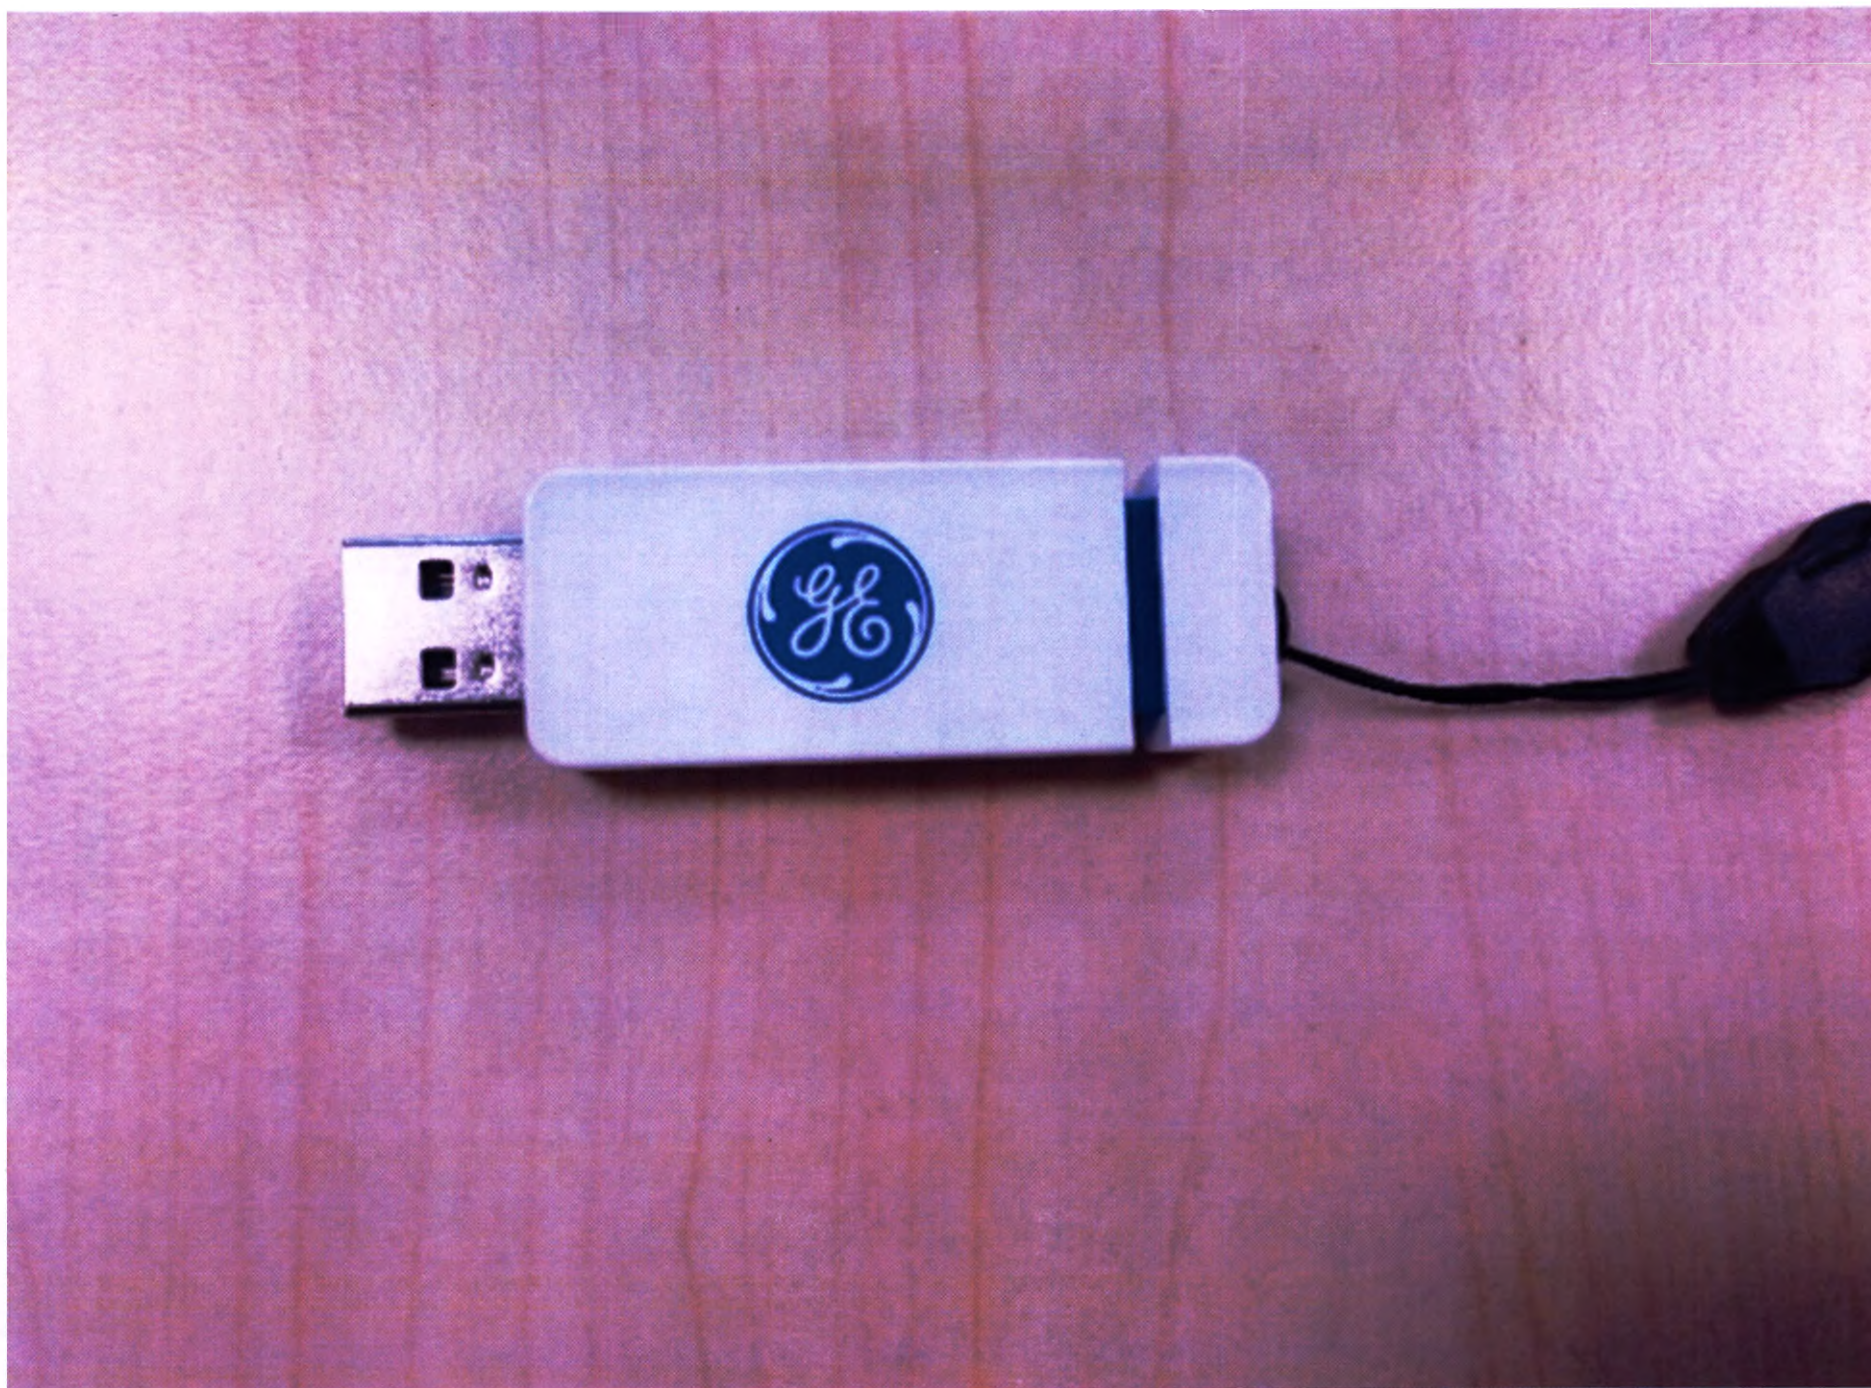







Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 70 листа(ов)
Руководитель департамента регистрации
и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
Парахина С.Б.

