



Закрытое акционерное общество «ЛИДЕР»

(ЗАО «ЛИДЕР»)

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр.1

Телефон: +7 (499) 130 43 71, info@med-leader.com

ИНН/КПП: 7727797159 / 772701001 ОГРН: 11377460638

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор ЗАО «ЛИДЕР»



✓  Е. В. Бычкова

« 12 » февраля 2021 г.

Проект

маркировки для рынка Российской Федерации на медицинское изделие

**Провод-электрод чреспищеводный для временной электростимуляции
стерильный одноразовый STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018**

Маркировка индивидуальной и вторичной упаковки провода-электрода чреспищеводного для временной электростимуляции стерильного одноразового STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018 содержит следующую информацию:

Наименование изделия (его варианта исполнения)	Провод-электрод чреспищеводный STEZA®- * T2, T3, T4, M2, M3, M4, S2, S3, S4, в зависимости от варианта исполнения
Надпись	«Сделано в России»
	Товарный знак предприятия-изготовителя
ТУ 26.60.13-003-17119413-2018	Обозначение технических условий
РУ № ____ от ____	Номер и дата регистрационного удостоверения
	Уникальный заводской (серийный) номер изделия;
	ЗАО «ЛИДЕР», 117216, Москва, Москва, Грина, д. 7, стр. 1
	Дата выпуска изделия
	Запрет на повторное применение
	«Беречь от влаги»
	Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	Ограничение температуры
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Срок годности изделия
	Не использовать при повреждении упаковки
	Стерильно, стерилизация оксидом этилена
Надпись	«НЕ ТОКСИЧНО»

Маркировка транспортной упаковки провода-электрода чреспищеводного для временной электростимуляции стерильного одноразового STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018 содержит следующую информацию:

Наименование изделия	Провод-электрод чреспищеводный для временной электростимуляции стерильный одноразовый STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018
Надпись	«Сделано в России»
	Товарный знак предприятия-изготовителя
	ЗАО «ЛИДЕР», 117216, Москва, Москва, Грина, д. 7, стр. 1
	«Беречь от влаги»
	Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	Ограничение температуры
Условия транспортирования и хранения	Транспортирование в пределах температур – от минус 50°C до плюс 40°C и относительной влажности до 100% при 25°C. Хранение в пределах температур – от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности до 80% при 25°C.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

3 (три) _____ ЛИС
Бычкова Е.В. _____



М.П.



Закрывтое акционерное общество «ЛИДЕР»

(ЗАО «ЛИДЕР»)

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр.1

Телефон: +7 (499) 130 43 71, info@med-leader.com

ИНН/КПП: 7727797159 / 772701001 ОГРН: 1137746063840

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»



Е. В. Бирюкова


«29» октября 2020 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Провод-электрод чреспищеводный для временной электростимуляции
стерильный одноразовый STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018**

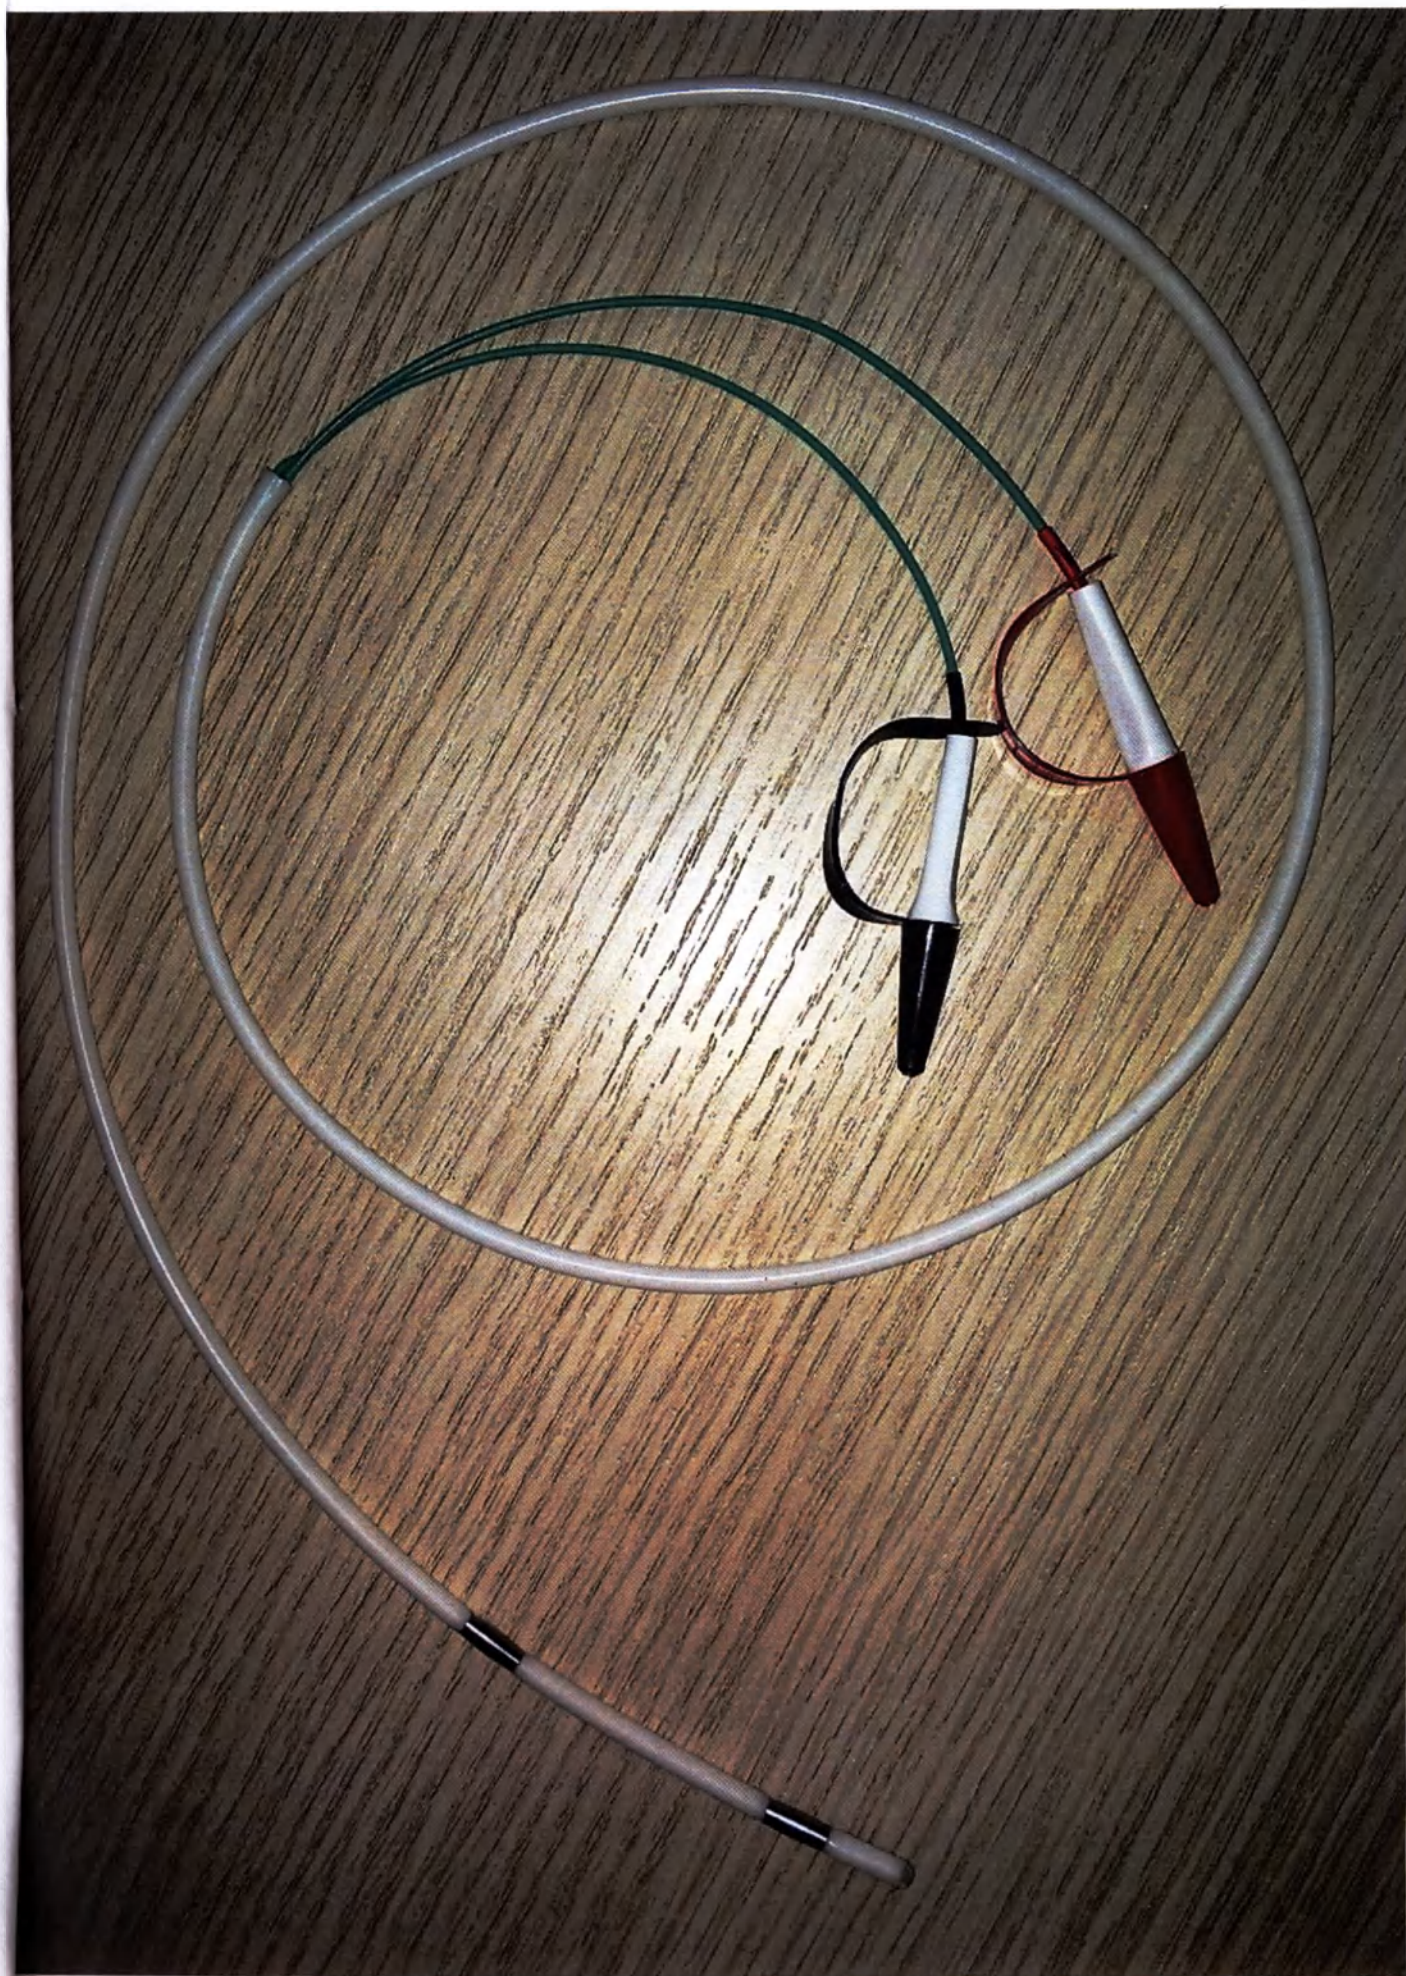


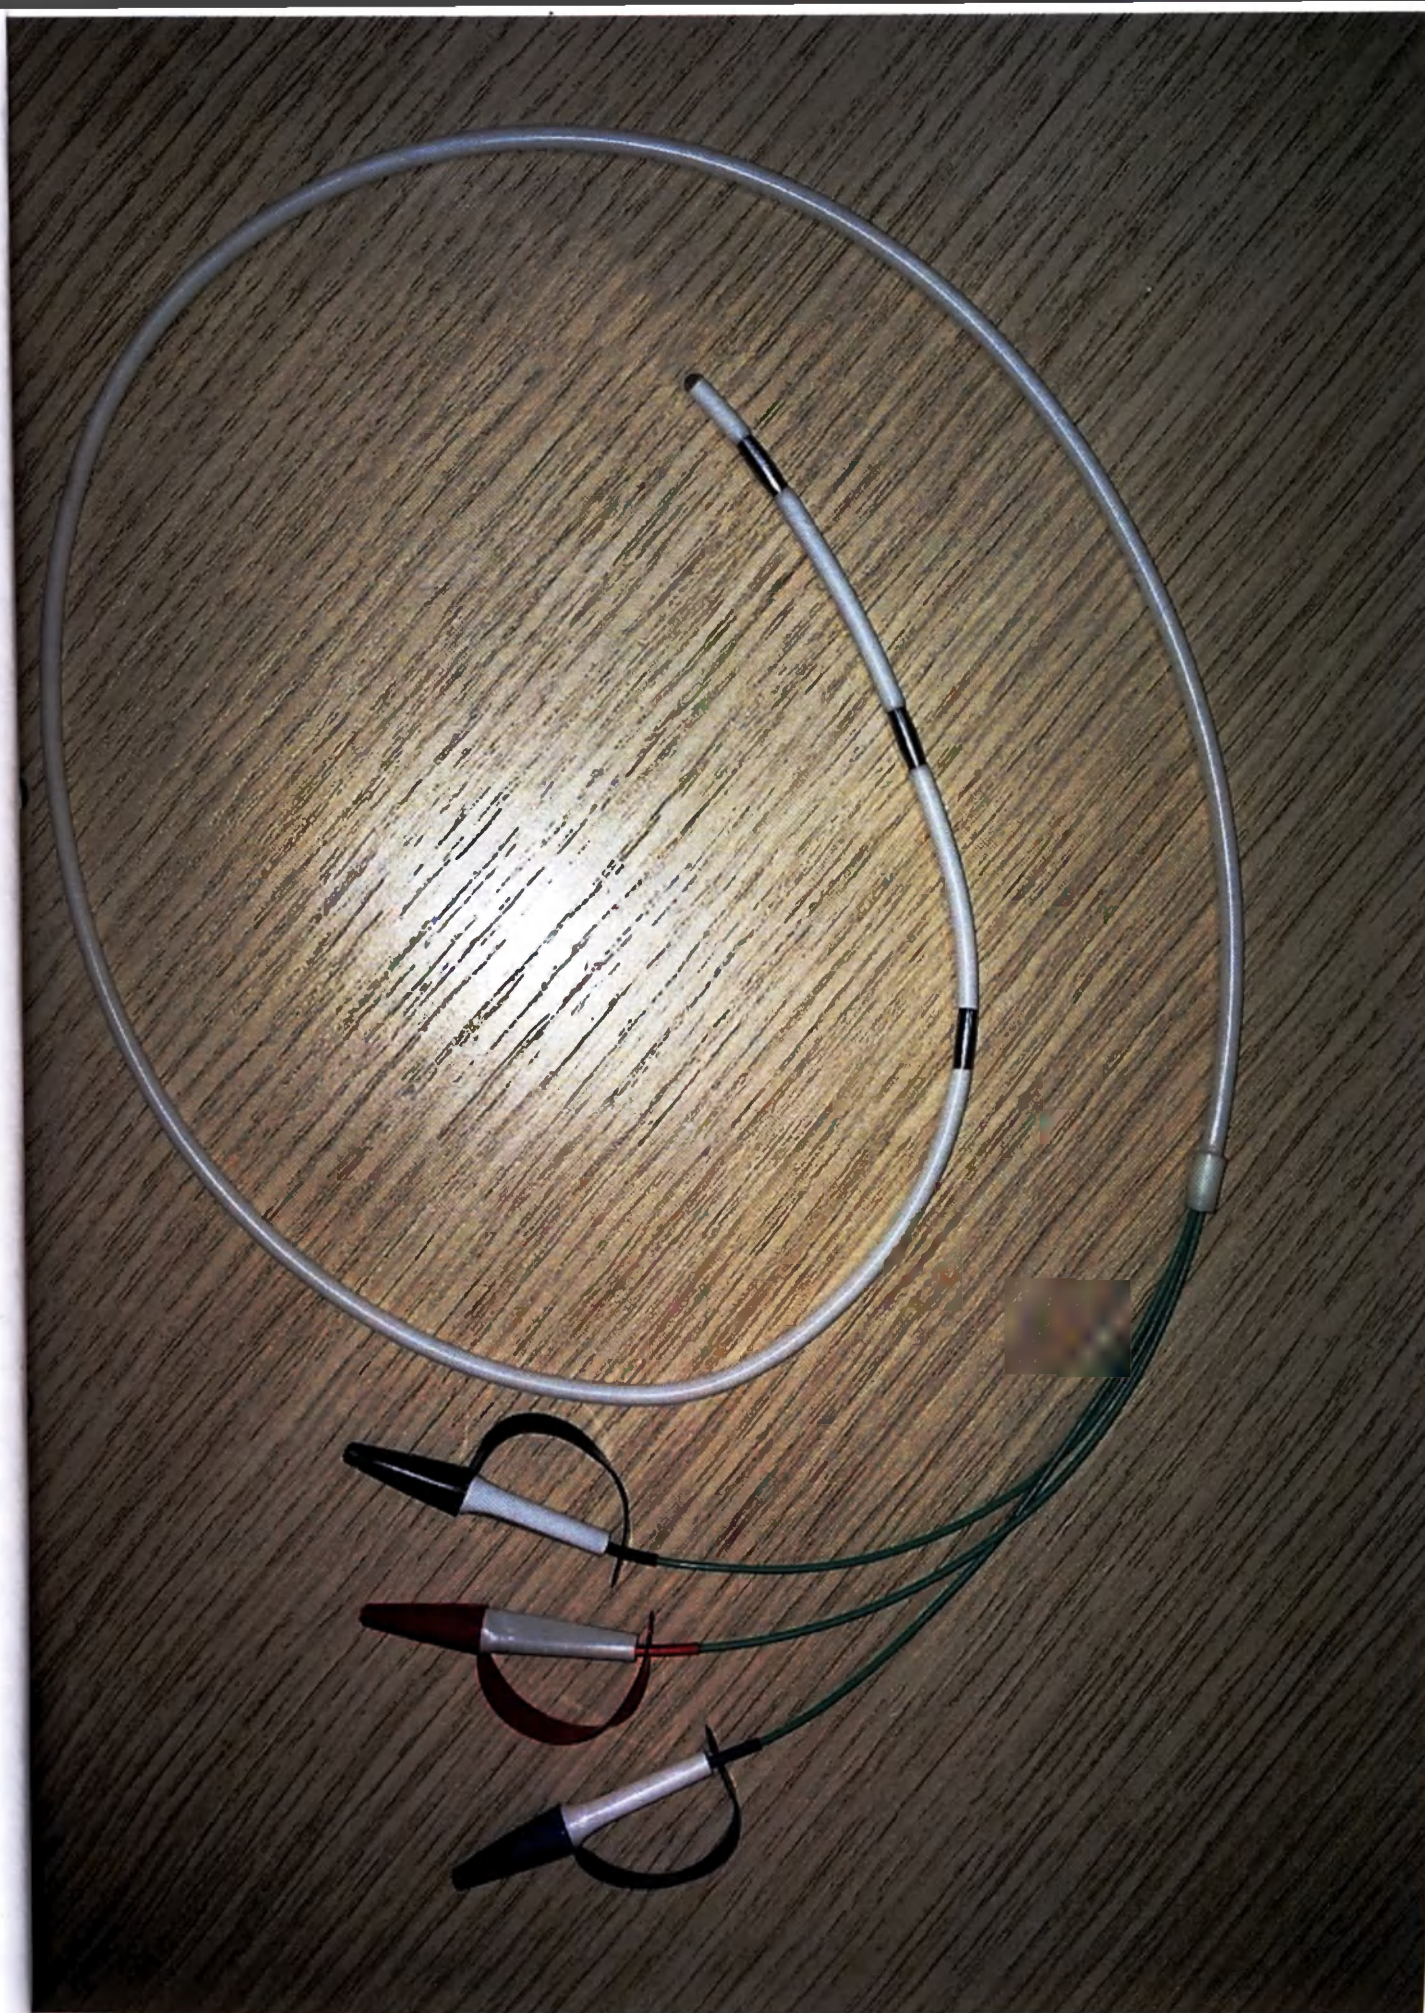


Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-M3

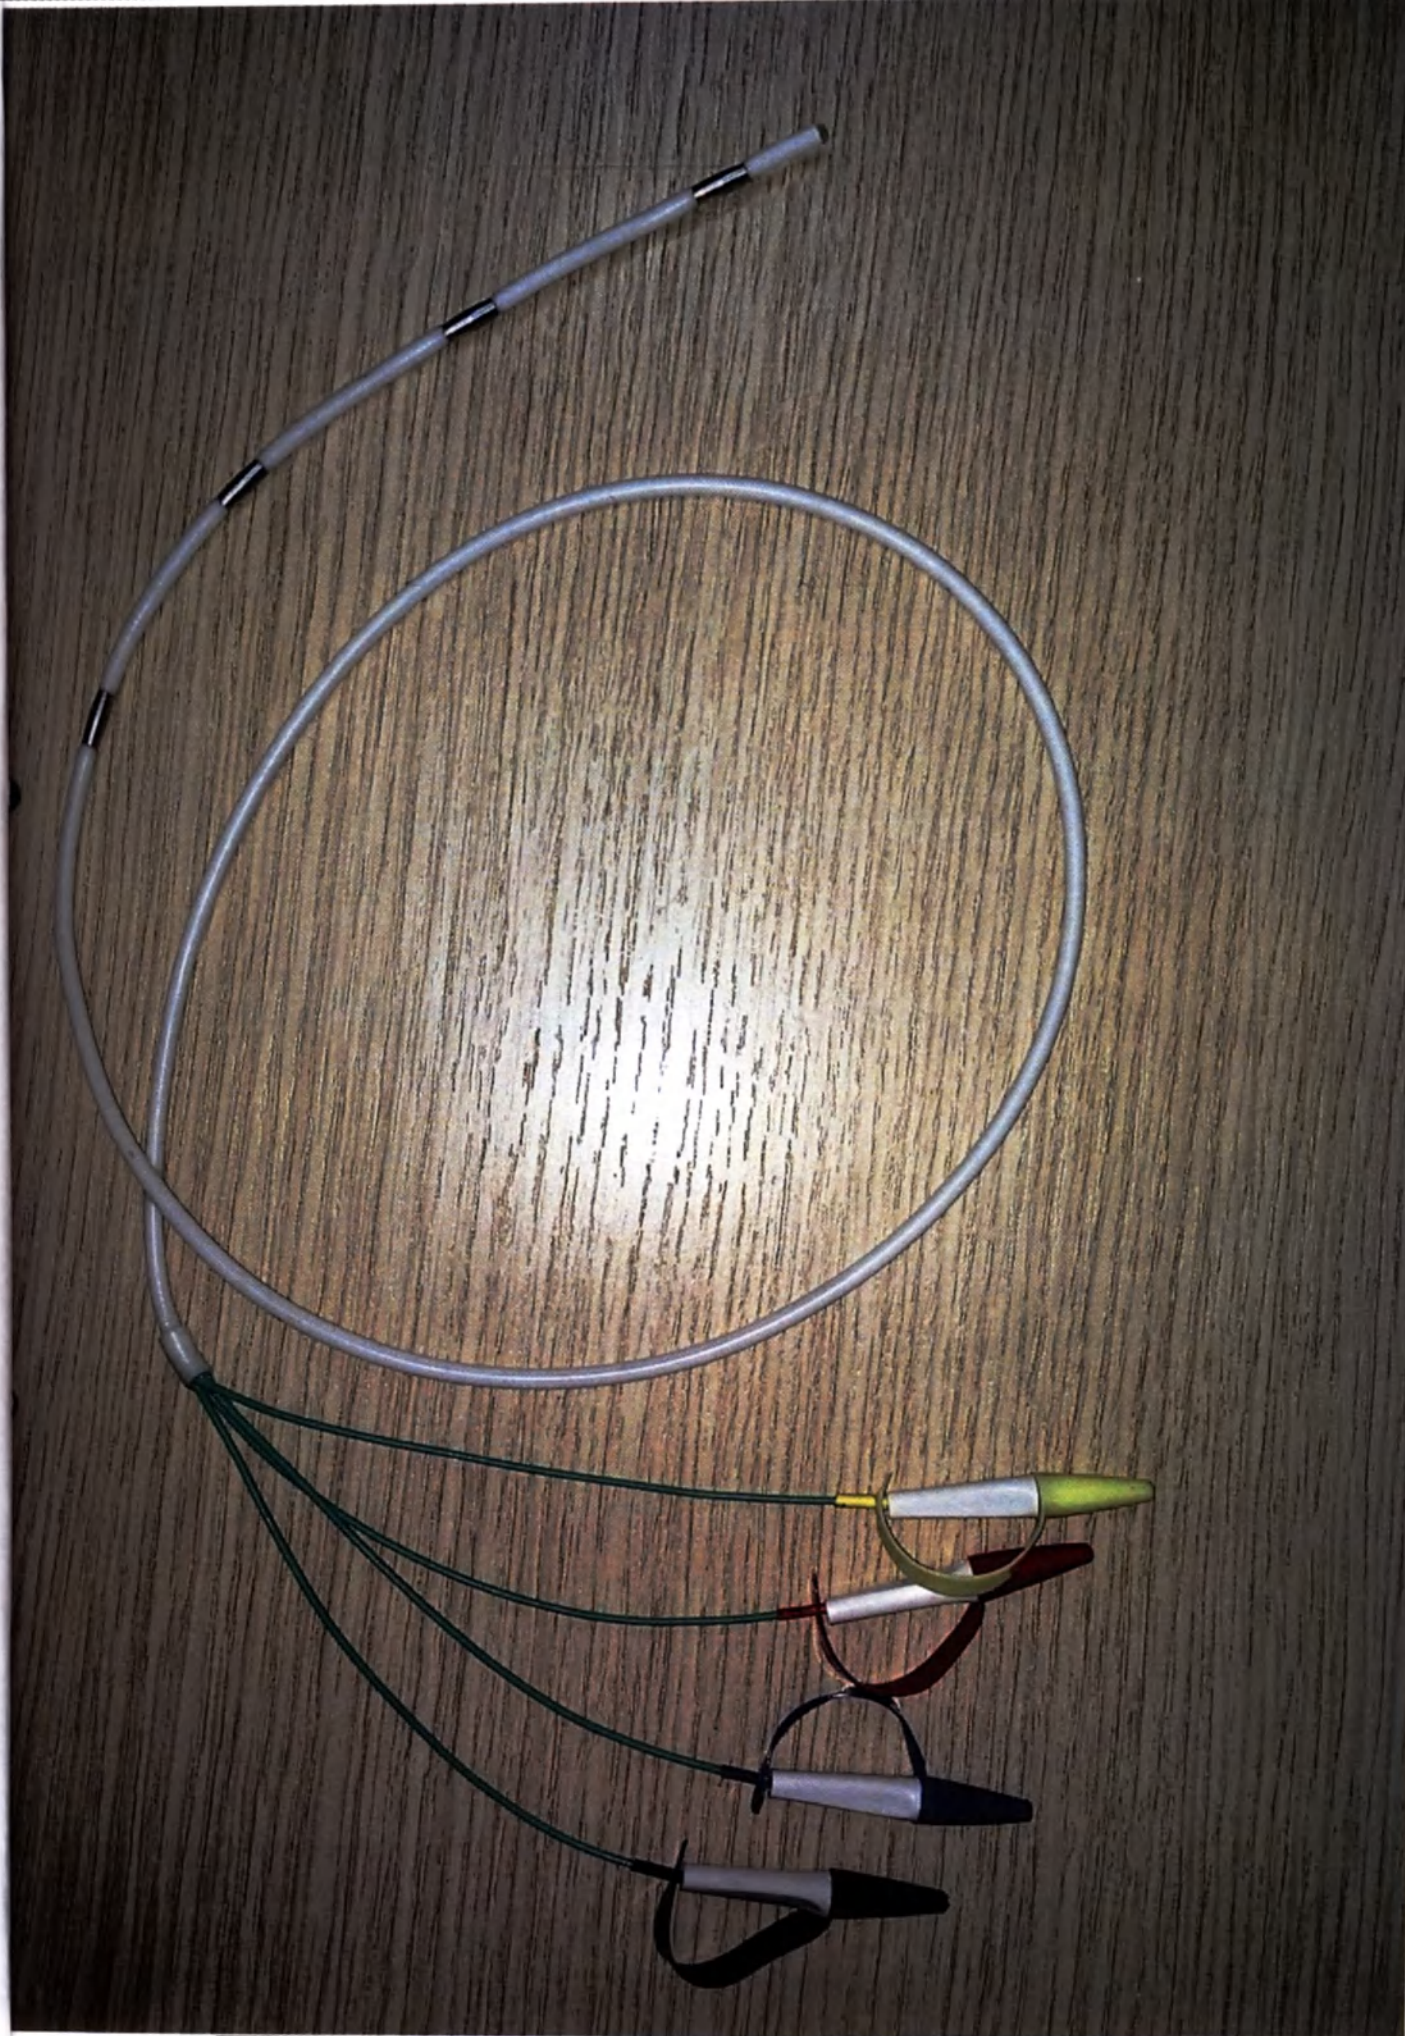


Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-M4

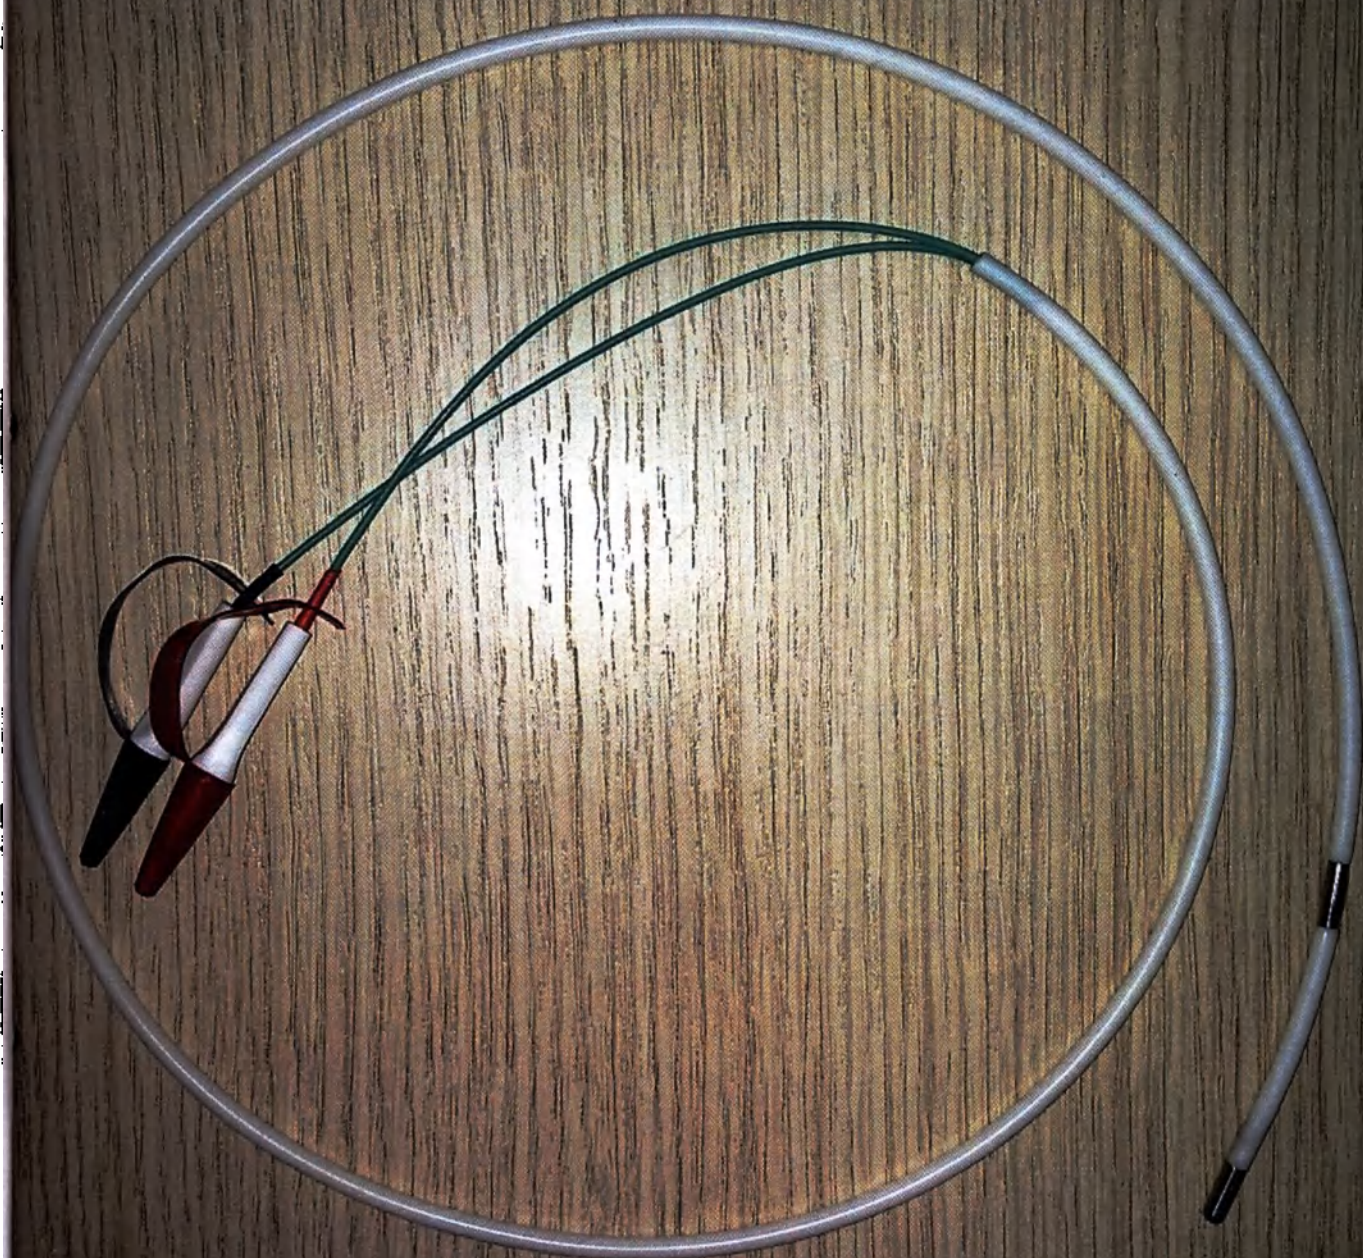


Провод-электрод чреспищеводный STEZA®- T2

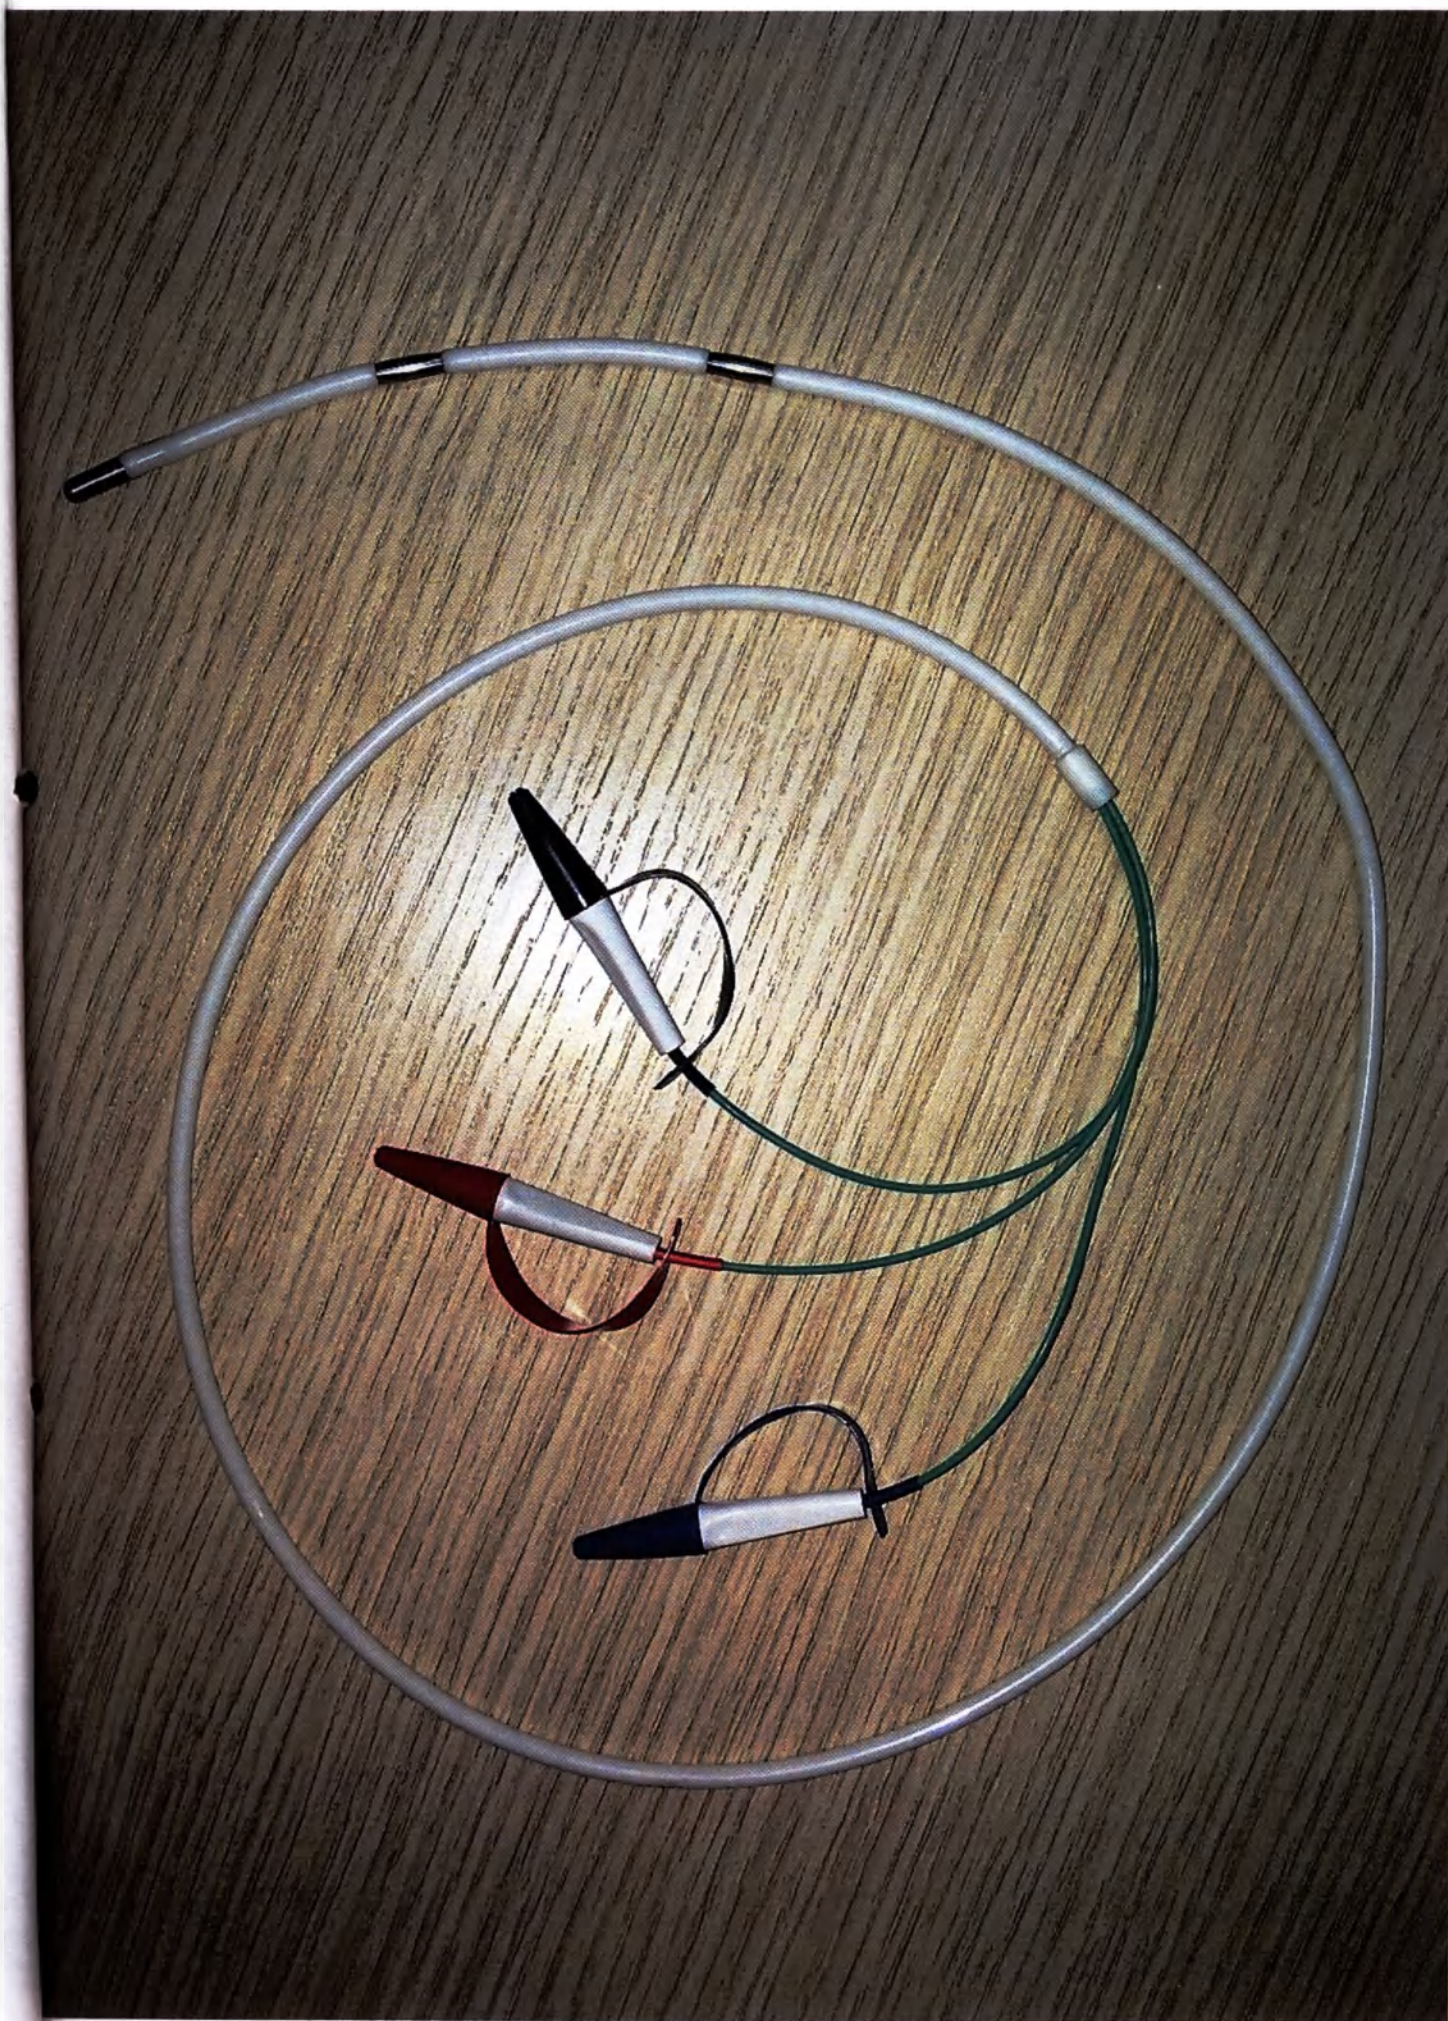


Провод-электрод чреспищеводный STEZA®- T3

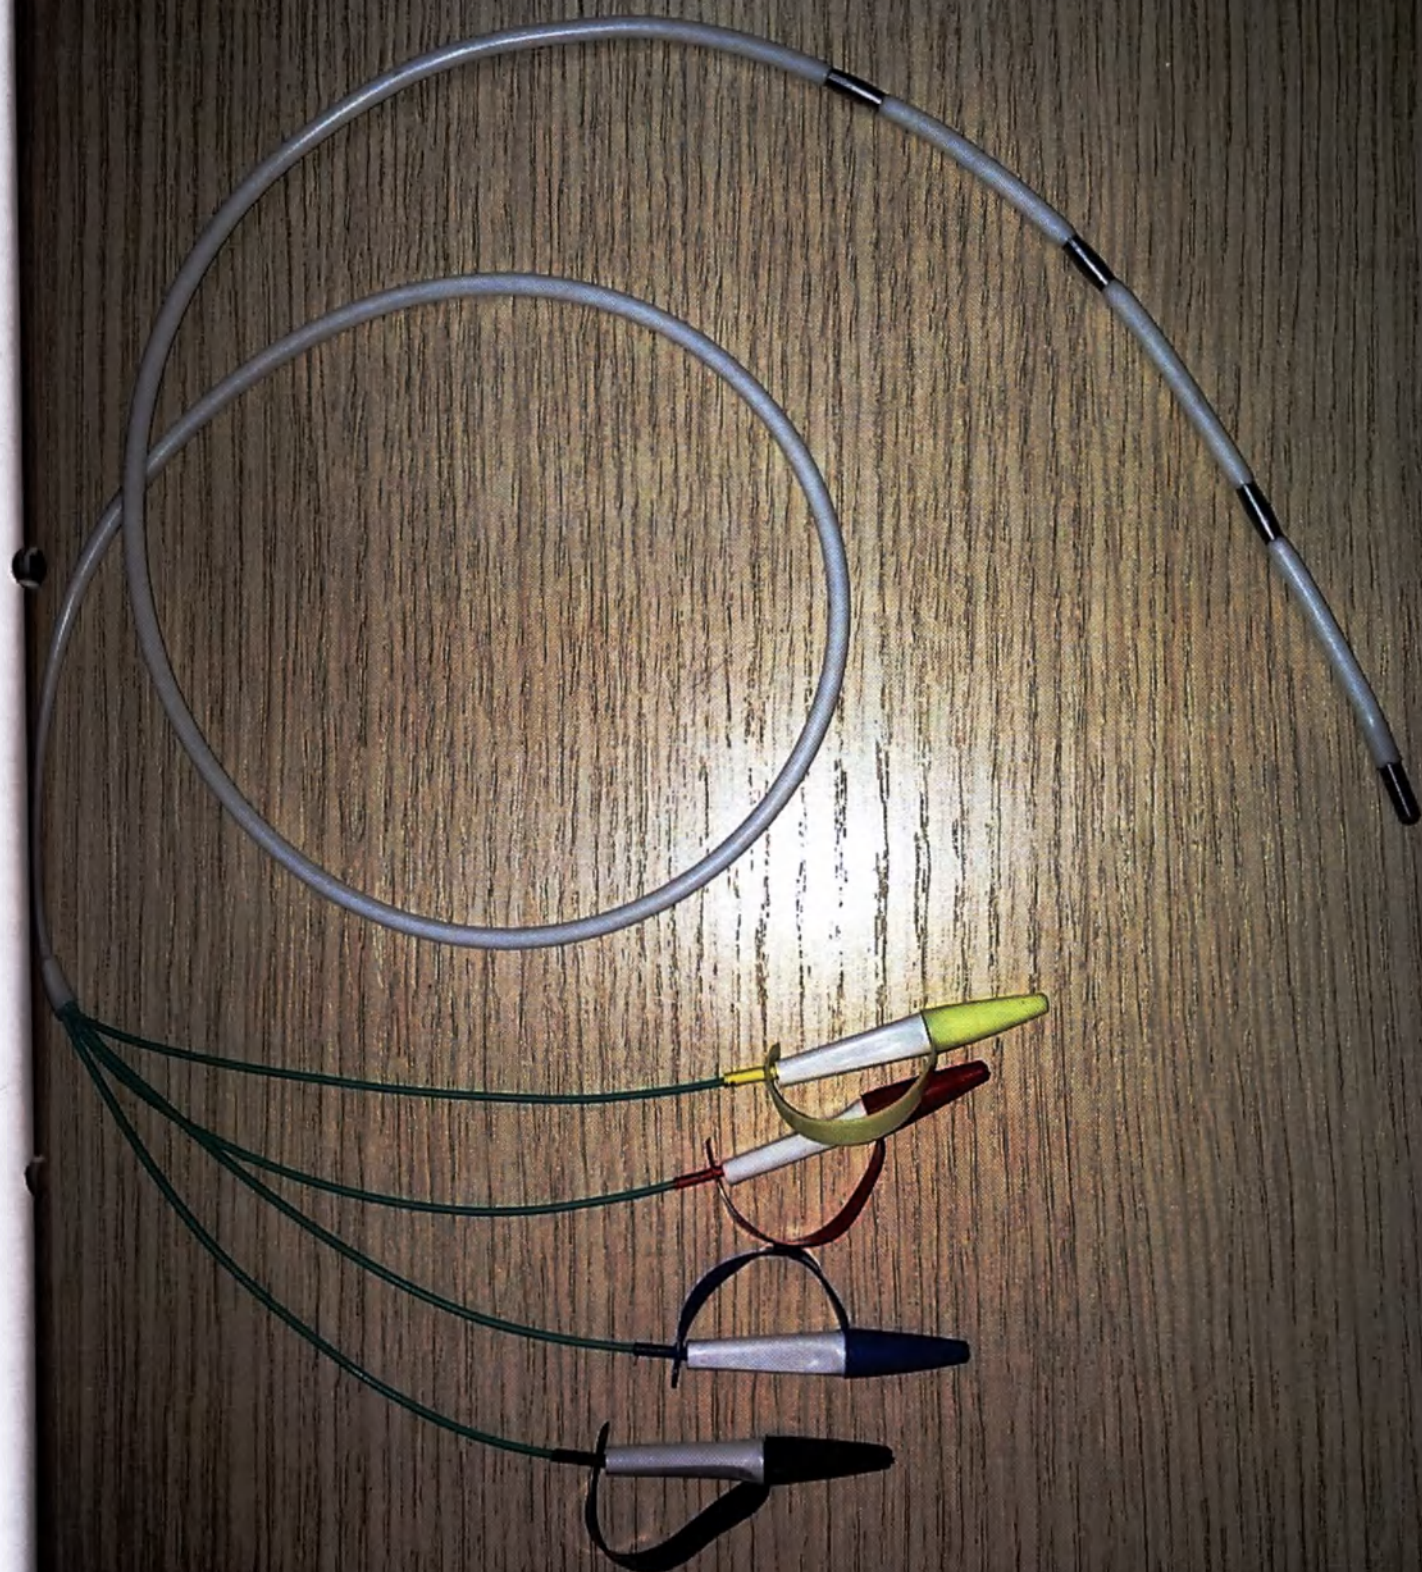


Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-T4

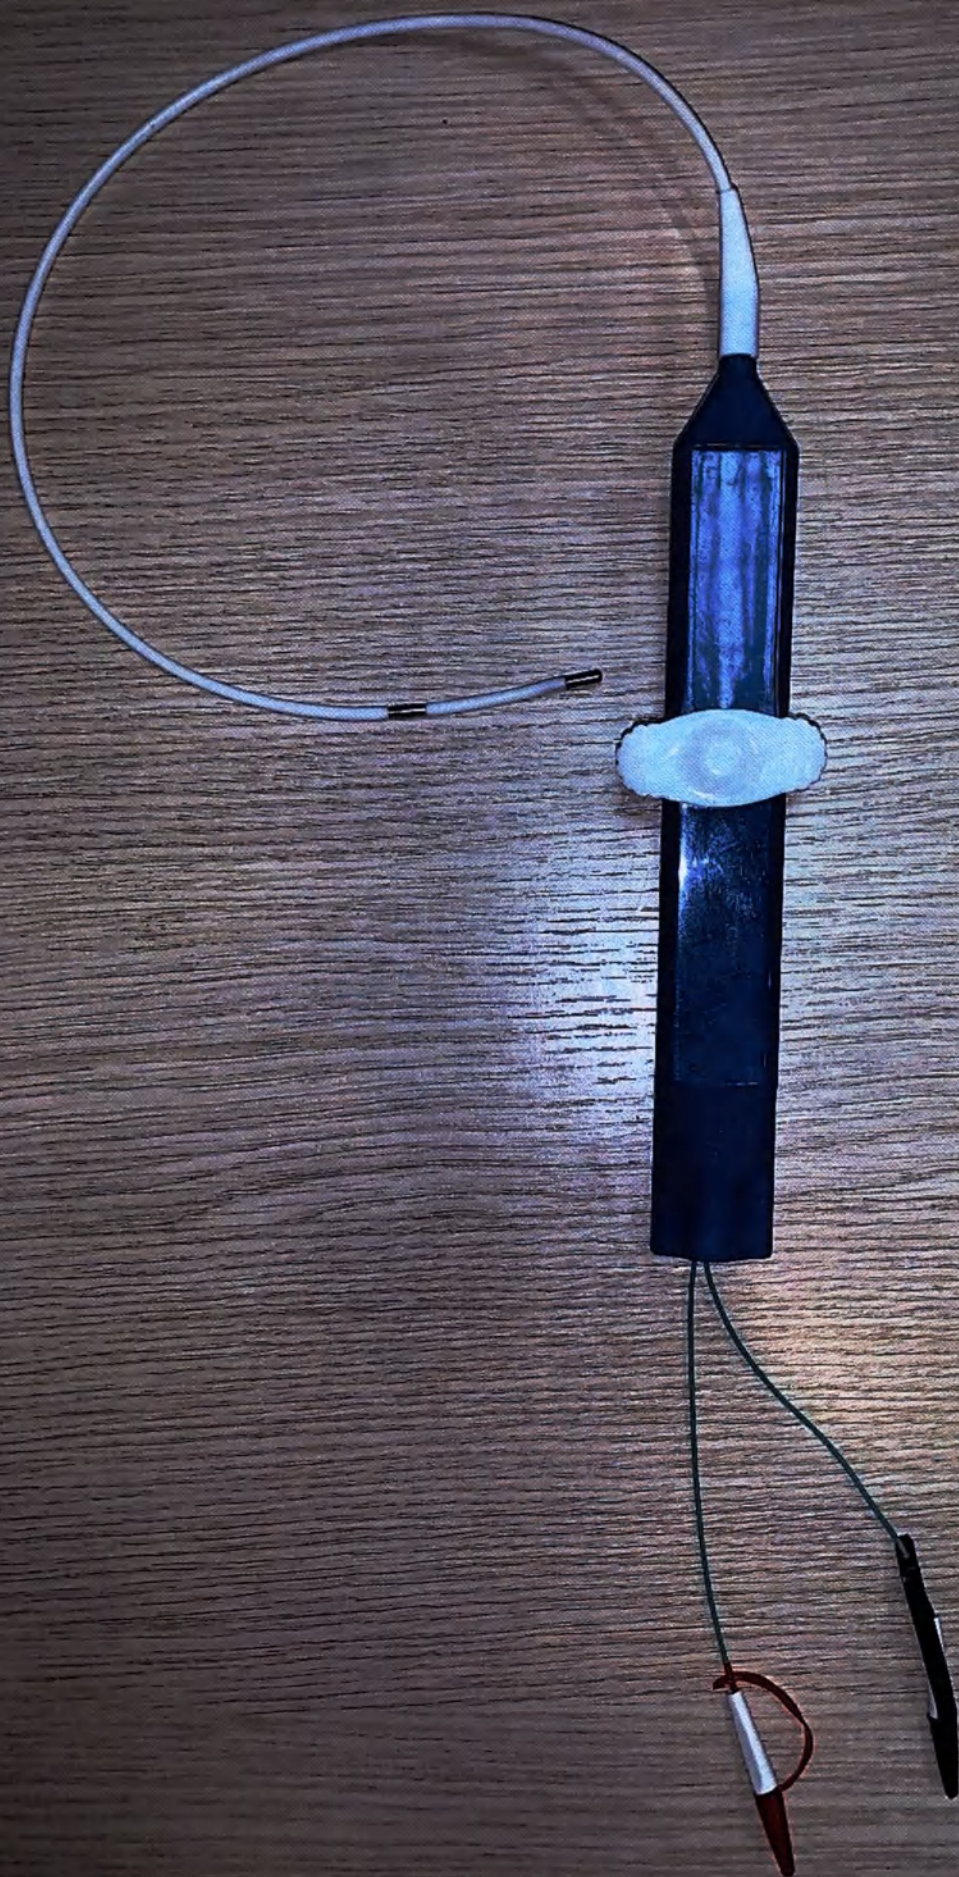

Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-S2

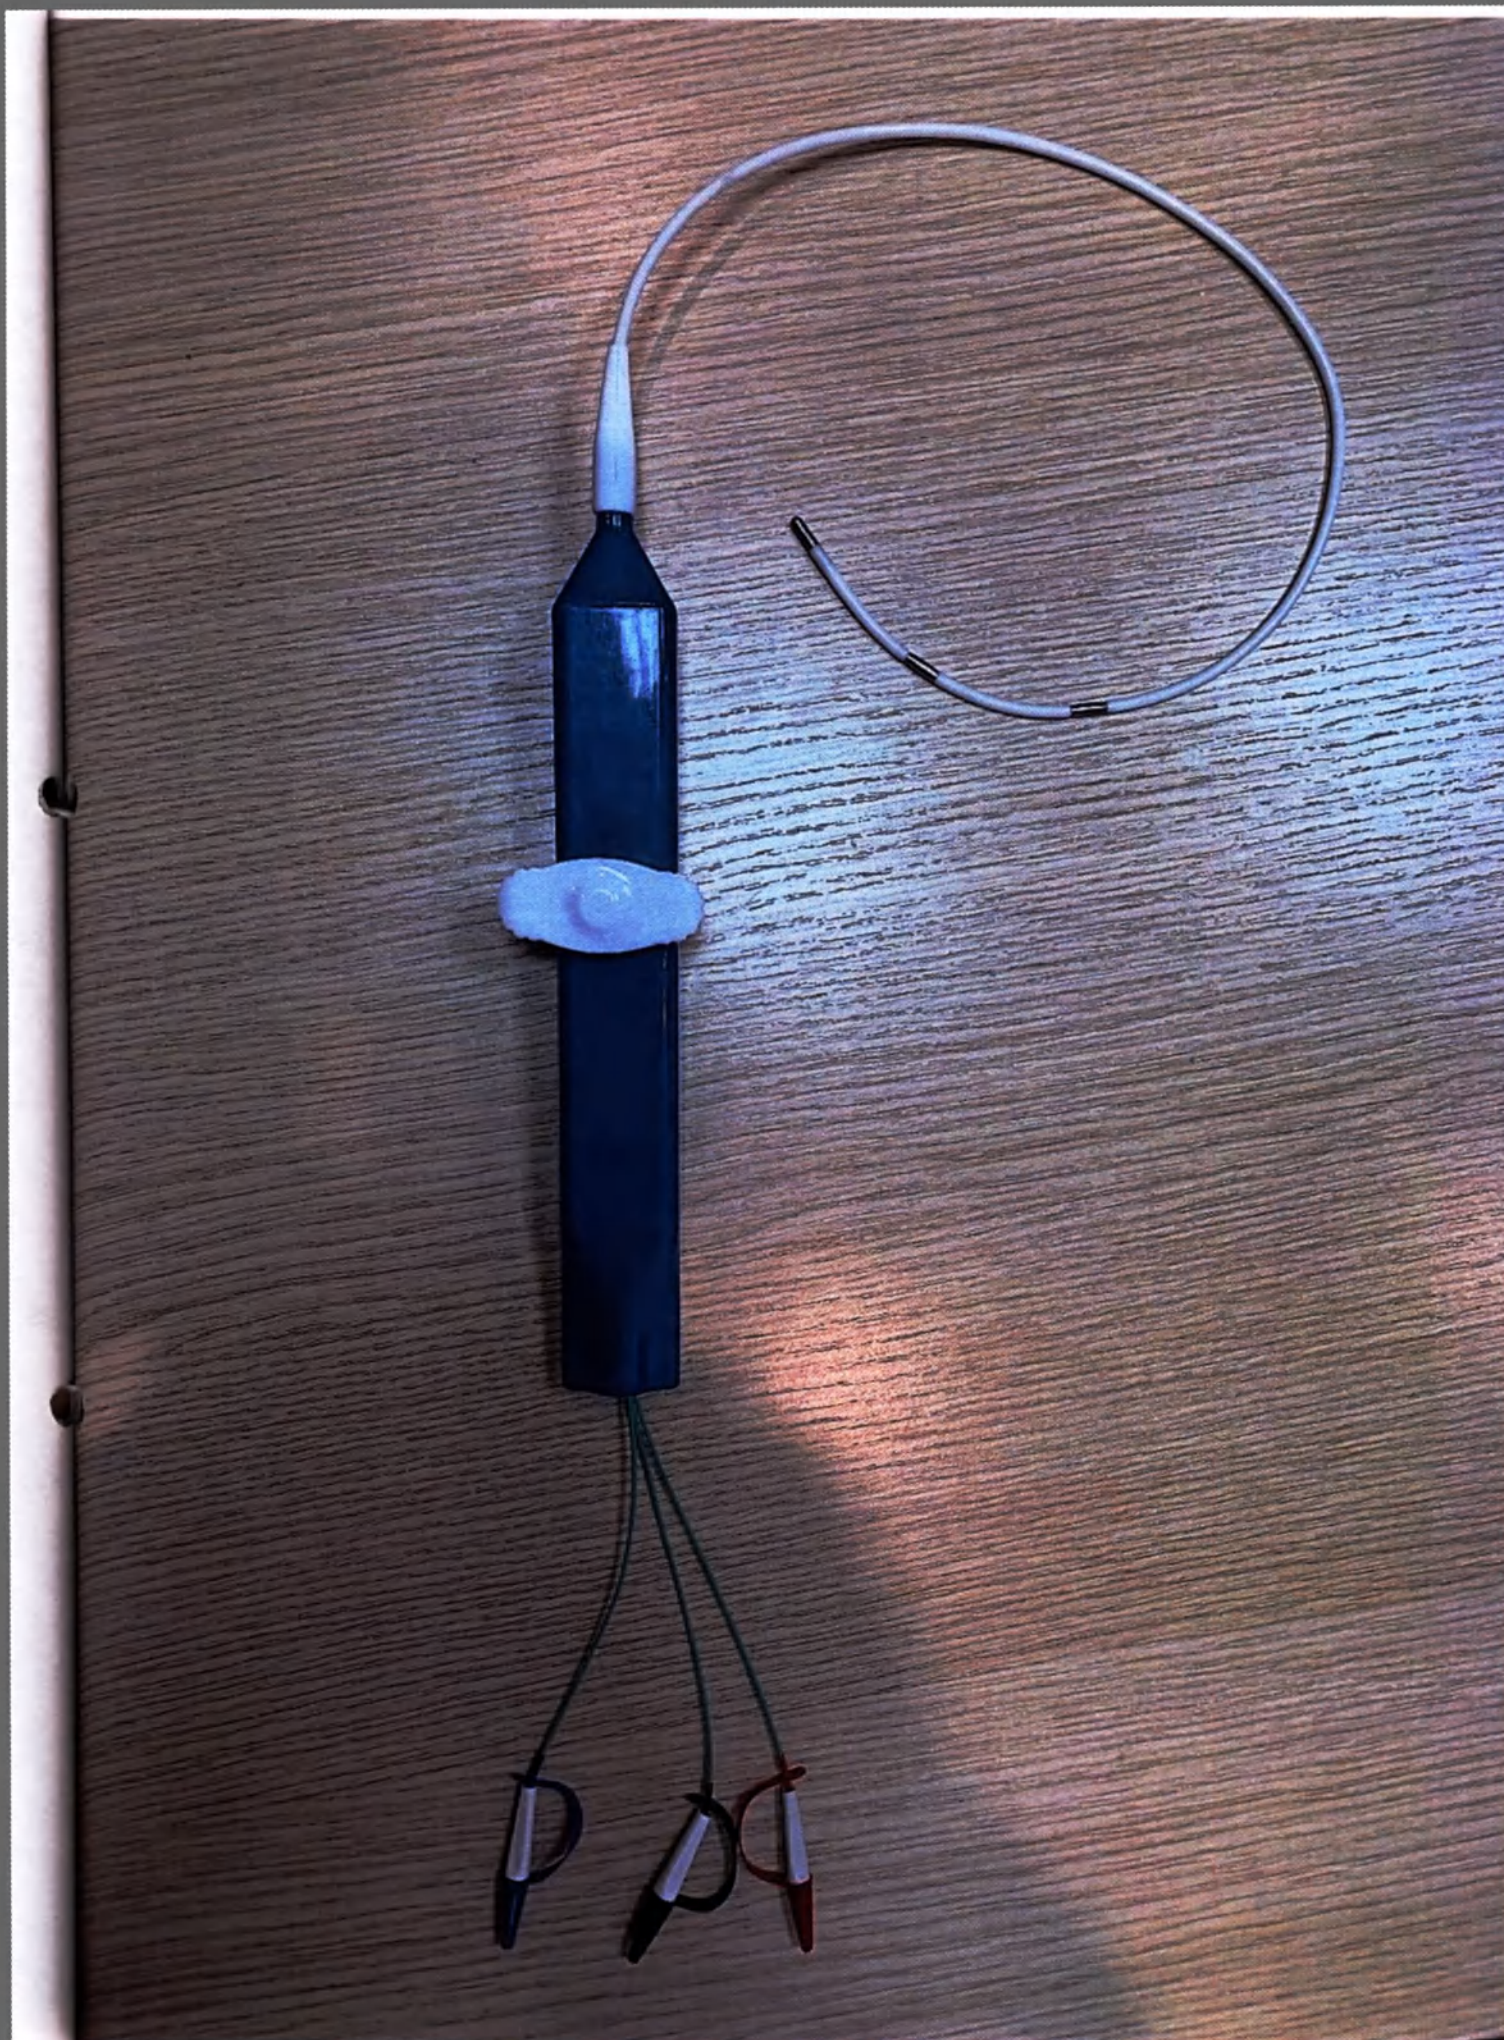

Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-S3

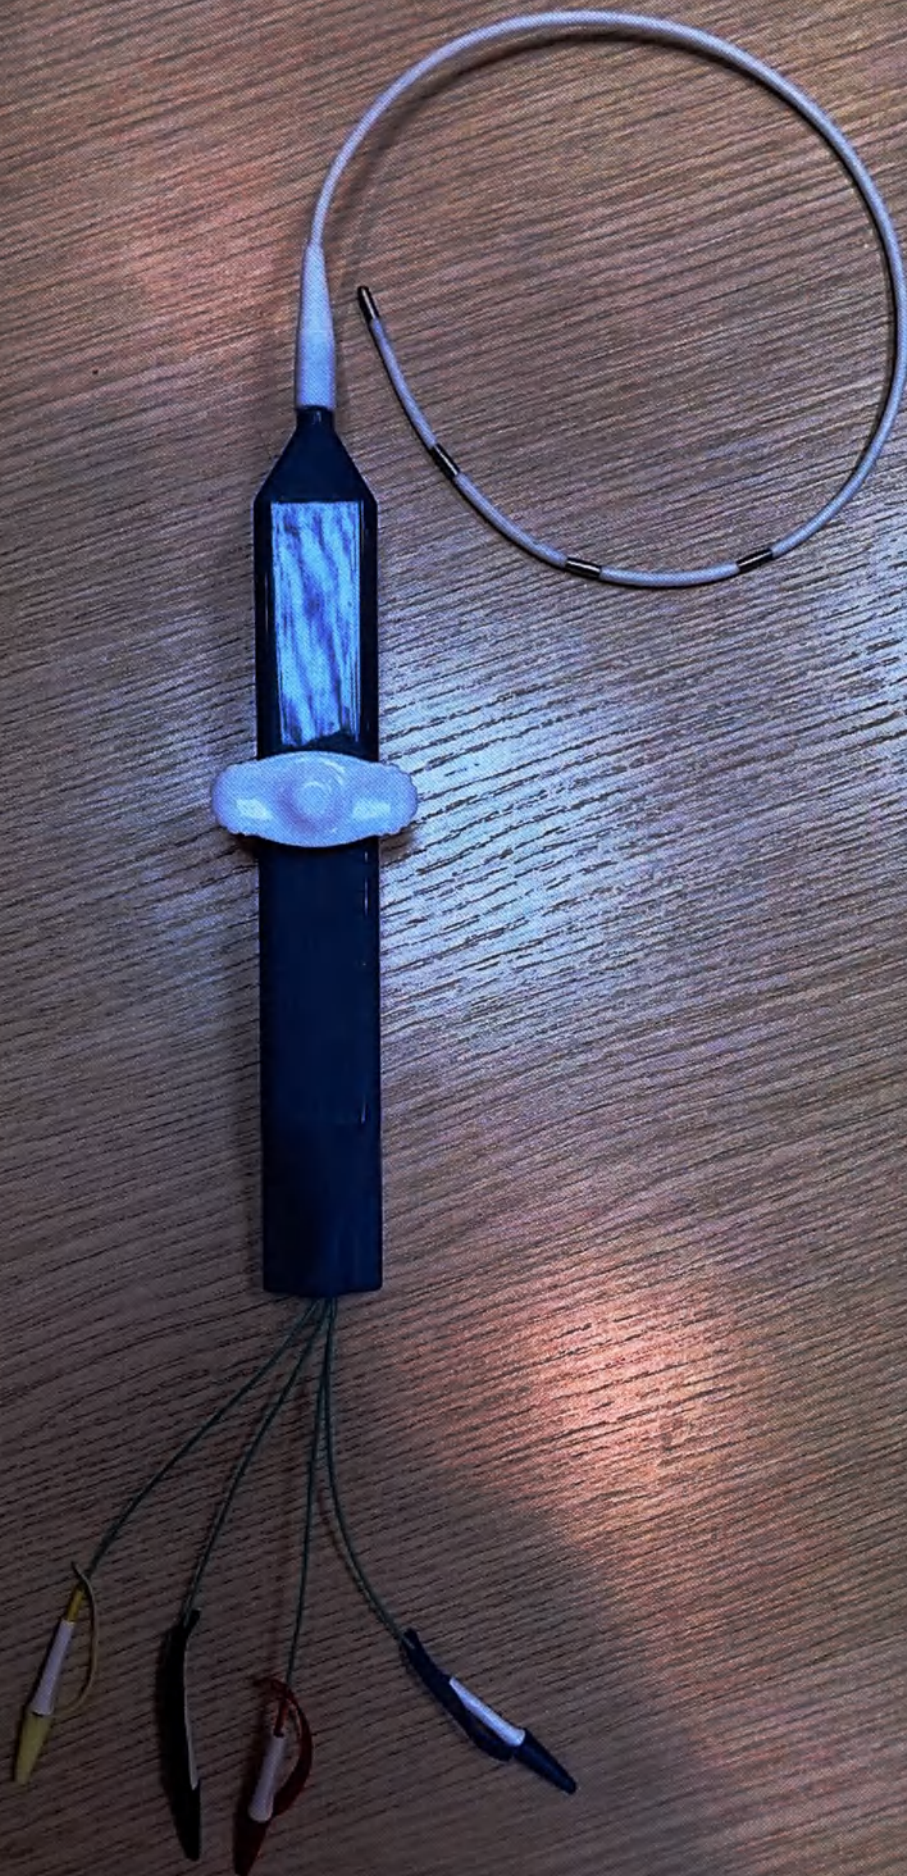

Провод-электрод чреспищеводный STEZA®-S4




ГОСТ ISO 11807
EN 868

Sterit® 250mm Sterit® PKC 200mm



ПОВРЕЖДЕННУЮ УПАКОВКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
DO NOT USE DAMAGED PACK NO USE EL PAQUETE DAÑADO

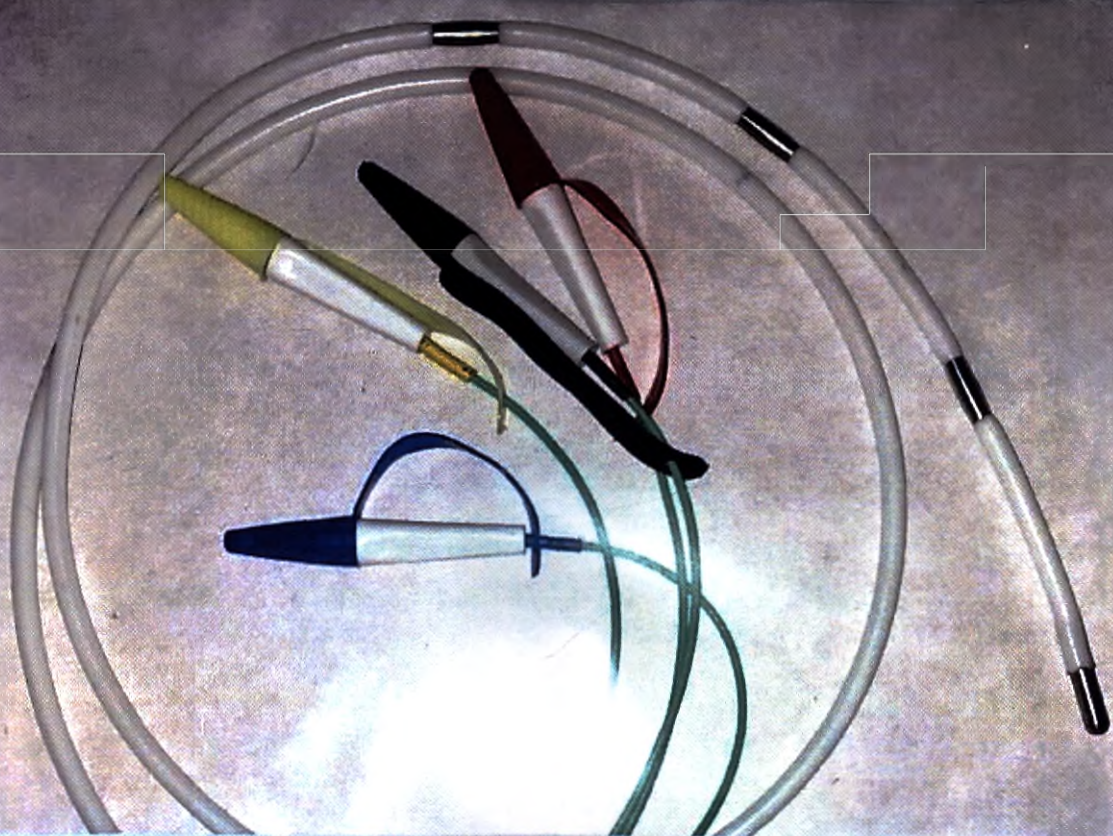

ЛИДЕР

SN

1944T2001


TU

26.60.13-003-17119413-2018

10.2019

10.2021

Провод-электрод чреспищеводный **STEZA®- T2**

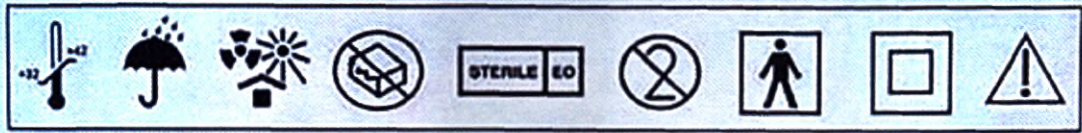

РУ № _____ дата _____

НЕ ТОКСИЧНО



Сделано в России
ЗАО "ЛИДЕР", г.Москва, ул.Грина, д.7, стр.1, тел. +7 (499)-130-43-71

GREEN + POSTERIZADO
FDM to green
FDM to green

ВИНАР

VIÑAR
VINO
VINO

VIÑAR

VIÑAR

фотографическое изображение индивидуальной упаковки с маркировкой на примере варианта исполнения Провод-электрод чреспищеводный



Фотографическое изображение индивидуальной упаковки с маркировкой на примере варианта исполнения Провод-электрод чреспищеводный **STEZA®-S2**

ЛИДЕР

SN

1944T2001

TU

26.60.13-003-17119413-2016




10.2019



10.2021

Провод-электрод чреспищеводный **STEZA® - T2**



РУ № _____ дата _____

НЕ ТОКСИЧНО

Сделано в России



ЗАО "ЛИДЕР", г.Москва, ул.Грина, д.7, стр.1, тел. +7 (499)-130-43-71

Фотографическое изображение вторичной упаковки с маркировкой на
примере варианта исполнения Провод-электрод чреспищеводный

STEZA®-T2

ЛИДЕР

SN

1944S2001

ТУ

26.60.13-003-17119413-2018




10.2019



10.2021

Провод-электрод чреспищеводный **STEZA® - S2**

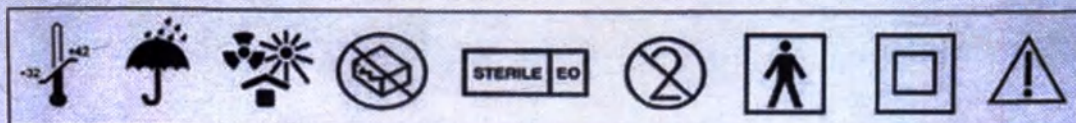

РУ № _____ дата _____

НЕ ТОКСИЧНО

Сделано в России



ЗАО "ЛИДЕР", г.Москва, ул.Грина, д.7, стр.1, тел. +7 (499)-130-43-71

Фотографическое изображение вторичной упаковки с маркировкой на примере варианта исполнения Провод-электрод чреспищеводный

STEZA®-S2



Провод-электрод чреспищеводный для временной
электростимуляции стерильный одноразовый
STEZA® по ТУ 26.60.13-003-17119413-2018

Транспортирование в пределах температур –
от минус 50 до плюс 40°C и относительной
влажности до 100% при 25°C.
Хранение в пределах температур –
от плюс 10 до плюс 35°C и относительной
влажности до 80% при 25°C.



Сделано в России
ЗАО "ЛИДЕР", г. Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 1, тел. +7 (499) 130-43-71

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

15 (Пятнадцать) листов
Бычкова Е.В.

