


Фотографические изображения

**Реагент в кассете для количественного определения фибриногена методом Клаусса
в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (Fibrinogen
/ Fibrinogen cobas t systems)**

Реагент в кассете для количественного определения фибриногена методом Клаусса в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (Fibrinogen / Fibrinogen cobas t systems)

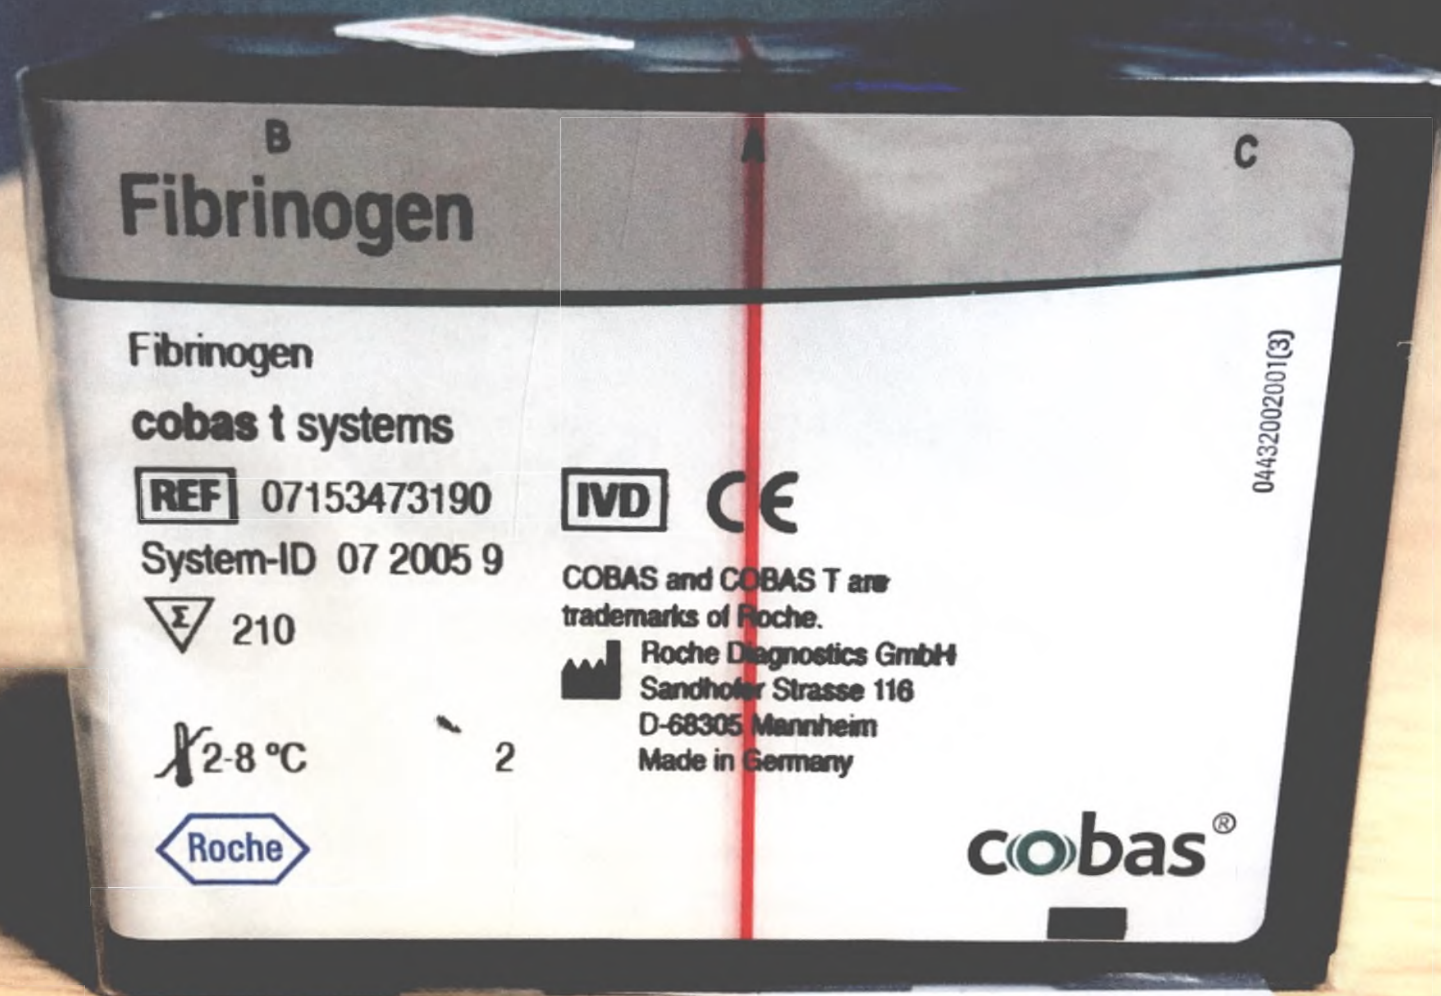

Реагент в кассете для количественного определения фибриногена методом Клаусса в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (Fibrinogen / Fibrinogen cobas t systems)

Fibrinogen



REF 07153473190

GTIN 07613336118887



07153473190 ≥ V1 CE
<http://e-labdoc.roche.com>



EU: +800 5505 6606



LOT 41119401



2020-12-31



2019-08-30

1

Ser.No. 01732

Fibrinogen

07153473190

02

Реагент в кассете для определения тромбинового времени (ТВ) в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (TT / Thrombin Time cobas t systems)

Реагент в кассете для количественного определения фибриногена методом Клаусса в цитратной плазме на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (Fibrinogen / Fibrinogen cobas t systems)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, D- 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07163473190

реагент в кассете для определения тромбинового времени (ТВ) в цитратной плазме
на анализаторах гемостаза автоматических cobas t (TT / Thrombin Time cobas t
systems)

