

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «МИП-Тест»
Жвакина Е.Е.

« 15 » 12 2020 года




Фотографические изображения на медицинское изделие:

Установка лазерная медицинская Dornier варианты исполнения:
Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier
Medilas H Solvo 35, с принадлежностями


«Установка лазерная медицинская Dornier варианты исполнения: Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier Medilas H Solvo 35, с принадлежностями».

I. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H Solvo:


1. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H Solvo;

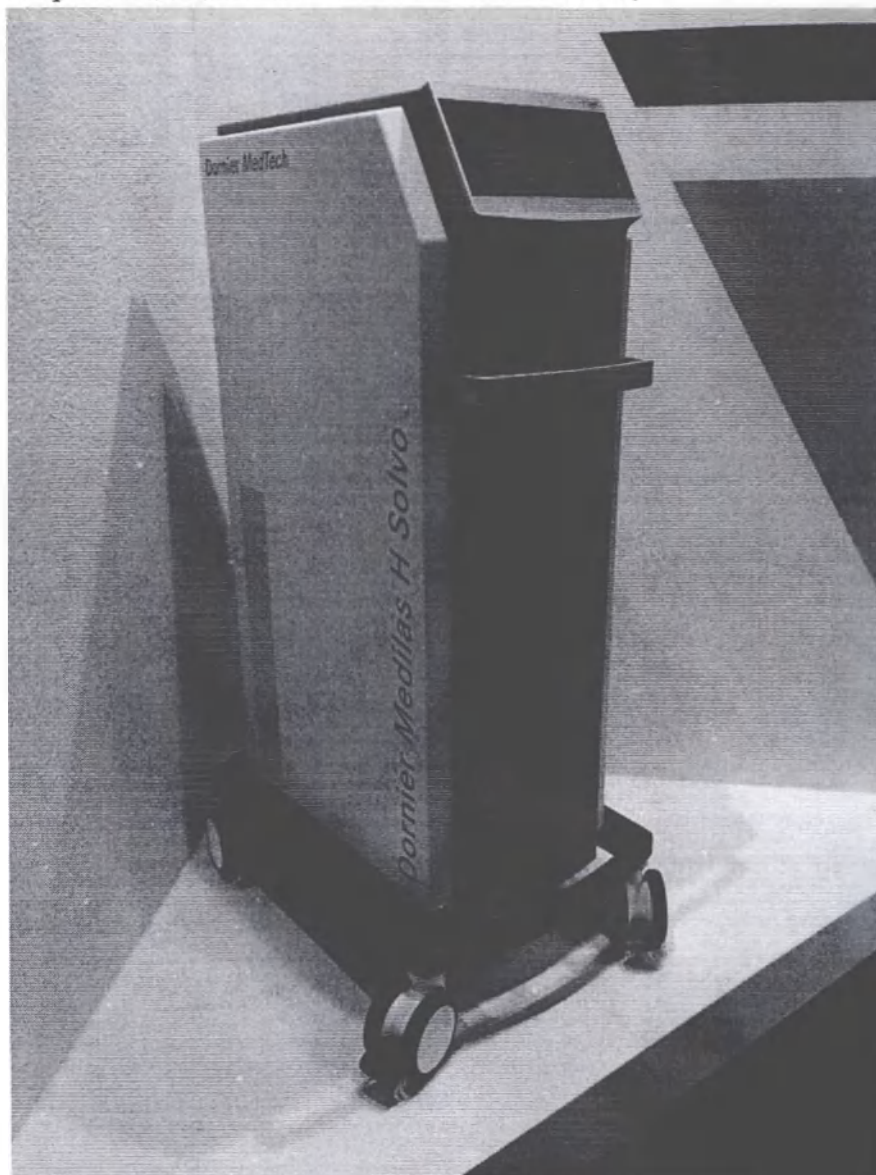


2. Очки защитные от лазерного излучения, защита D 2100 (Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02076);

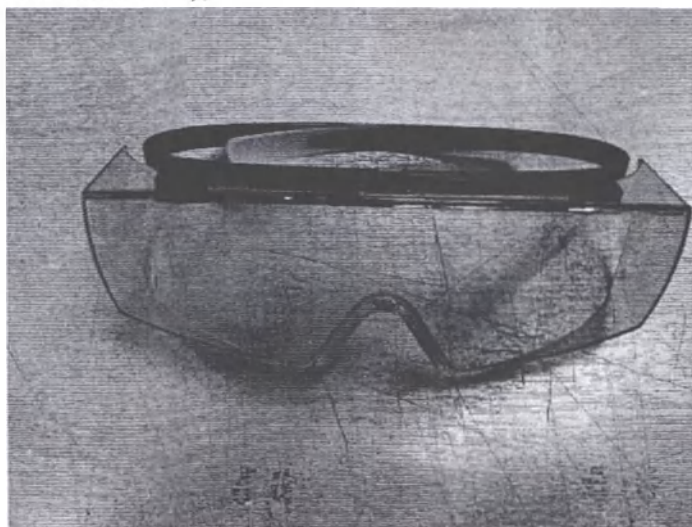


3. Педаль ножная проводная или беспроводная 1 шт.;

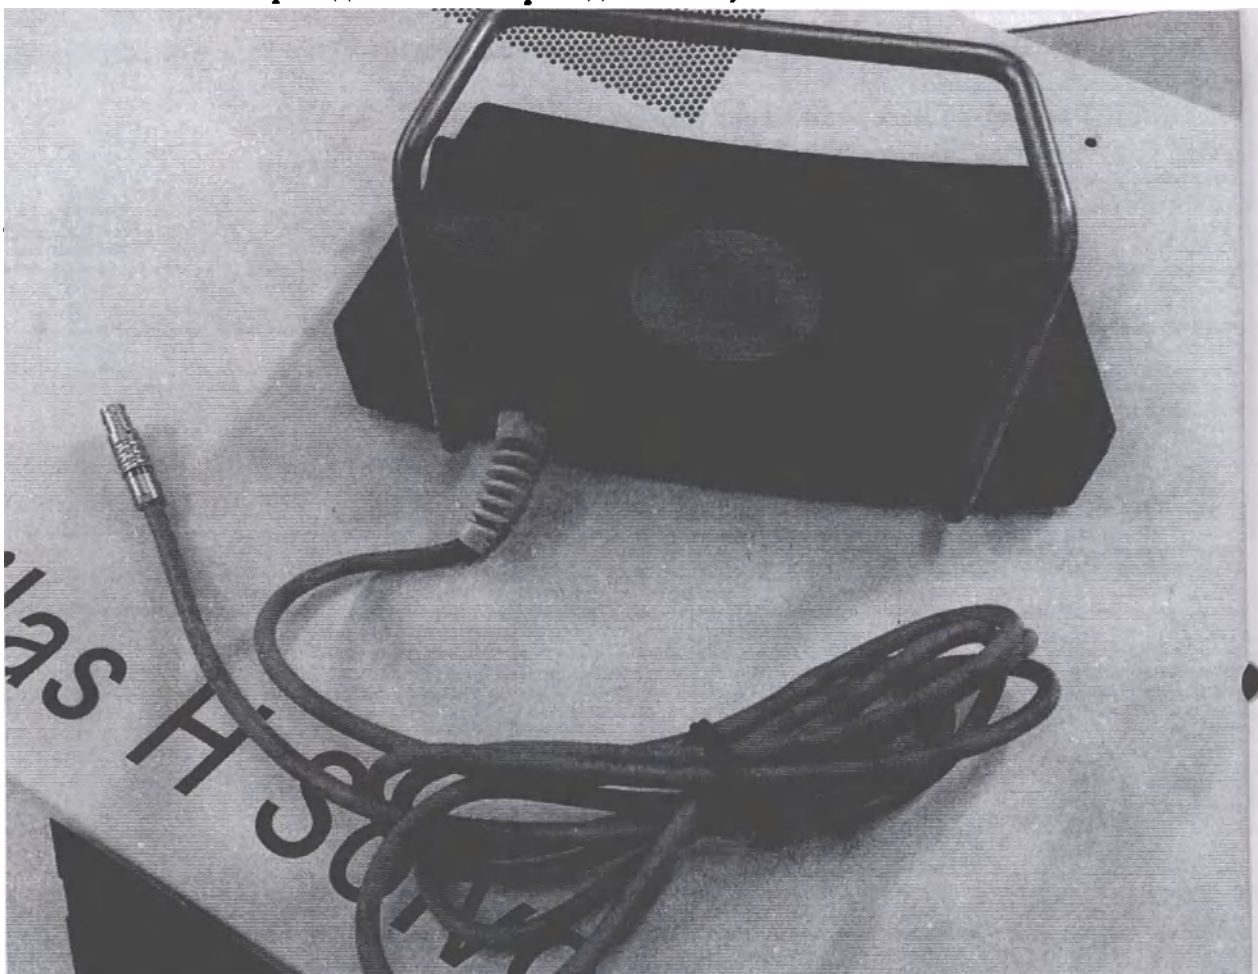

4. Фильтр защитный для эндоскопа, 1 шт.;

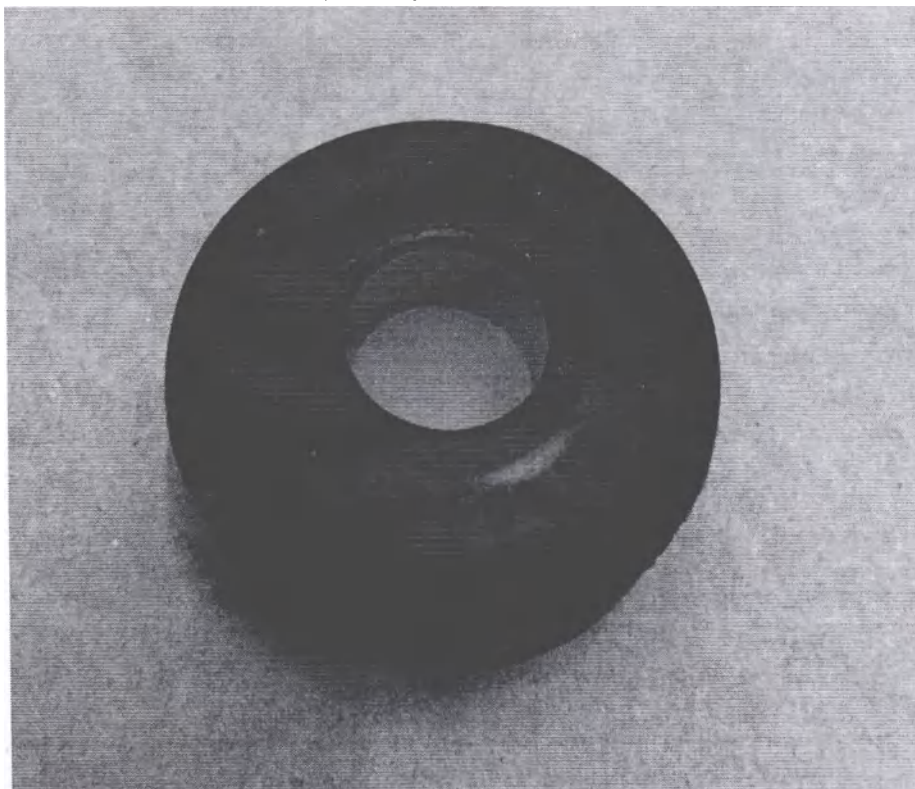

5. Разъем (штекер) выключателя блокировки двери (для контакта блокировки двери), 1 шт.;

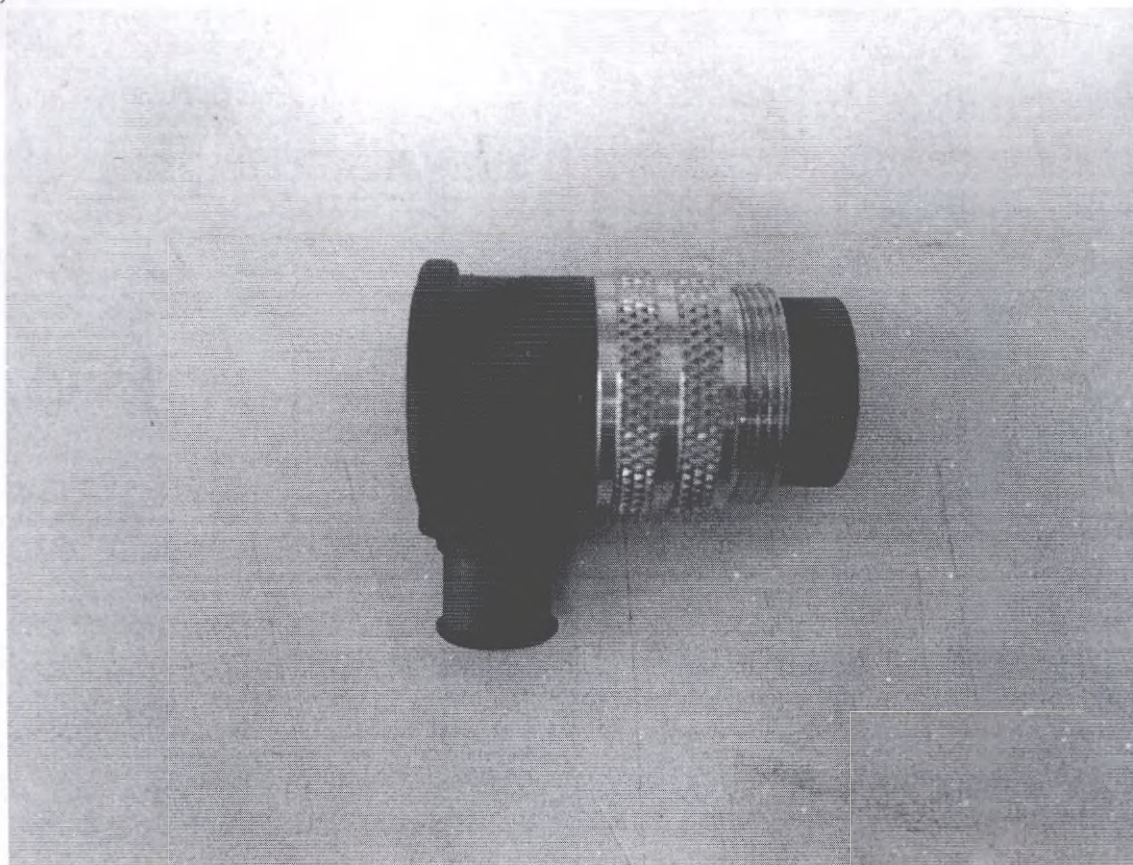

6. Кабель сетевой типа С19 длина 3 м, 1 шт.;




7. Руководство по эксплуатации, 1 шт.



Operating Manual

Dornier Medilas H30

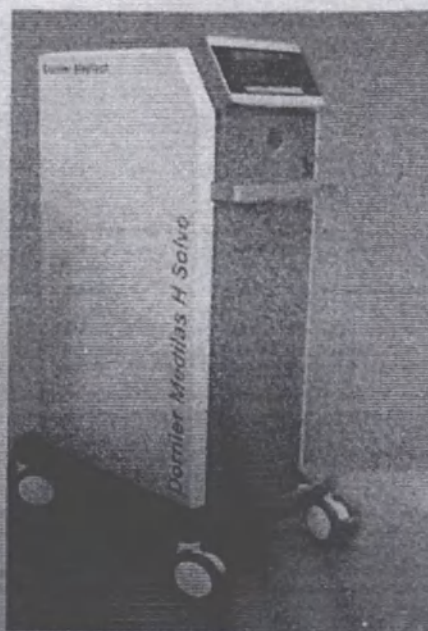

Dornier Medilas H Solvo

CE1275

English

(Translation from German language)

The order number for this User's Manual: k2013697

Domier MedTech

7. Руководство по эксплуатации, 1 шт.



Operating Manual

Dornier Medilas H30



Dornier Medilas H Solvo

CE1275

English


(Translation from German language)

The order number for this User's Manual: K2013697


Dornier MedTech

II. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H UroPulse:


1. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H UroPulse;

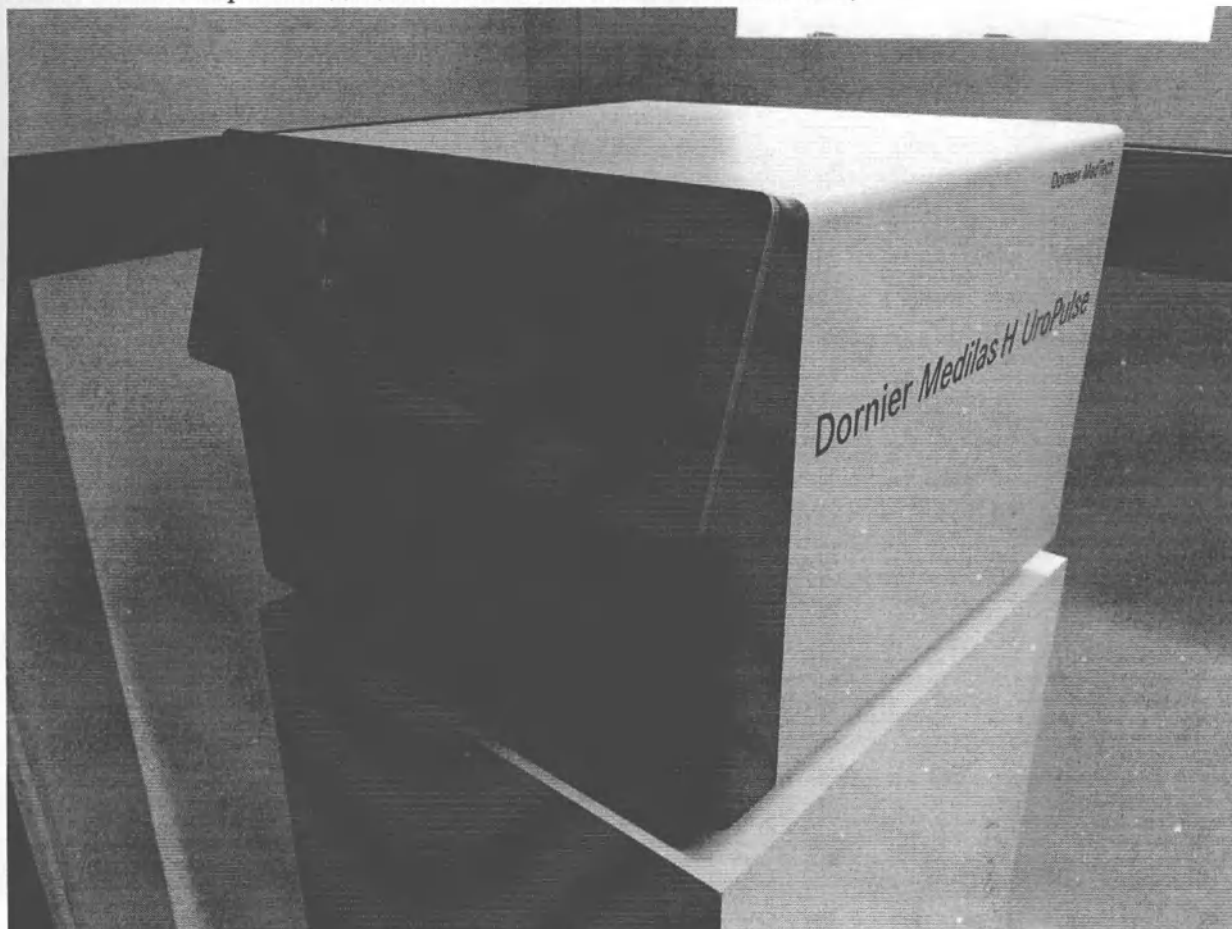

2. Очки защитные от лазерного излучения, защита D 2100 (Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02076);

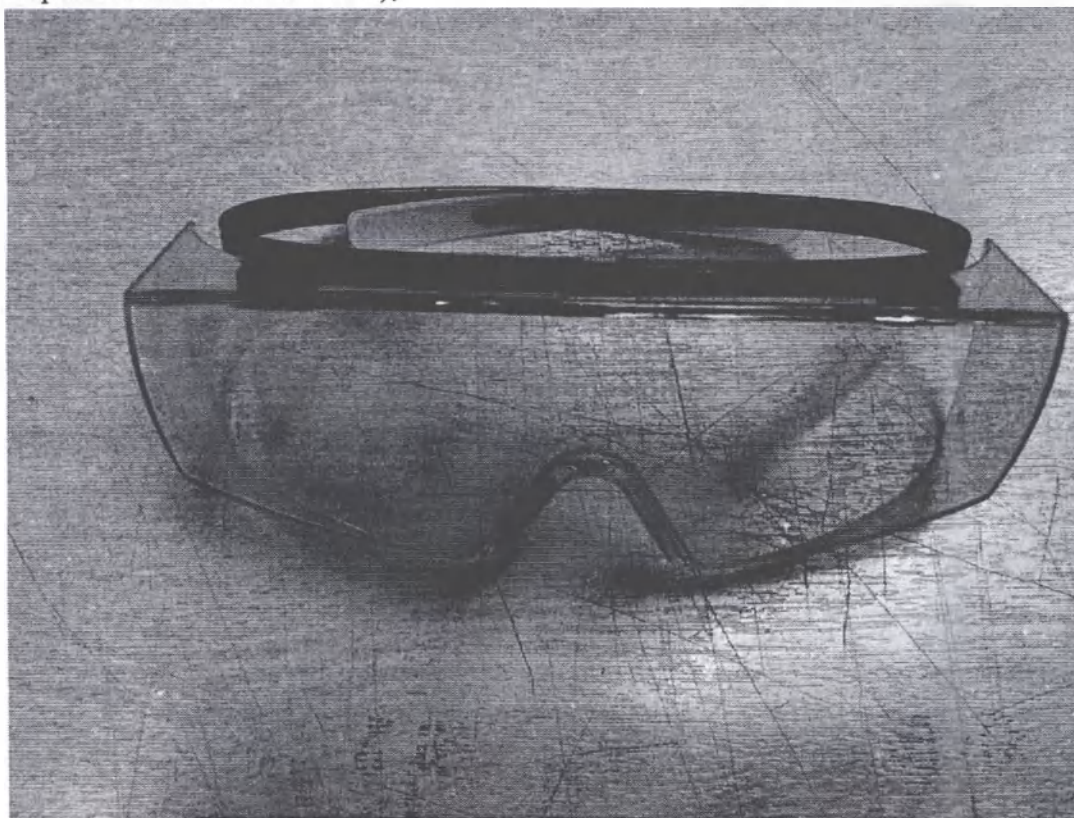


3. Педаль ножная проводная или беспроводная 1 шт.;

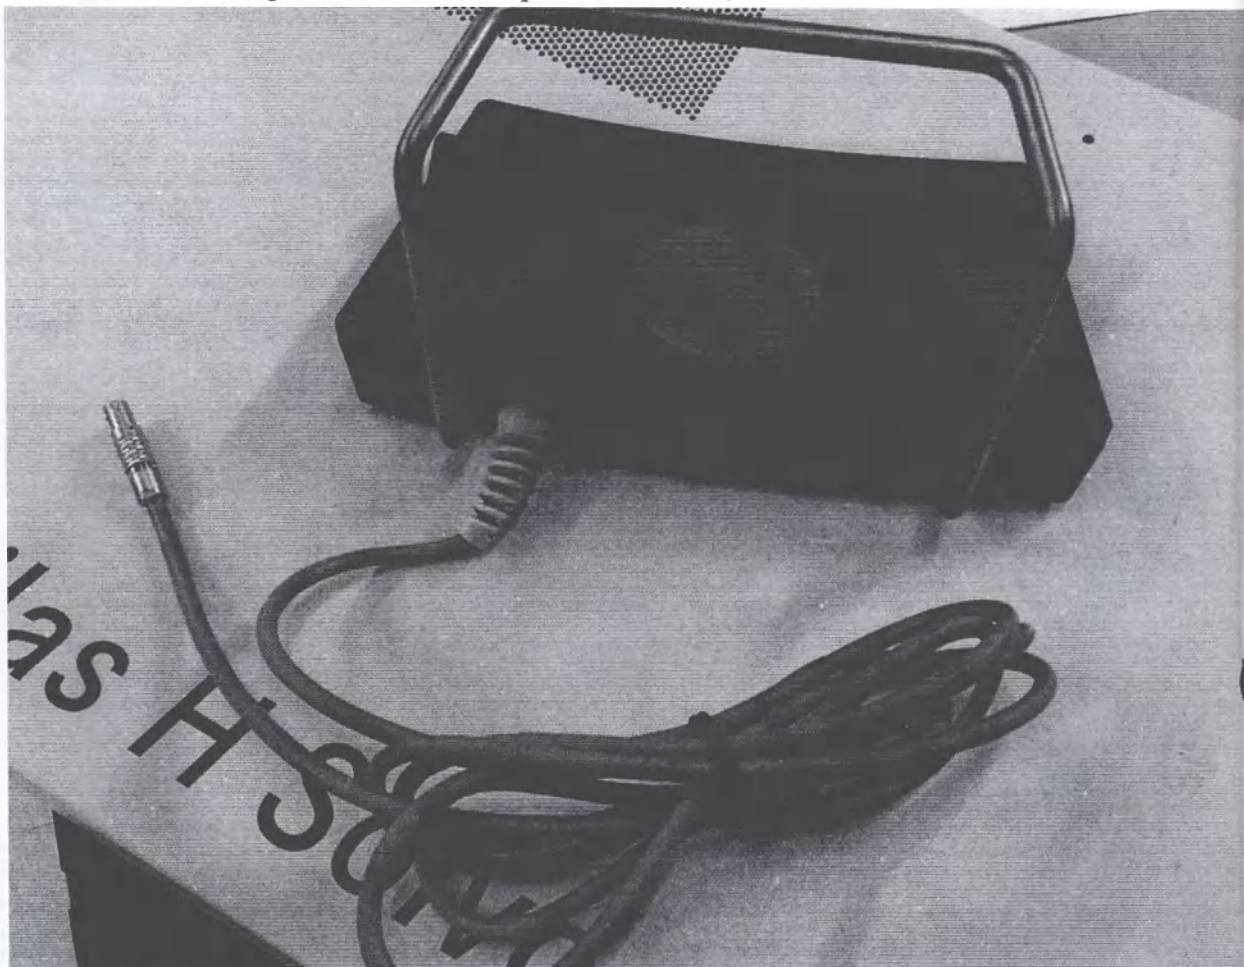

4. Фильтр защитный для эндоскопа, 1 шт.;



5. Разъем (штекер) выключателя блокировки двери (для контакта блокировки двери), 1 шт.;

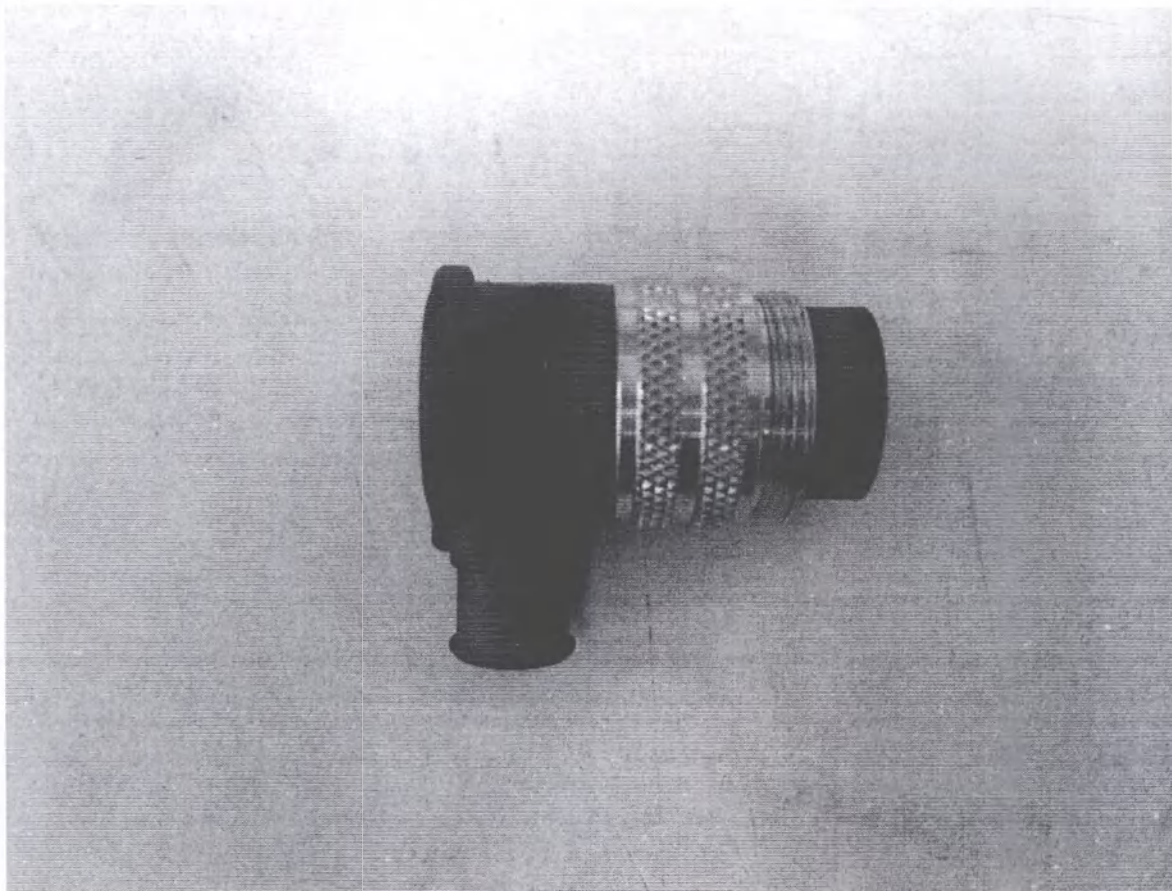

6. Кабель сетевой типа С19 длина 3 м, 1 шт.;



7. Руководство по эксплуатации, 1 шт.



Operating Manual

Dornier Medilas HRM



Dornier Medilas H UroPulse
CE1275

English
(Translation from German language)

The order number for this User's Manual: K2013695


Domier MedTech

III. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H Solvo 35


1. Установка лазерная медицинская Dornier Medilas H Solvo 35




2. Очки защитные от лазерного излучения, защита D 2100 (Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02076);

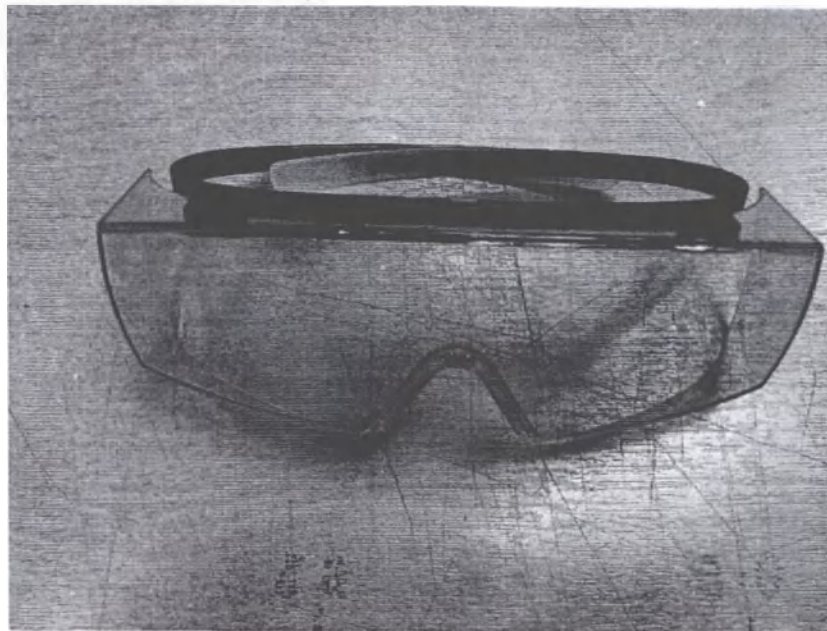


3. Педаль ножная проводная или педаль ножная беспроводная 1 шт.;

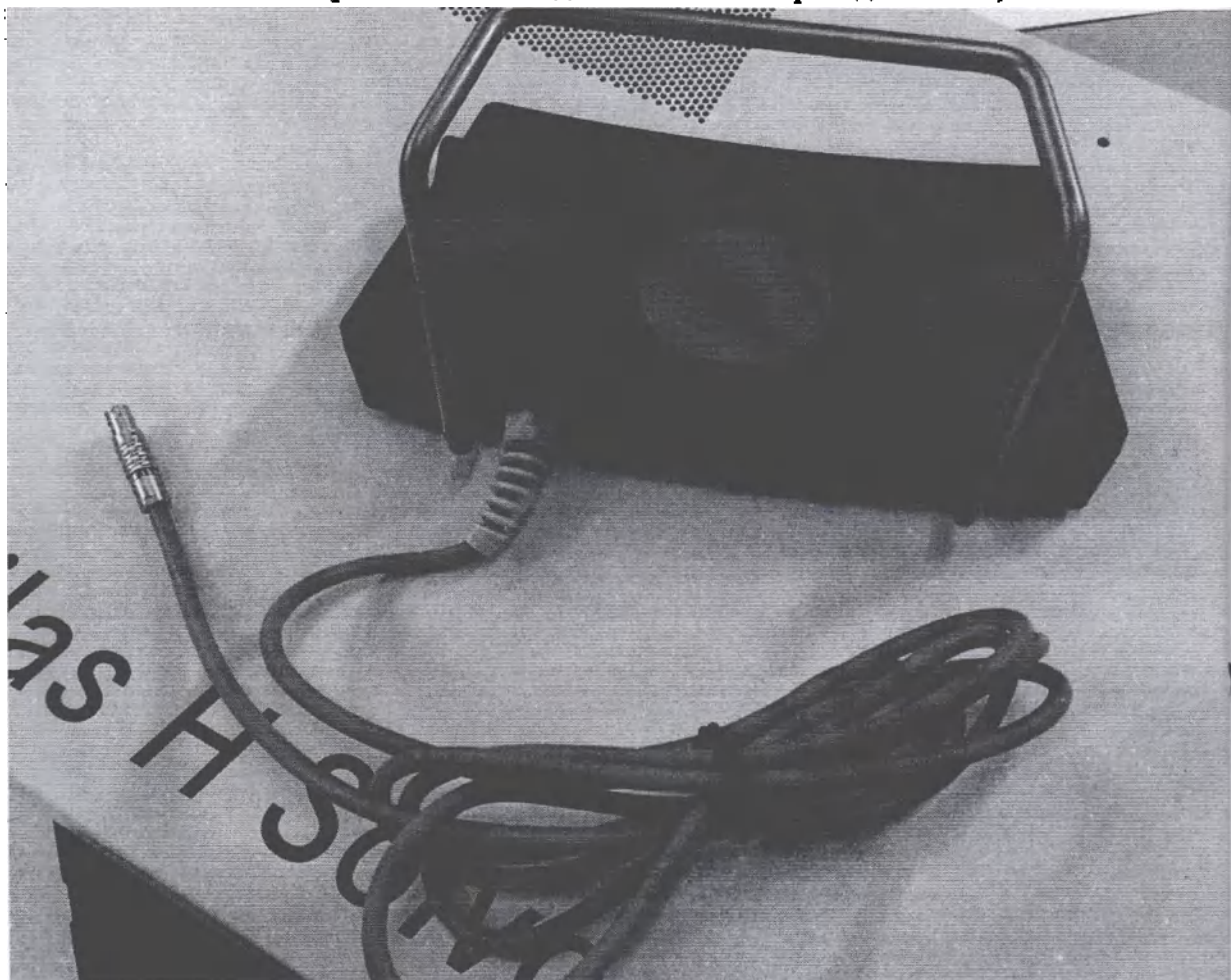


4. Разъем (штекер) выключателя блокировки двери (для контакта блокировки двери), 1 шт.;

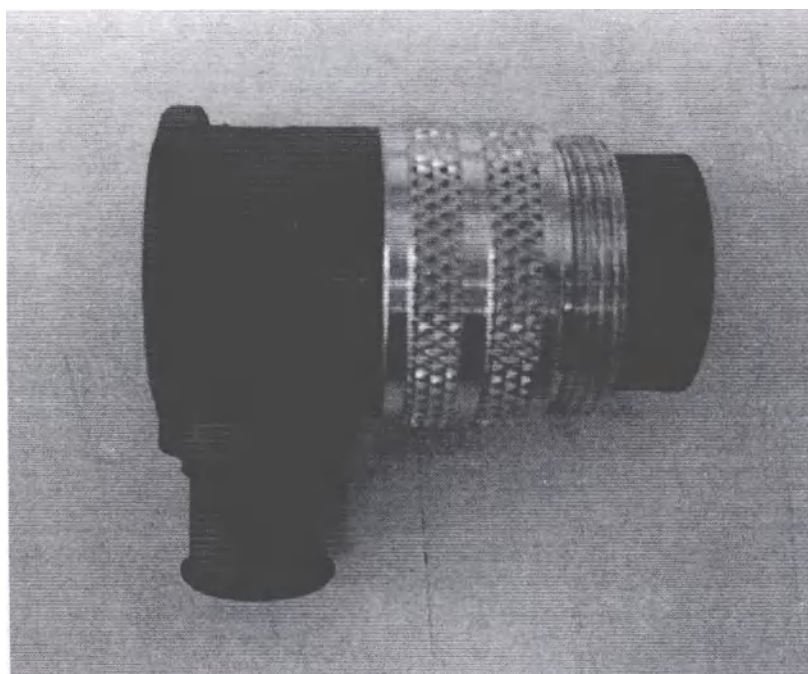

5. Кабель сетевой типа C19 длина 3 м, 1 шт.;

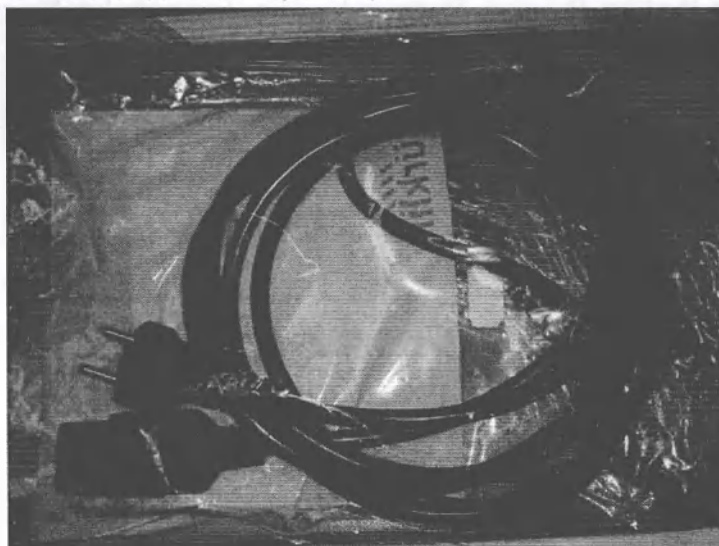

6. Руководство по эксплуатации, 1 шт.

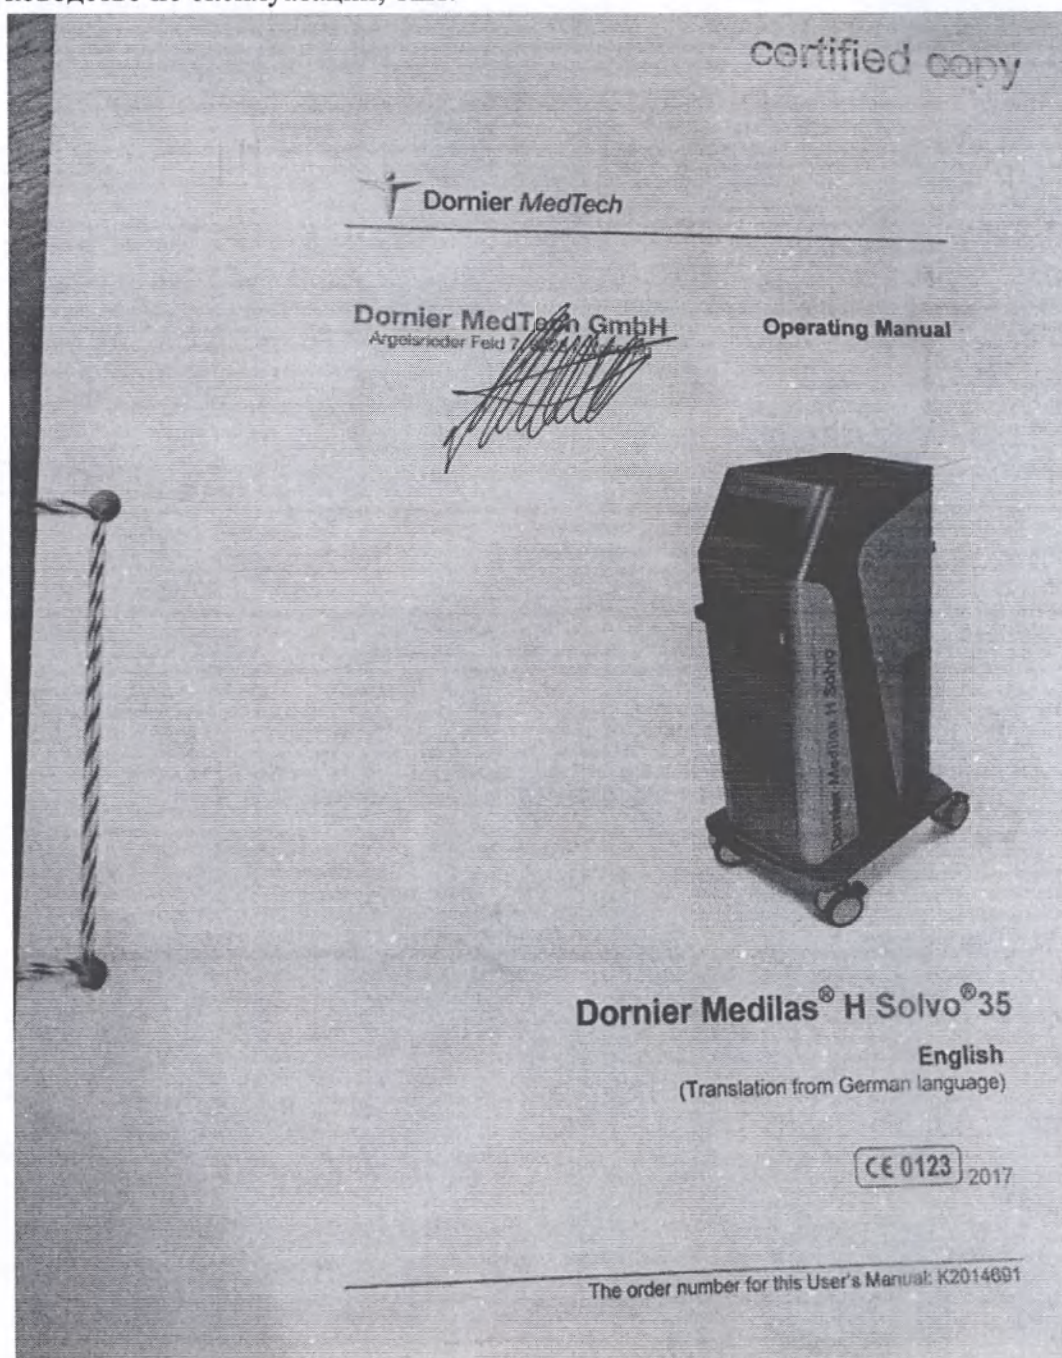

**IV. Принадлежности к установке лазерной медицинской варианты исполнения:
Dornier Medilas H Solvo, Dornier Medilas H UroPulse, Dornier Medilas H Solvo 35:**


1. Держатель для световода не более 10 шт.;




2. Набор сервисный для многоцветных световодов, в составе:



- приспособление для резки световодов, 1 шт.,

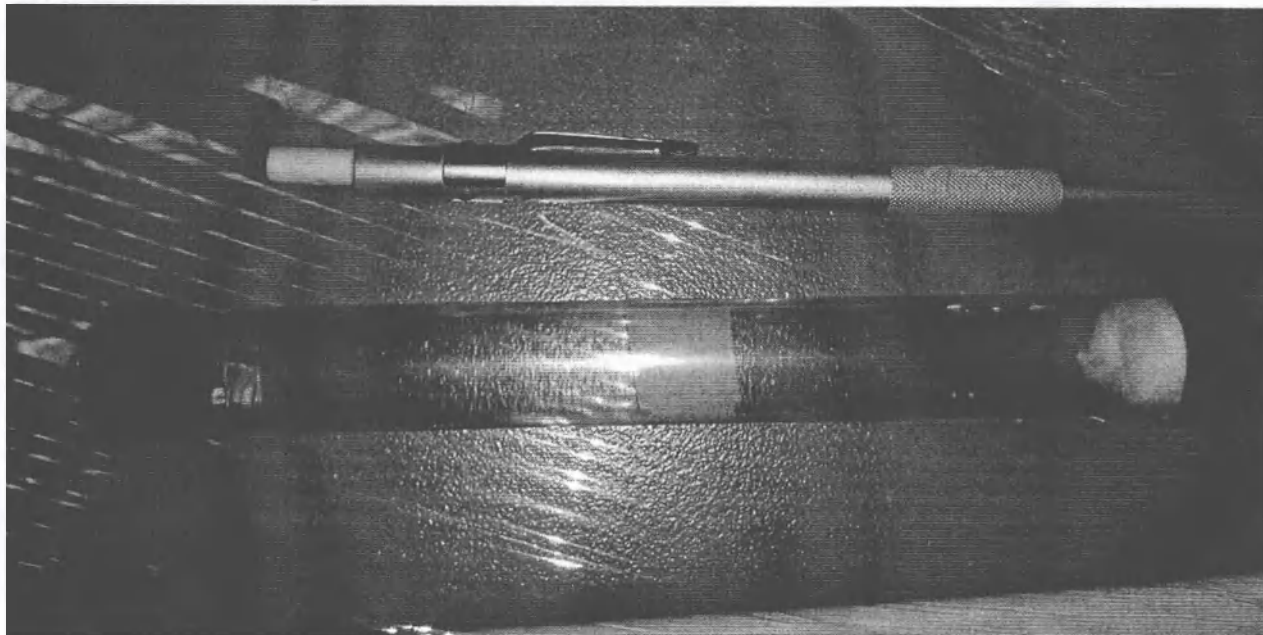


- клещи для удаления изоляции со световода диаметром 270μм, 1 шт.,

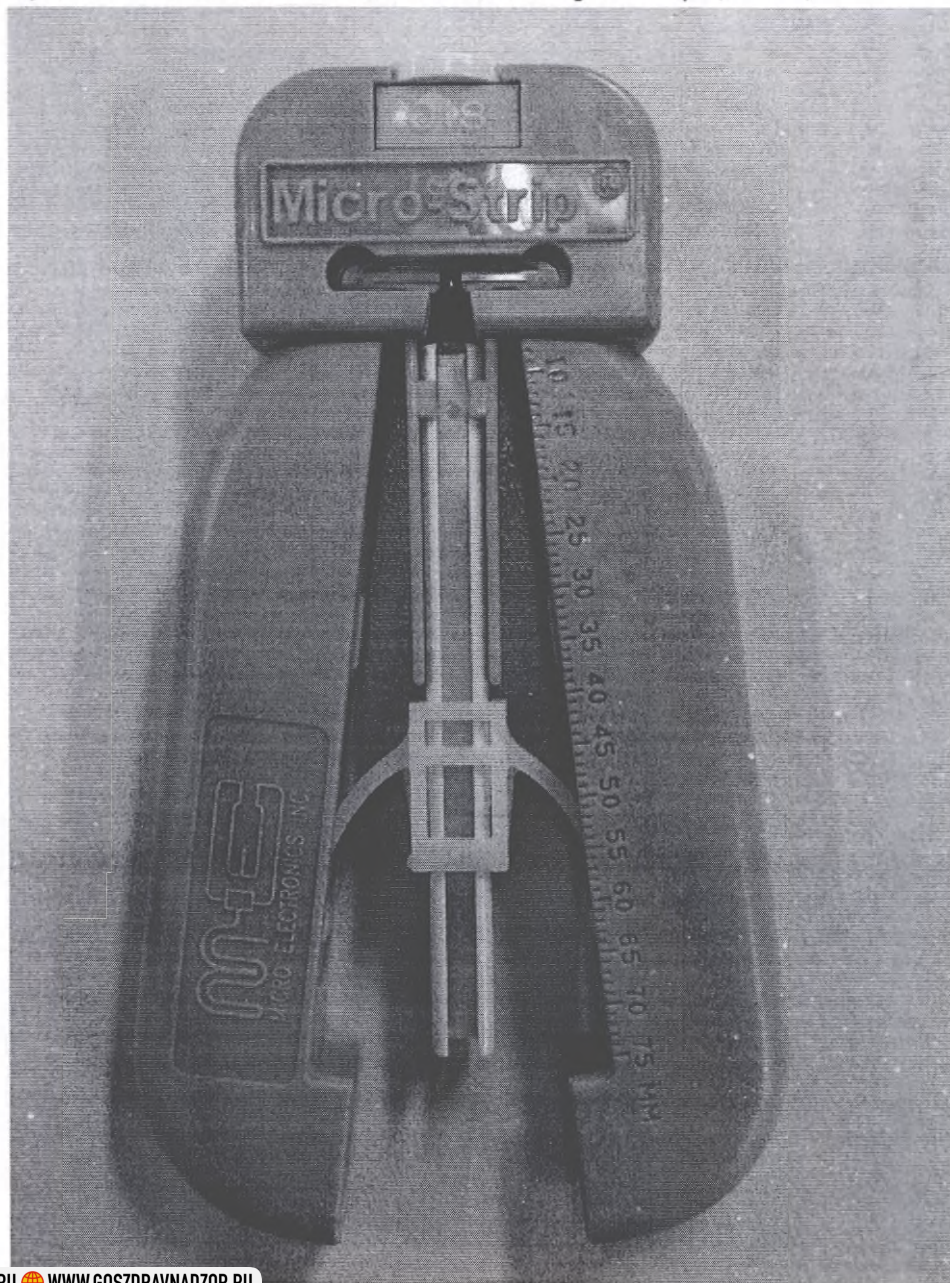


- клещи для удаления изоляции со световода диаметром 400μм, 1 шт.,




- клещи для удаления изоляции со световода диаметром 600μм, 1 шт.,

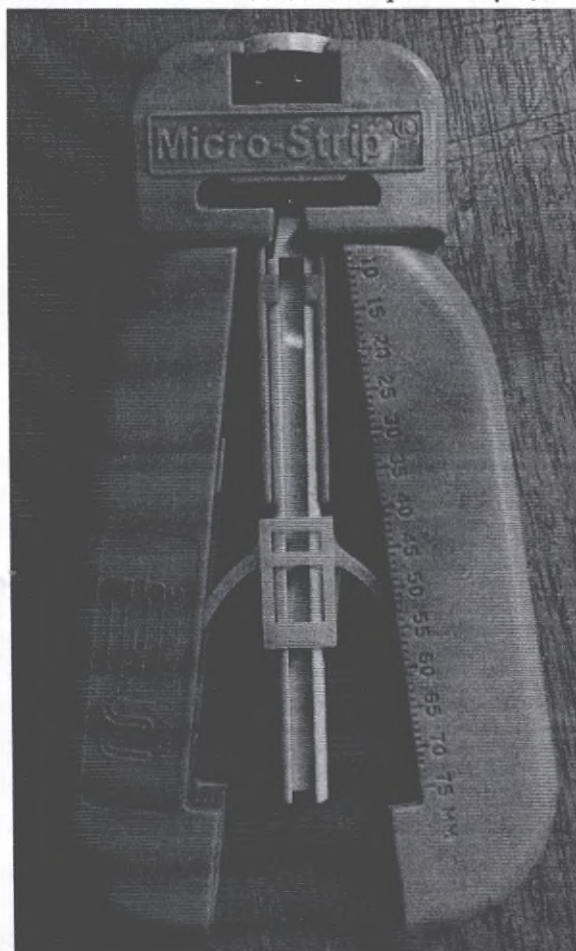


- пластинка керамическая, 5 шт.,

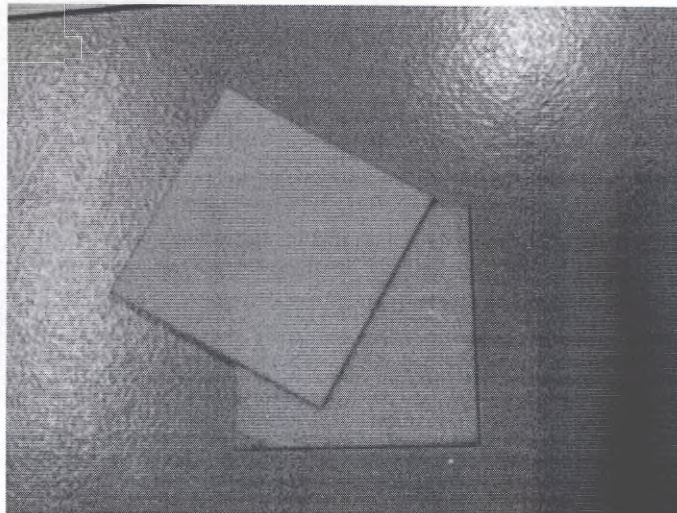

- лупа, 1 шт.,

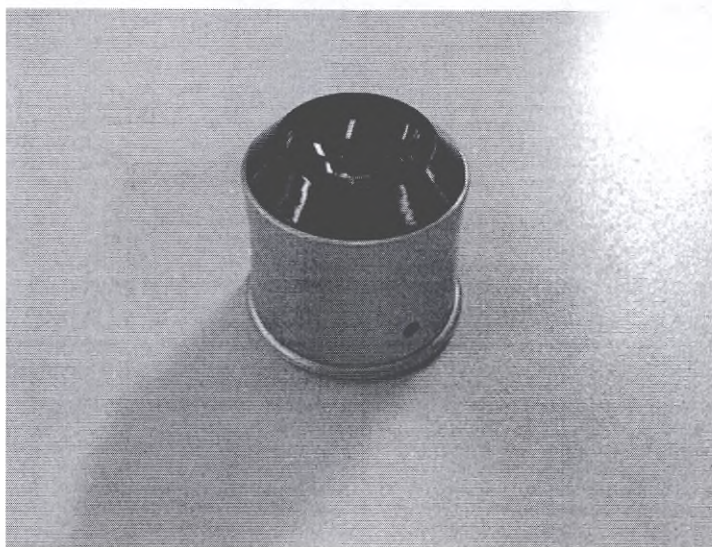


- инструкция по применению, 1 шт.

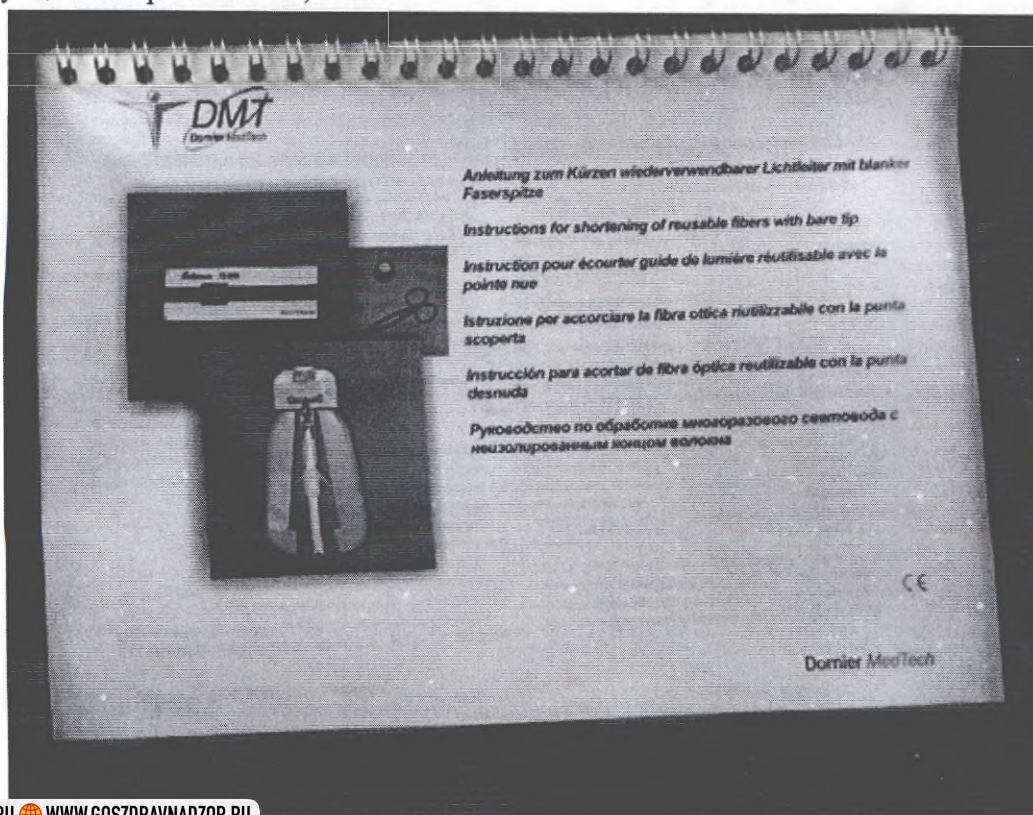


3. Приспособление для резки световодов, не более 10 шт.;




4. Клеши для удаления изоляции со световода диаметром 0,3мм, не более 10 шт.;

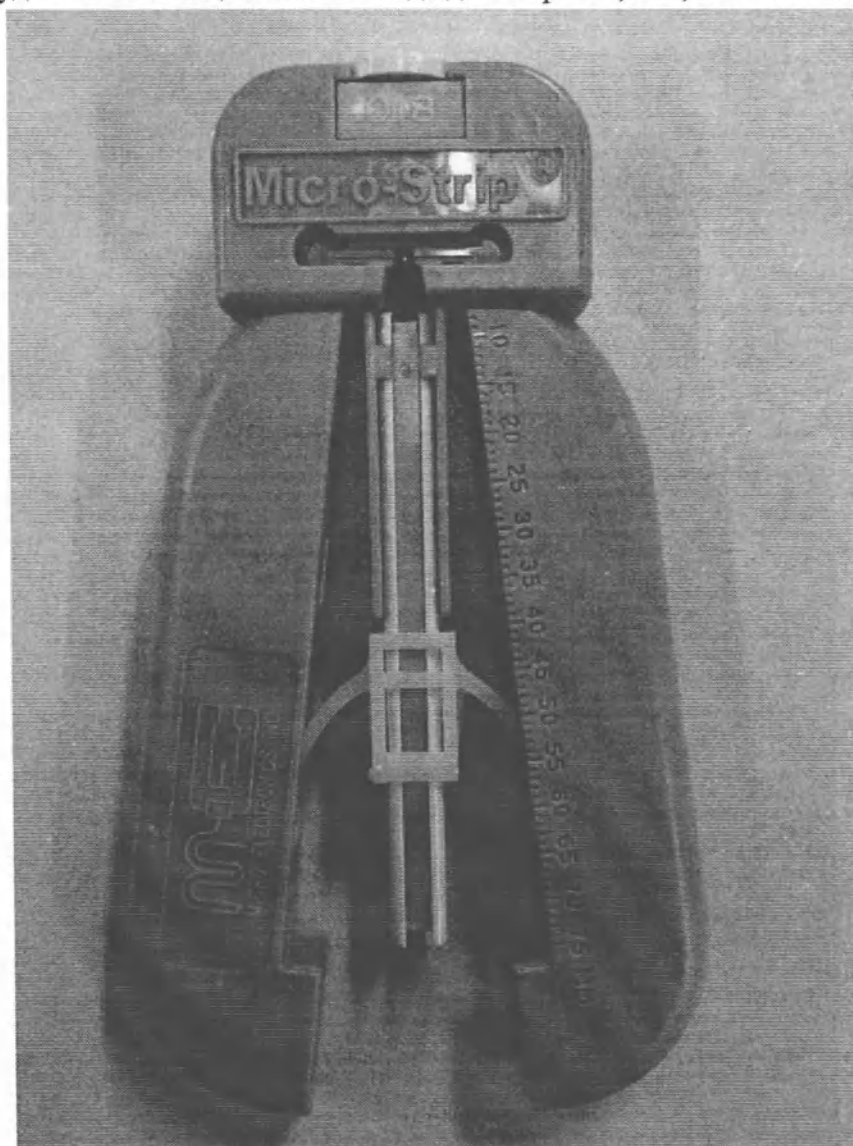


5. Клеши для удаления изоляции со световода диаметром 0,4мм, не более 10 шт.;

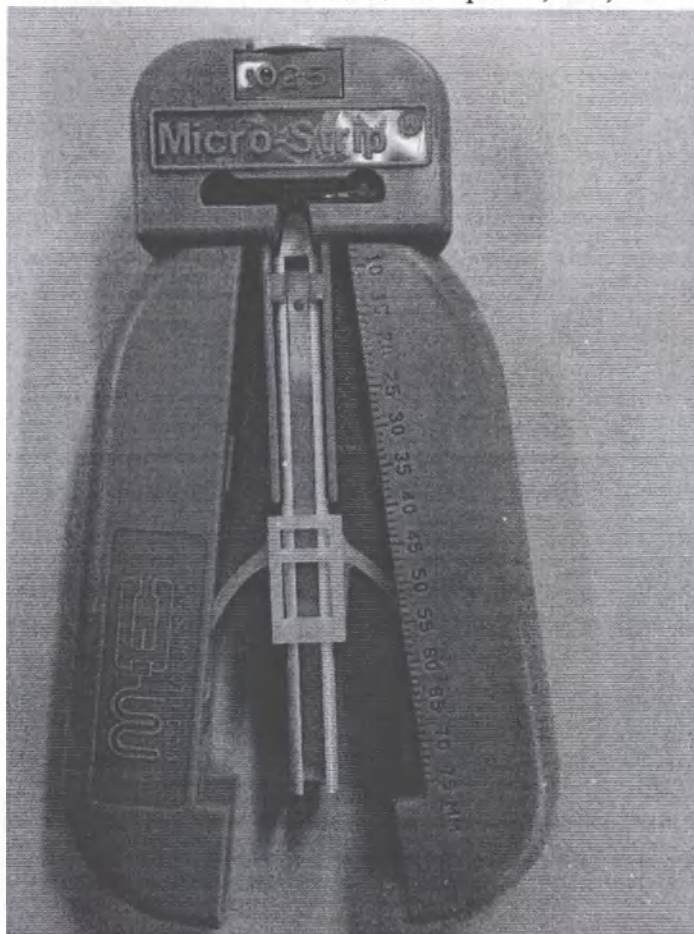


6. Клеши для удаления изоляции со световода диаметром 0,6мм, не более 10 шт.;

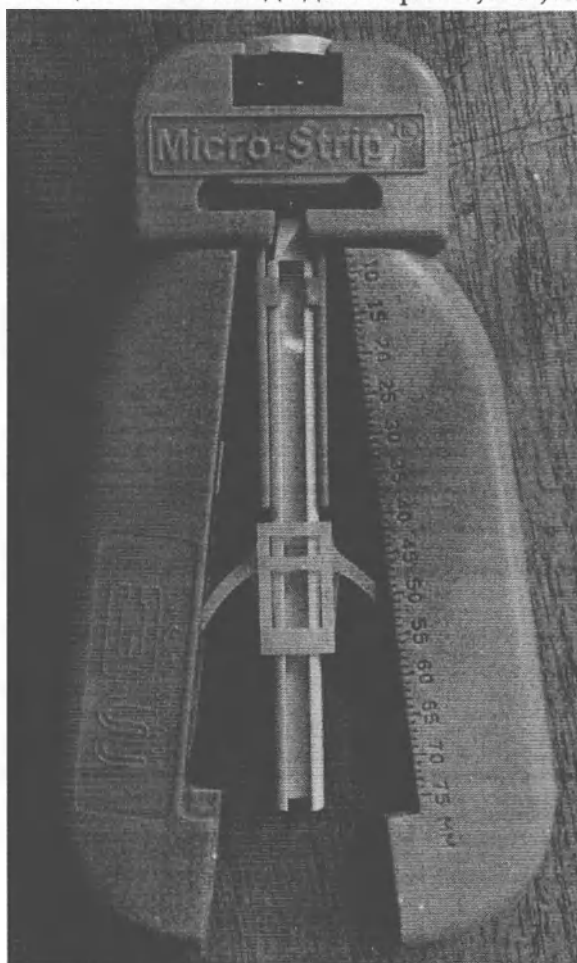


7. Клеши для удаления изоляции со световода диаметром 1мм, не более 10 шт.;

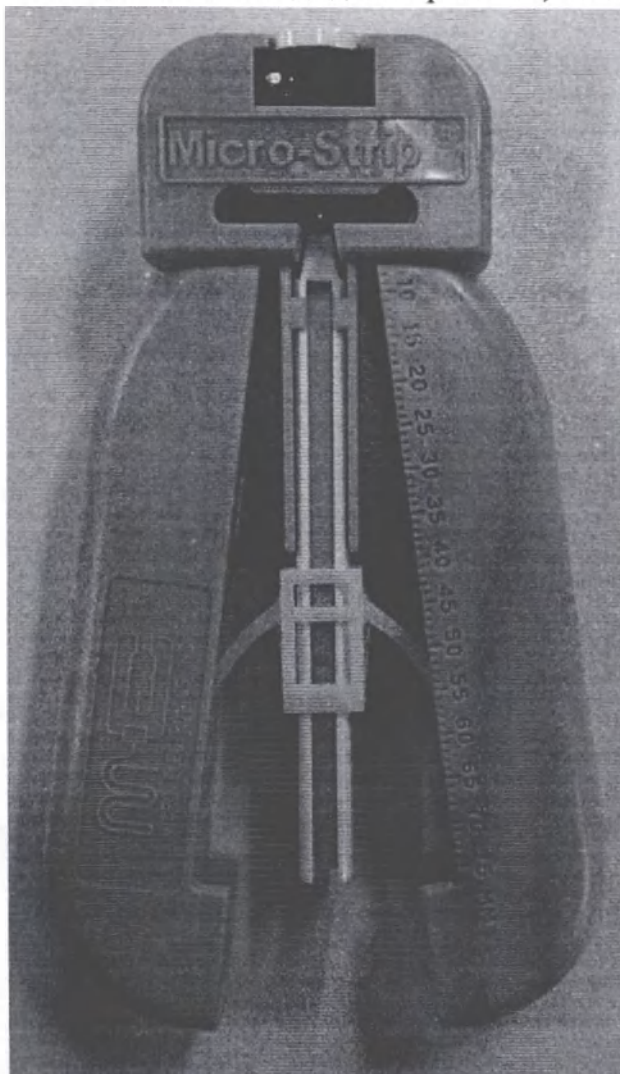


8. Клеши MediStrip стерилизуемые для удаления изоляции со световода диаметром 0,35 мм, внешним диаметром 0,5 мм, не более 10 шт.;

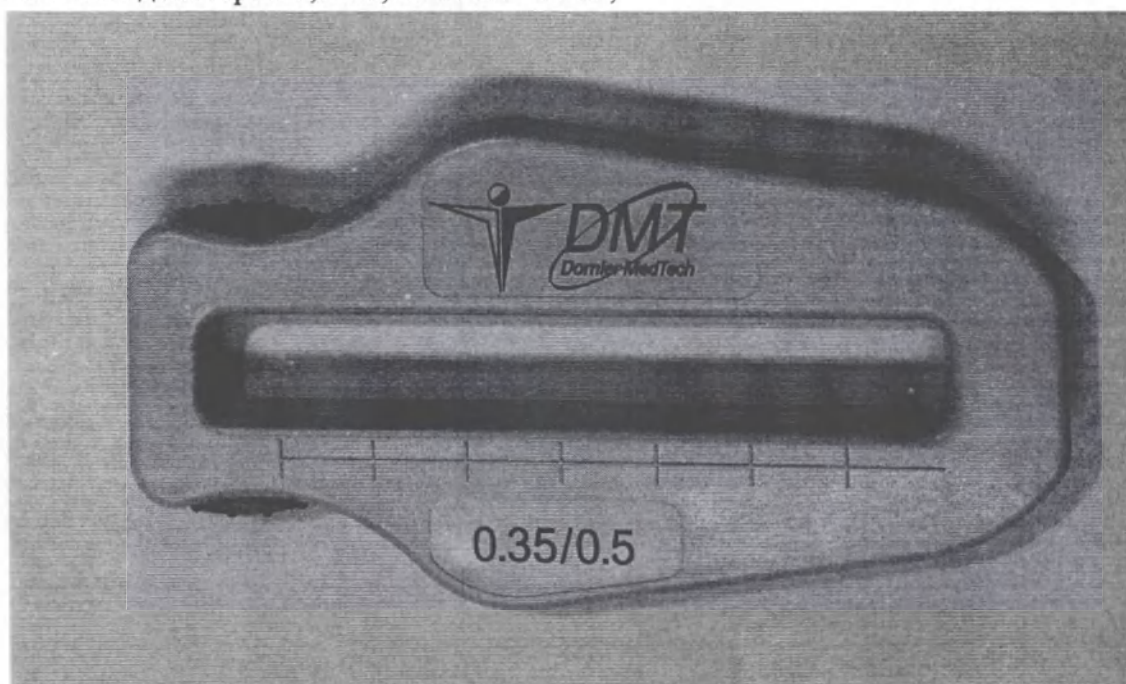

9. Клеши MediStrip стерилизуемые для удаления изоляции со световода диаметром 0,5 мм, внешним диаметром 0,9 мм, не более 10 шт.;

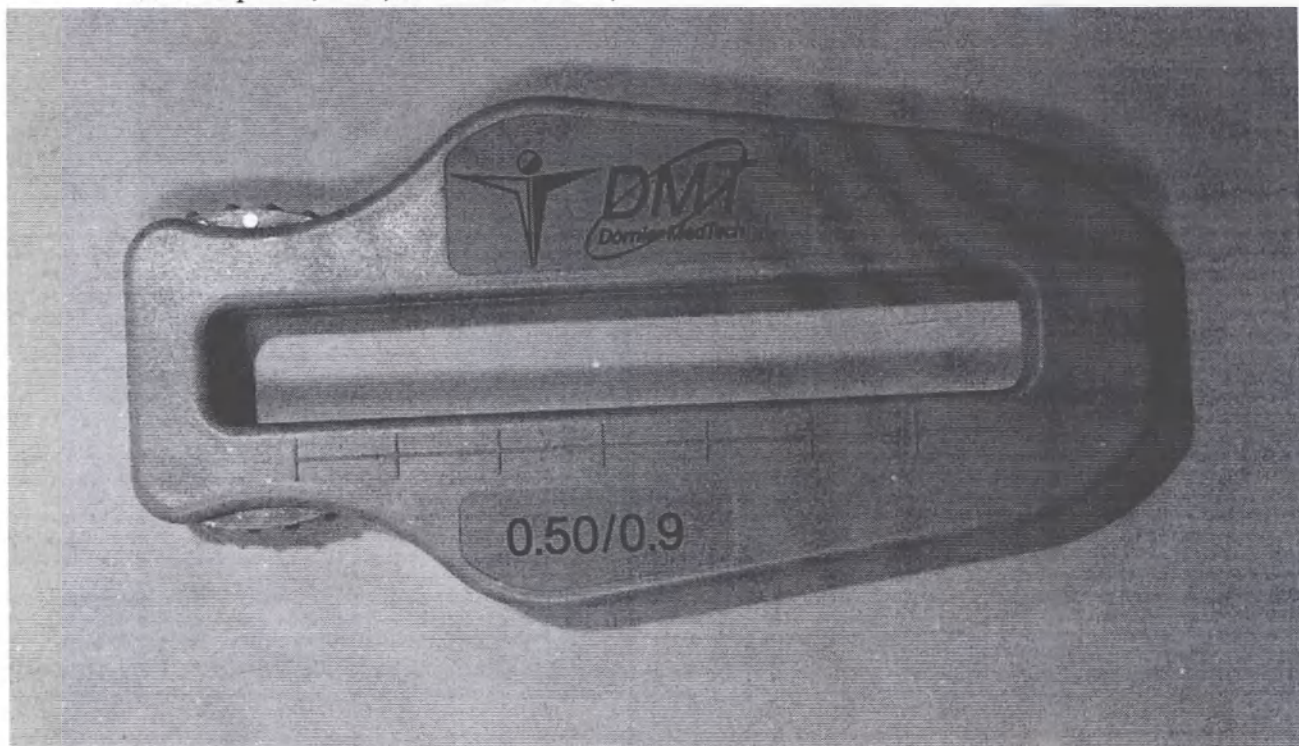


10. Клеши MediStrip стерилизуемые для удаления изоляции со световода диаметром 0,7 мм, внешним диаметром 1,2 мм, не более 10 шт.;

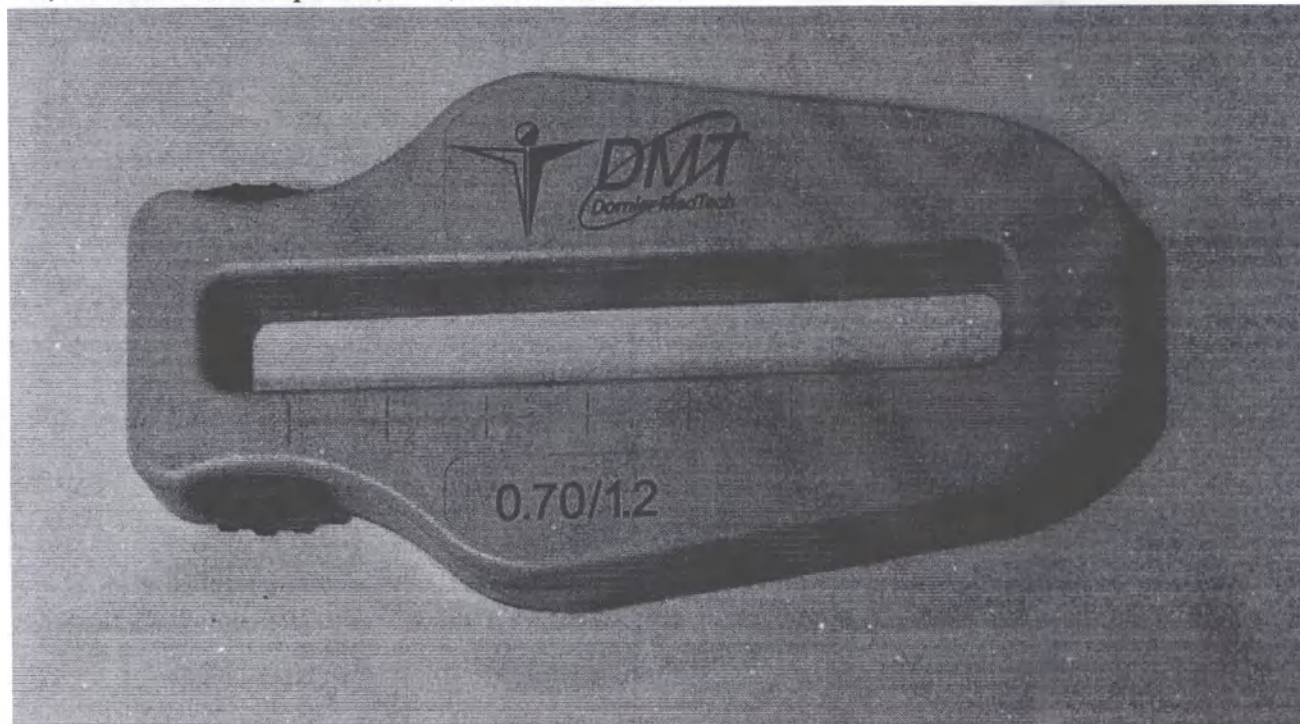

11. Лупы, не более 10 шт.;



12. Пластины керамические, не более 10 шт.;

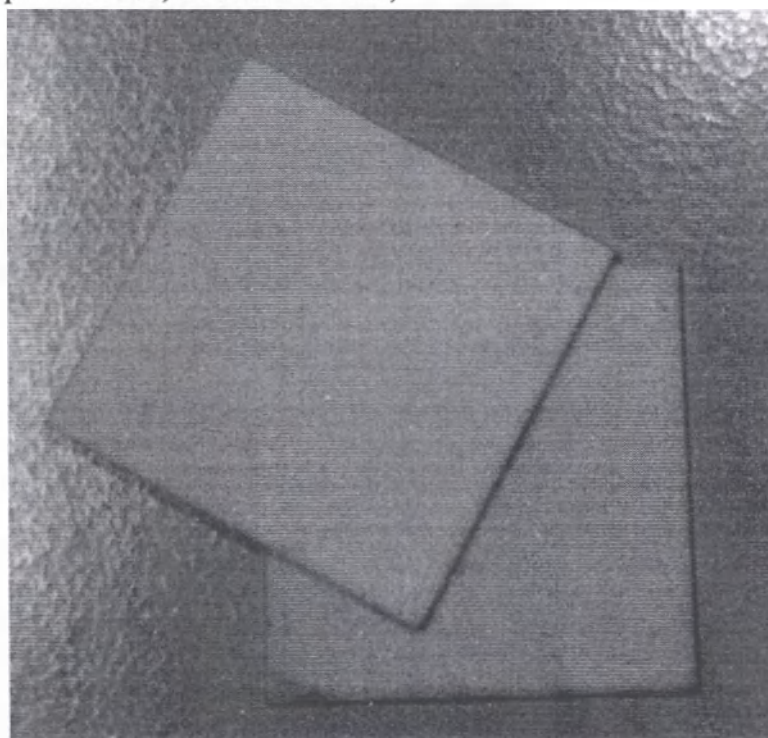


13. Знаки лазера предупредительные, не более 10 шт.;




14. Световоды головолоконные одноразовые, варианты исполнения:

- Световод головолоконный одноразовый с диаметром оптоволокну 270μм, внешним диаметром 400μм длина 3,0м-1уп.(3шт.), не более 100 упаковок;

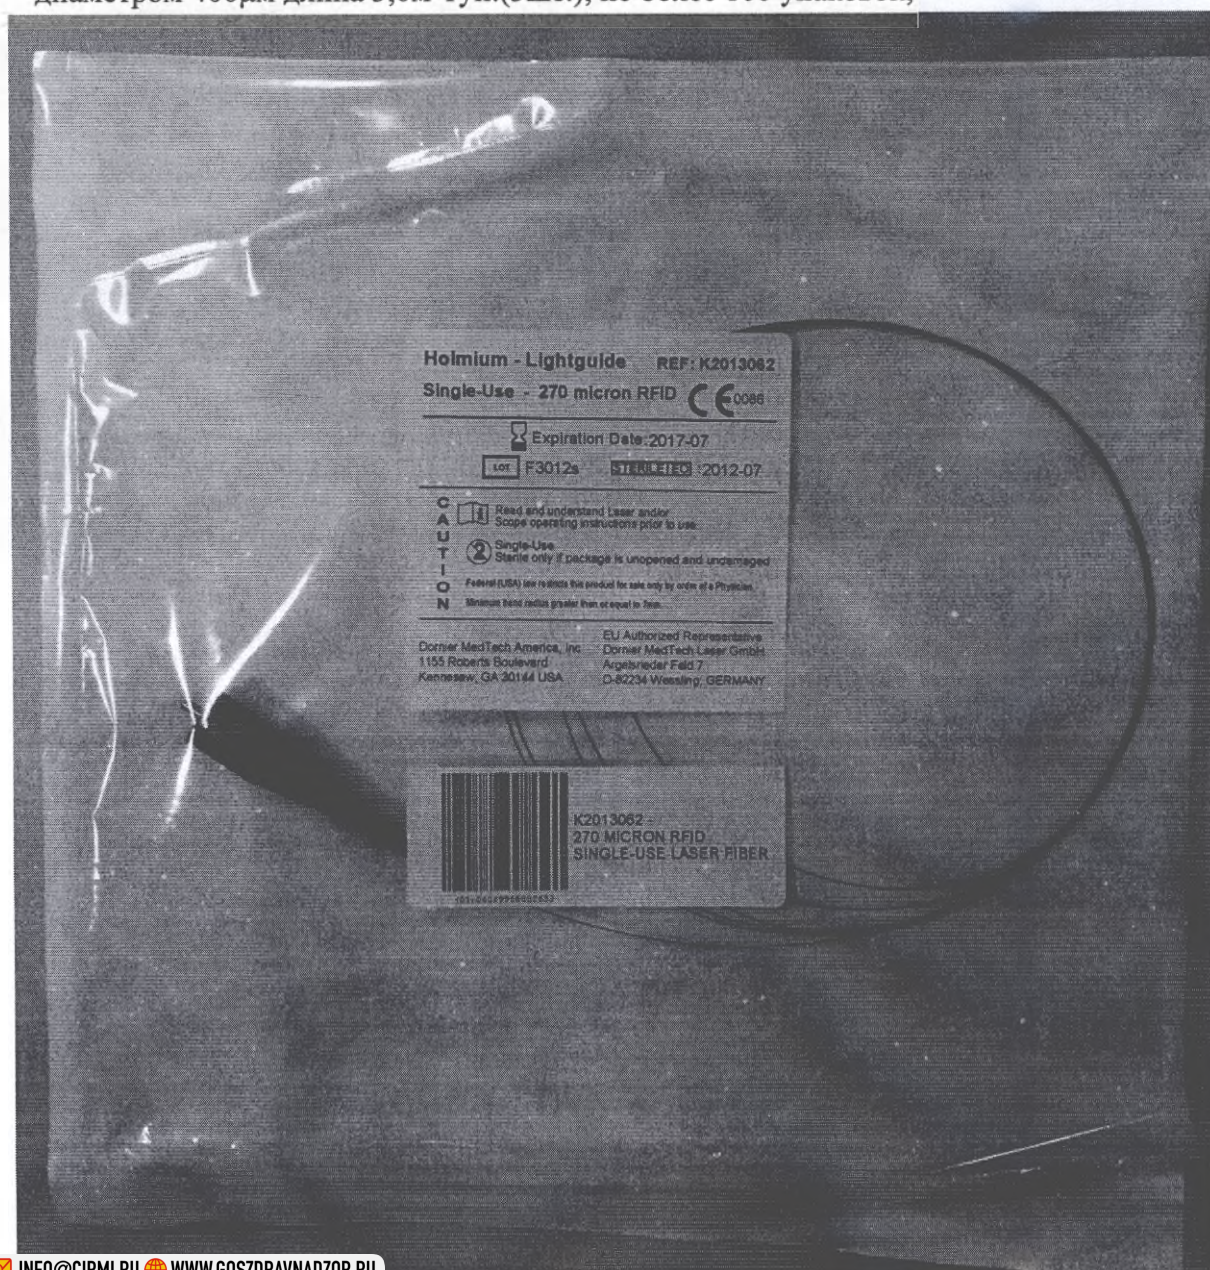


- Световод волоконный одноразовый с диаметром оптоволокну 270μм, внешним диаметром 460μм длина 3,0м-1 уп.(3шт.), не более 100 упаковок;

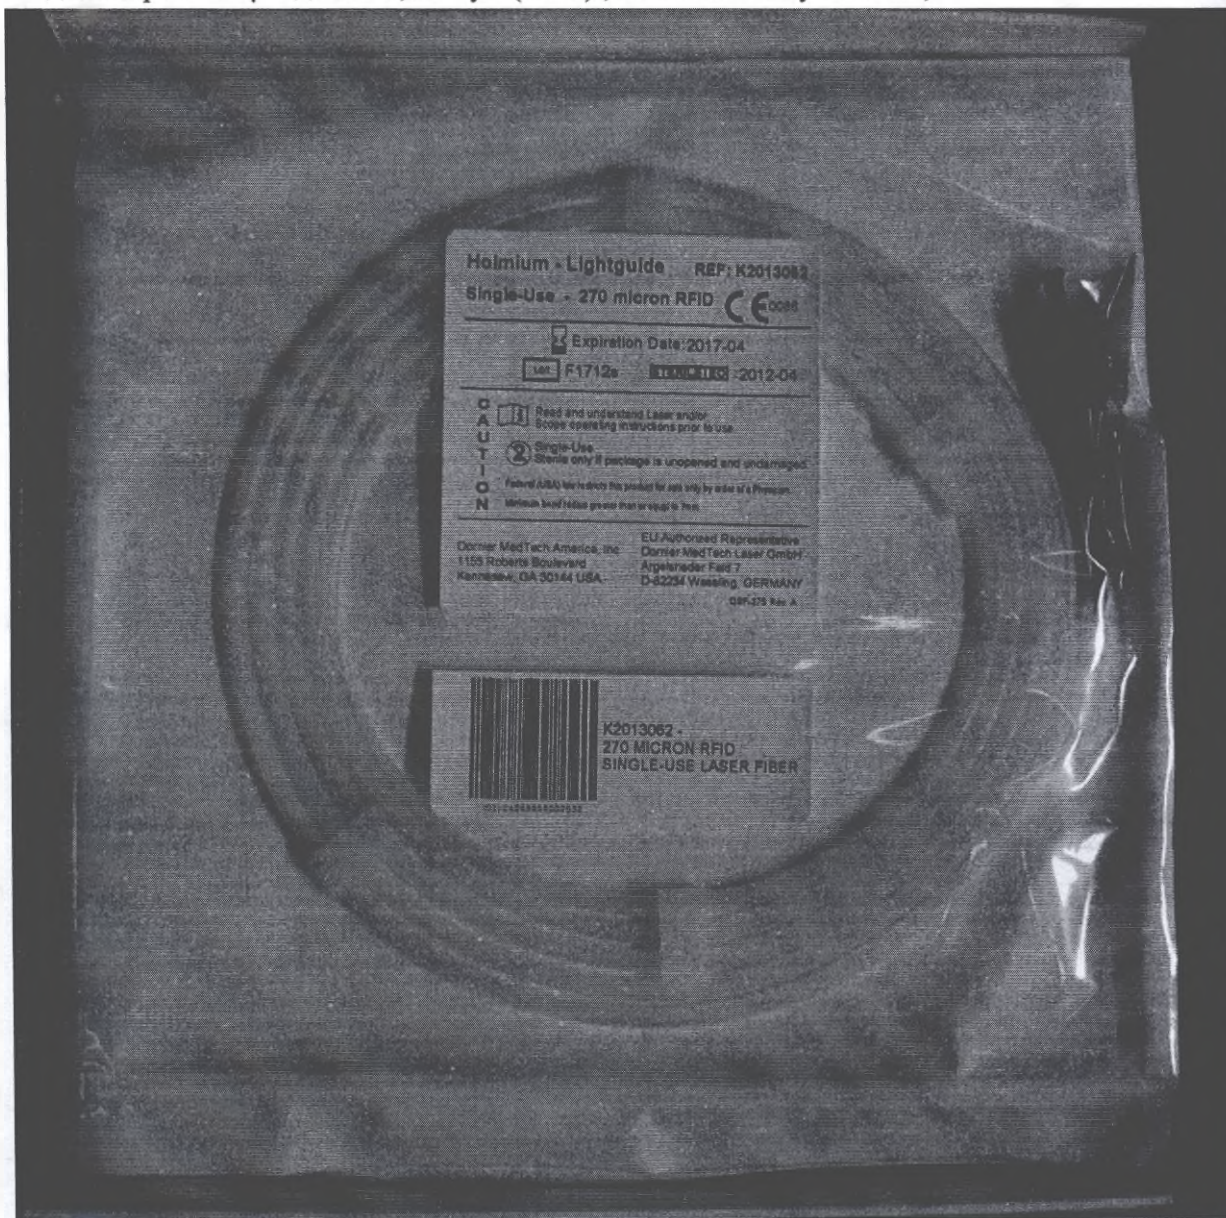

- Световод головолоконный одноразовый с диаметром оптоволокна 400μм, внешним диаметром 730μм длина 3,0м-1уп.(3шт.), не более 100 упаковок;



- Световод головолоконный одноразовый с диаметром оптоволокна 400μм, внешним диаметром 730μм длина 4,5м-1уп.(3шт.), не более 100 упаковок;

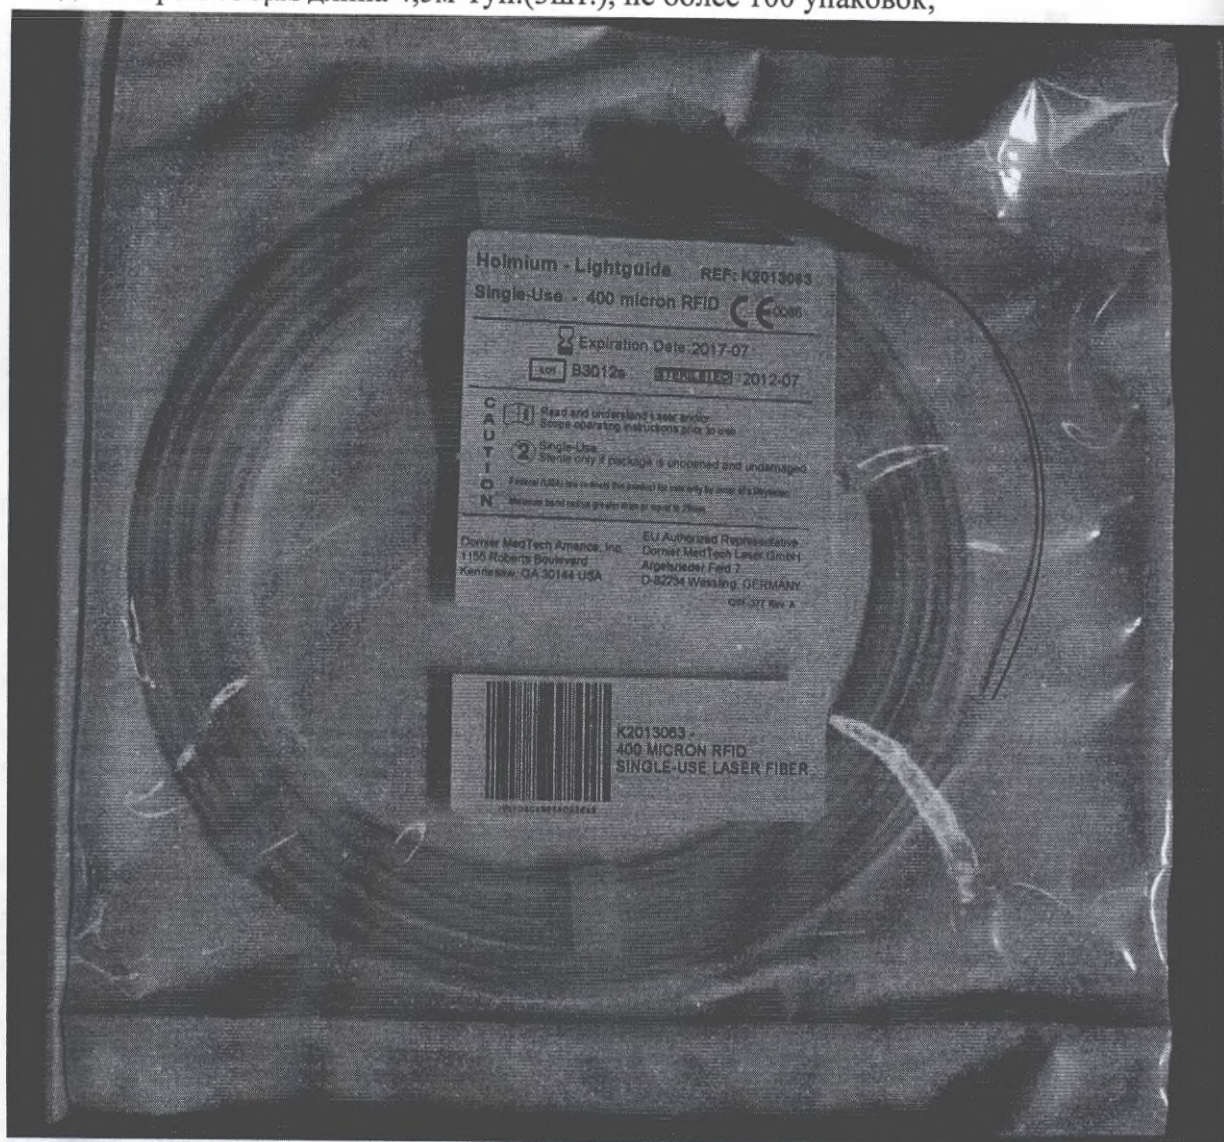

- Световод волоконный одноразовый с диаметром оптоволокну 600μм, внешним диаметром 750μм длина 4,5м-1уп.(3шт.), (не более 100 упаковок);



- Световод головолоконный одноразовый с диаметром оптоволоконна 1000μм, внешним диаметром 1400μм длина 3,0м-1 уп.(3шт.), не более 100 упаковок;



15. Световоды головолоконные многоразовые варианты исполнения:

- Световод головолоконный многоразовый с диаметром оптоволокну 270μм, внешним диаметром 400μм длина 3,0м-1уп.(3шт.), не более 100 упаковок;



- Световод головолоконный многоразовый с диаметром оптоволокна 270μm, внешним диаметром 460μm длина 3,0м-1 уп.(3шт.), не более 100 упаковок;




- Световод головолоконный многоцветный с диаметром оптоволокну 400µм, внешним диаметром 730µм длина 3,0м-1 уп.(3шт.), не более 100 упаковок;



- Световод головолоконный многоцветный с диаметром оптоволокну 600μм, внешним диаметром 750μм длина 3,0м-1 уп.(3шт.), не более 100 упаковок;



- Световод головолоконный многообразовый с диаметром оптоволокна 1000μм, внешним диаметром 1400μм длина 3,0м-1уп.(3шт.), не более 100 упаковок;

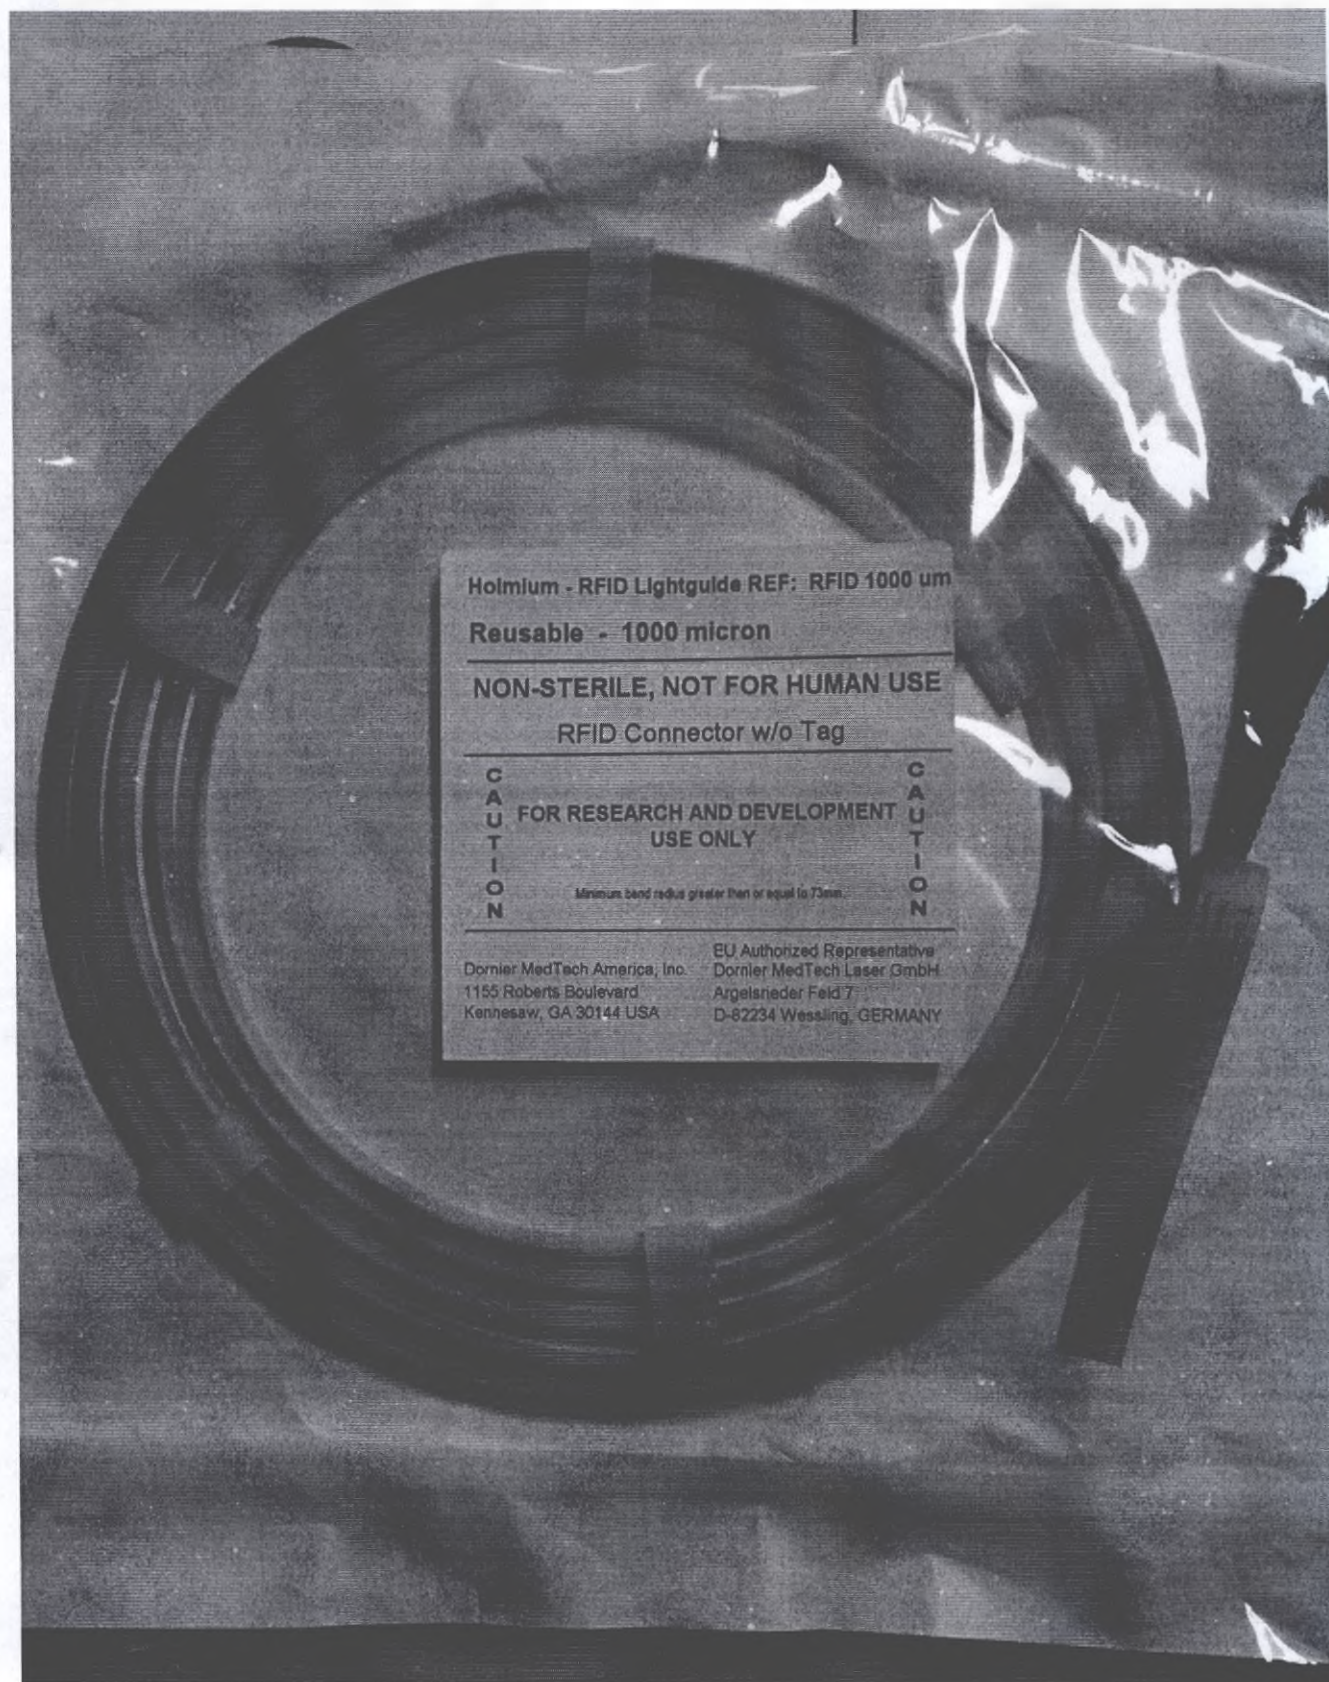

Holmium - RFID Lightguide REF: RFID 1000 um

Reusable - 1000 micron

NON-STERILE, NOT FOR HUMAN USE

RFID Connector w/o Tag

C
A
U
T
I
O
N

FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
USE ONLY


Minimum bend radius greater than or equal to 73mm

C
A
U
T
I
O
N


Dornier MedTech America, Inc.
1155 Roberts Boulevard
Kennesaw, GA 30144 USA

EU Authorized Representative
Dornier MedTech Laser GmbH
Argelsrieder Feld 7
D-82234 Wessling, GERMANY

16. Внешний дополнительный дисплей 8" в составе:
- дисплей медицинский 8";

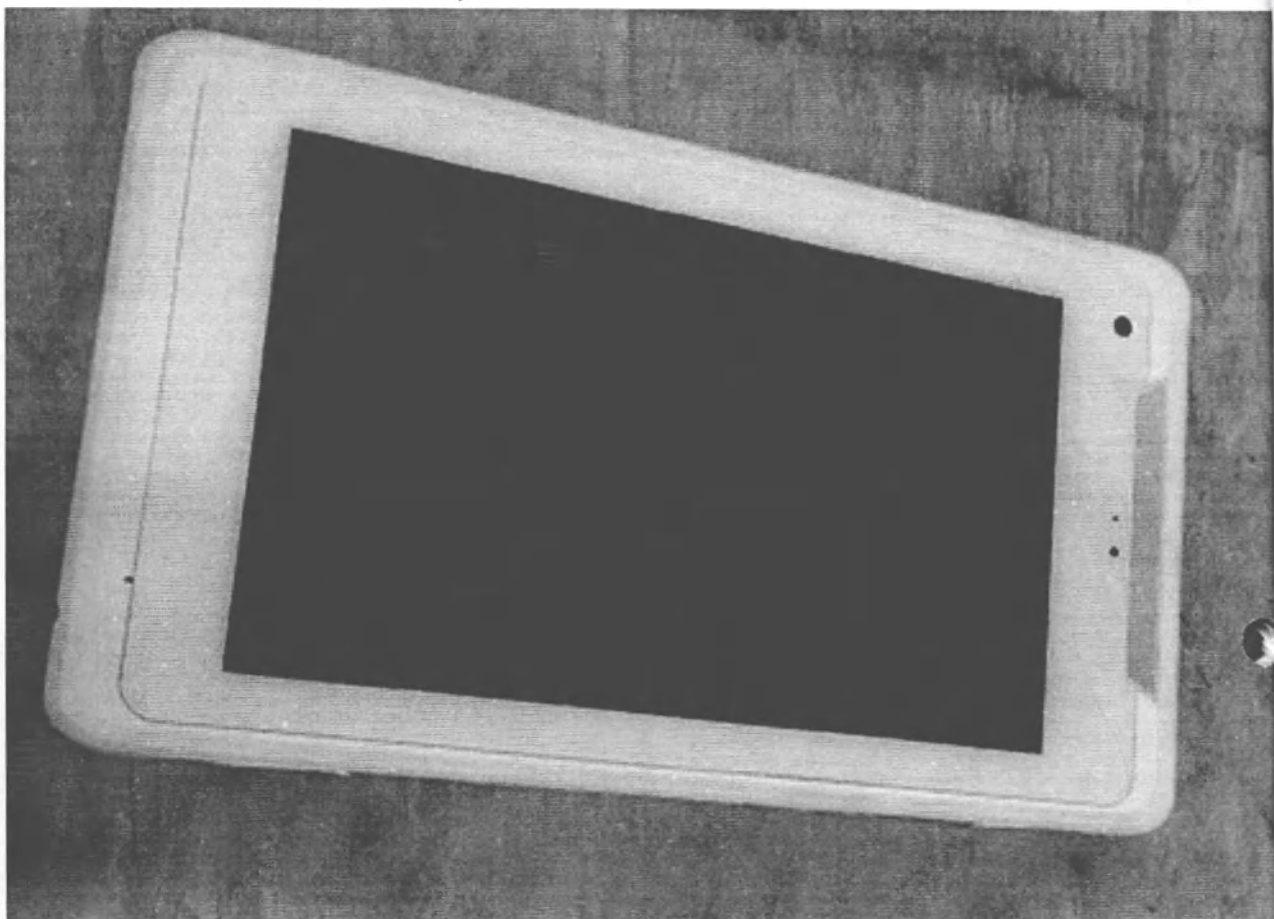

- блок питания дисплея;

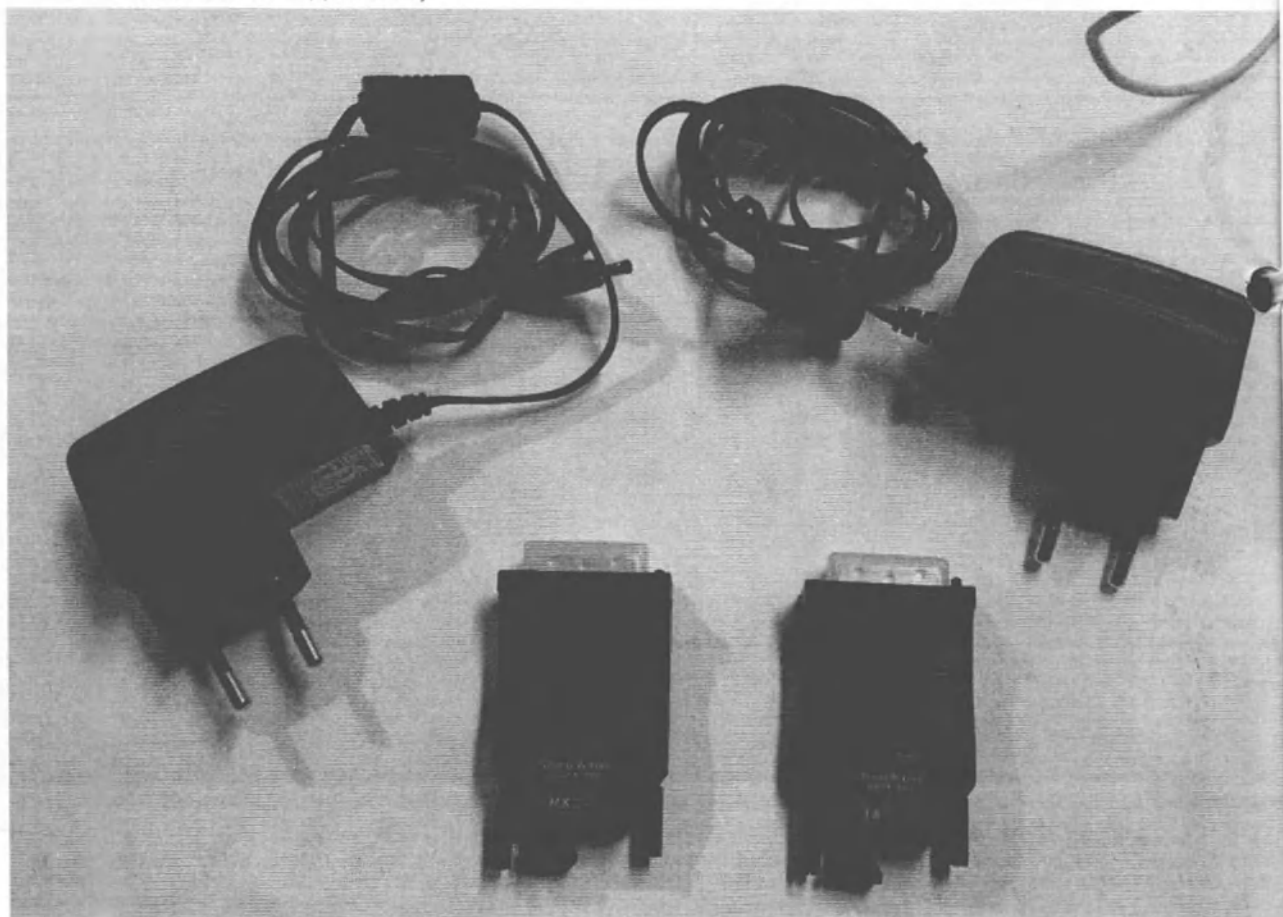

- кронштейн держатель (4-х осевой)- 1 шт;



- ПО APP V1.0.4;

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 18 листов

