
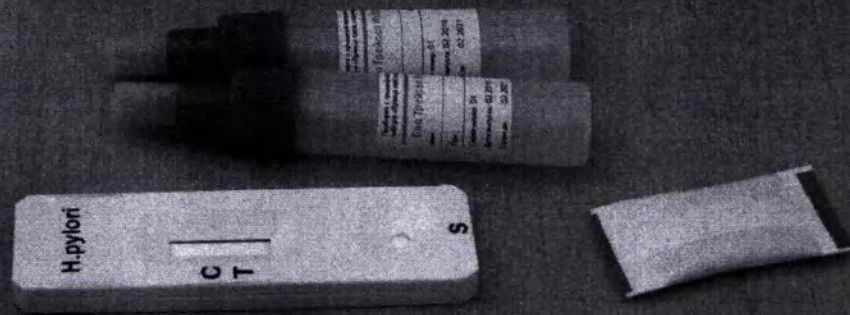
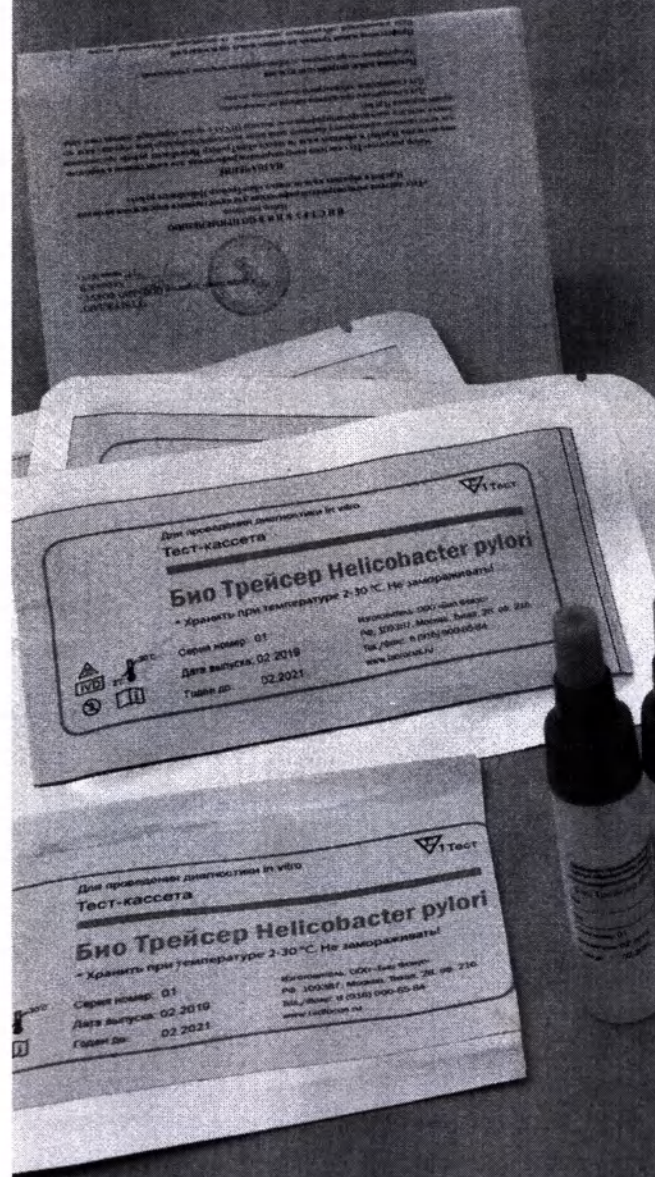


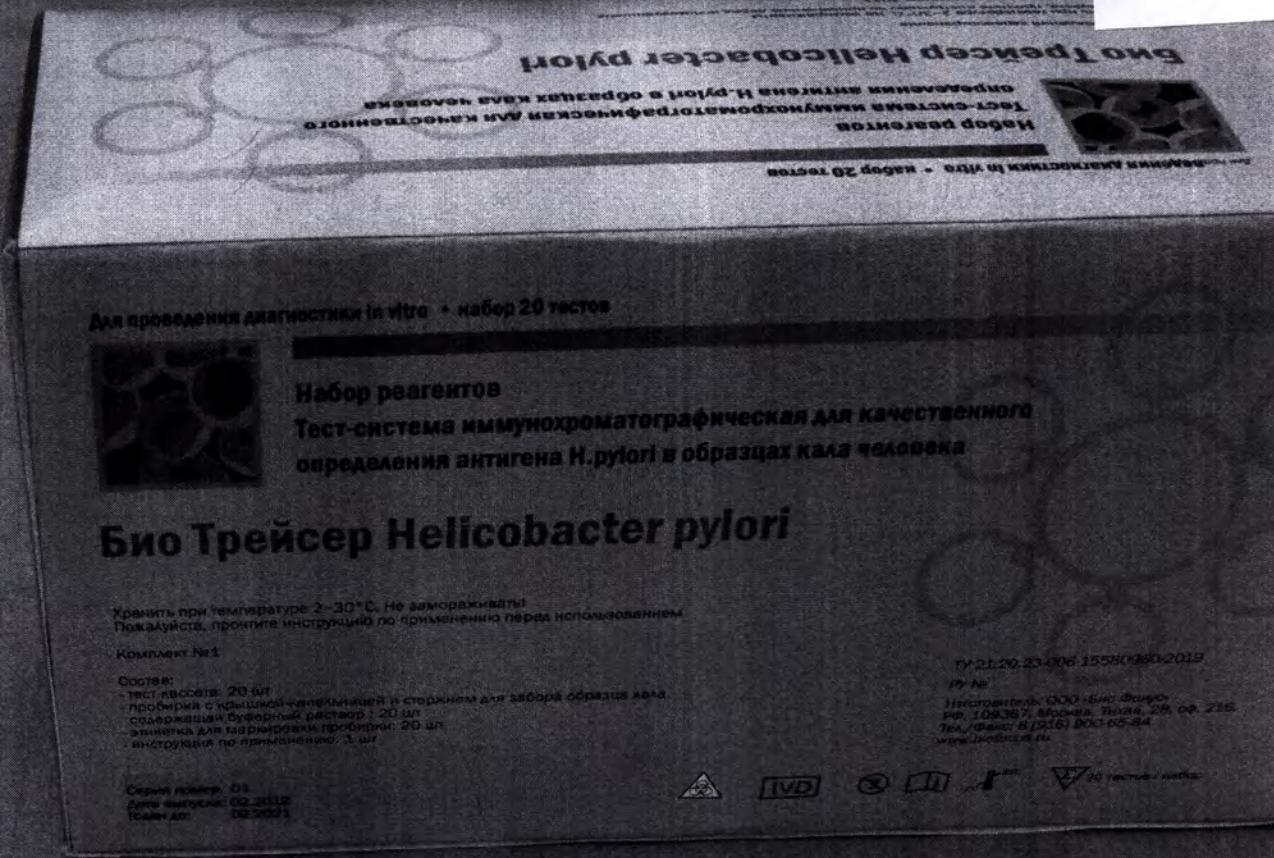

Для проведения диагностики in vitro - набор 20 тестов

**Набор реагентов**  
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антигена *H. pylori* в образцах кала человека

**Био Трейсер Helicobacter pylori**






Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!  
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием






Комплект №1





Состав:  
- тест-кассеты: 20 шт  
- пробирки с крышечкой-капиллярной и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор: 20 шт  
- этикетки для маркировки пробирок: 20 шт  
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 03  
Дата выпуска: 02.2019  
Годен до: 02.2021

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Трейсер»  
РФ, 125087, Москва, Тихая, 28, оф. 218.  
Тел./Факс: 8 (495) 900-65-84  
www.bio-trayser.ru

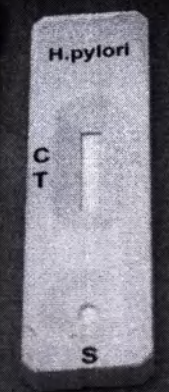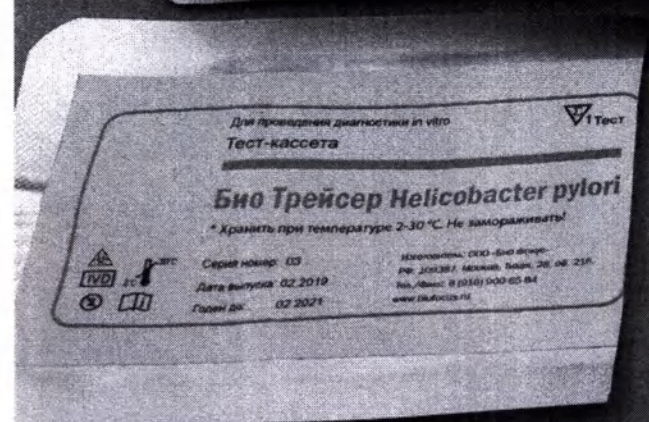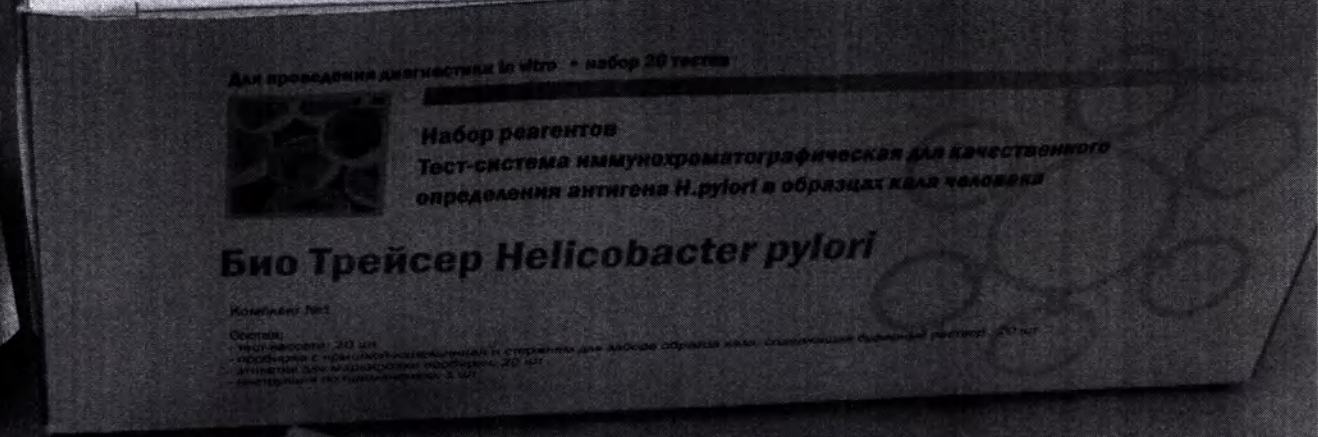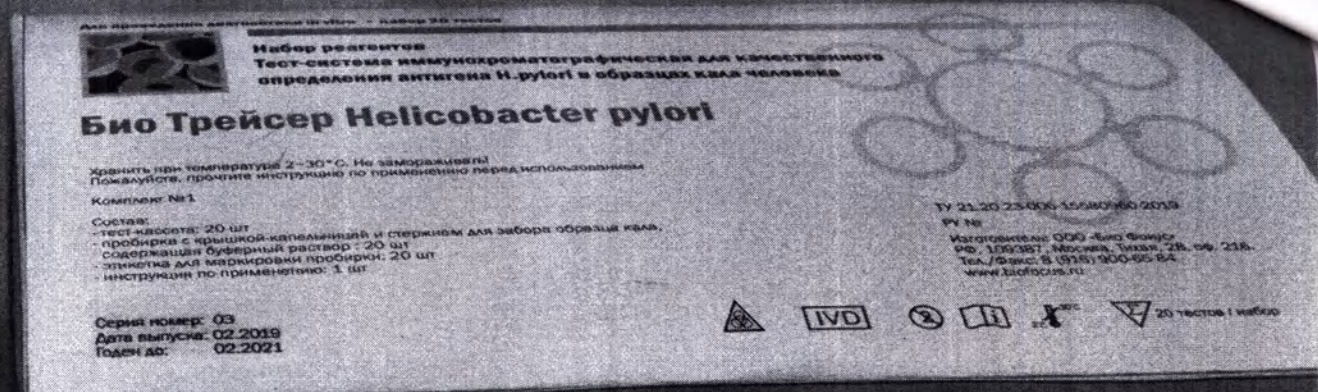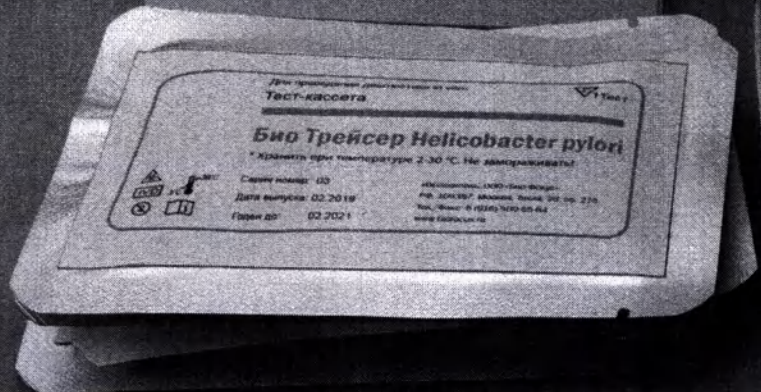

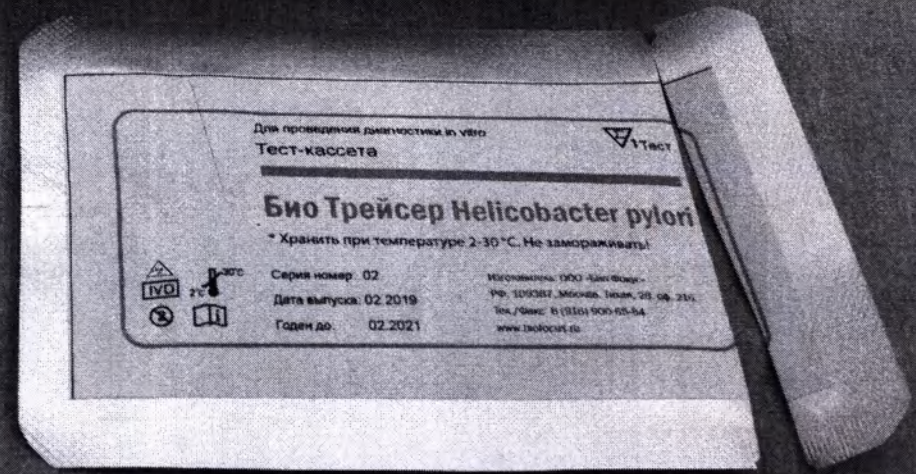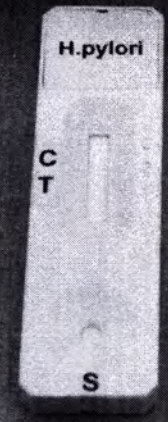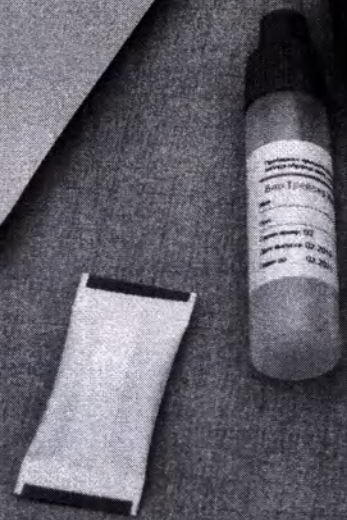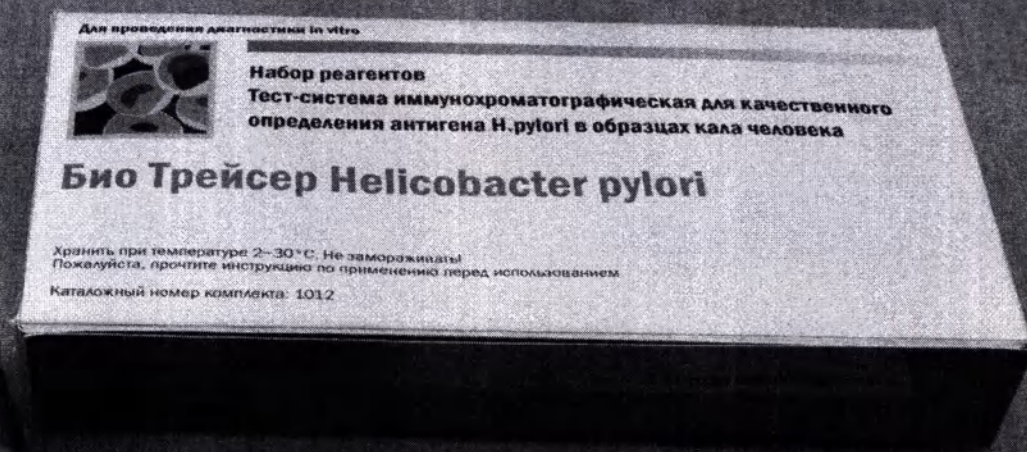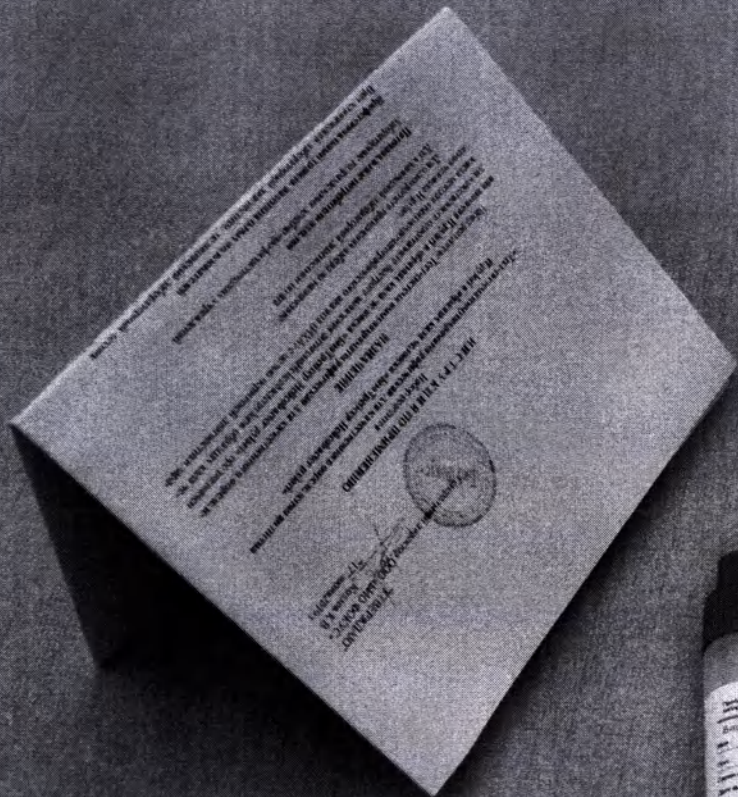

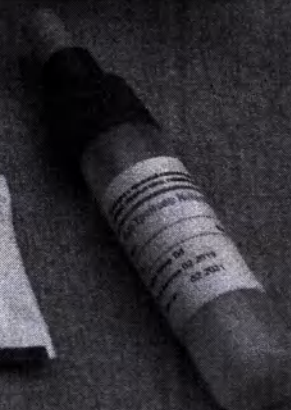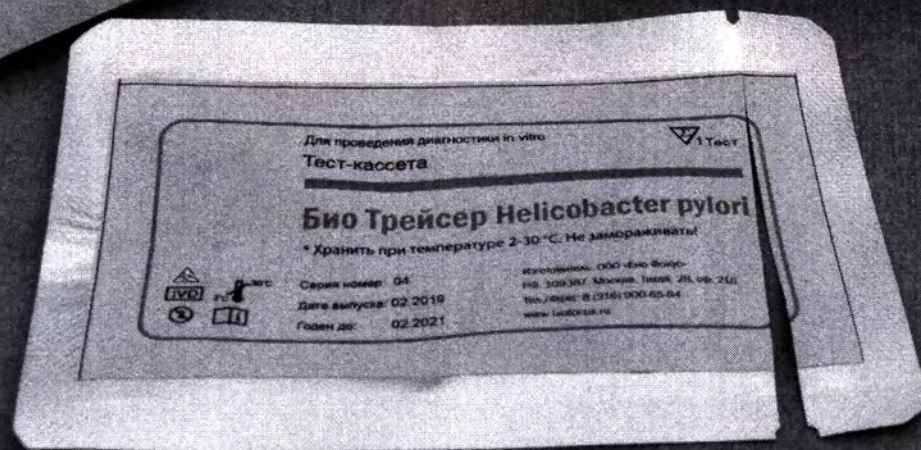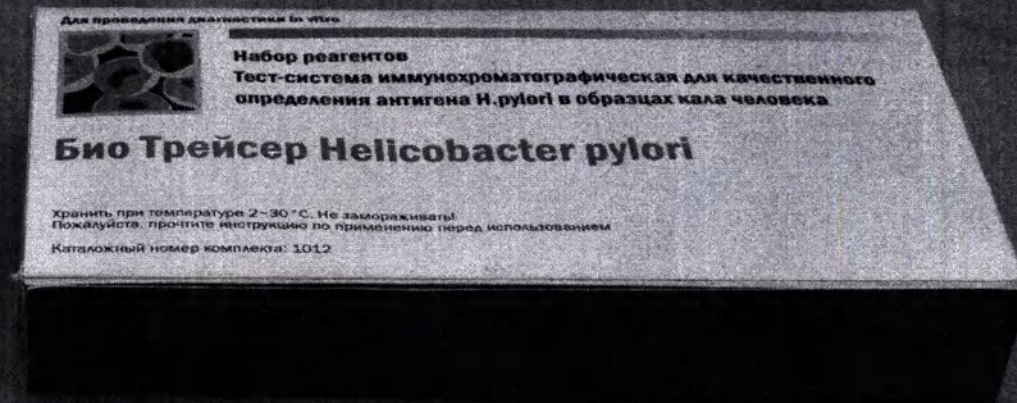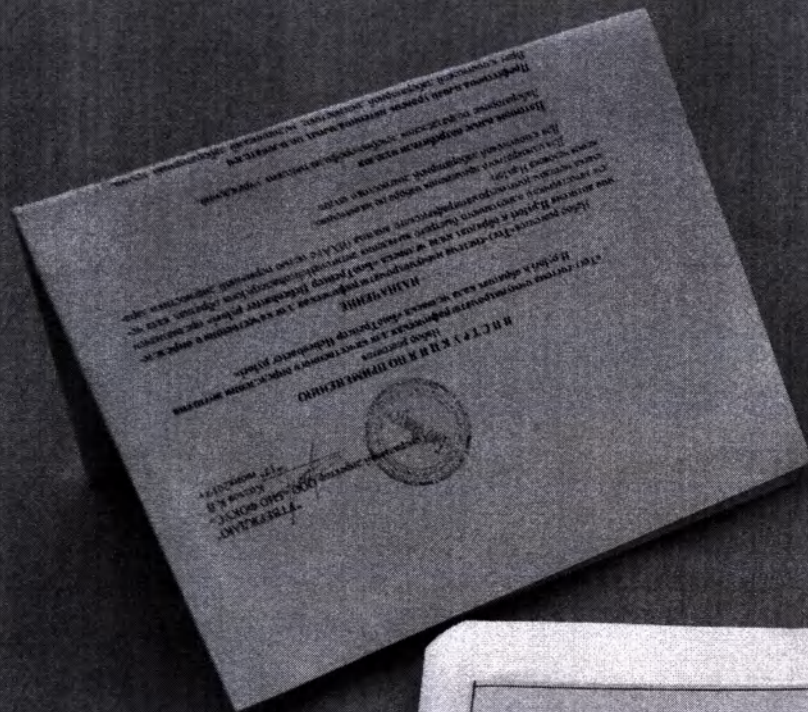




[illegible]

**Boys**

5NO Tpeaced Helicob

...the ...

1. Введение  
2. Описание объекта исследования  
3. Методика исследования  
4. Результаты исследования  
5. Заключение  
6. Литература  
7. Приложение  
8. Заключение

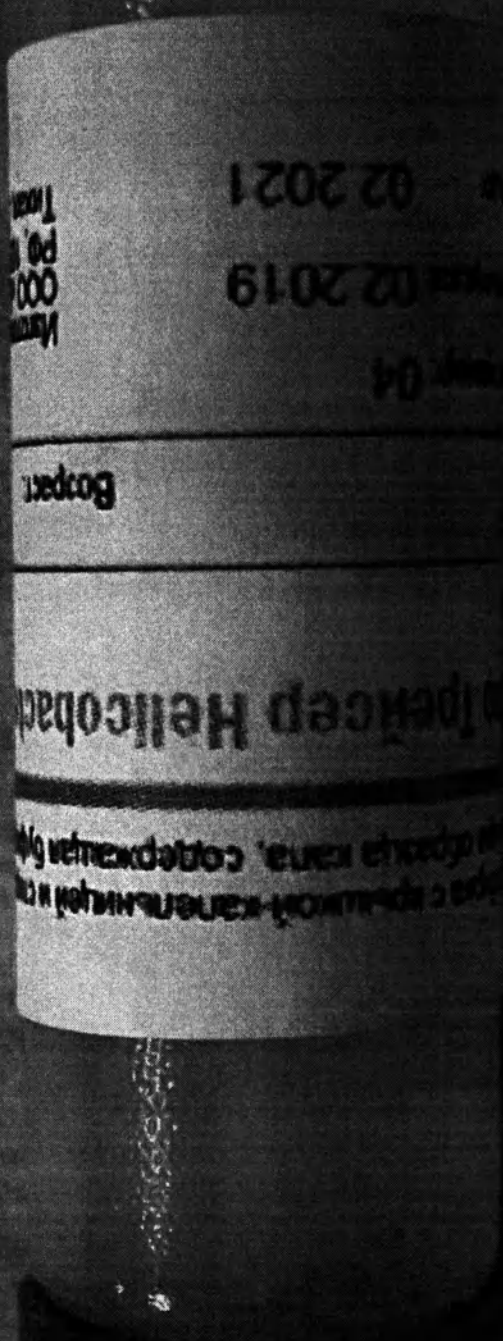

Испещер  
02 2019  
02 2021

02 2021

02 2019

04

Испещер

Испещер Helicobacter

Испещер Helicobacter, содержащий в себе

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

\_\_\_\_\_  
листов

Генеральный директор


«БИО ФОКУС» Козлов К.В.






Для проведения диагностики in vitro

Тест-кассета



## Био Трейсер Helicobacter pylori

\* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: 01

Дата выпуска: 02.2019

Годен до: 02.2021

Изготовитель: ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387 Москва, Телав. 28, оф. 216  
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84  
[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)

Прибор с кристаллокалыватель и термометр для  
измерения температуры, измерения флуоресцентного

Био Трейсер Helicobacter pylori

Имя:

Пол:

Возраст:

Серия номер 01

Дата выпуска 02.2019

Годен до: 02.2021

История  
ООО «Био Трейсер»  
РФ 100387 Москва  
Тел: 8 (495) 210-210

Пробирка с крышкой-капельницей и стержнем для  
забора образца кала, содержащая буферный раствор

## Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Имя :

---

Пол :

Возраст:

Серия номер: **01**

Дата выпуска: **02.2019**

Изготовитель:  
ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва,  
Тихая, 28, оф. 216.

Годен до: **02.2021**

Для проведения диагностики in vitro



Тест-кассета

# Био Трейсер Helicobacter pylori

\* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: **02**

Дата выпуска: **02.2019**

Годен до: **02.2021**

Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)

Серия номер: 02  
Дата выпуска: 02.2019  
Годен до: 02.2021

ТУ 21.20.23-006-15580960-2019  
РУ №

Био Трейсер

Для проведения диагностики in vitro



**Набор реагентов**

**Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антигена H.pylori в образцах кала человека**

## Био Трейсер Helicobacter pylori

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- пробирка с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор : 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.  
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84  
[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)



1 тест/набор

Для проведения диагностики in vitro



**Набор реагентов**

**Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антигена H.pylori в образцах кала человека**

## Био Трейсер Helicobacter pylori

Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!  
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1012

Био Трейсер

Пробирка с крышкой-капельницей и стержнем для  
забора образца кала, содержащая буферный раствор

## Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Имя :

---

Пол :

Возраст:

Серия номер: **02**

Дата выпуска: **02.2019**

Изготовитель:  
ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва,  
Тихая, 28, оф. 216.

Годен до: **02.2021**



Для проведения диагностики in vitro



Тест-кассета

# Био Трейсер Helicobacter pylori

\* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: **03**

Дата выпуска: **02.2019**

Годен до: **02.2021**

Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)

забора образца кала, содержащая буферный раствор

# Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Имя :

---

Пол :

Возраст:

---

Серия номер: **03**


Дата выпуска: **02.2019**

Годен до: **02.2021**

Изготовитель:  
ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва,  
Тихая, 28, оф. 216.

Био Трейсер

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антигена *H. pylori* в образцах кала человека

## Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- пробирка с крышкой-капельницей и стержнем для забора образца кала, содержащая буферный раствор: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.  
Тел/Факс: 8 (916) 900-65-84  
[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)



1 тест/набор

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антигена *H. pylori* в образцах кала человека

## Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Хранить при температуре 2–30°С. Не замораживать!  
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Каталожный номер комплекта: 1012

Био Трейсер

Для проведения диагностики in vitro



Тест-кассета

# Био Трейсер Helicobacter pylori

\* Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!



Серия номер: **04**

Дата выпуска: **02.2019**

Годен до: **02.2021**

Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216.

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

[www.biofocus.ru](http://www.biofocus.ru)

забора образца кала, содержащая буферный раствор

# Био Трейсер *Helicobacter pylori*

Имя :

---

Пол :

Возраст:

Серия номер: **04**

Дата выпуска: **02.2019**

Годен до: **02.2021**

Изготовитель:  
ООО «Био Фокус»  
РФ, 109387, Москва,  
Тихая, 28, оф. 216.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов  
Генеральный директор  
«БИО ФОКУС» Козлов К.В.

