



Анастомат для циркумизии одноразовый


**Анастомат для циркумизии одноразовый, 10 мм (ZSR-DCA-10)
с защитным колпачком**

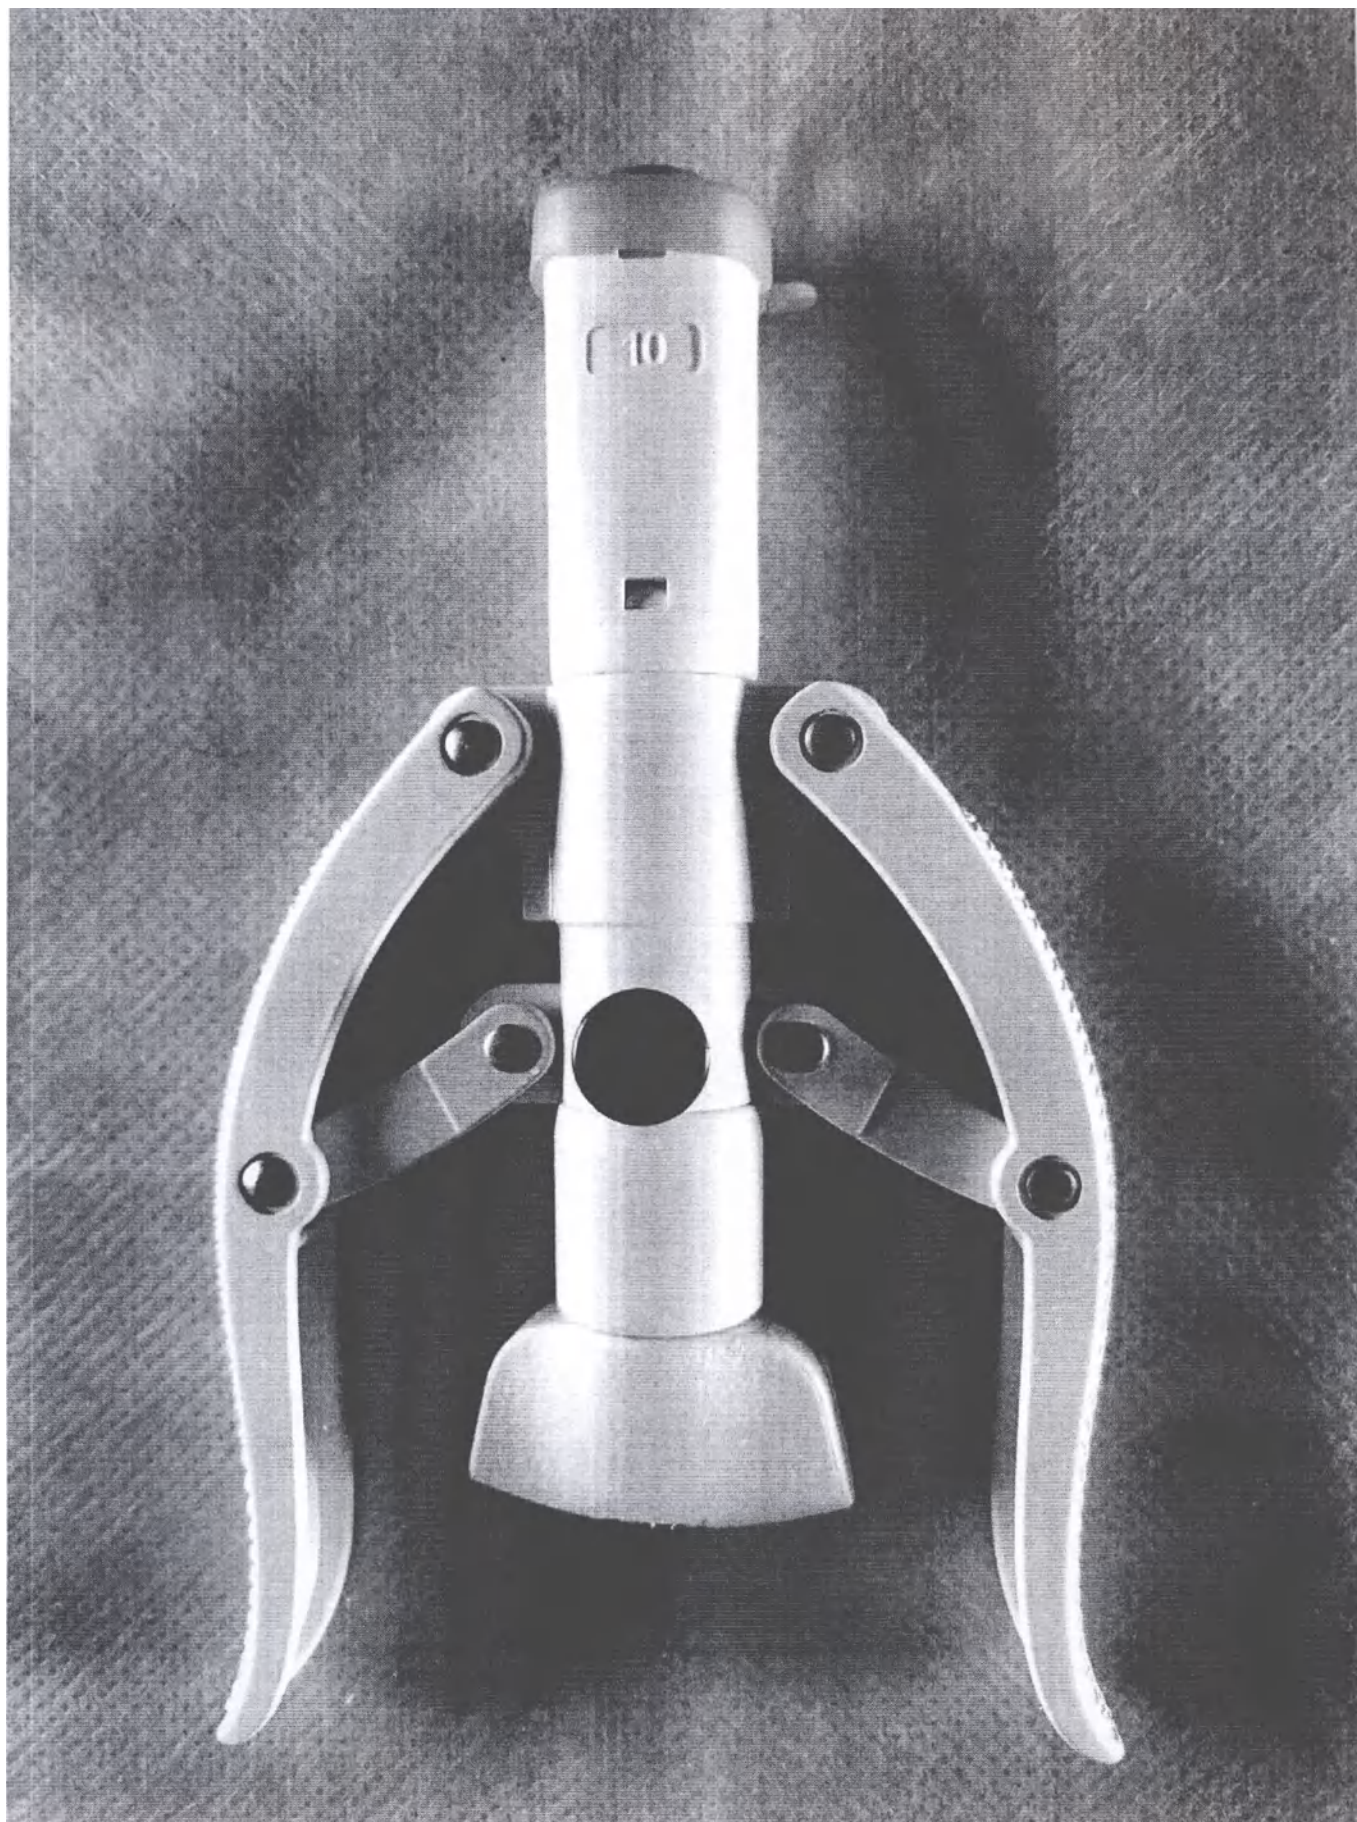


**Анастомат для циркумизии одноразовый, 10 мм (ZSR-DCA-10)
без защитного колпачка**

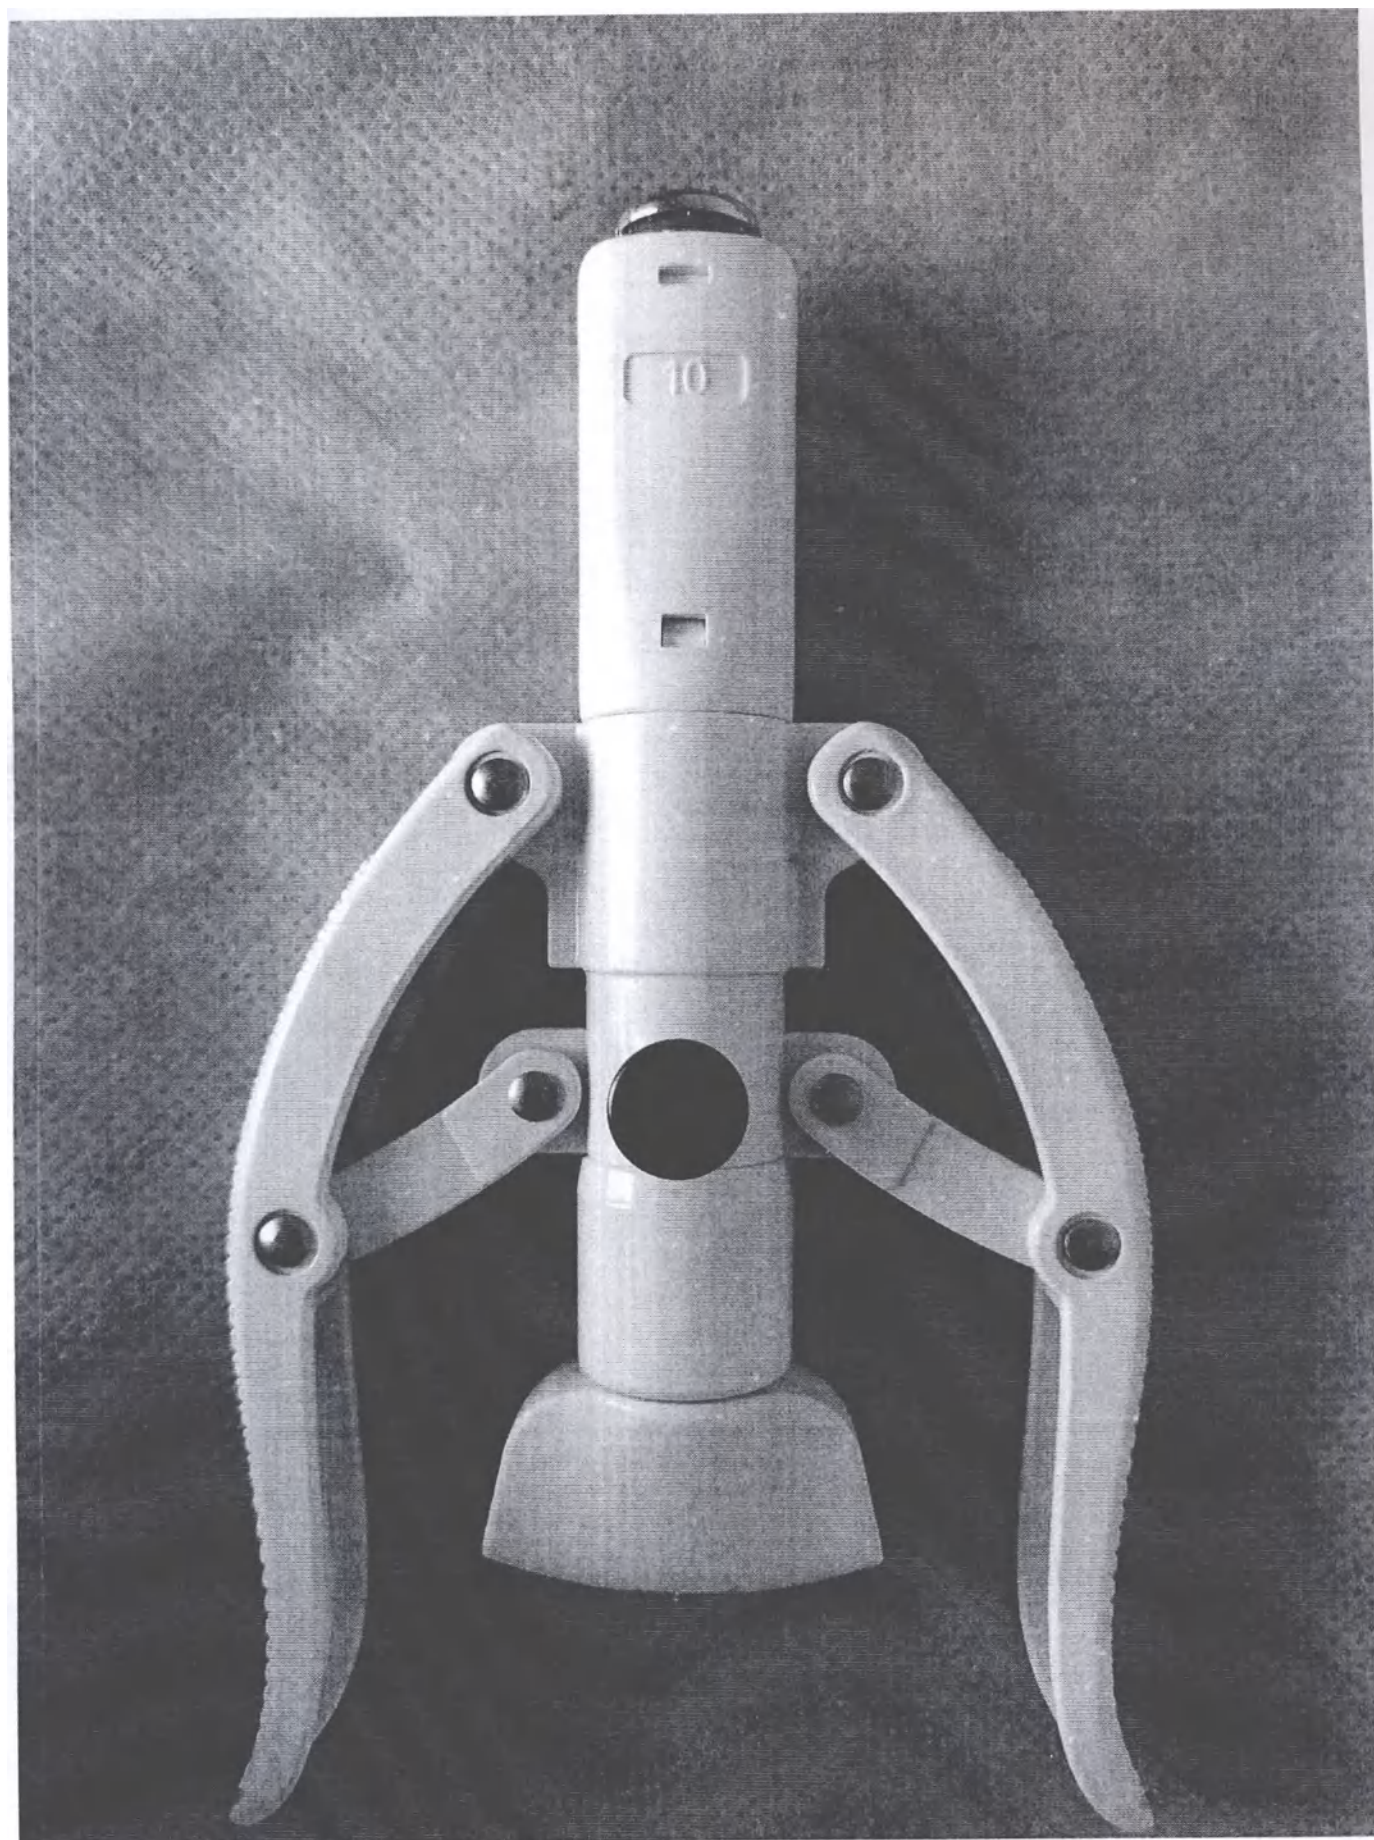


Анастомат для циркумизии одноразовый, 10 мм (ZSR-DCA-10)
без защитного колпачка

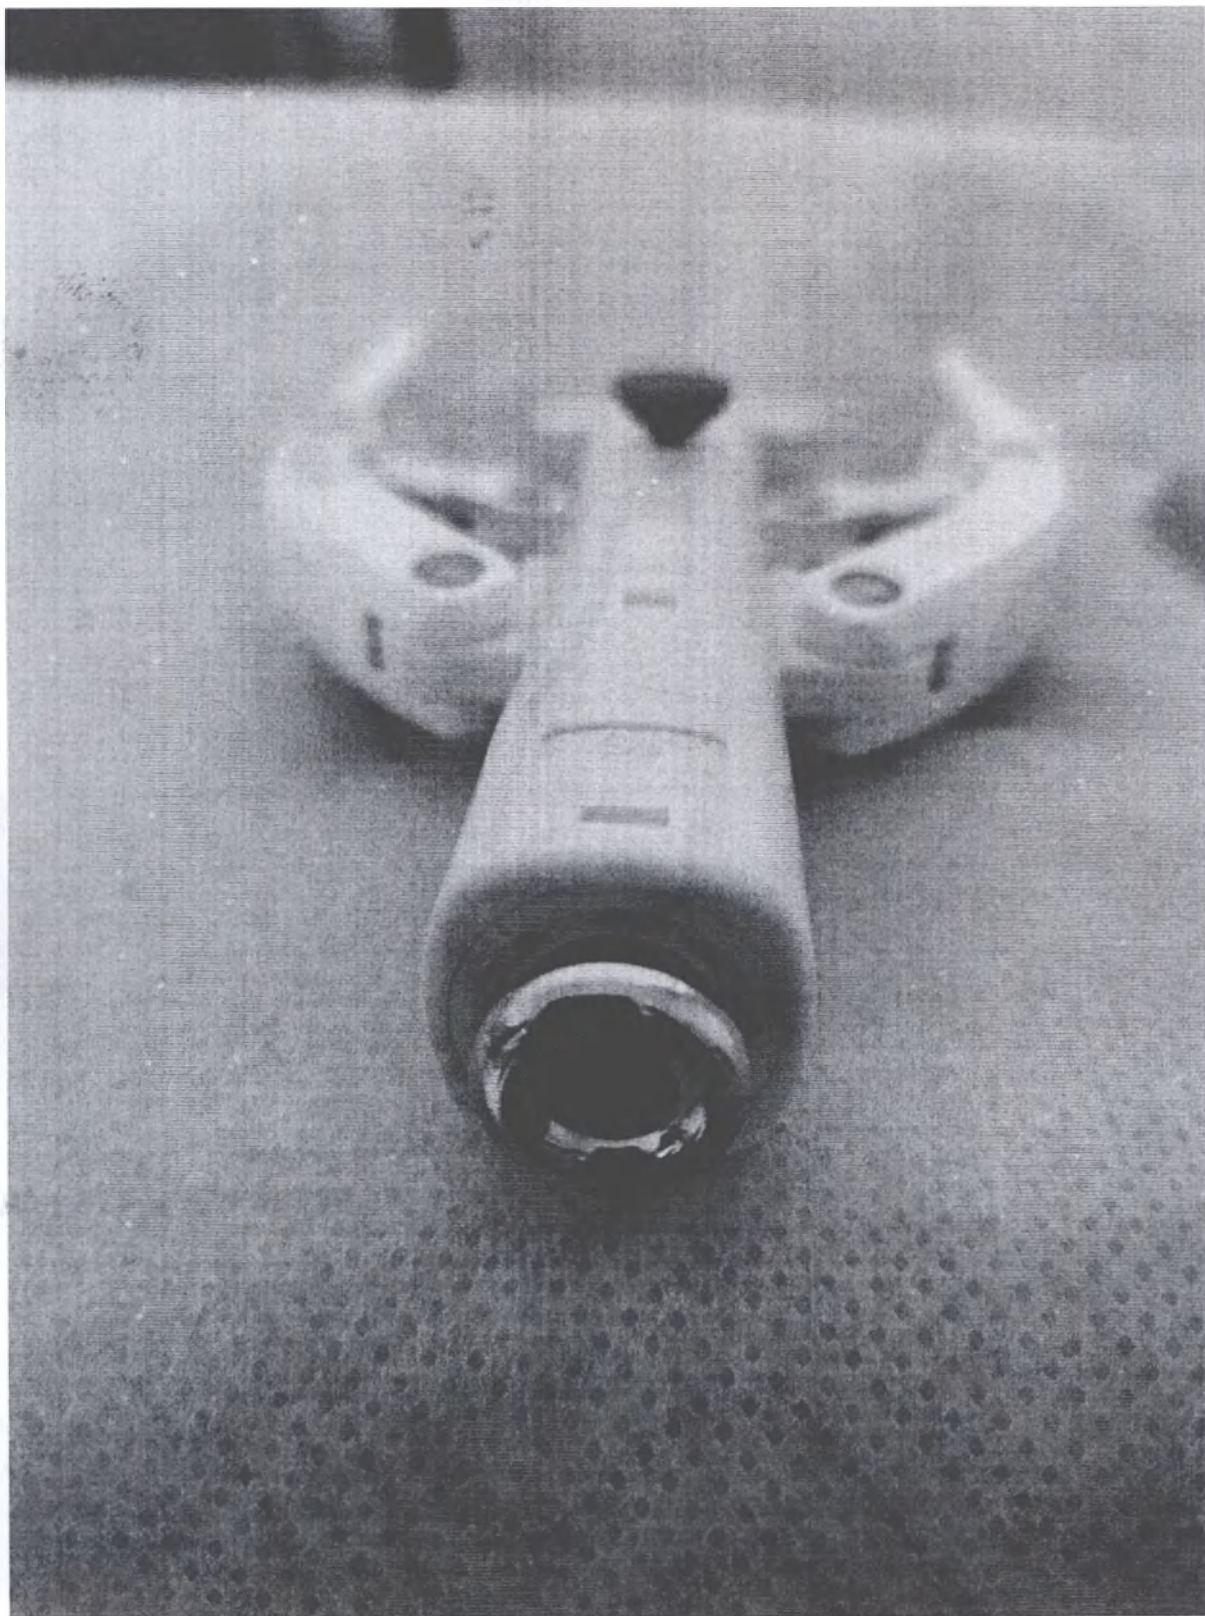


Анастомат для циркумизии одноразовый, 14 мм (ZSR-DCA-14)
с защитным колпачком

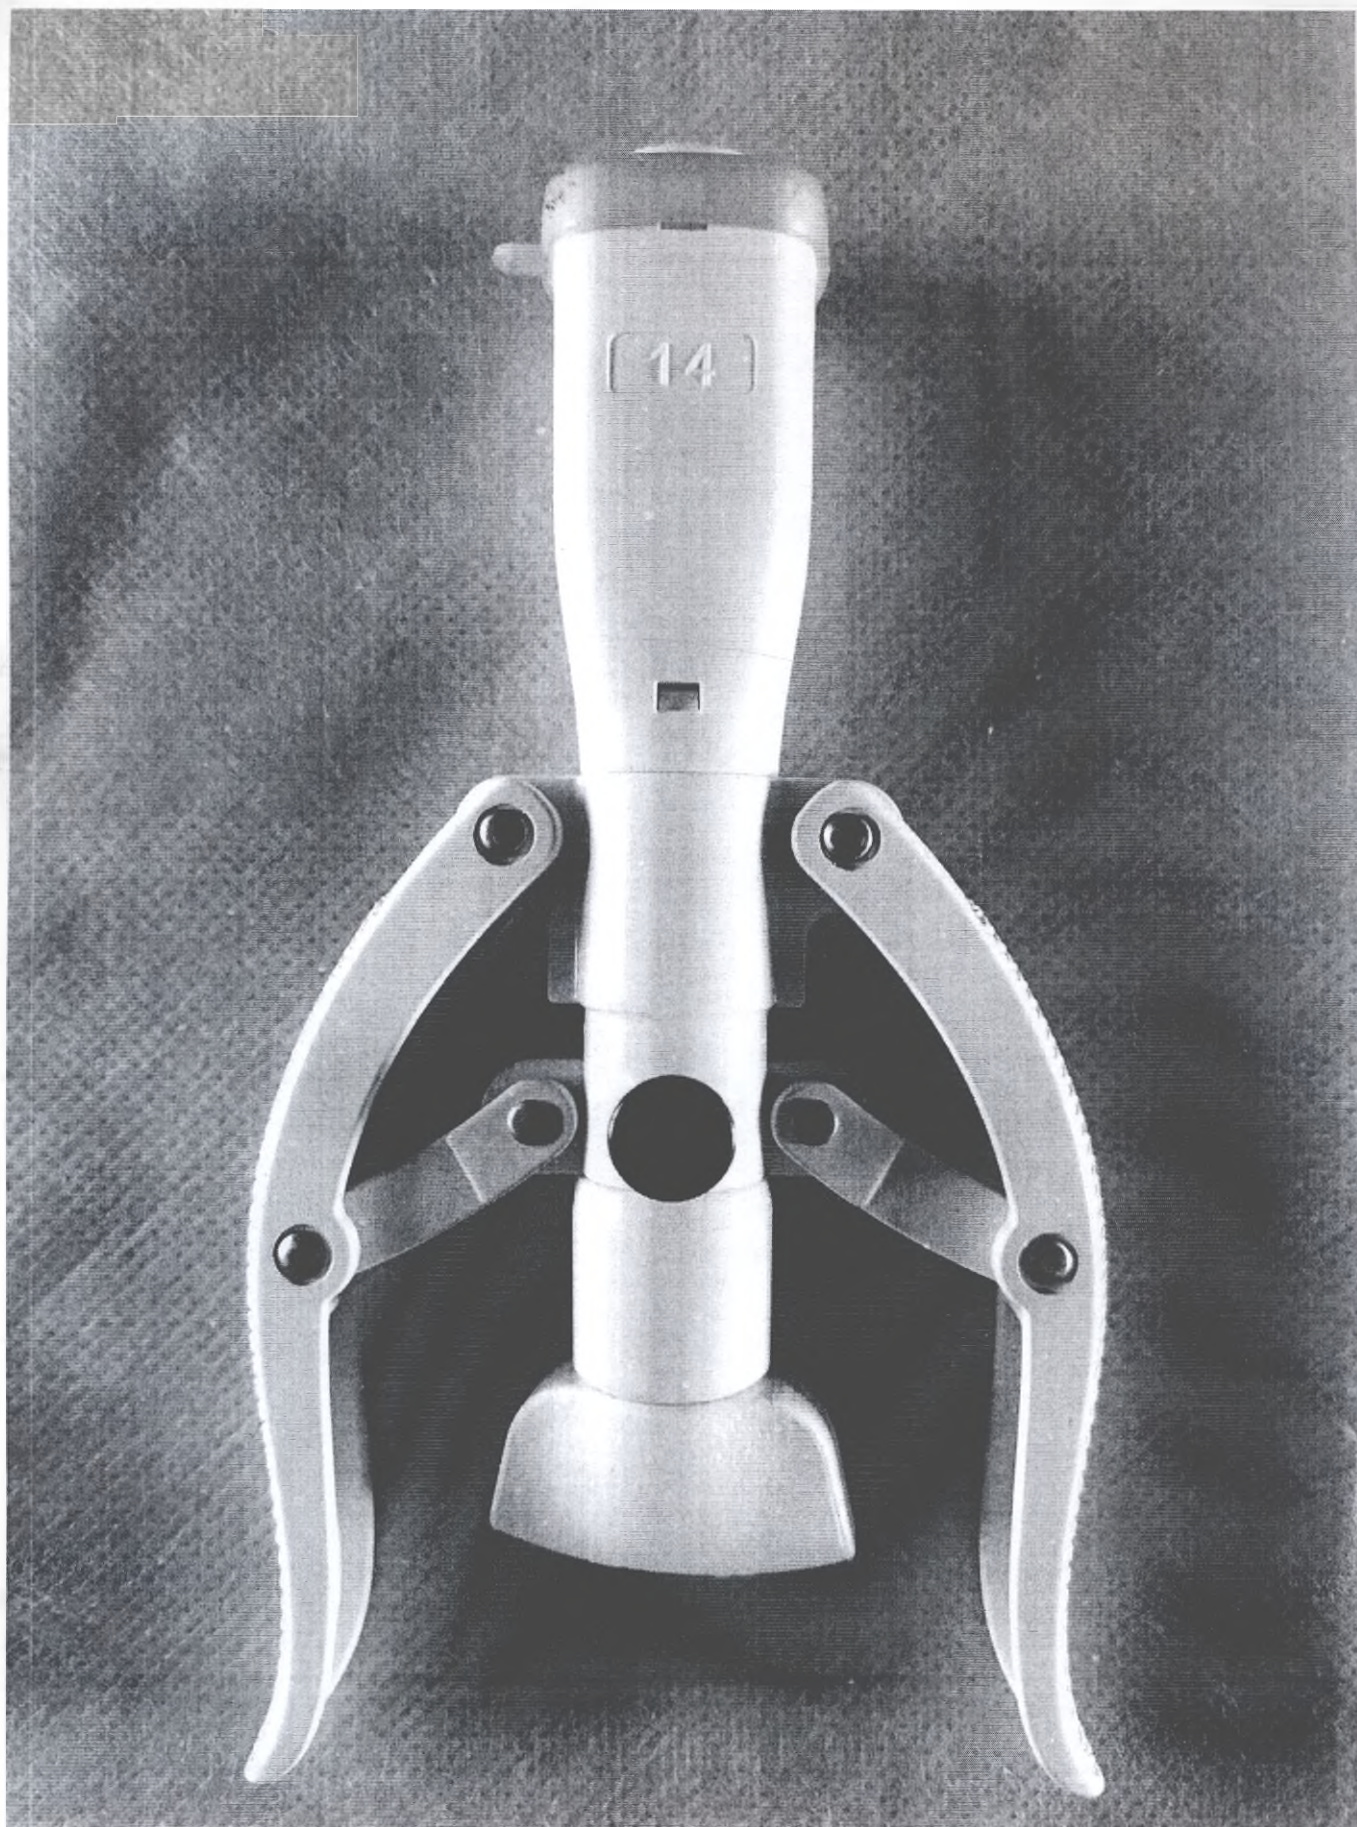


Анастомат для циркумизии одноразовый, 14 мм (ZSR-DCA-14)
без защитного колпачка

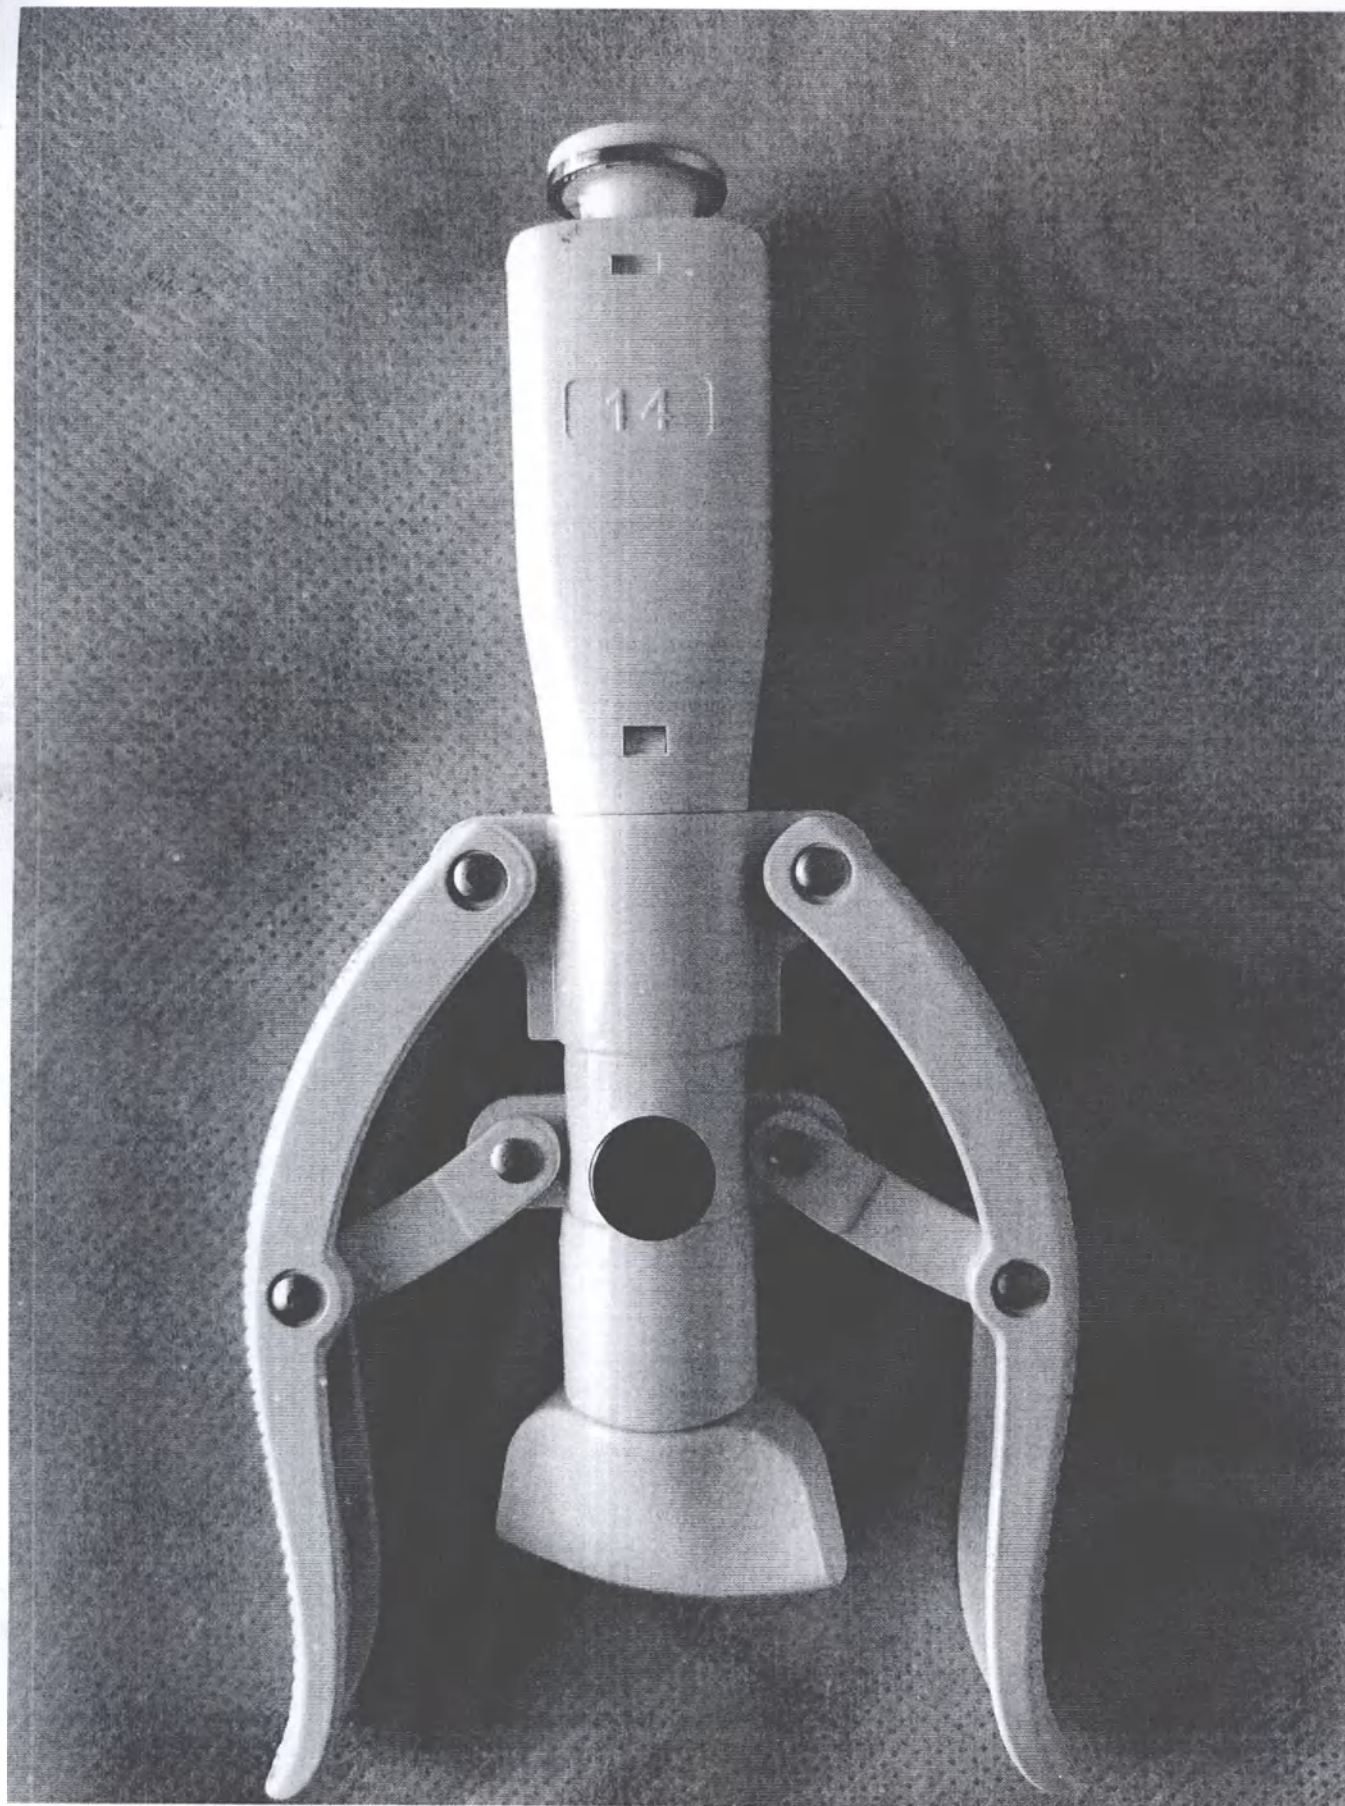


Анастомат для циркумизии одноразовый, 14 мм (ZSR-DCA-14)
без защитного колпачка

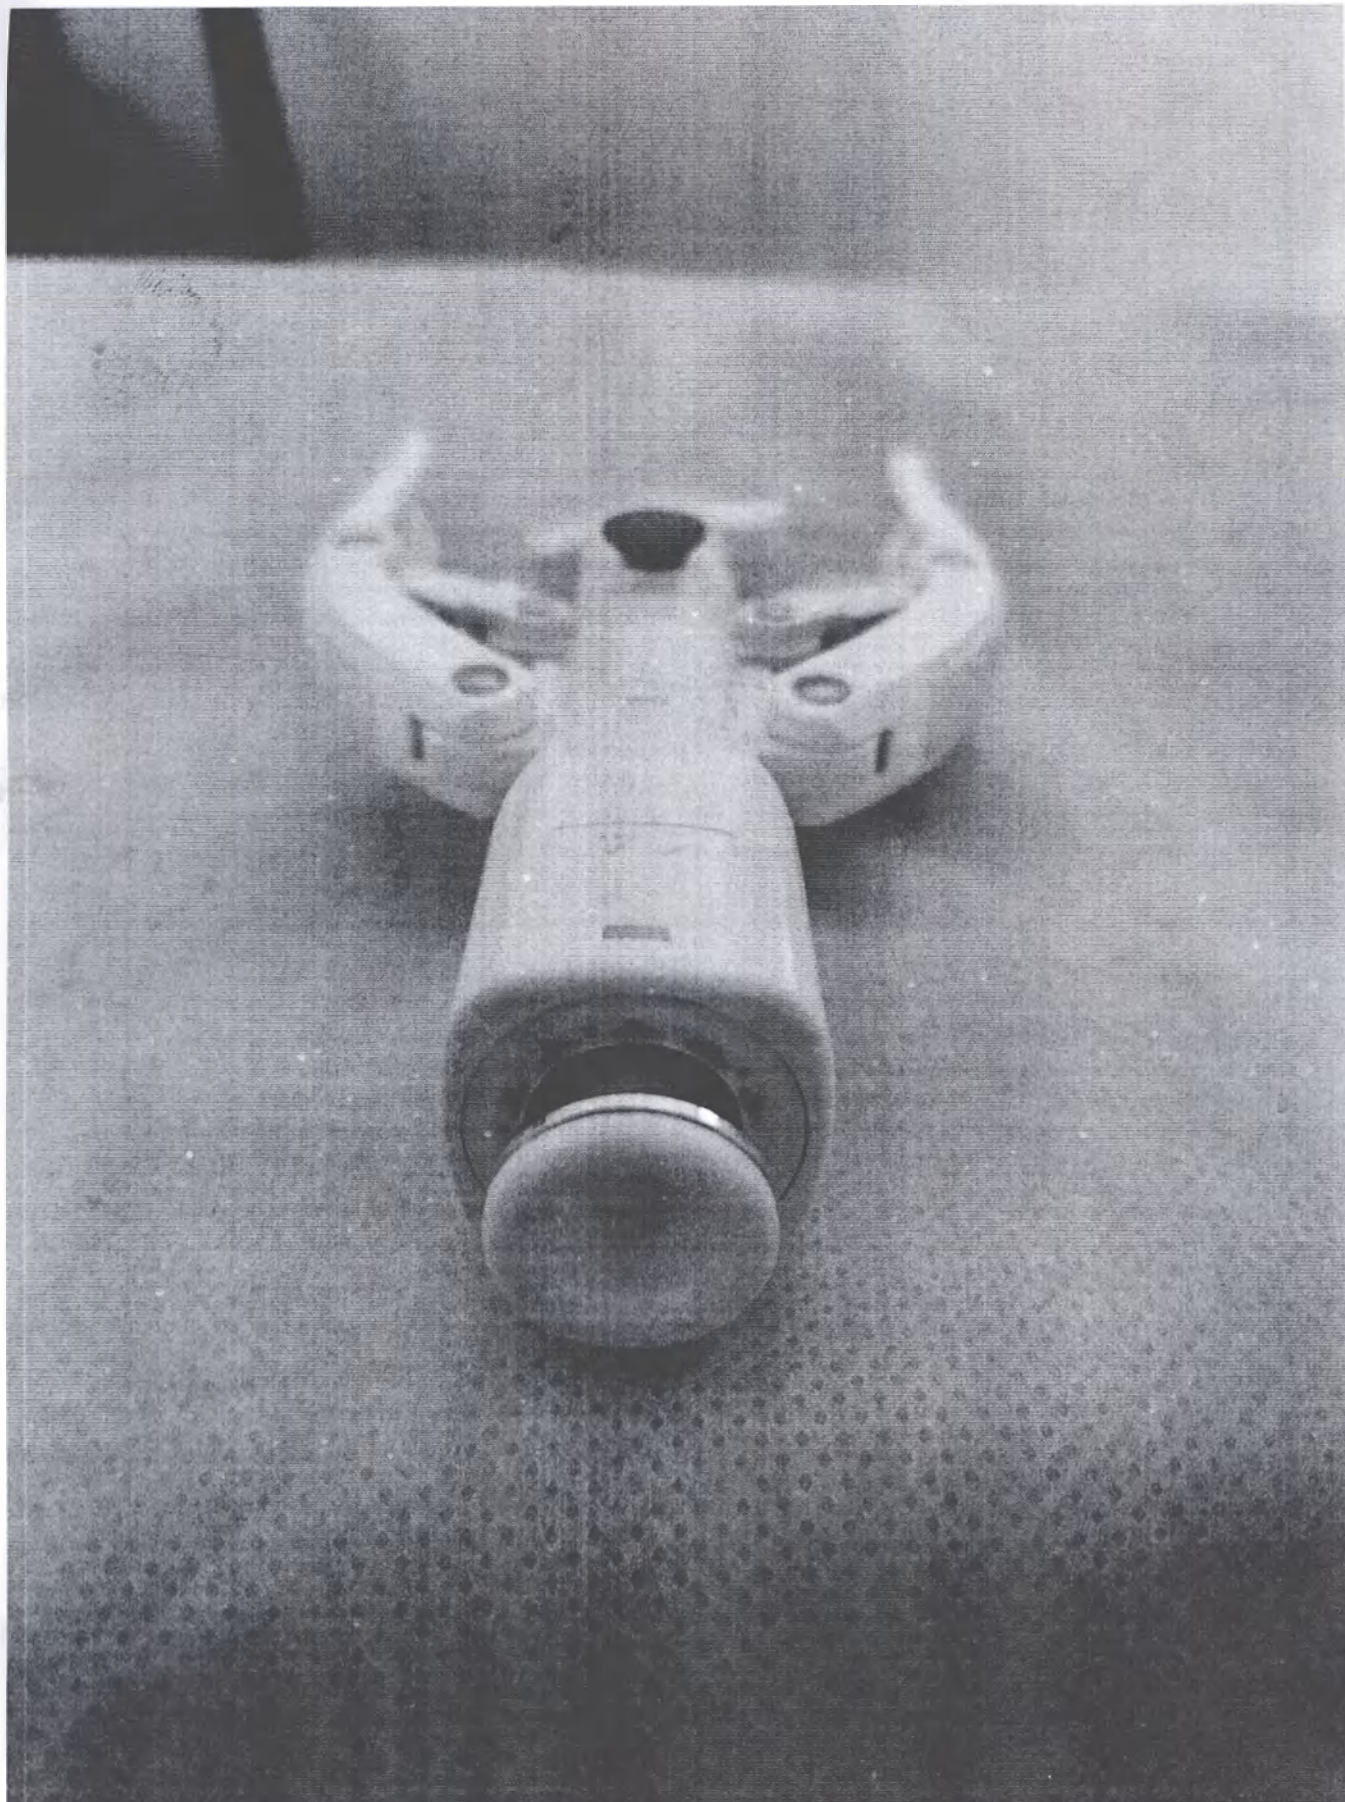


**Анастомат для циркумизии одноразовый, 18 мм (ZSR-DCA-18)
с защитным колпачком**

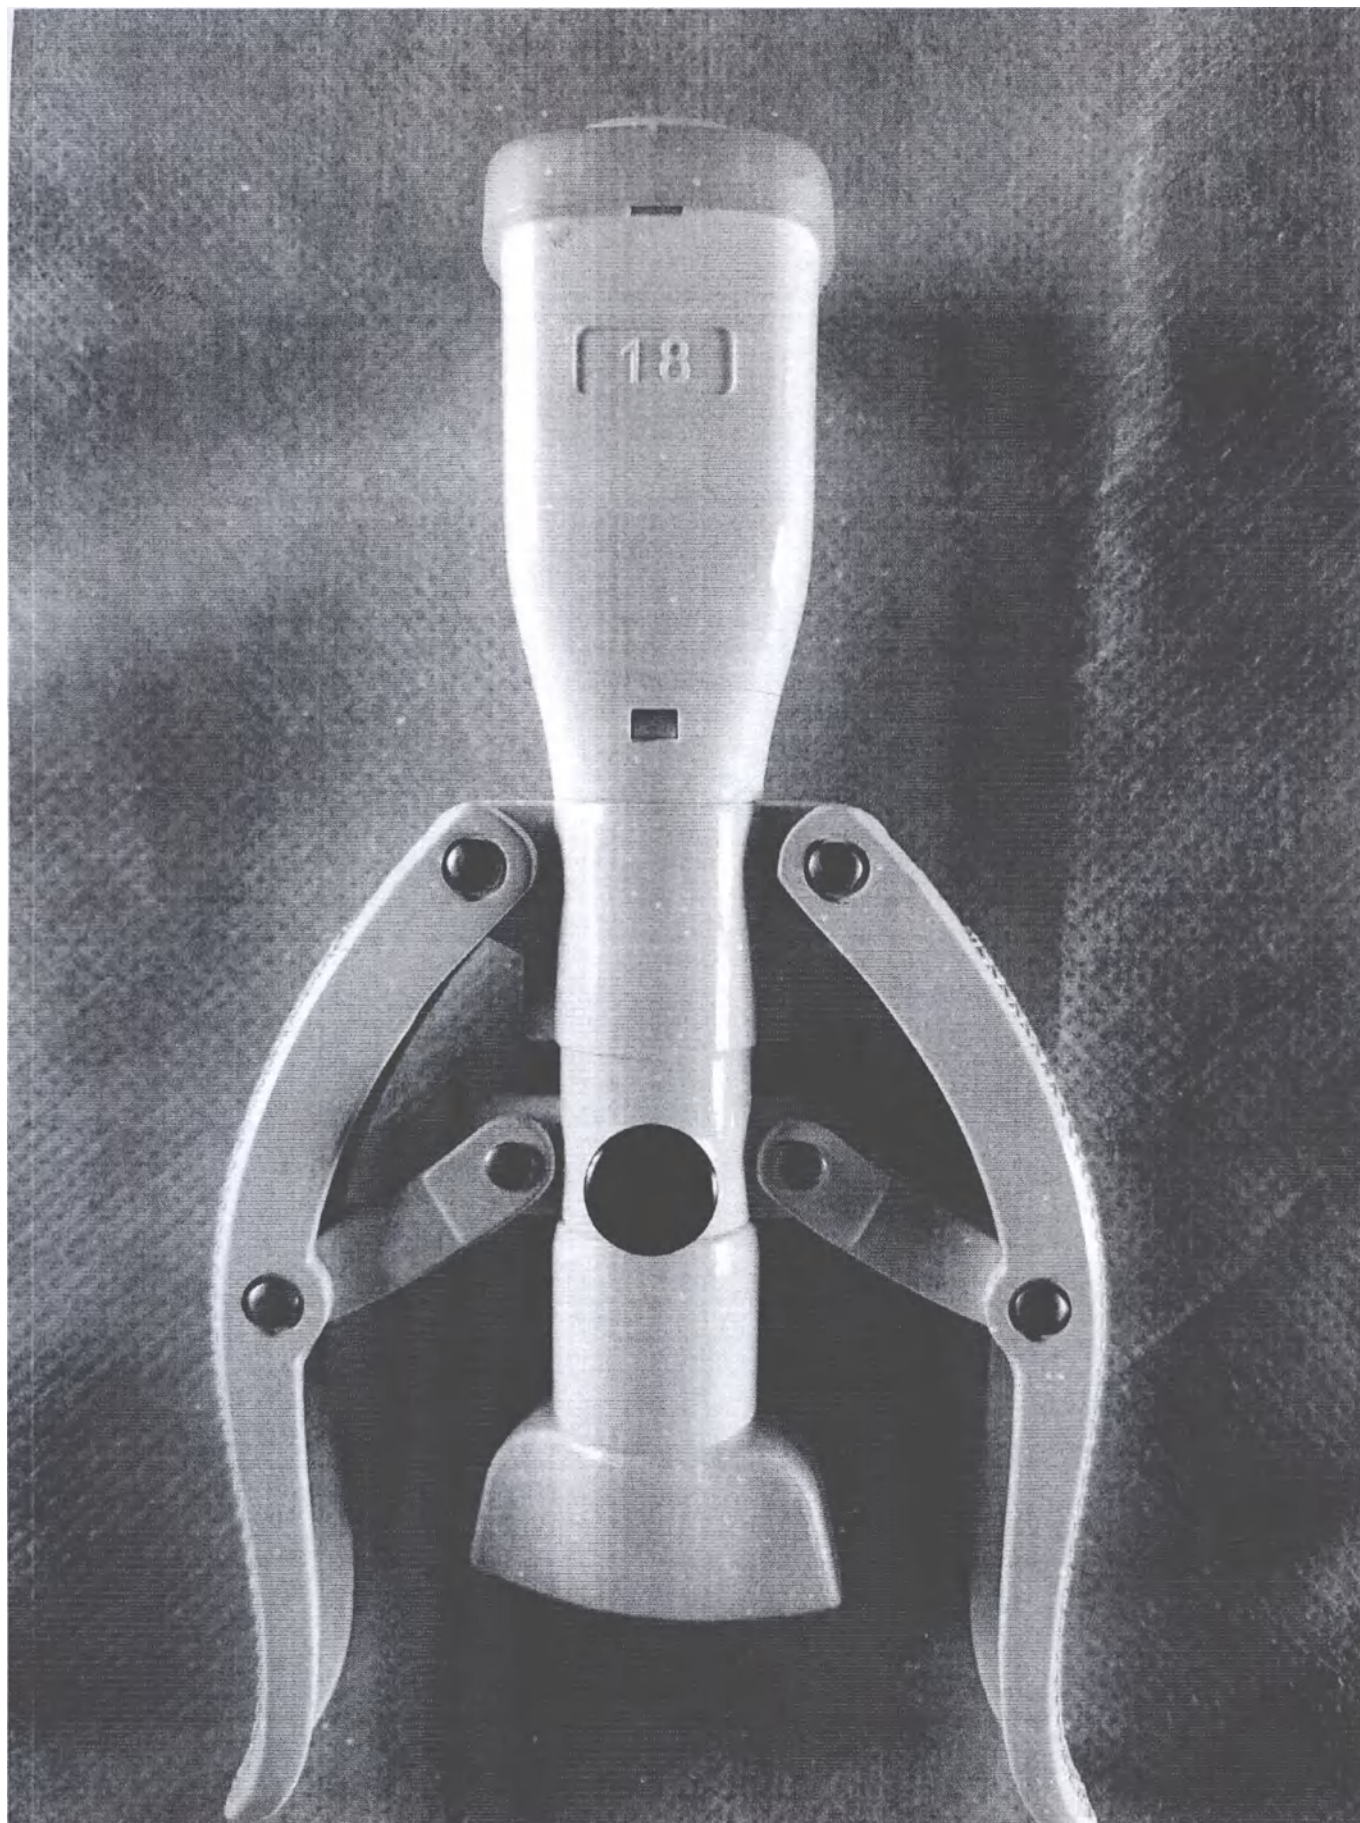


Анастомат для циркумизии одноразовый, 18 мм (ZSR-DCA-18)
без защитного колпачка

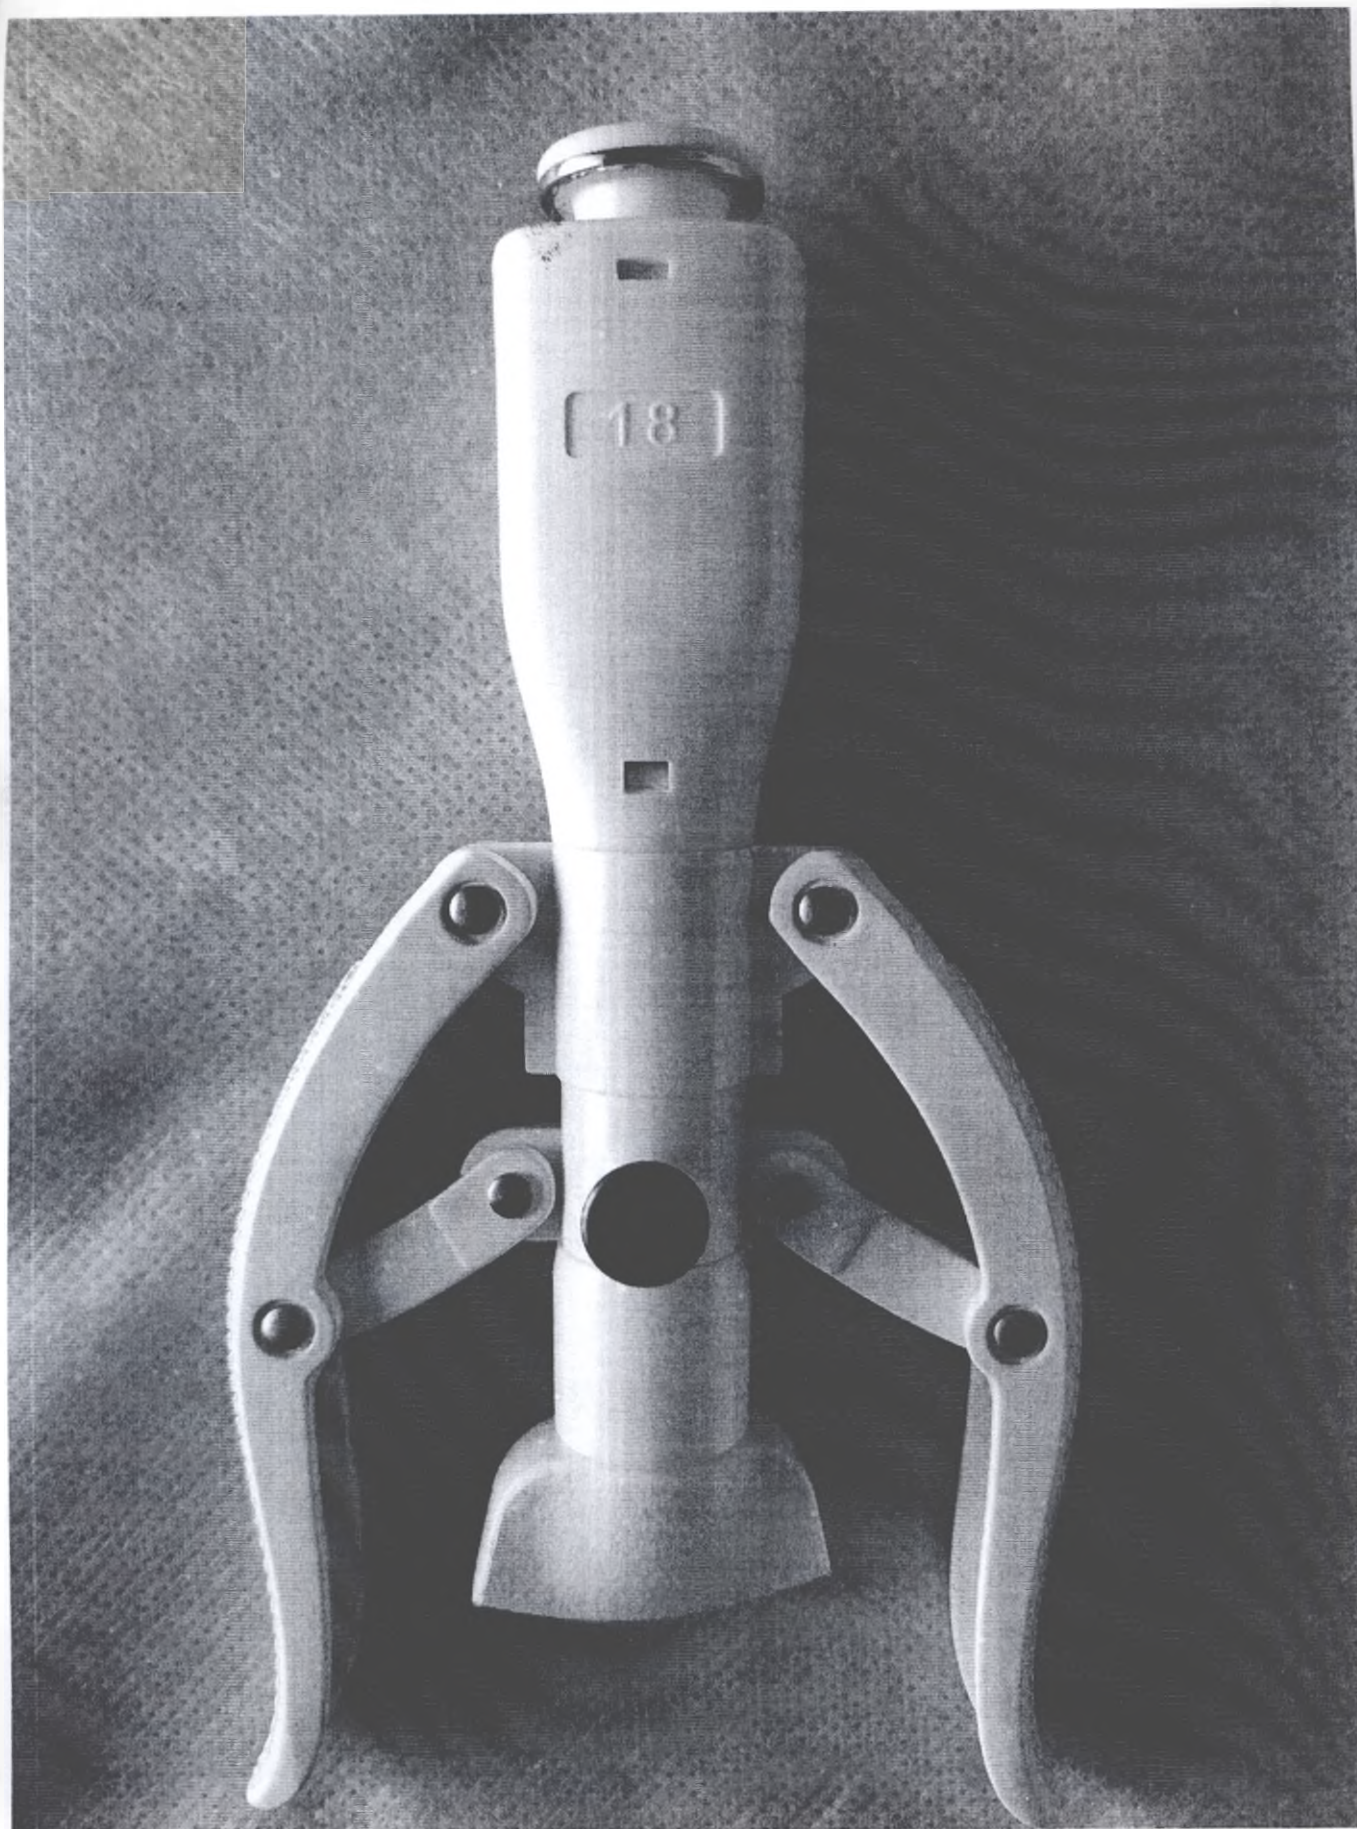


Анастомат для циркумизии одноразовый, 18 мм (ZSR-DCA-18)
без защитного колпачка

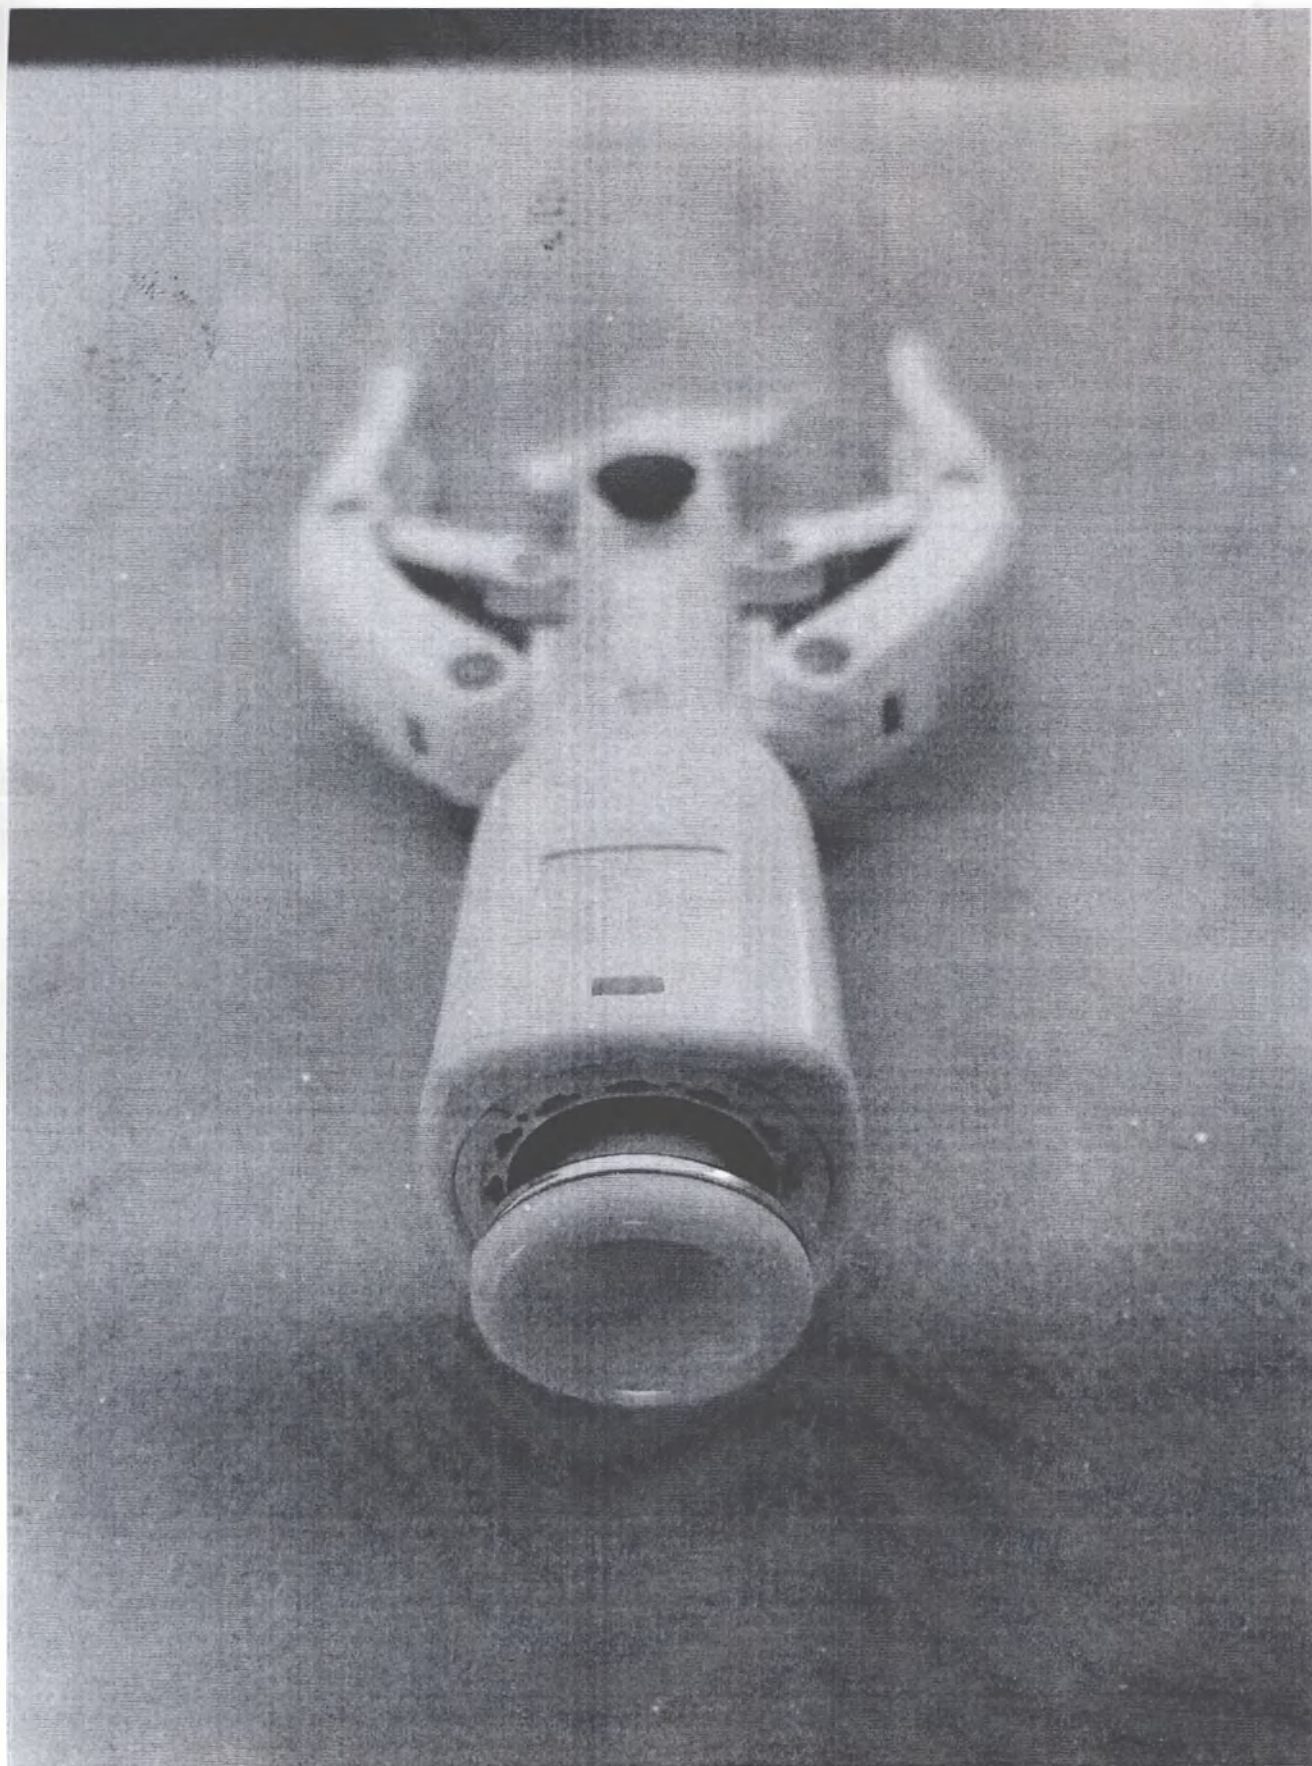


Анастомат для циркумизии одноразовый, 22 мм (ZSR-DCA-22)
с защитным колпачком

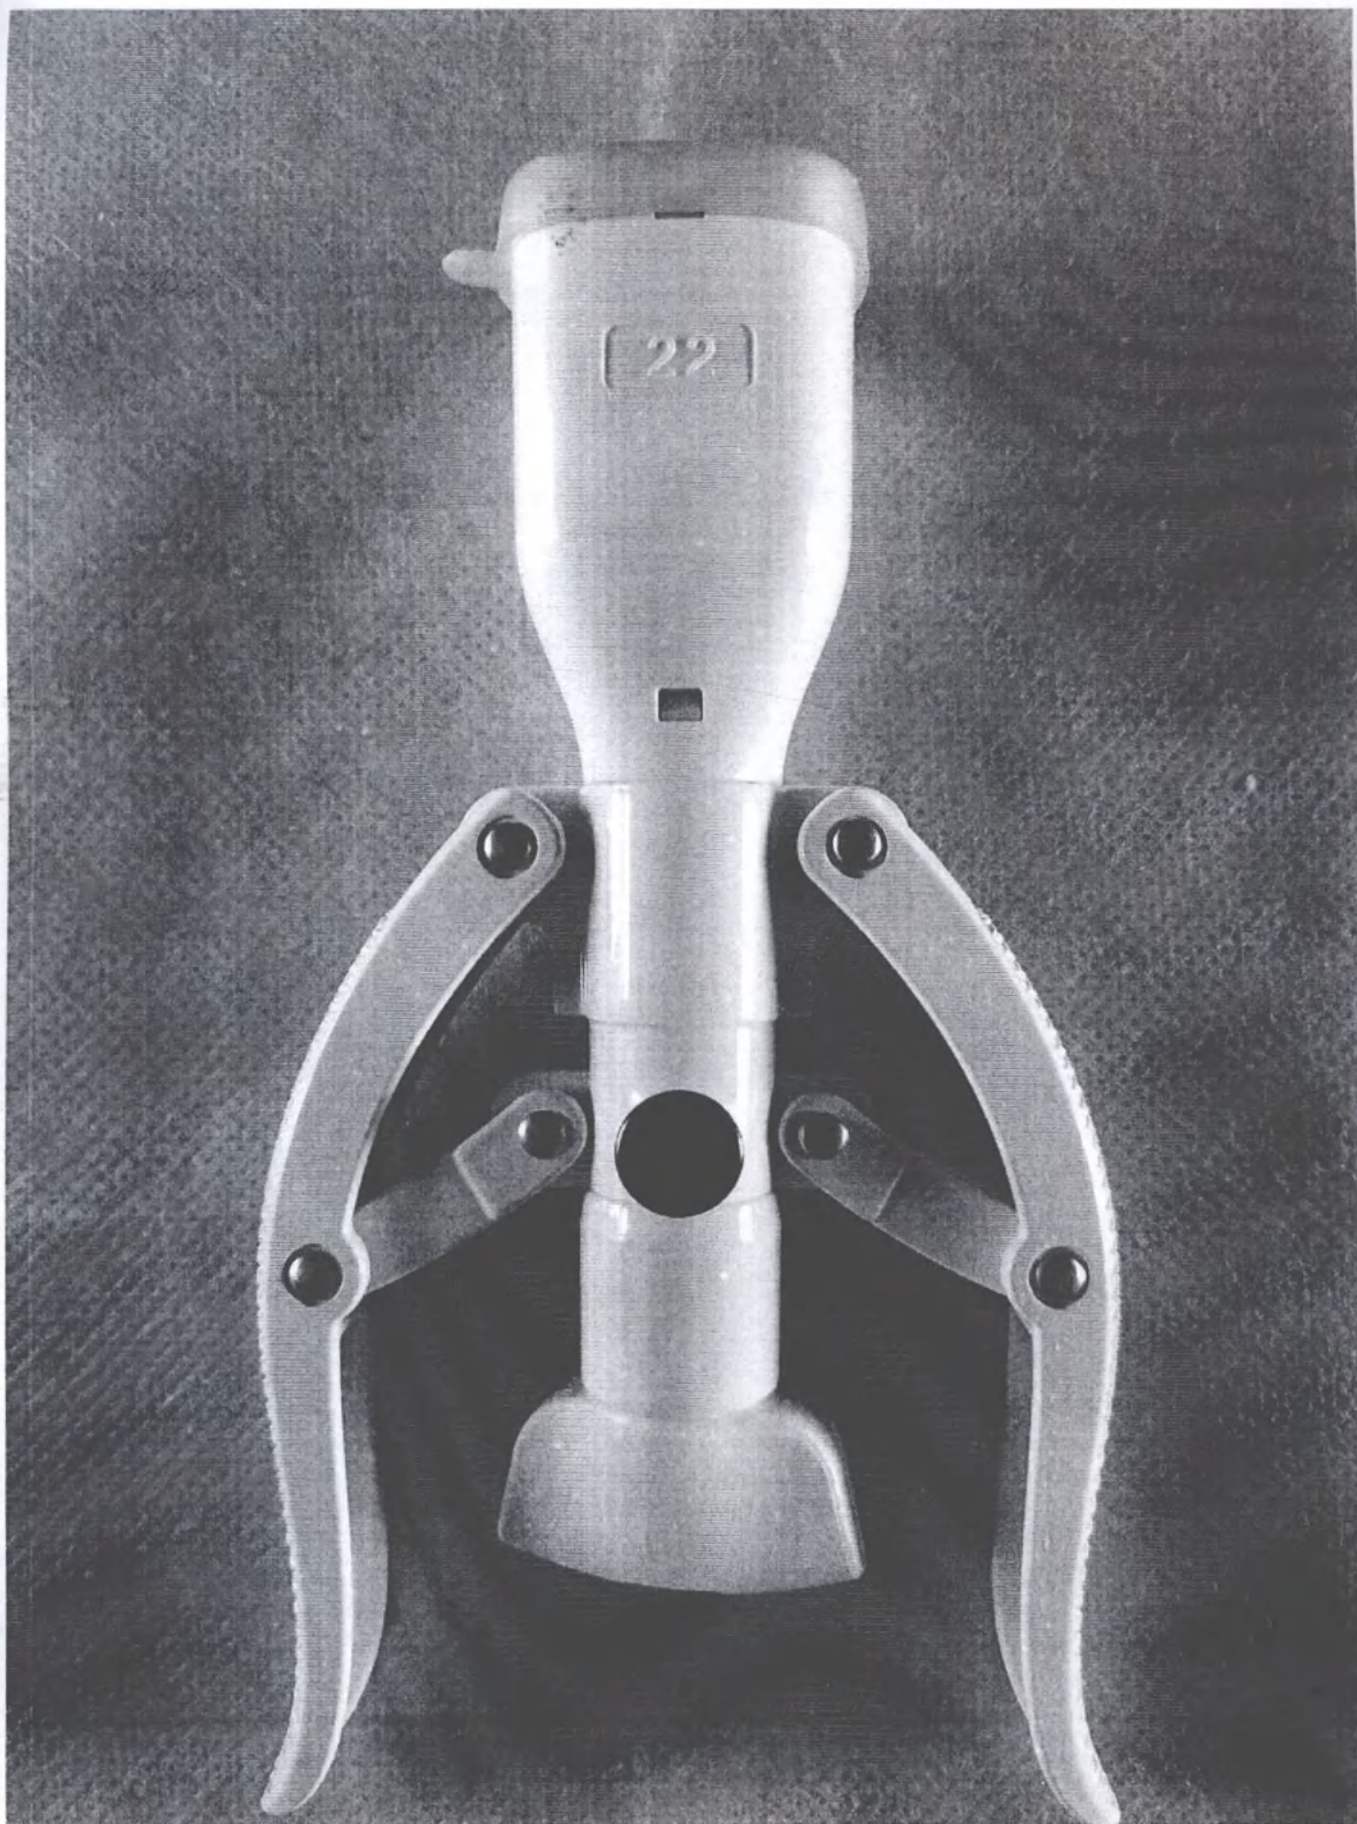


**Анастомат для циркумизии одноразовый, 22 мм (ZSR-DCA-22)
без защитного колпачка**

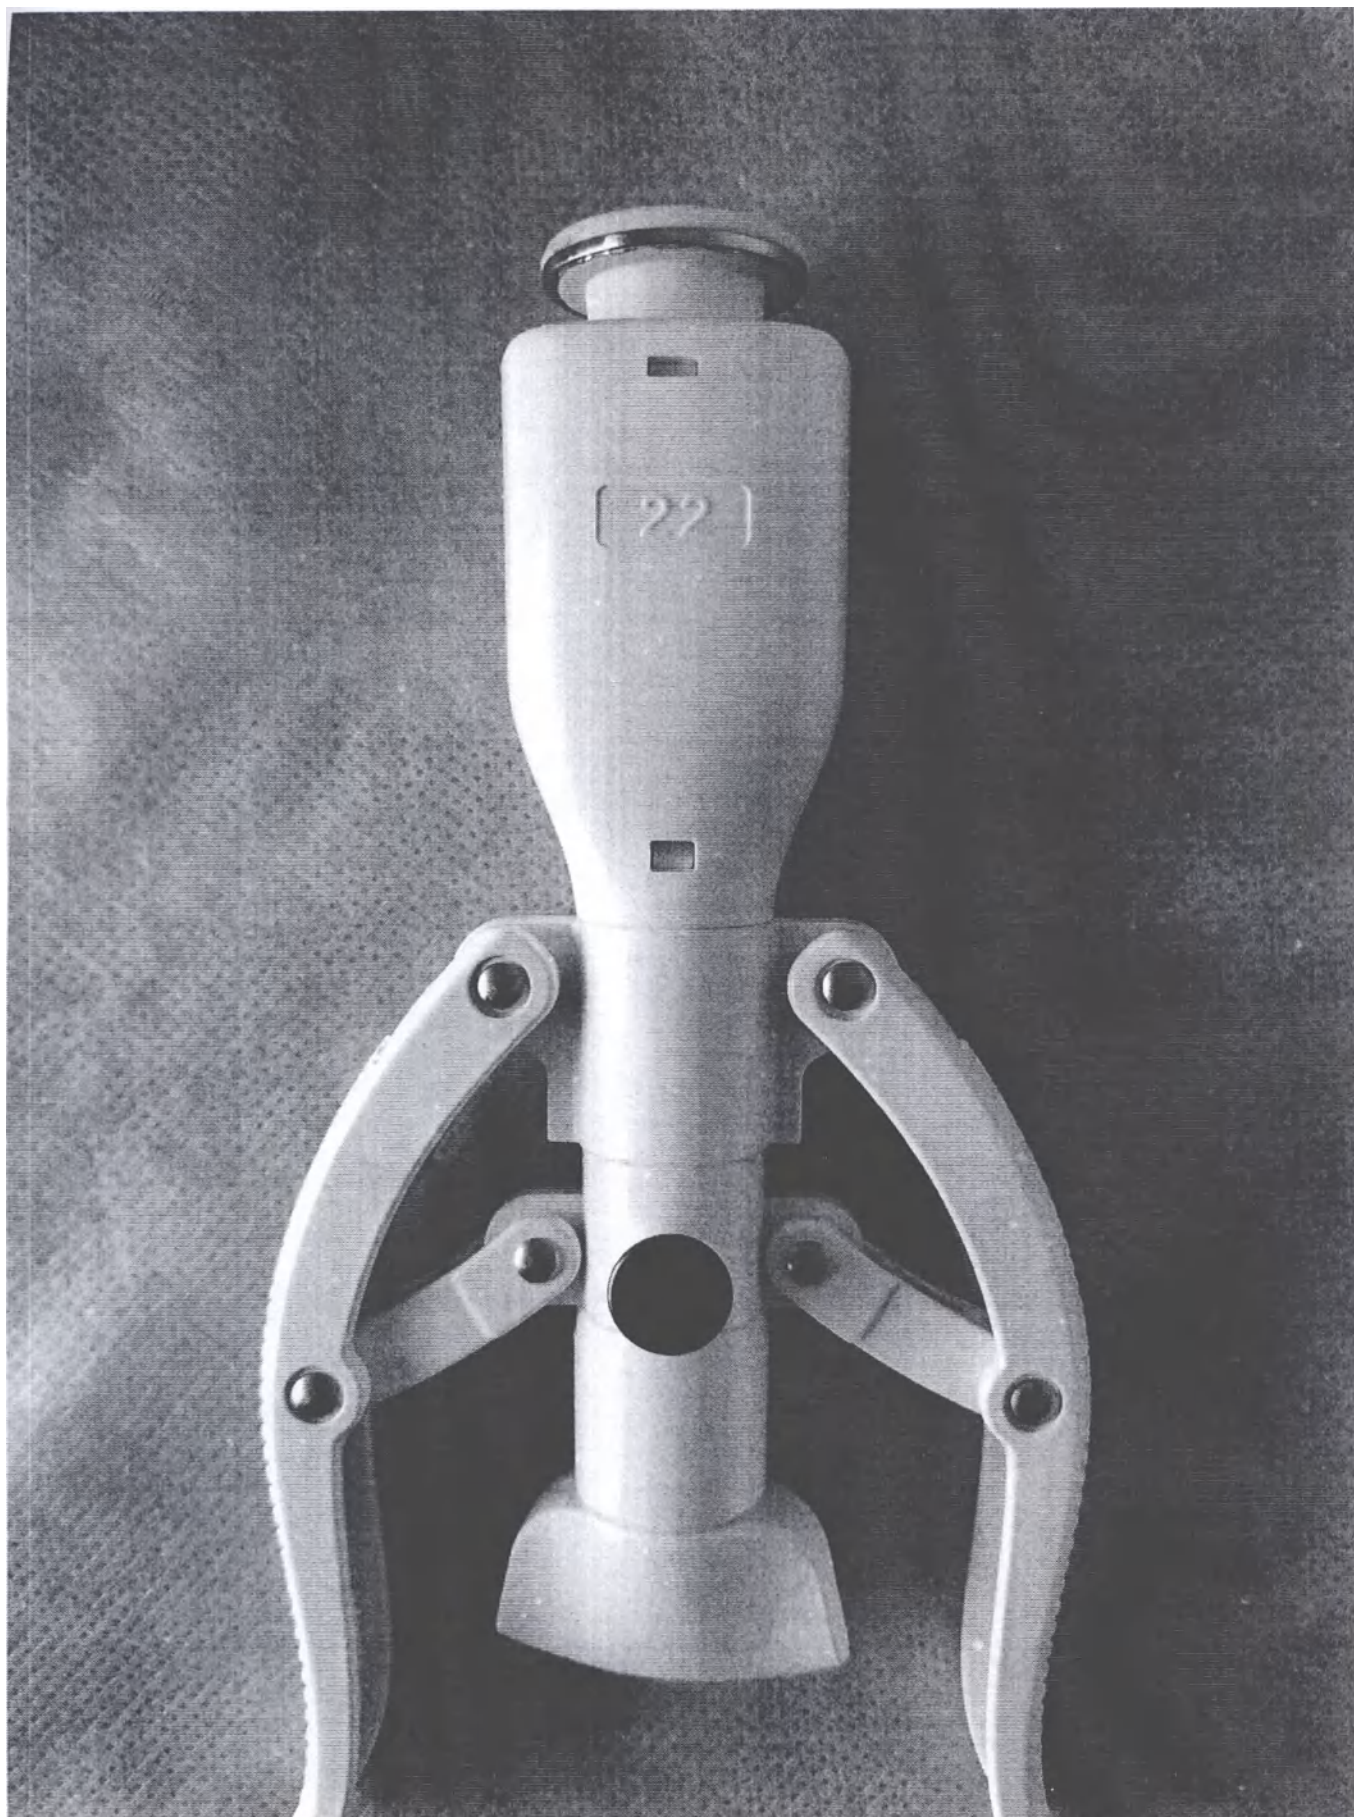


Анастомат для циркумизии одноразовый, 22 мм (ZSR-DCA-22)
без защитного колпачка

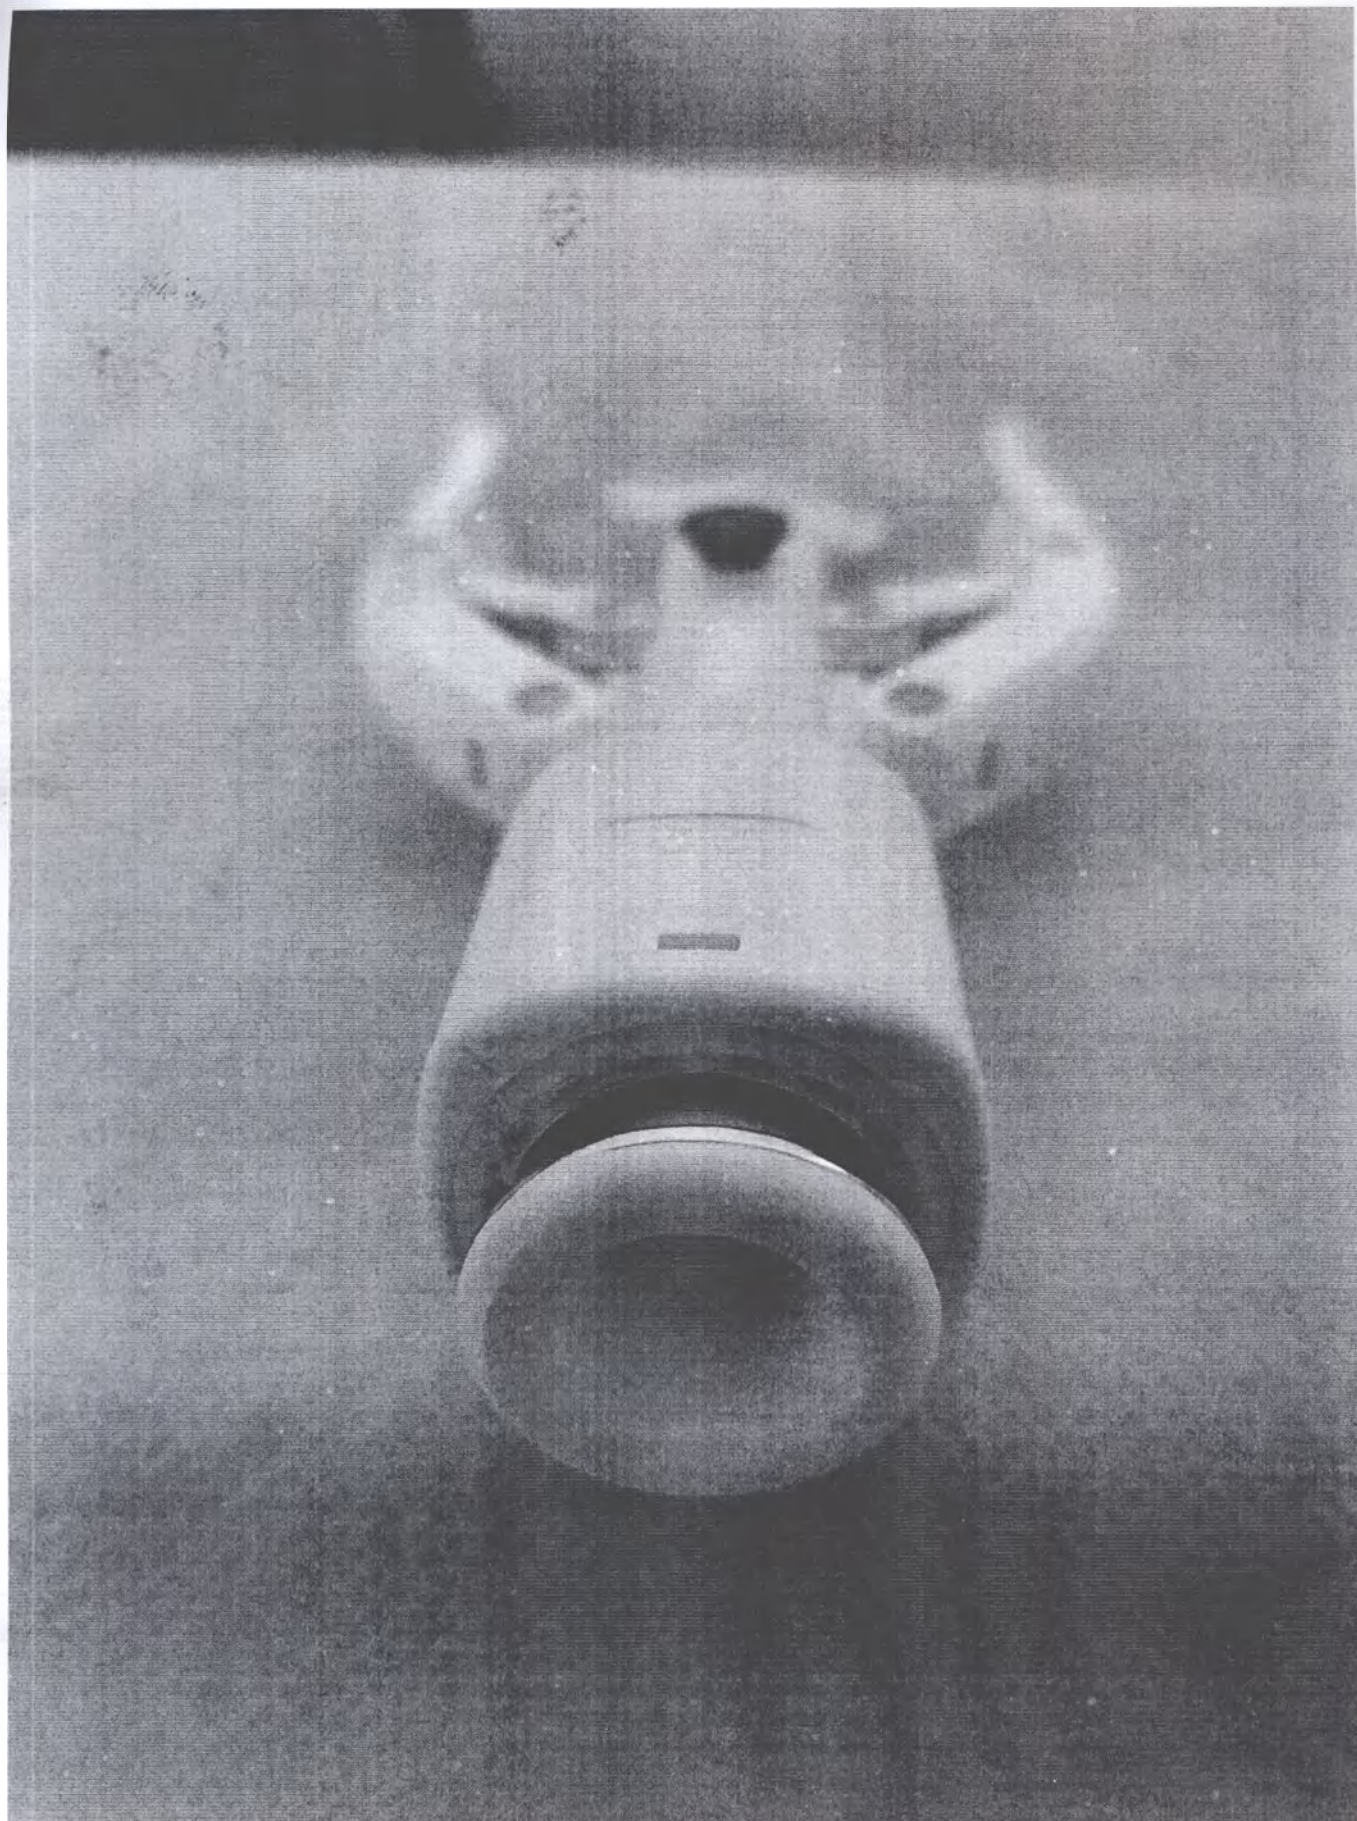


**Анастомат для циркумизии одноразовый, 26 мм (ZSR-DCA-26)
вид с защитным колпачком.**

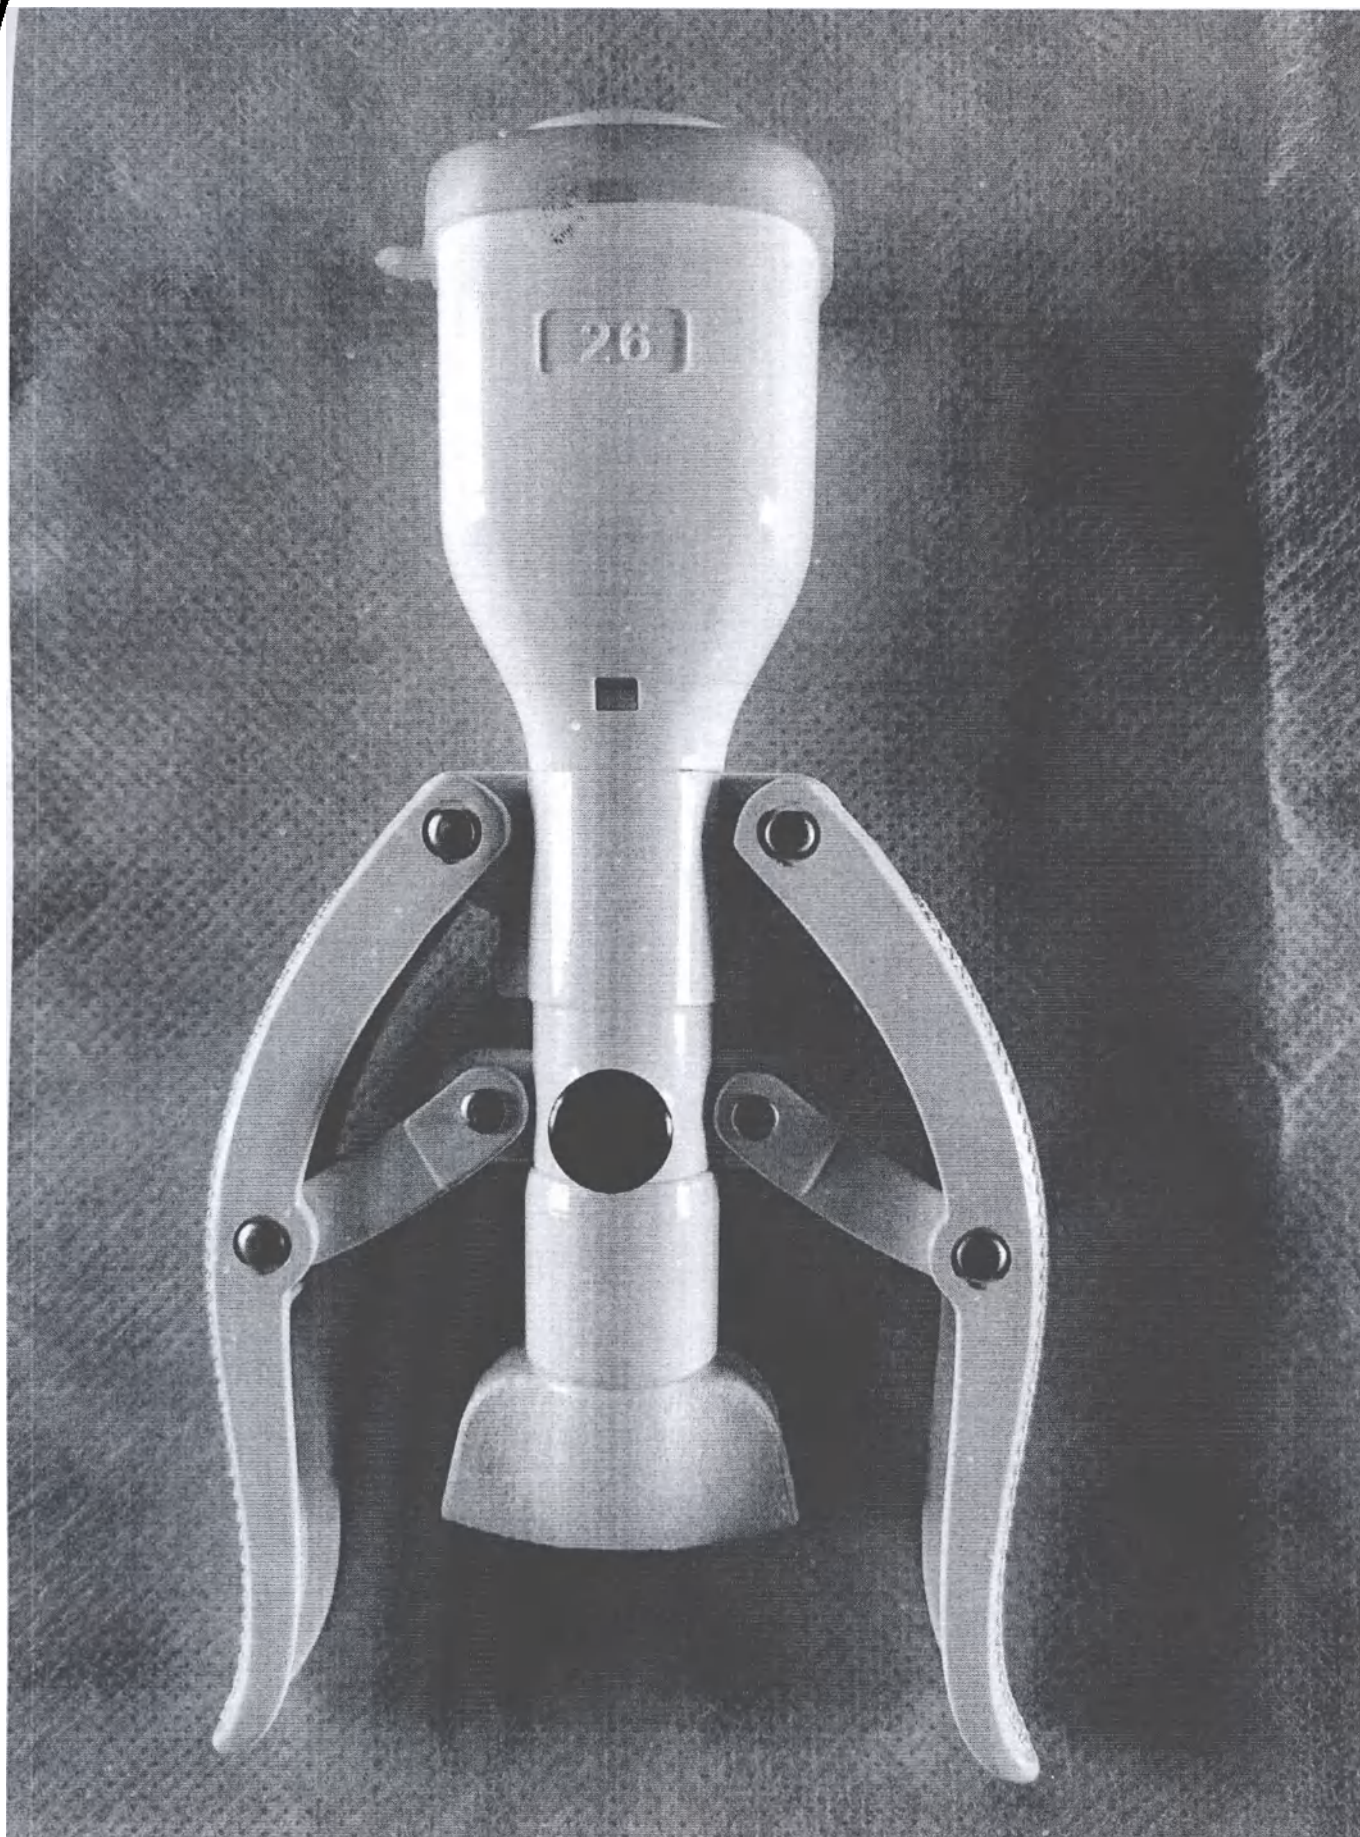


Анастомат для циркумизии одноразовый, 26 мм (ZSR-DCA-26)
вид без защитного колпачка.

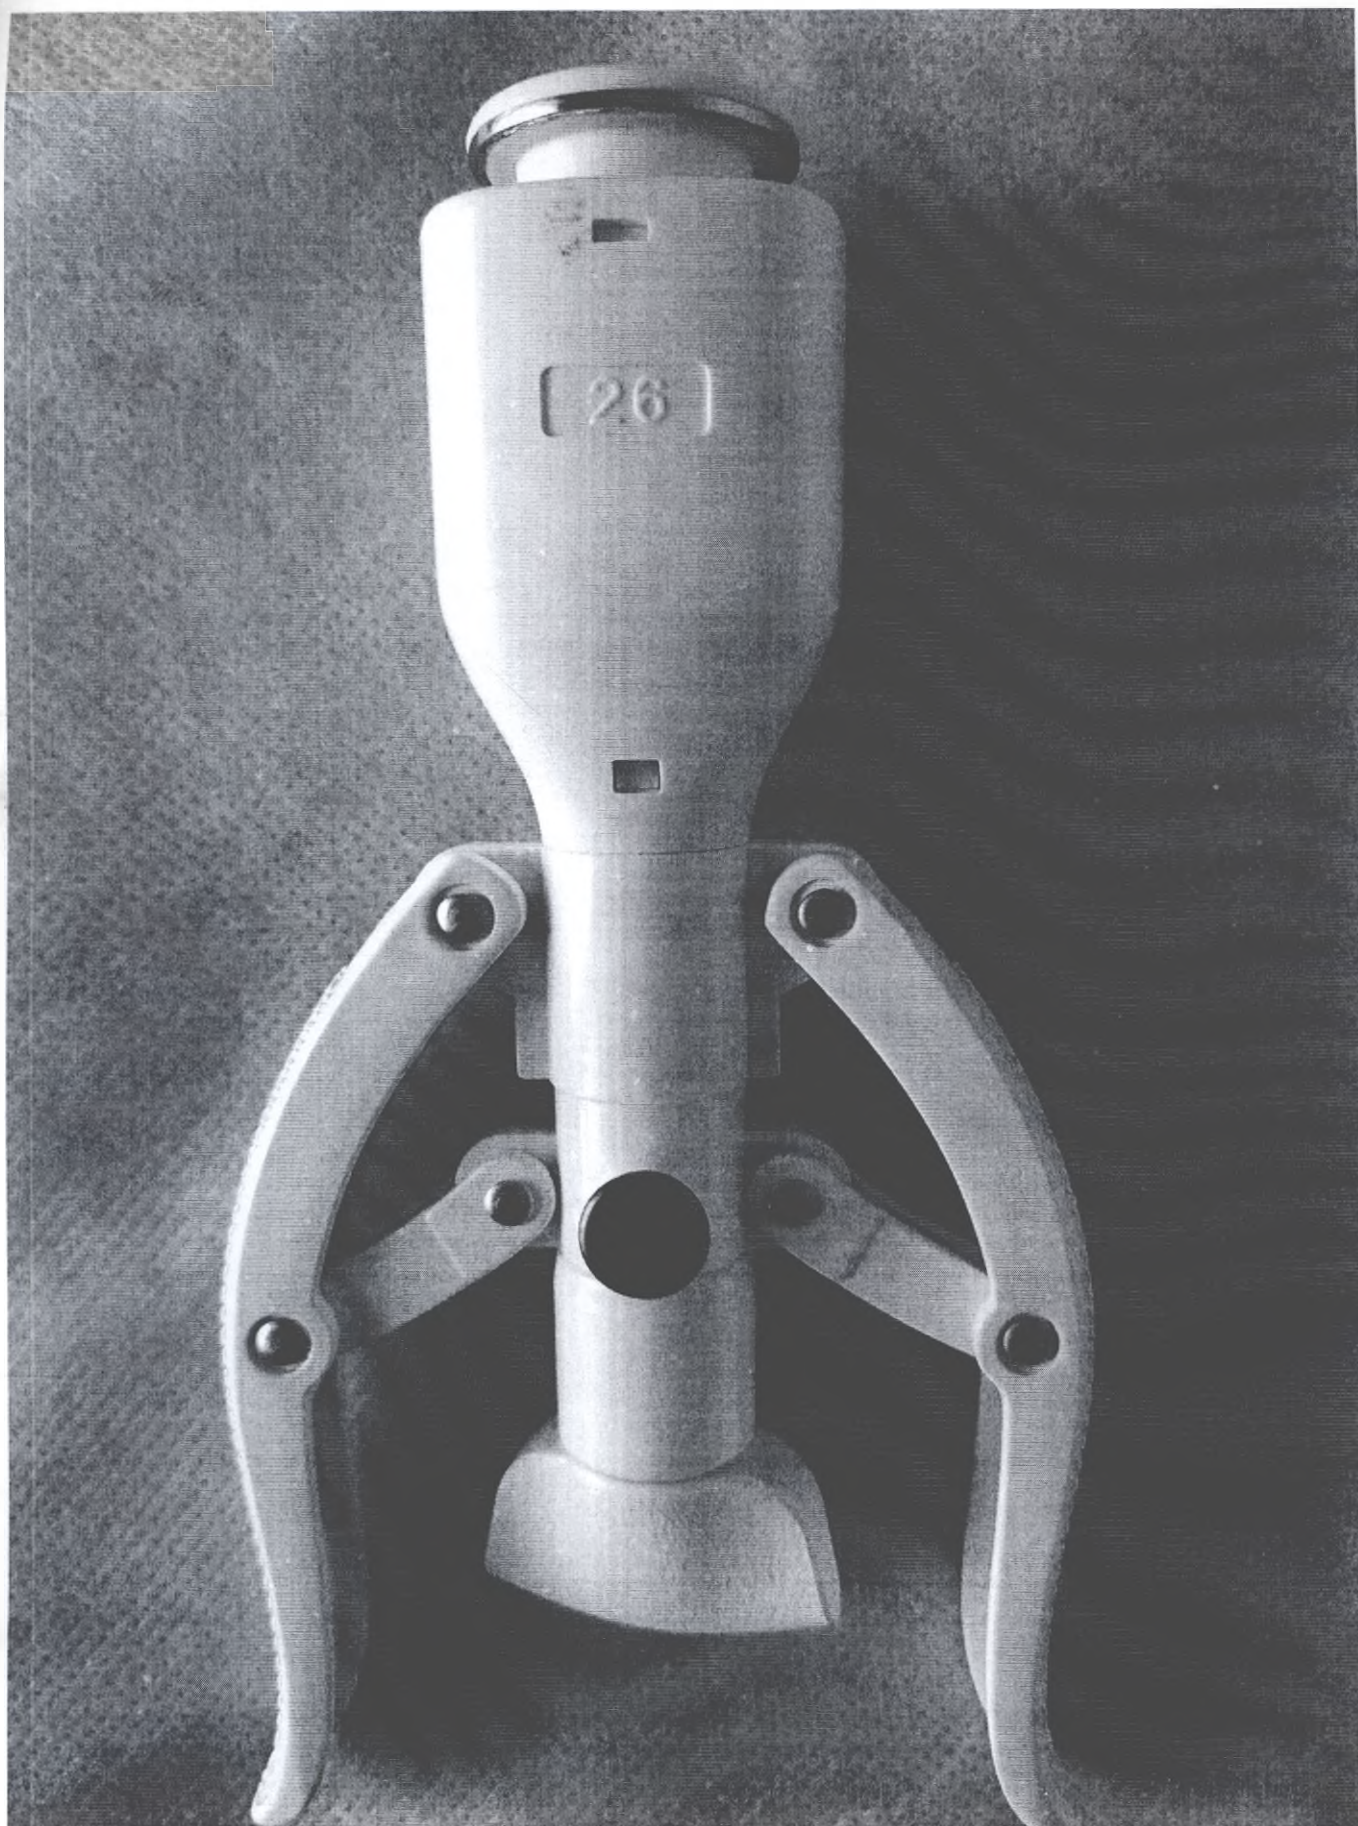


Анастомат для циркумизии одноразовый, 26 мм (ZSR-DCA-26)
вид без защитного колпачка.

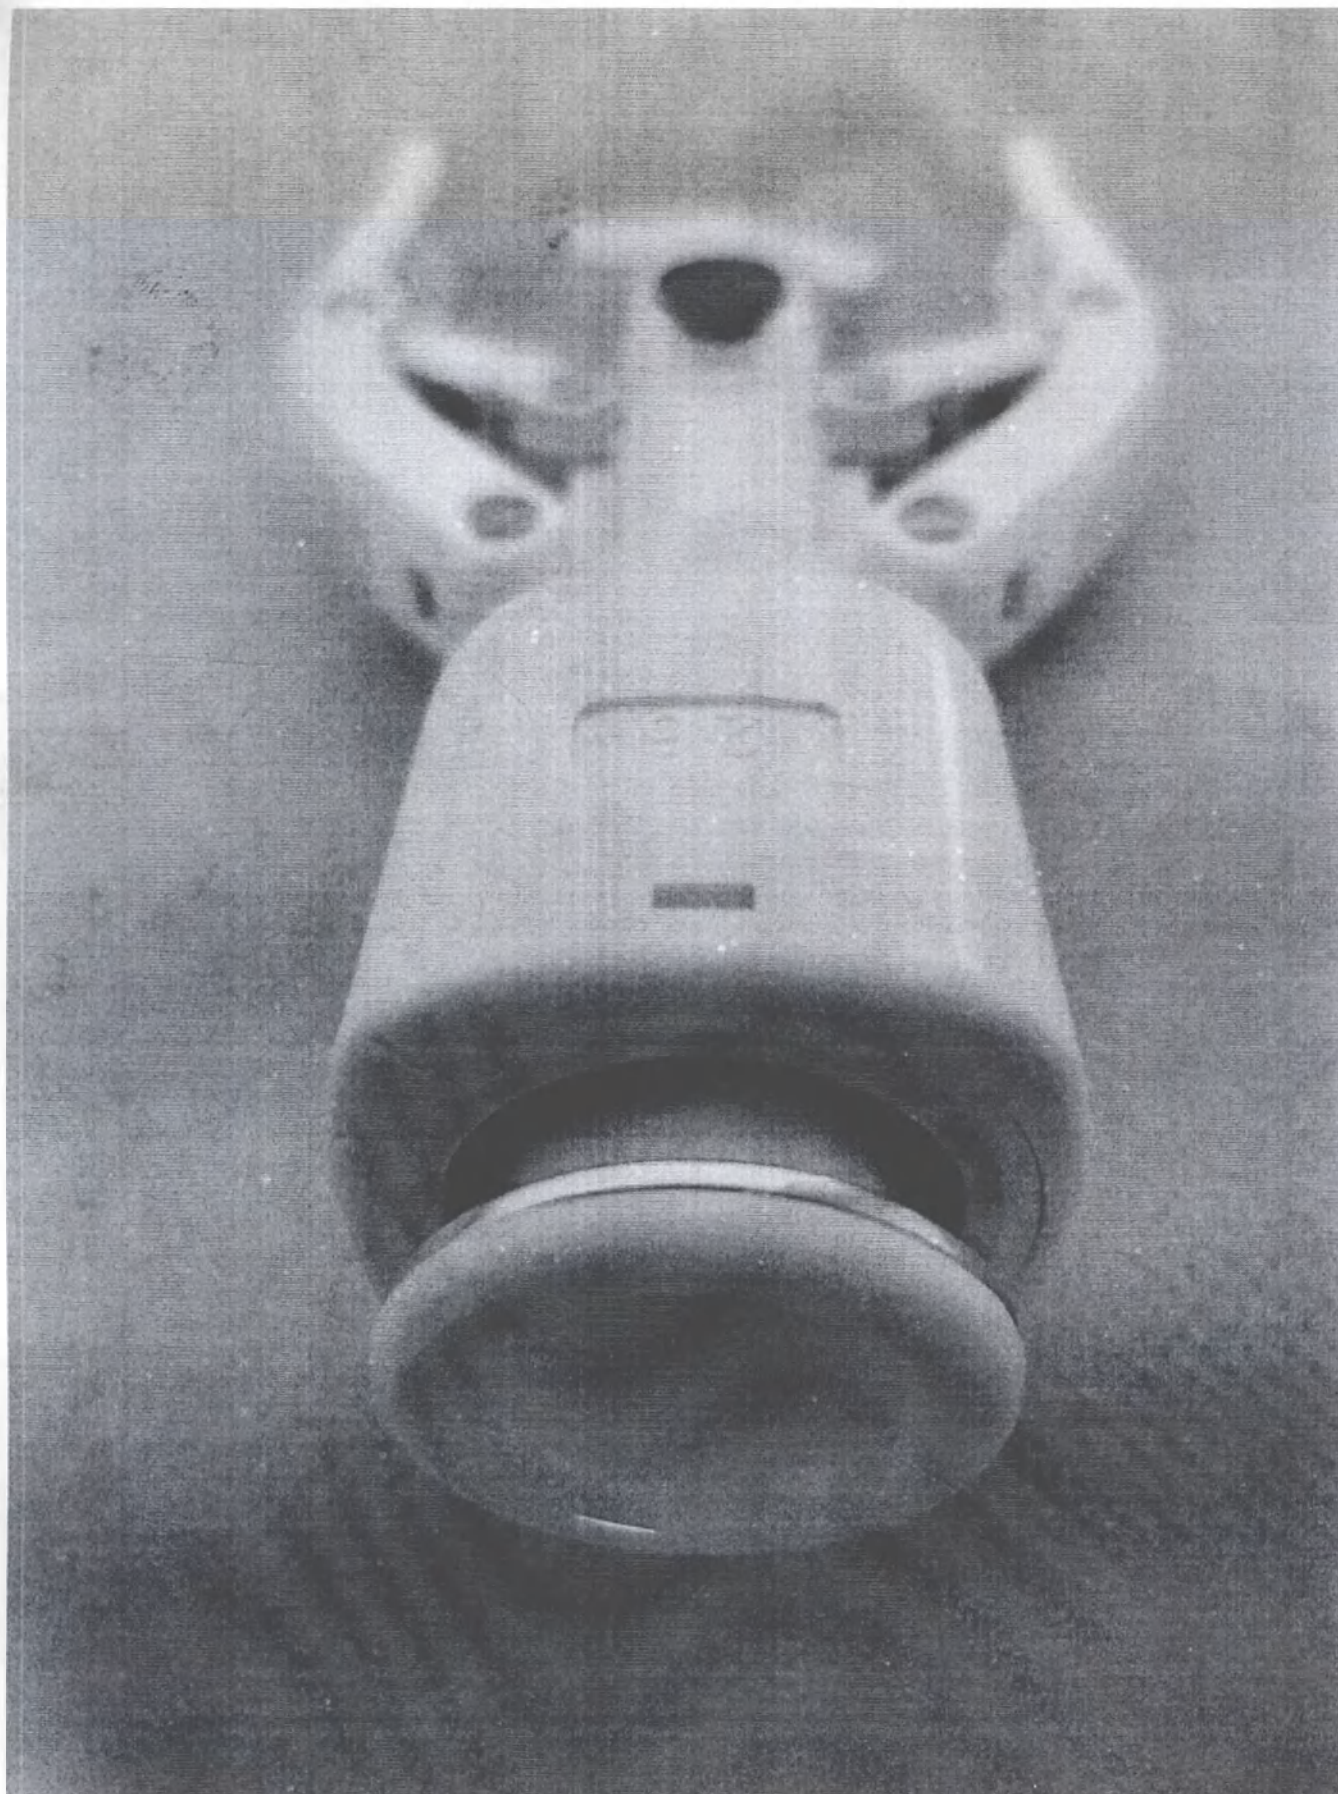


Анастомат для циркумизии одноразовый, 30 мм (ZSR-DCA-30A)
вид с защитным колпачком.

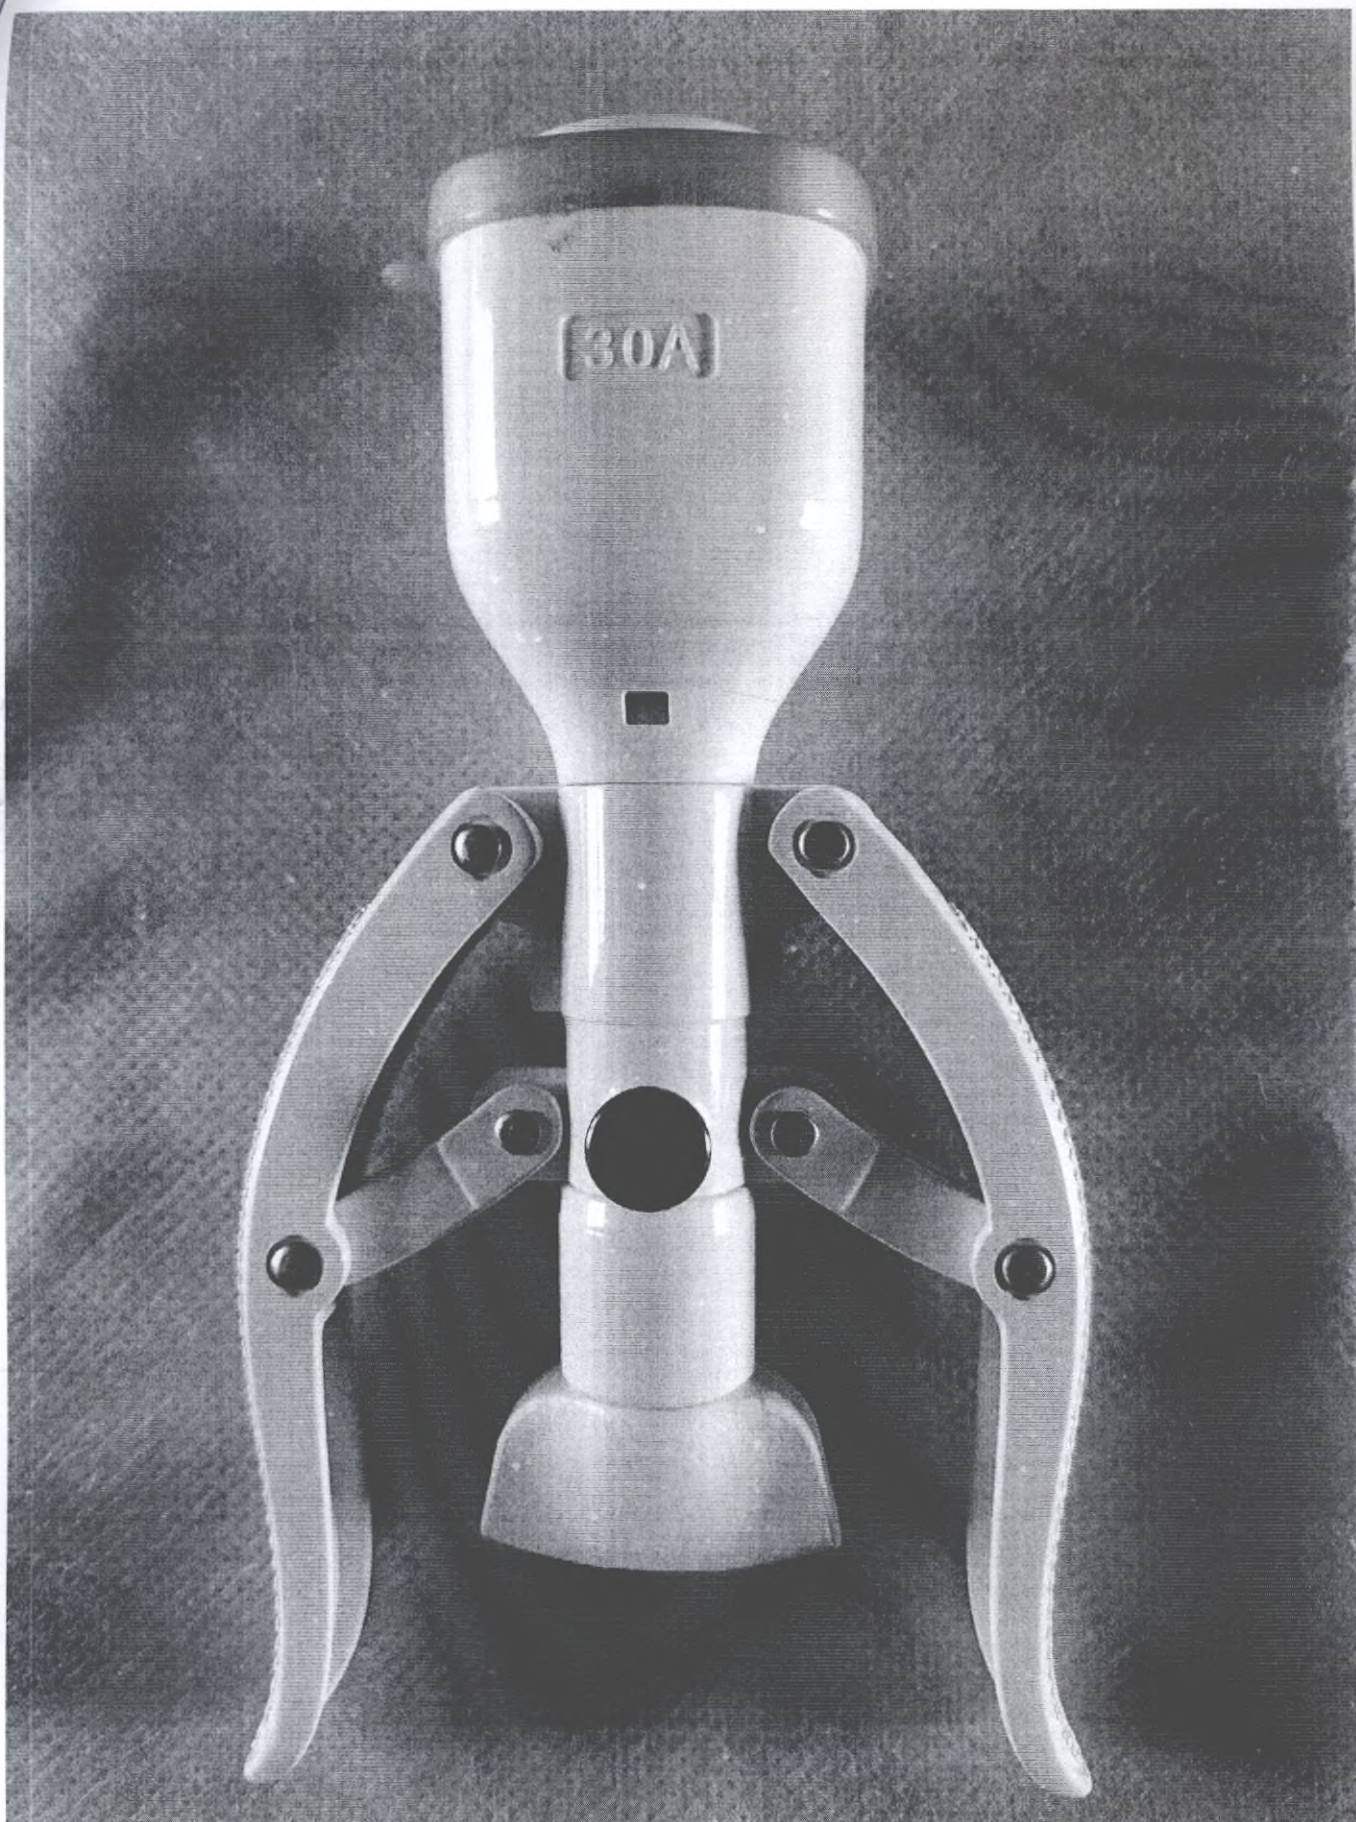


Анастомат для циркуляции одноразовый, 30 мм (ZSR-DCA-30A)
вид без защитного колпачка.

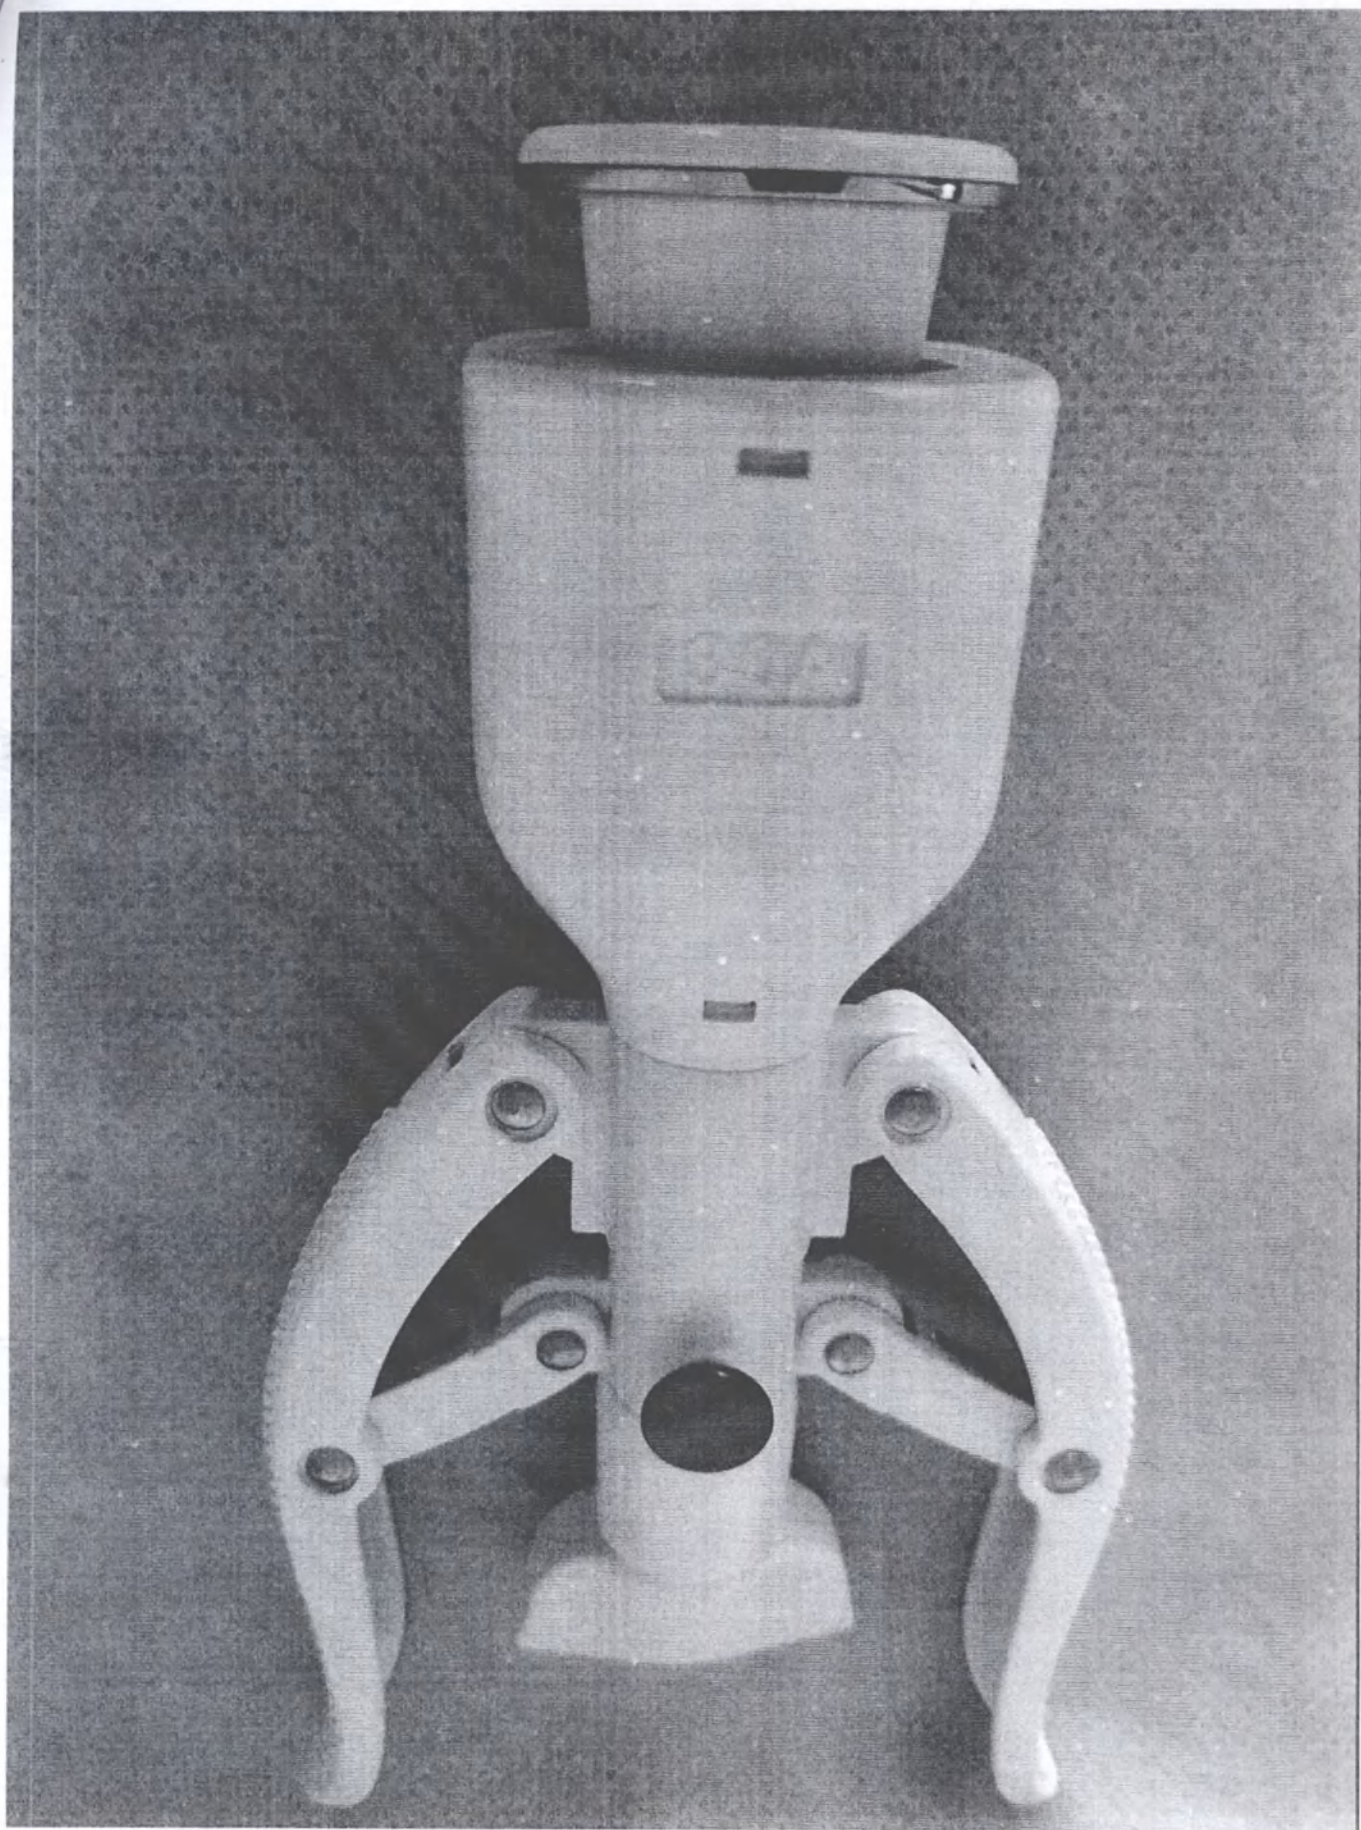

Анастомат для циркумизии одноразовый, 30 мм (ZSR-DCA-30A)
вид без защитного колпачка.

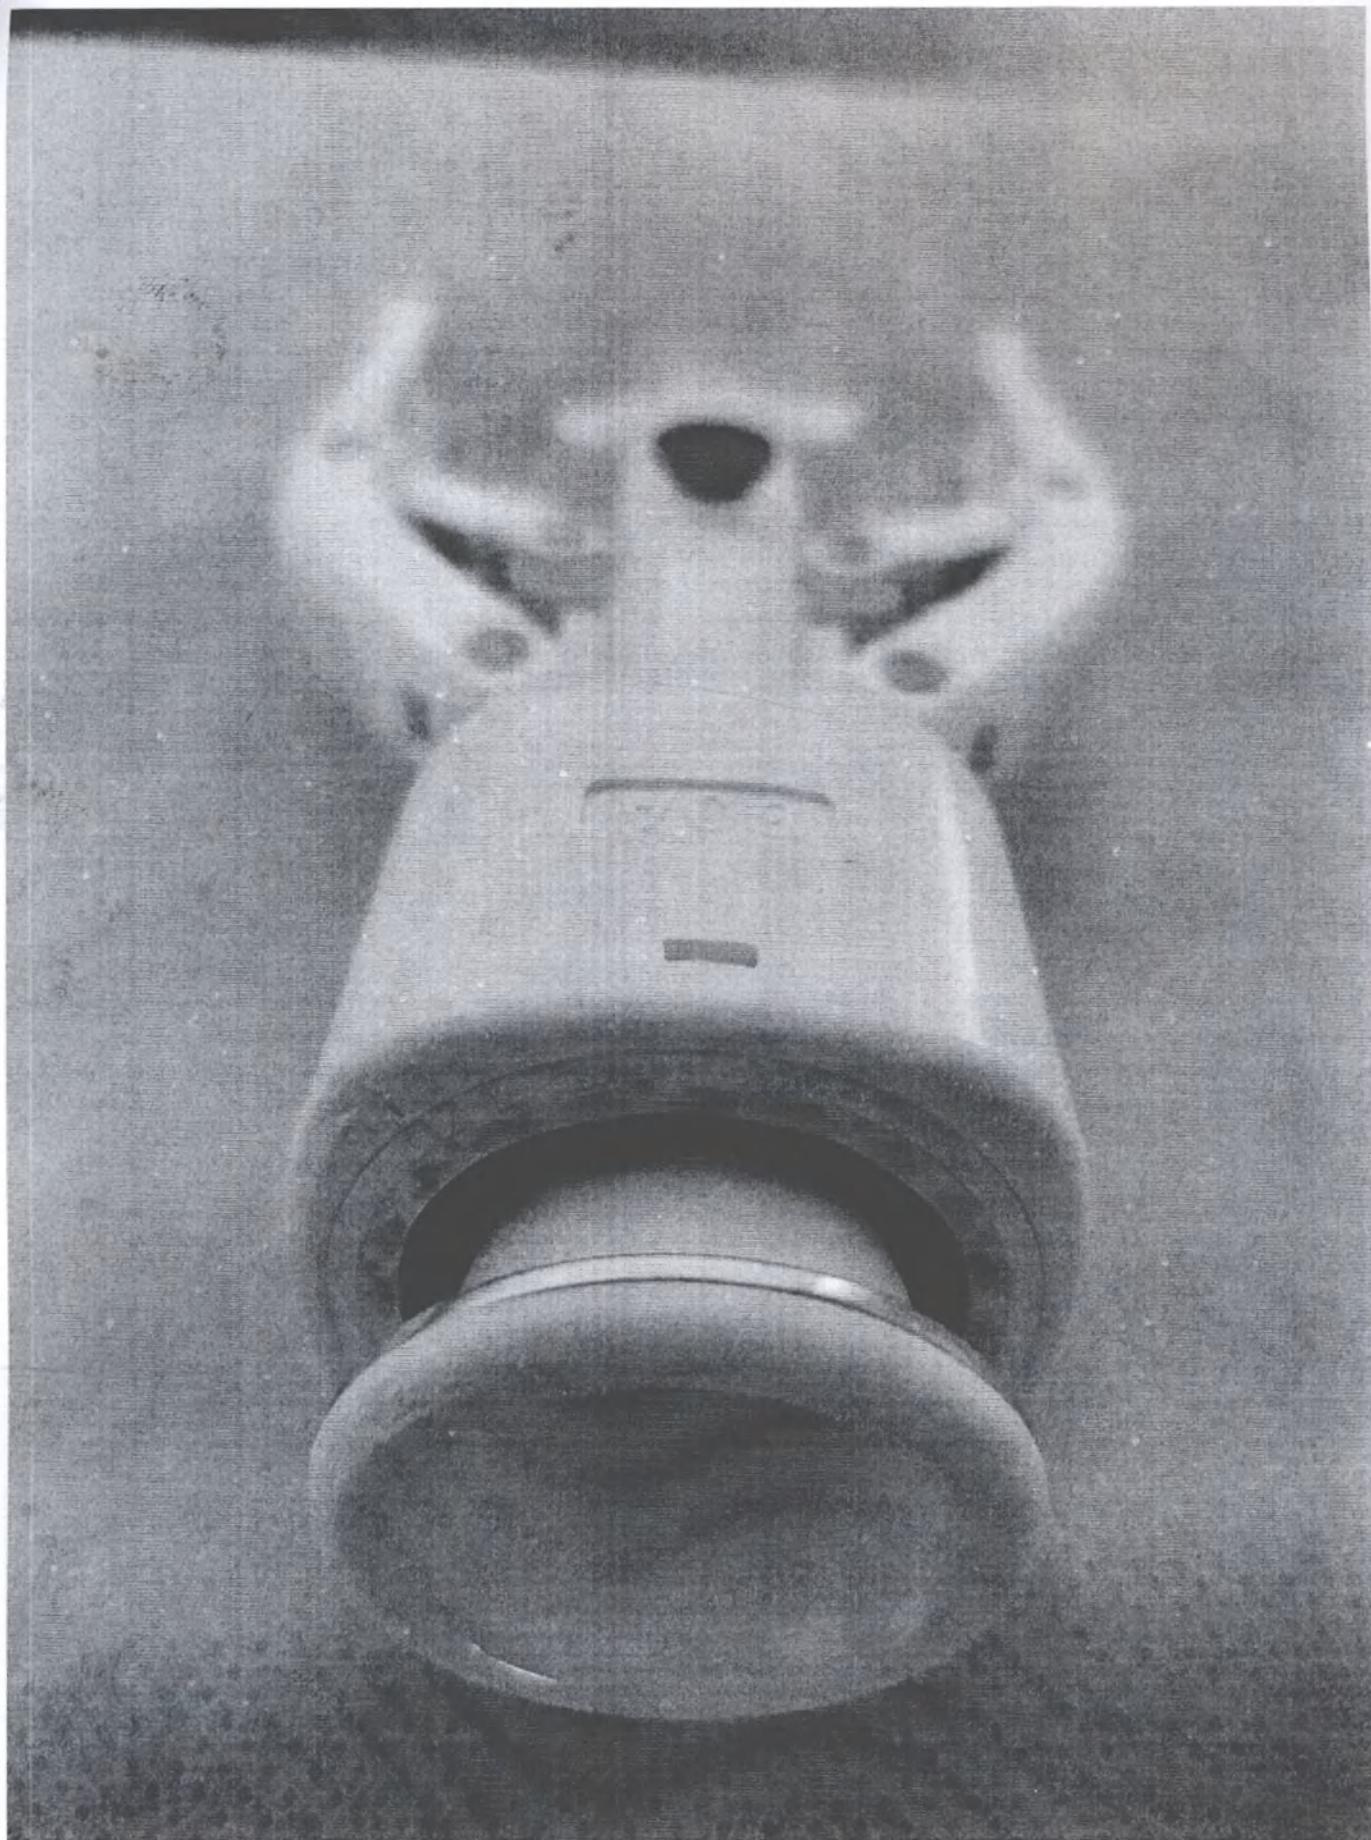


Анастомат для циркумизии одноразовый, 34 мм (ZSR-DCA-34),
вид с защитным колпачком.

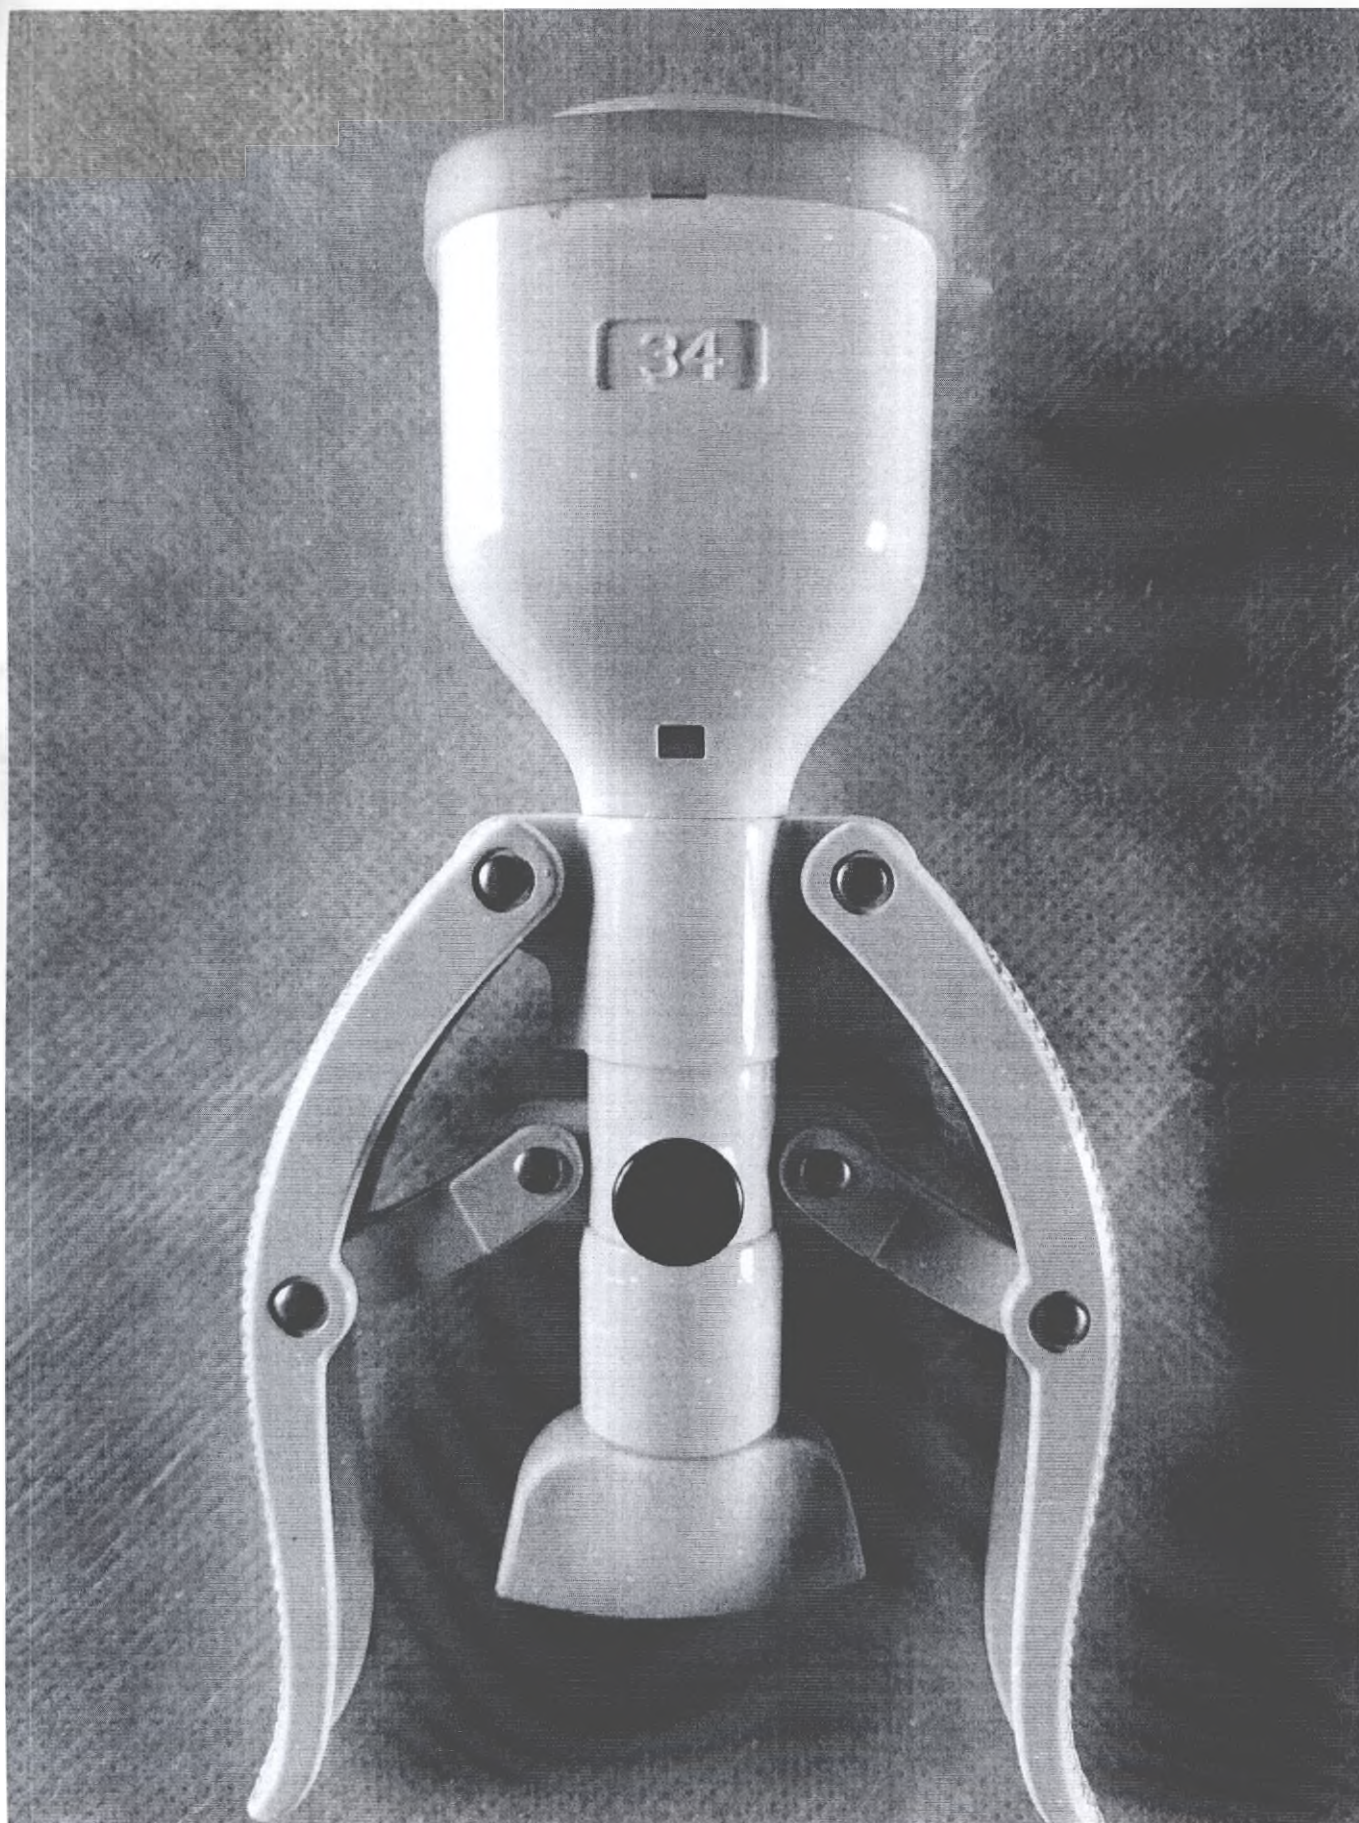


Анастомат для циркумизии одноразовый, 34 мм (ZSR-DCA-34),

вид без защитного колпачка.

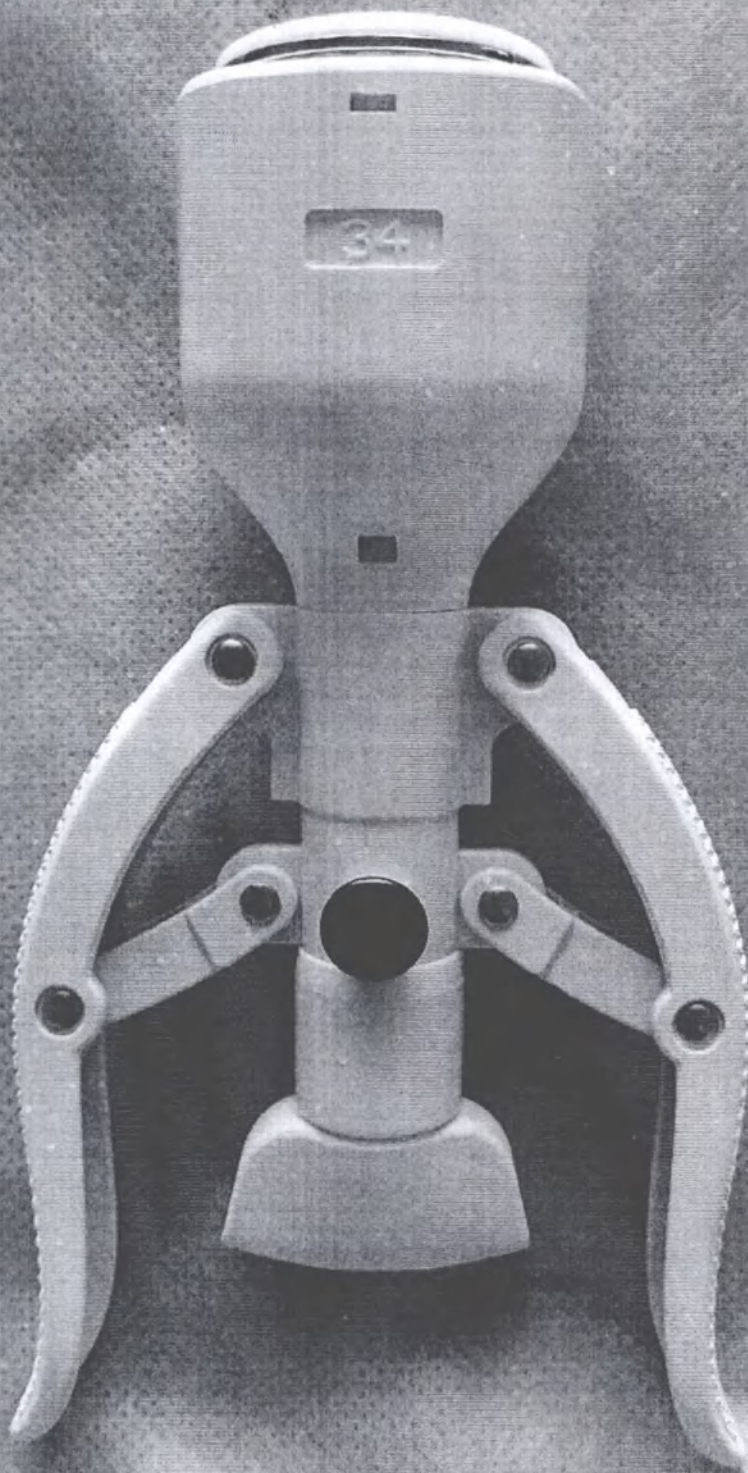


Анастомат для циркумизии одноразовый, 34 мм (ZSR-DCA-34),


вид без защитного колпачка.

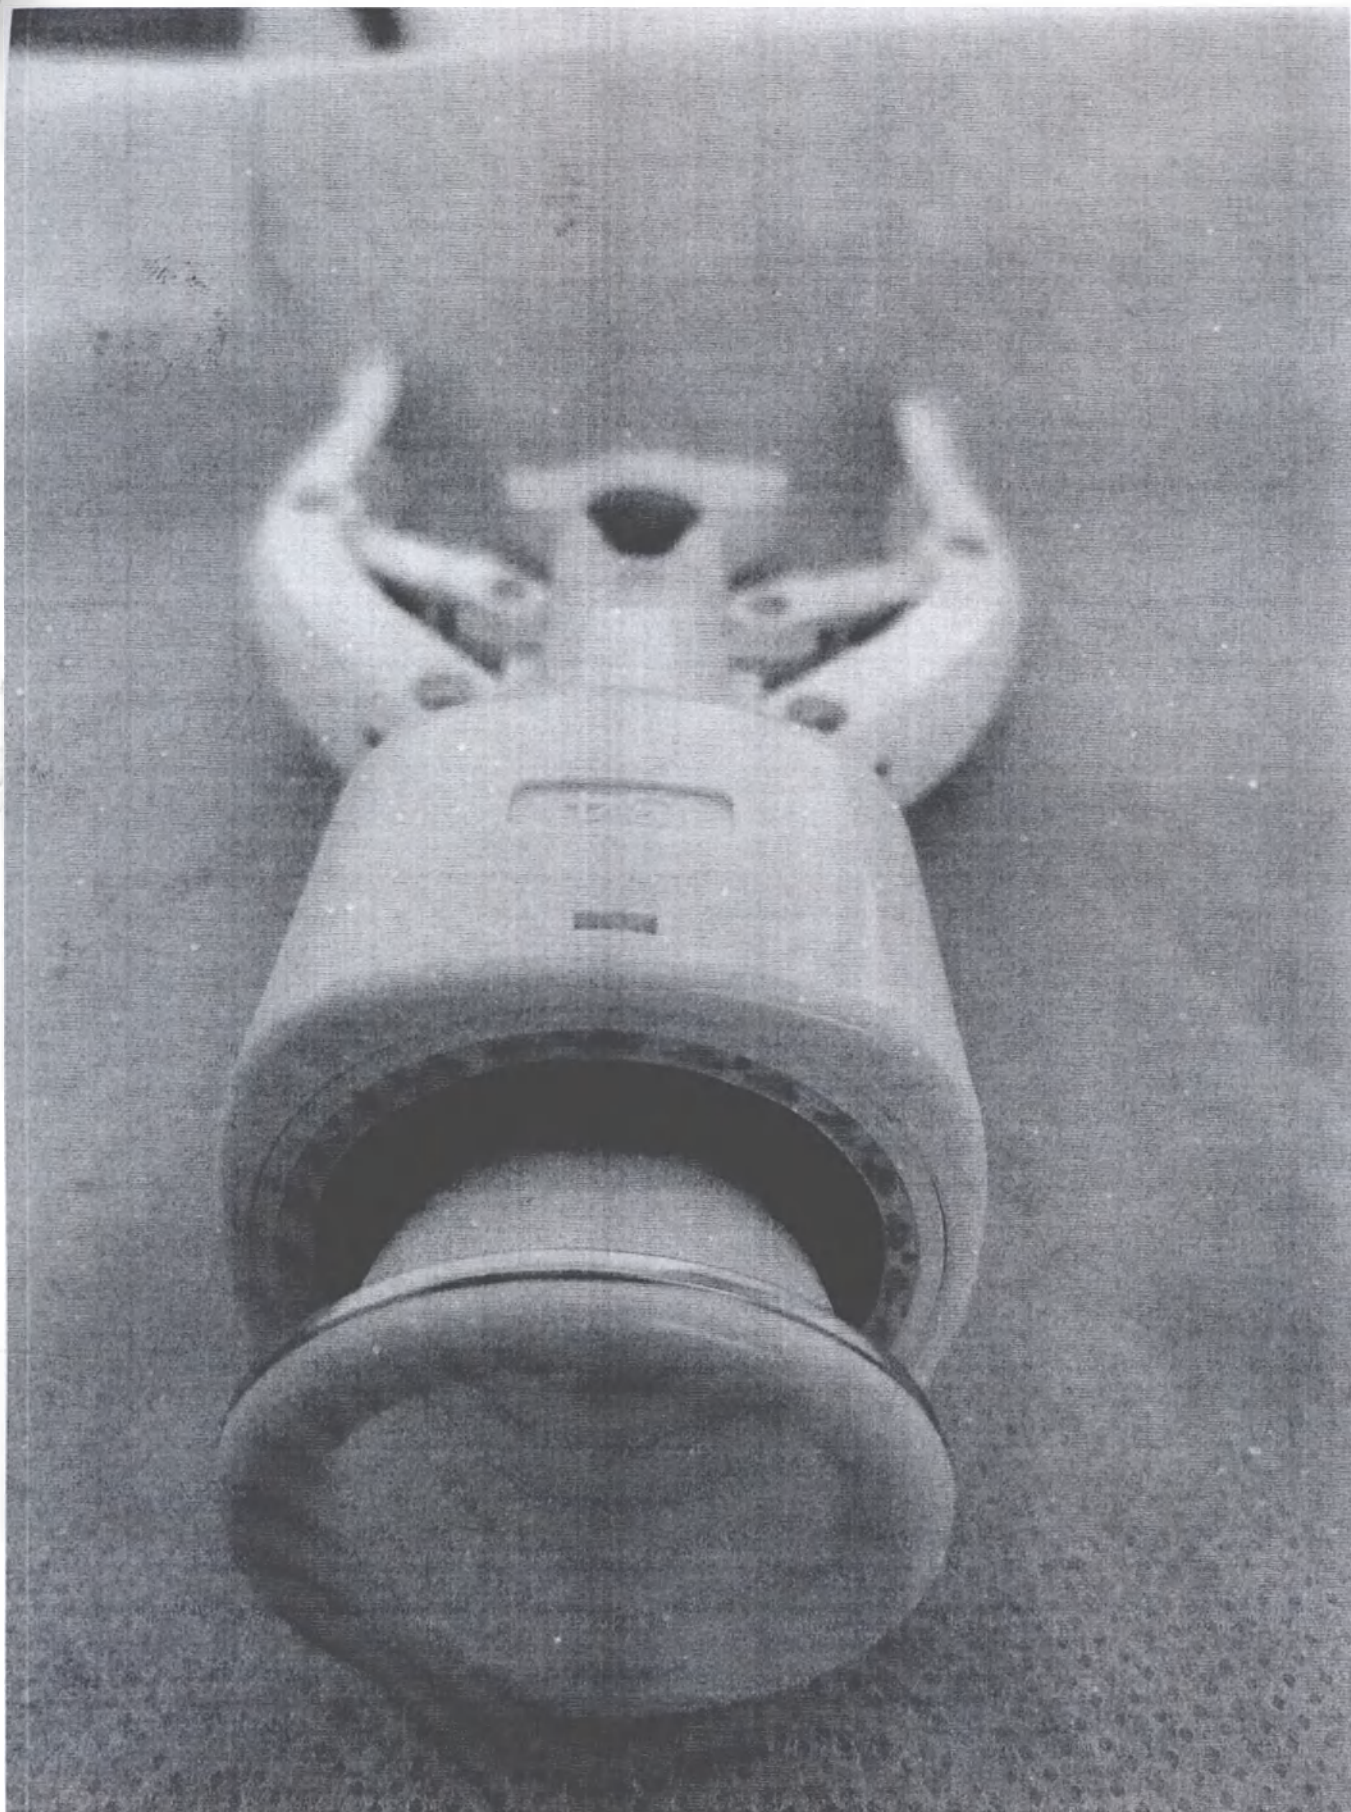

Внешний вид отсека со скобами с силиконовой прокладкой

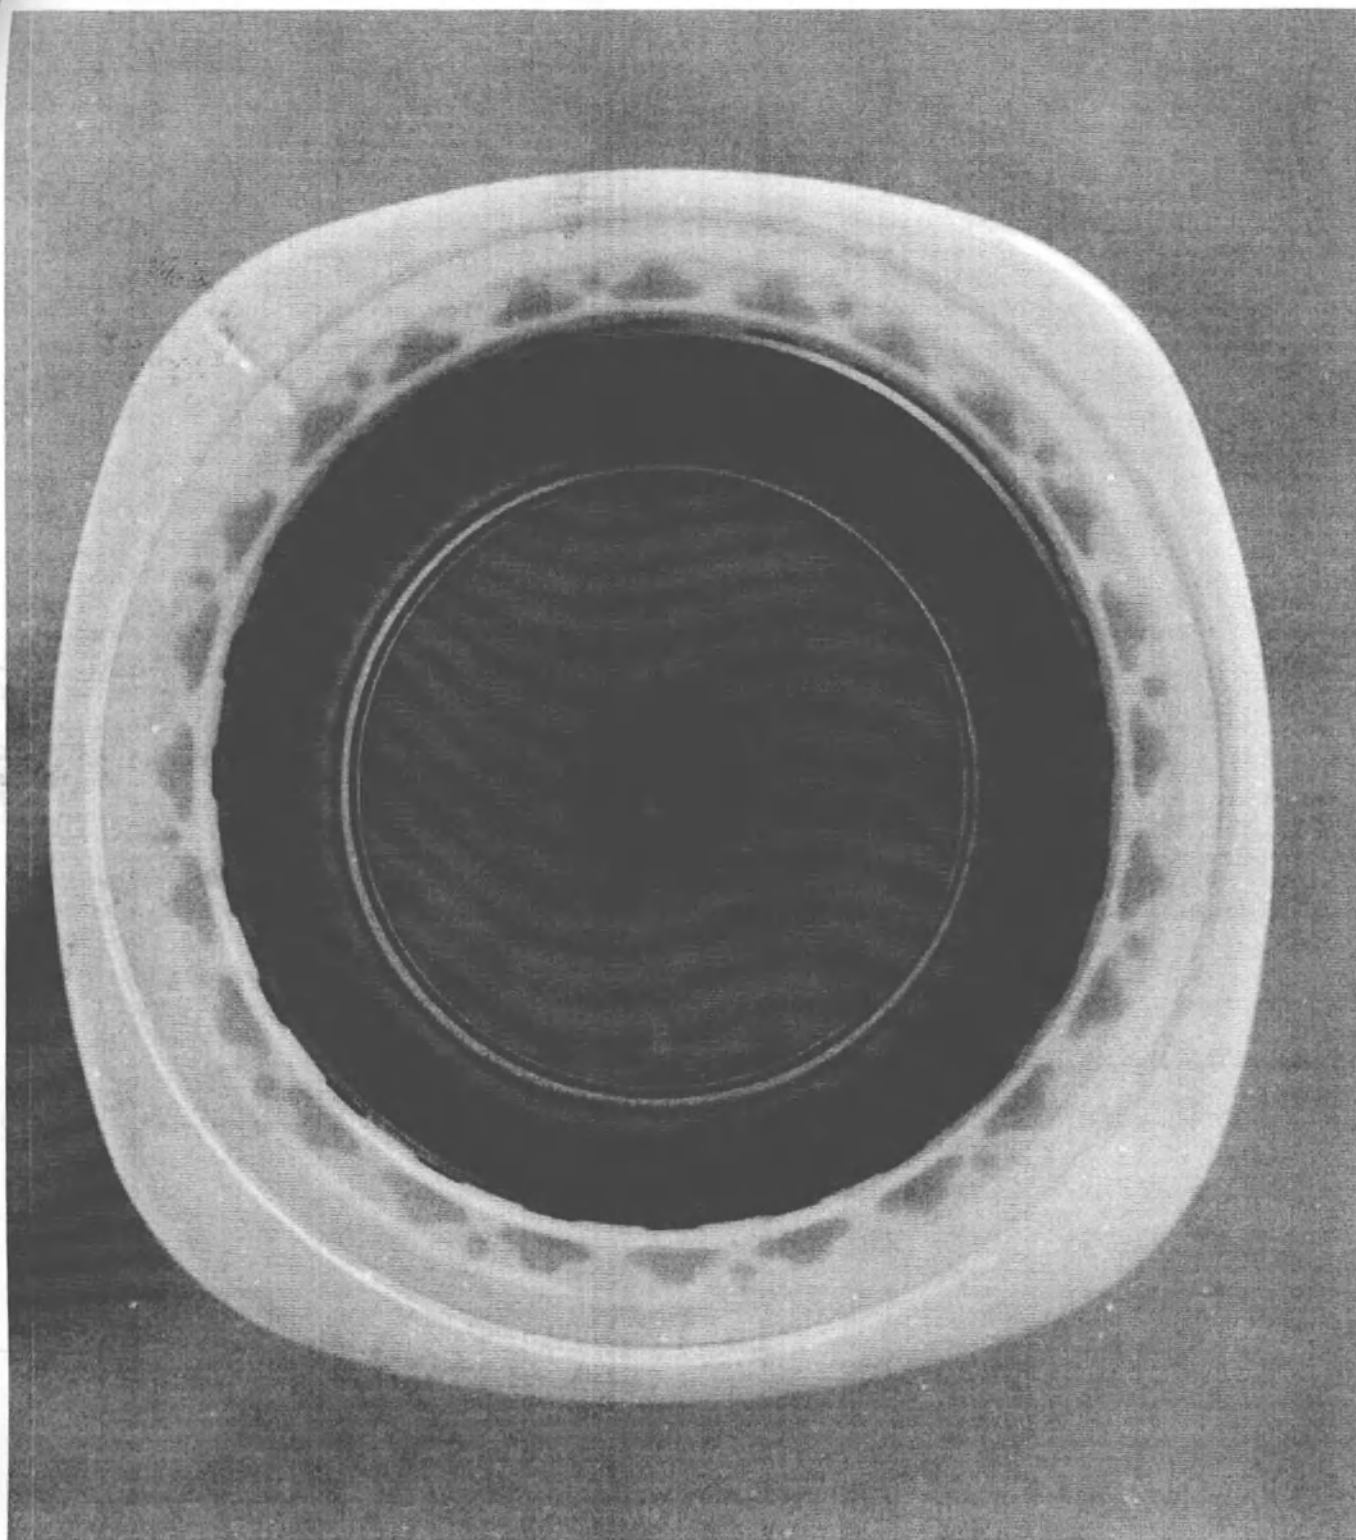


Внешний вид отсека со скобами без силиконовой прокладки

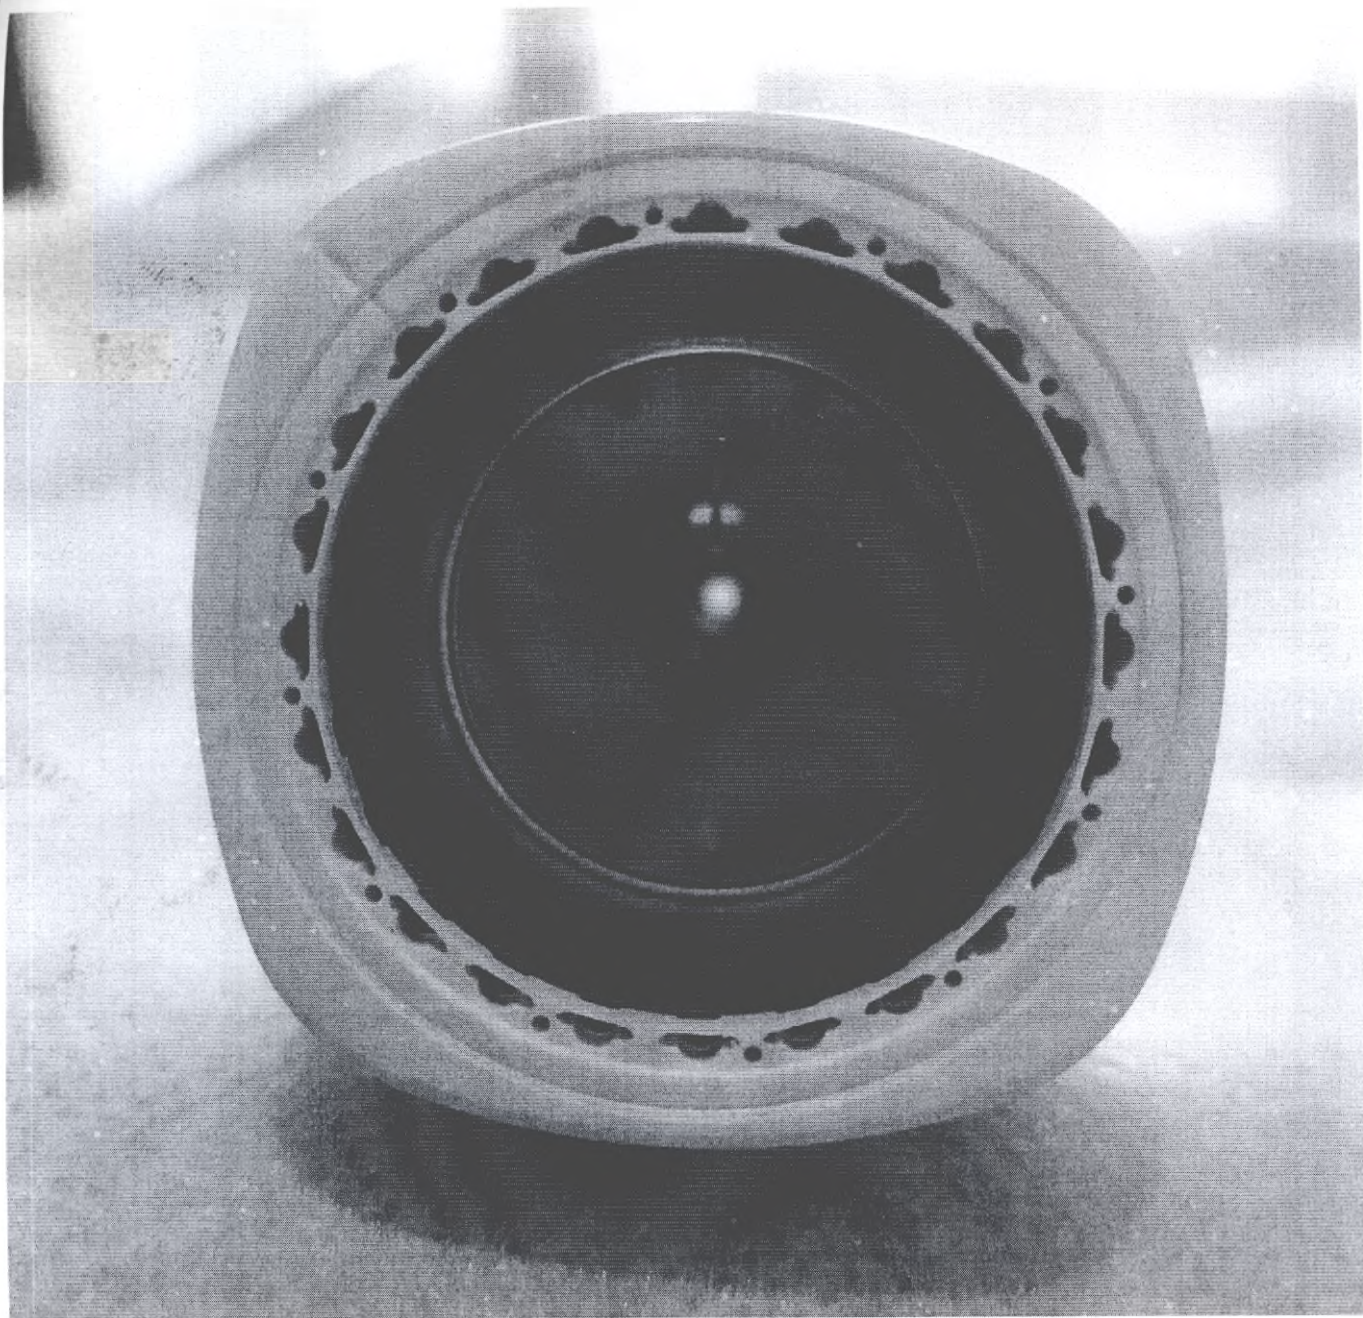


Силиконовая прокладка





Силиконовая прокладка
(интегрирована в верхний отсек отсека для скоб на производстве)

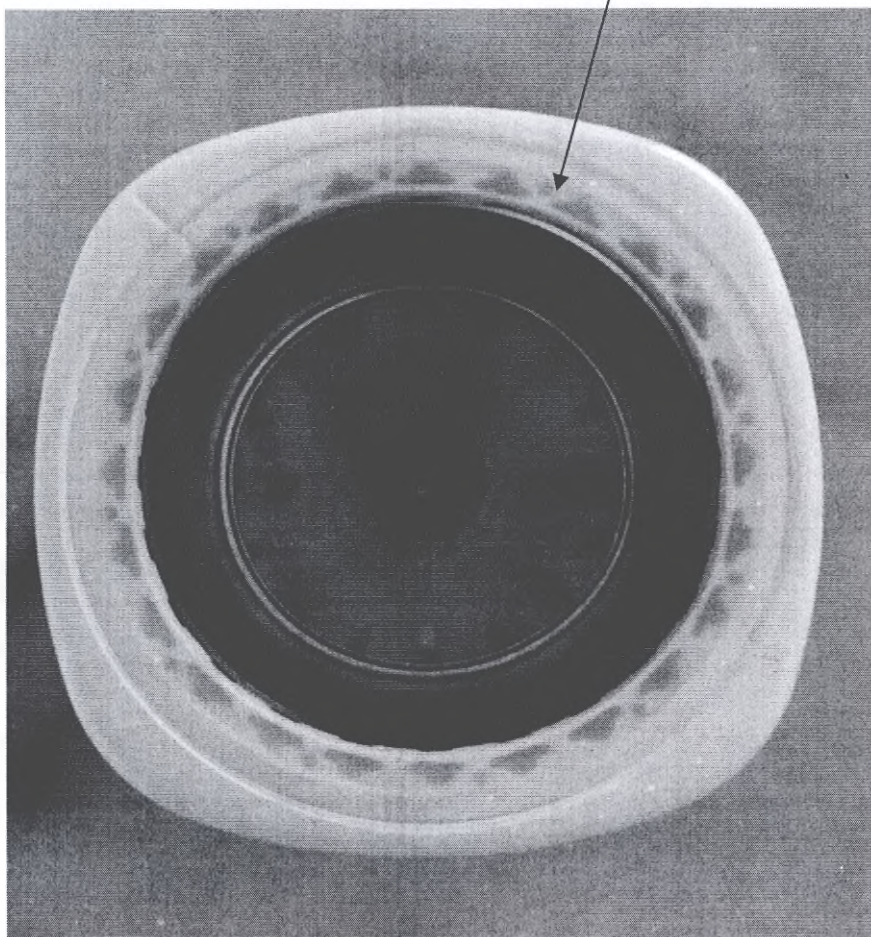

Стожок(внешний вид)

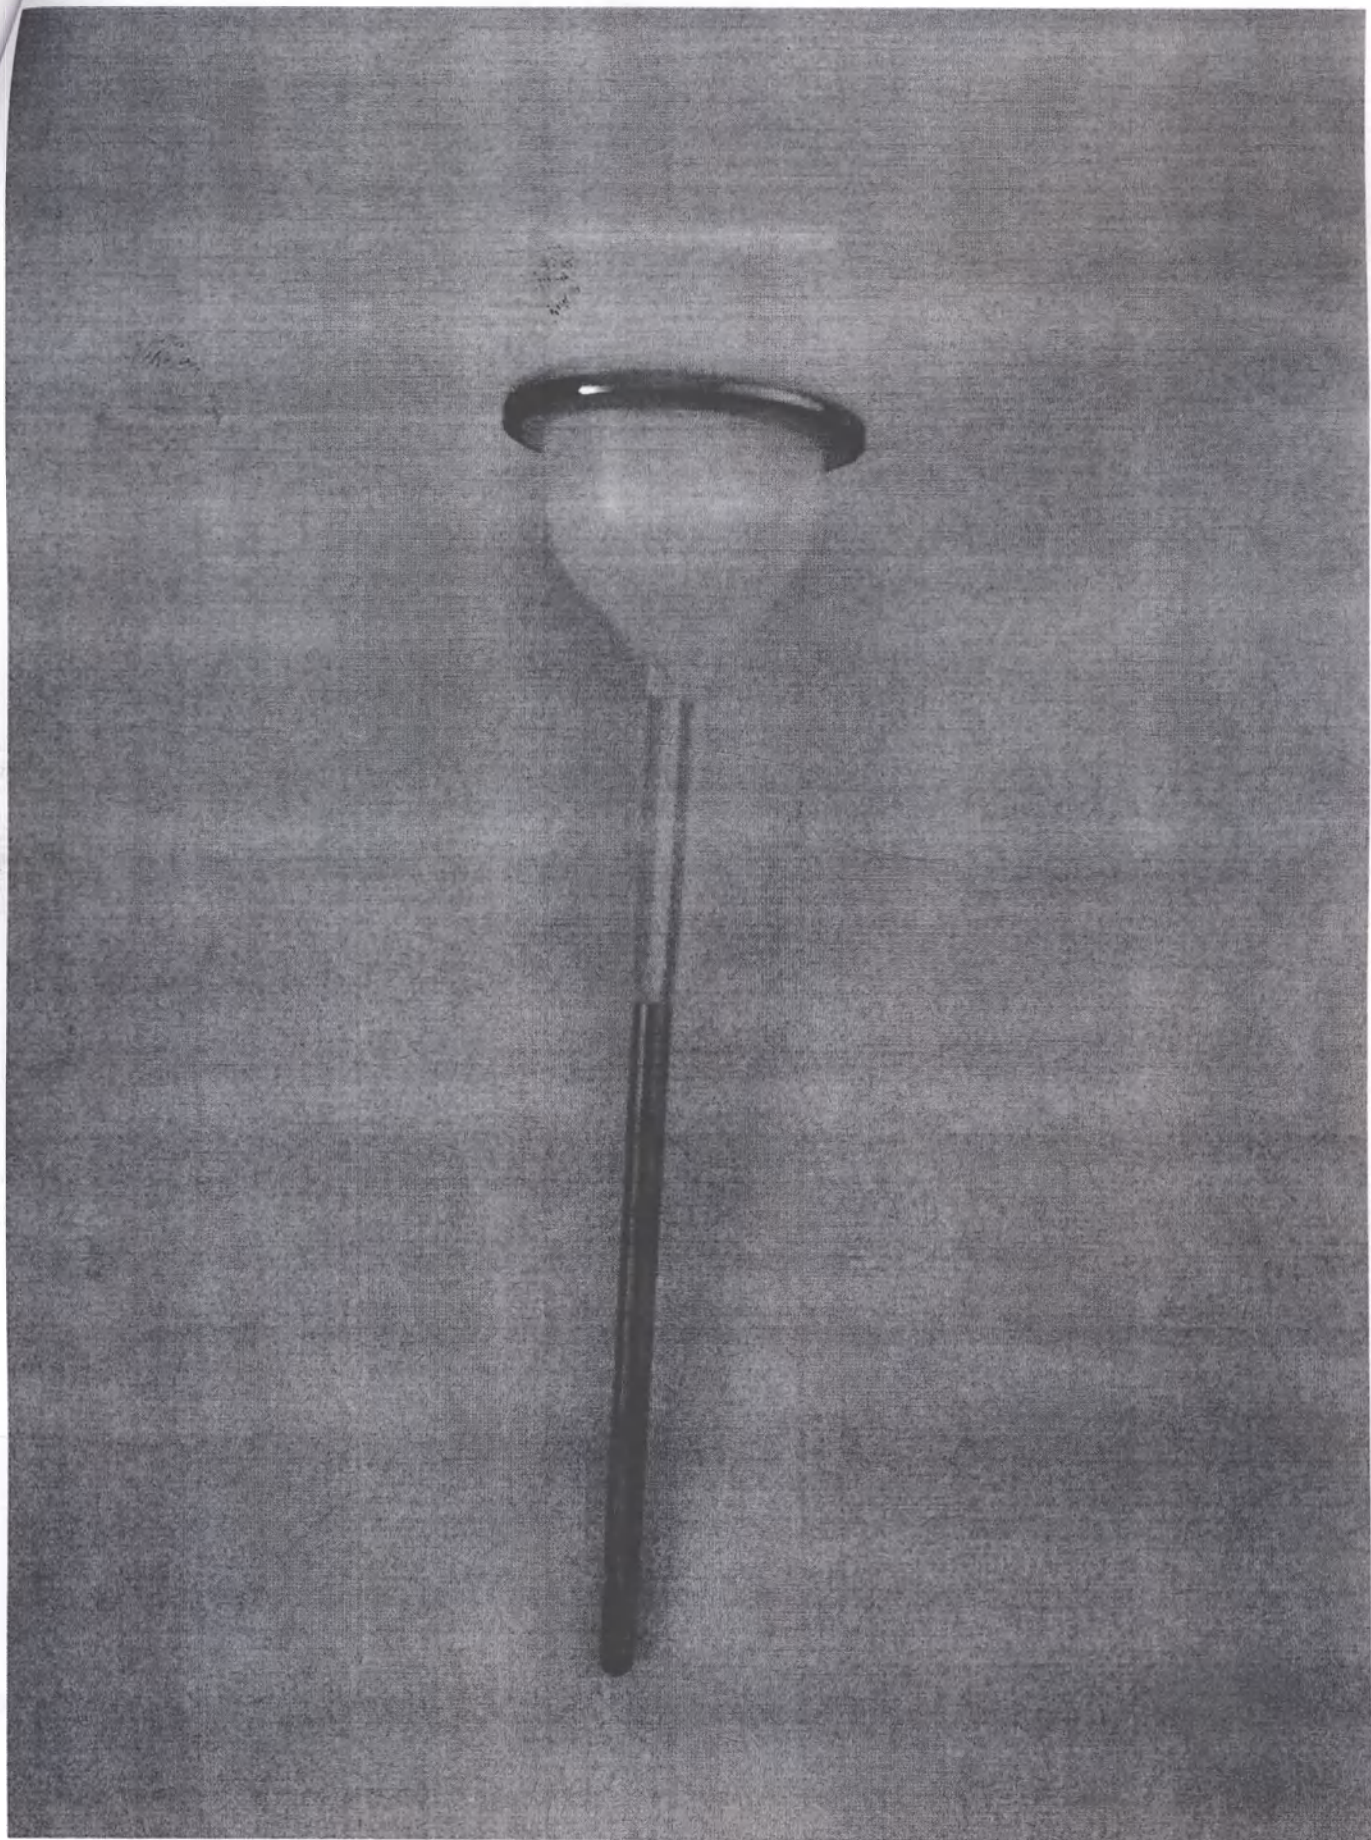

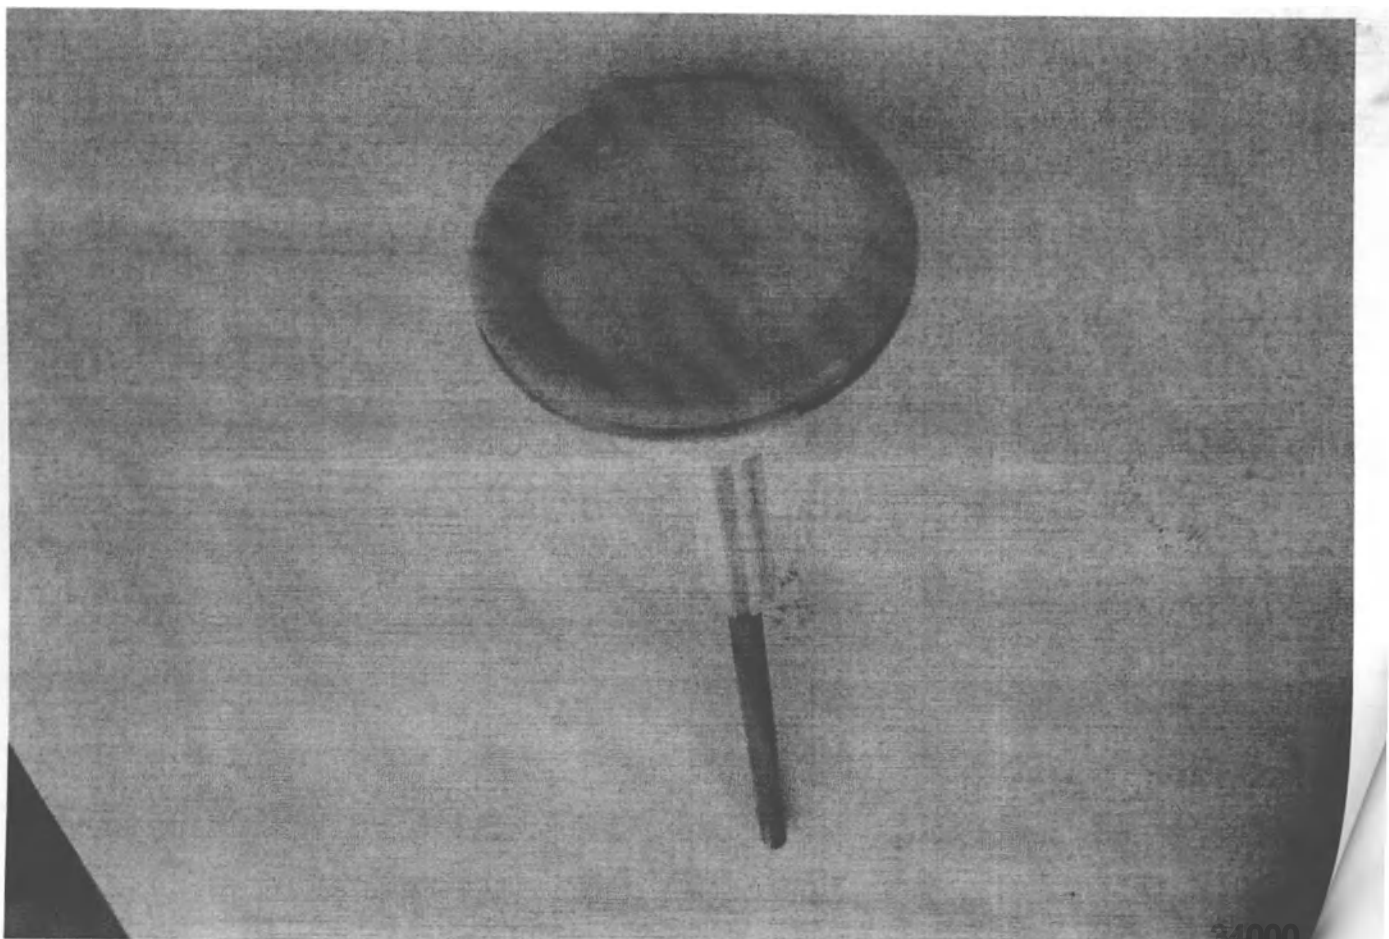


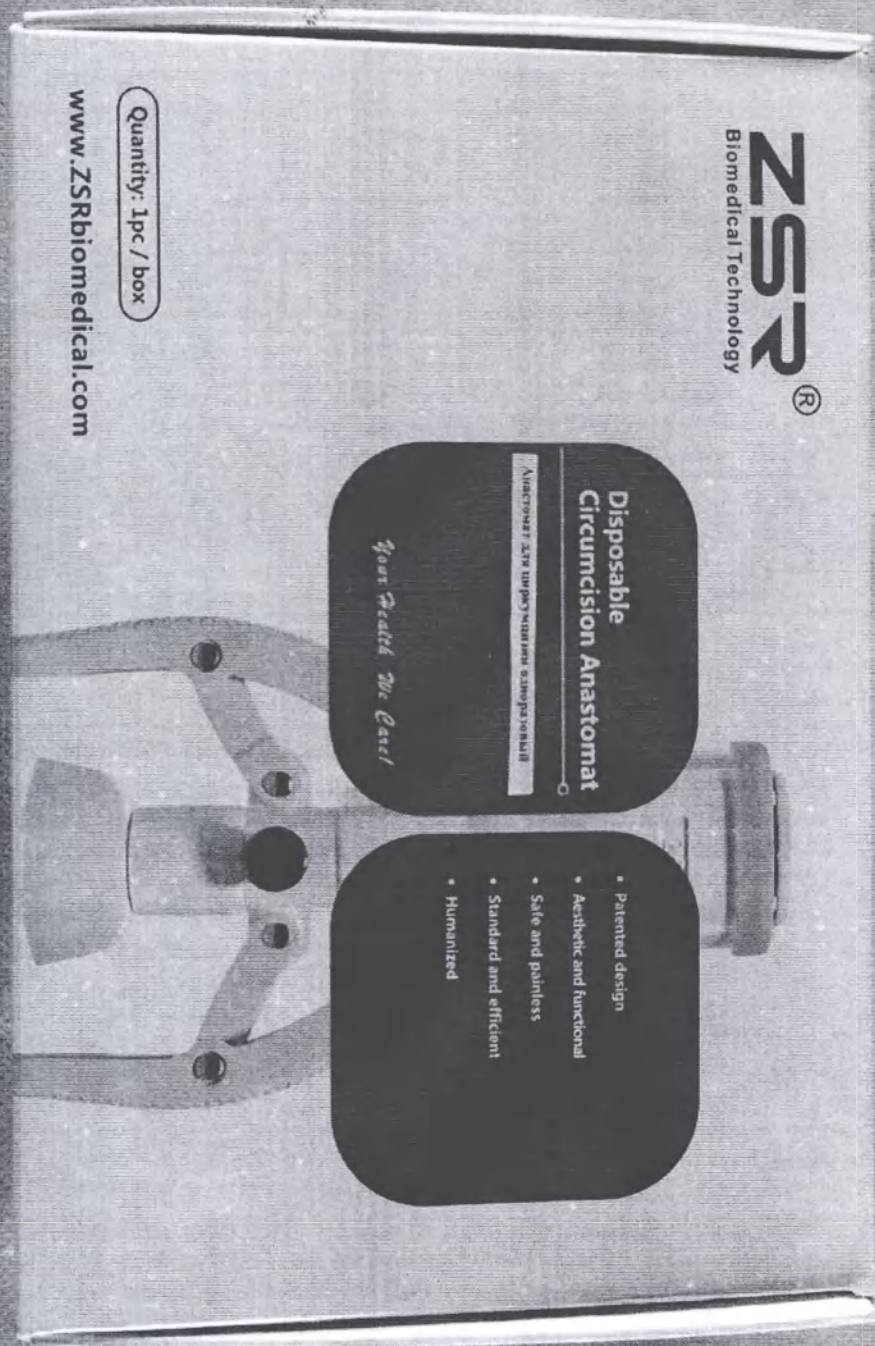

Индивидуальная наружная упаковка (в развернутом виде)



Индивидуальная первичная упаковка

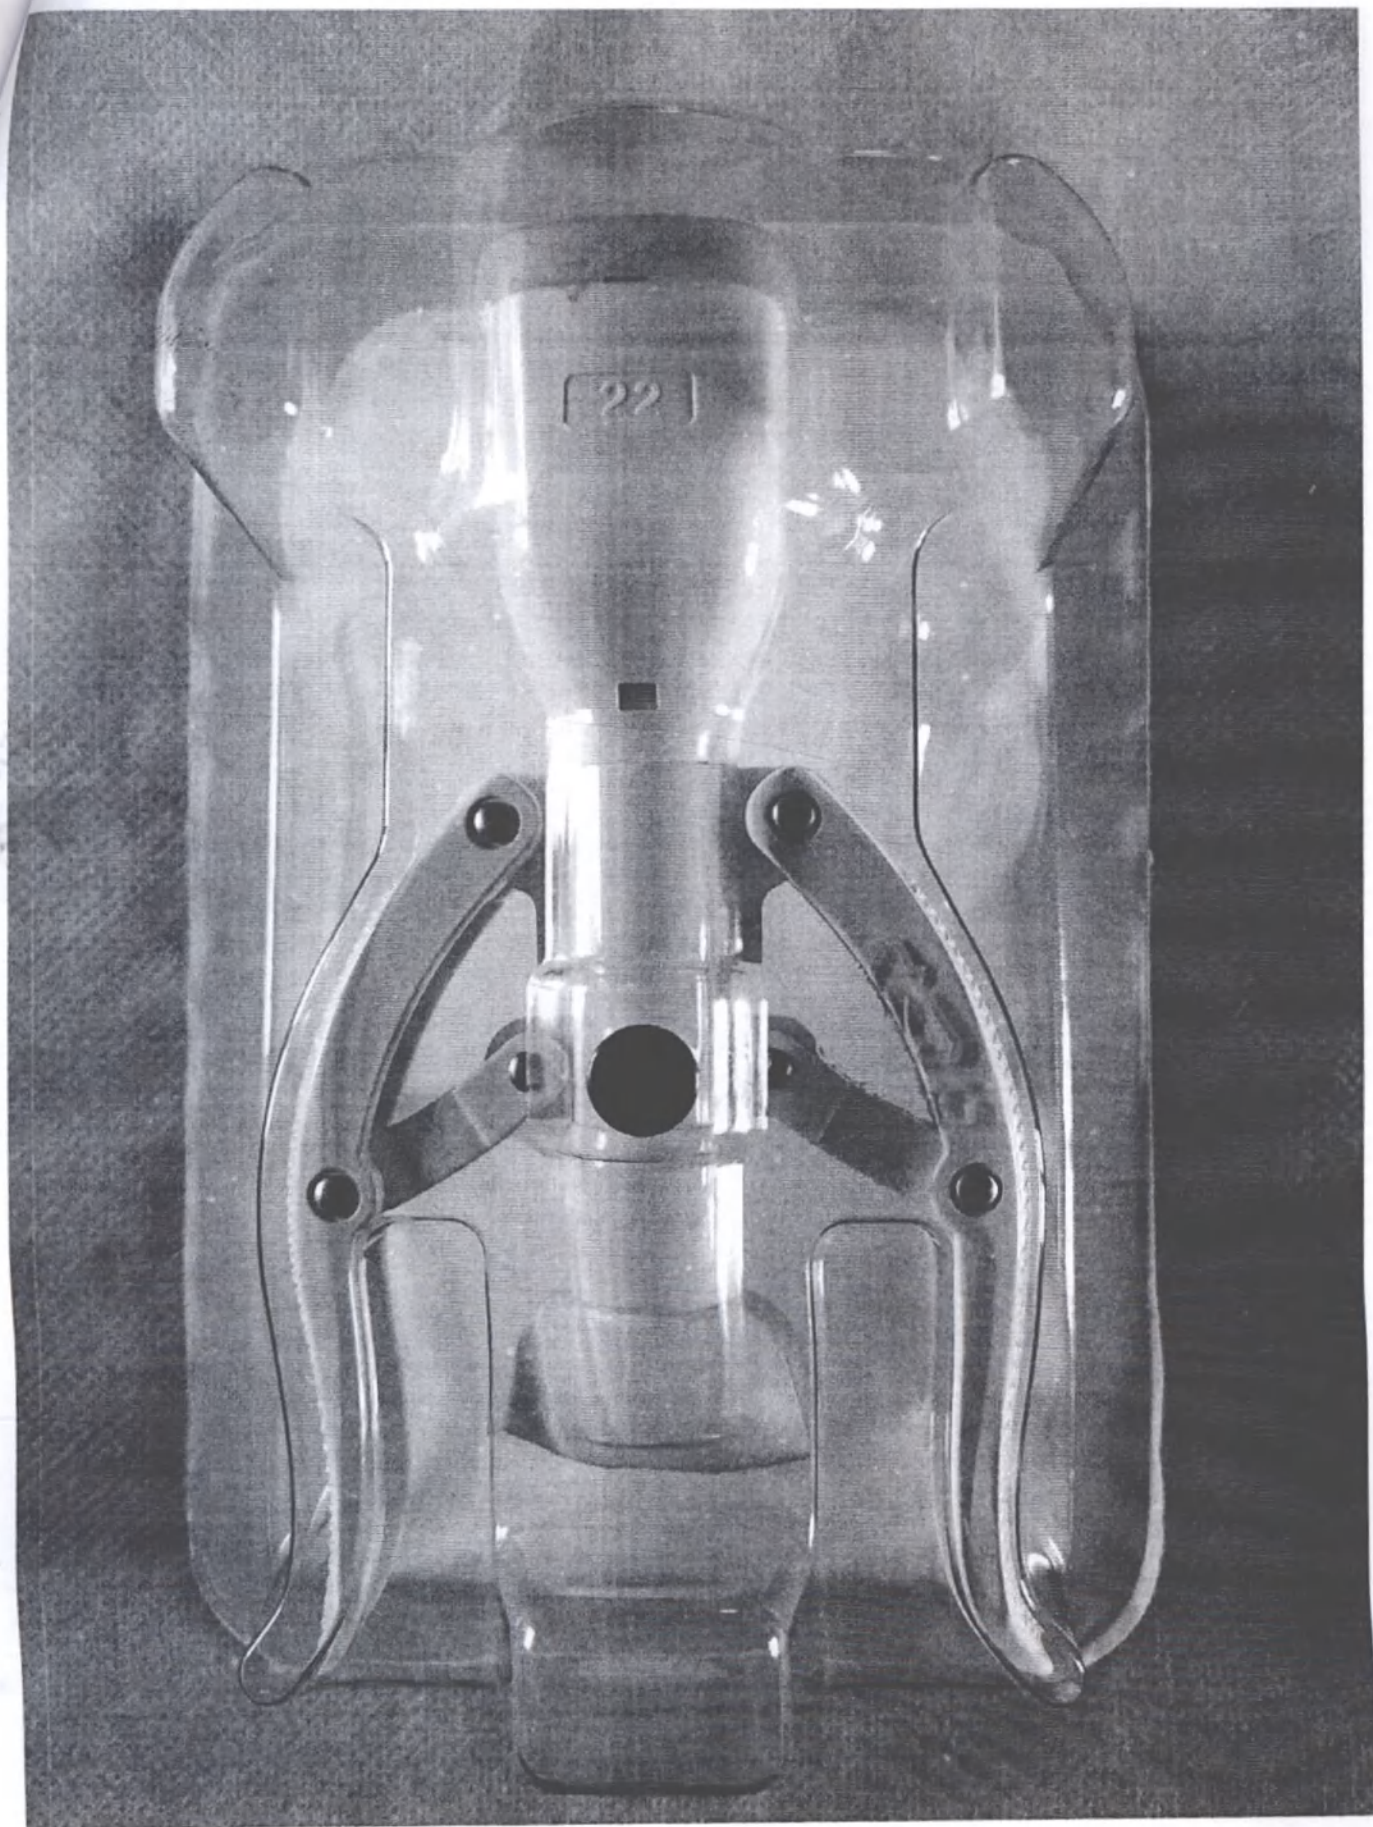



ZSR[®]
Biomedical Technology



Disposable Circumcision Anastomat

Анастомат для ширкумцизии одноразовый

☐ ZSR-DCA-34

☐ ZSR-DCA-30A



2021-02
19030201

☐ ZSR-DCA-26

☒ ZSR-DCA-22

LOT

☐ ZSR-DCA-18

☐ ZSR-DCA-14

☐ ZSR-DCA-10

Quantity: 1PC / Bag

Intended Use

This device is used for clinical male genital circumcision suture surgery and is suitable for patients with phimosis and redundant prepuce.

Contraindications

1. Man with malformed prepuce or glans (including the person whose prepuce and glans are widely and tightly adhered together) should avoid circumcised use this product ;
2. Man whose prepuce and glans are infected and the person with edema around glans should avoid circumcised use this product ;
3. Man who is suspected to have penile carcinoma should avoid circumcised use this product ;
4. Man who suffers from systematic disease (such as bleeding tendency, hypoproteinemia, serious cardiovascular disease, etc.) and mental disease should avoid circumcised use this product.

Storage and Transportation:

Keep away from direct sunlight ,snow and rain. Do not squeeze. Should be stored under the condition of clean,well ventilated,dry place.

The color is brown after sterilized by EO



Single use only



Caution: Consult accompanying documents



Do not use if package is damaged



IMPORTANT: READ CAREFULLY INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS BEFORE USE



Dongguan ZSR Biomedical Technology

Company Limited

Unit 448, Qingfeng Road, Taihu Village, Sanzhong

Village Committee, Qingxi Town, 523651 Dongguan


City, Guangdong Province, R.P. China

Fax: +86 769 - 87890862

Tel: +86 769-87328976

Email: sales@zsrbimedical.com

Website: www.ZSRbiomedical.com




Renault-Petersen Limited

Address: 5 Bankside, Hanborough Business Park, Witney

OX29 8 LJ UK

Tel: +44 1993882779 Fax: +44 1993880210

Слайзер

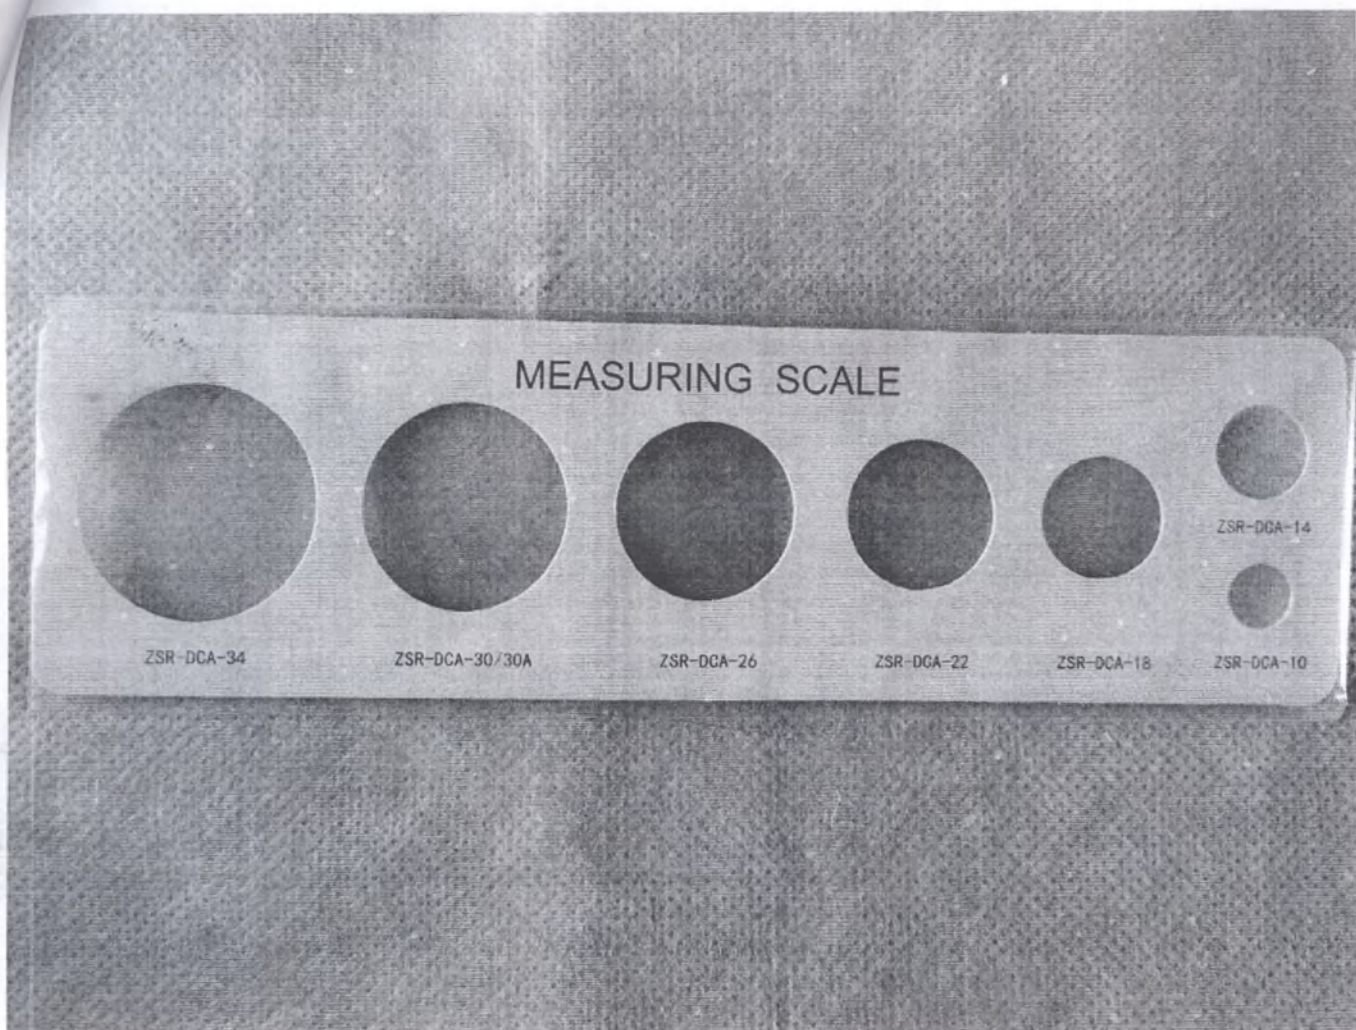



2016-2-25

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Анастомат для циркумизии
одноразовый



ZSR-DCA-34, ZSR-DCA-30A
ZSR-DCA-26, ZSR-DCA-22,
ZSR-DCA-18, ZSR-DCA-14,
ZSR-DCA-10

Данная инструкция по применению используется для моделей
ZSR-DCA-34, ZSR-DCA-30A, ZSR-DCA-26, ZSR-DCA-22, ZSR-DCA-18, ZSR-DCA-14, ZSR-DCA-10.

Пожалуйста, прочитайте все предупреждения и инструкции перед
применением. Используйте изделие только по назначению,
описанному ниже. Неправильное применение может привести к
серьезным смертельным исходам, травмам, неправильному
обращению с медицинским устройством.

Все анастоматы для обрезания стерильны и предназначены
для одноразового использования только для гигиены.

Dongguan ZSR Biomedical Technology Company Limited

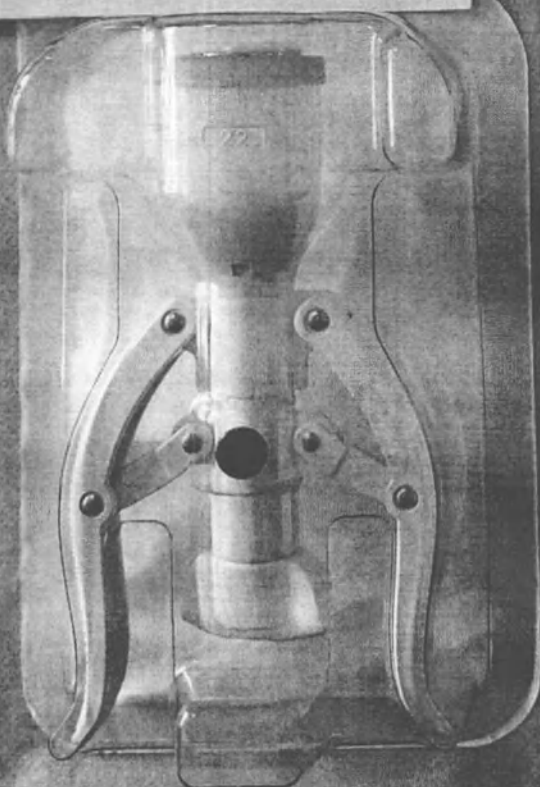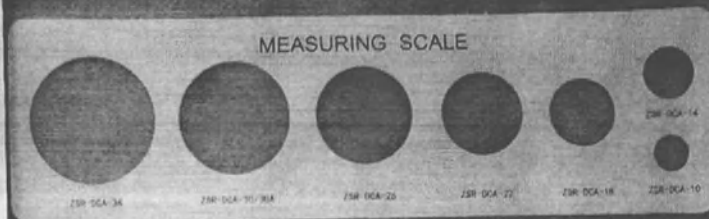

прошито и пронумеровано

Кол-во листов 32 тридцать два



Генеральный директор
ООО «ОМЕГАМЕДСЕРВИС»
/Кокарева И.О./