
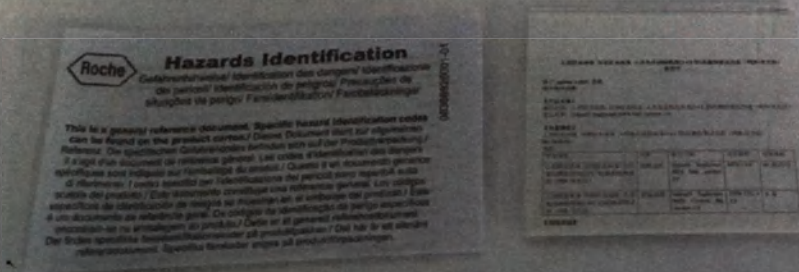


Фотографические изображения

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

2023

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0) (общий вид)

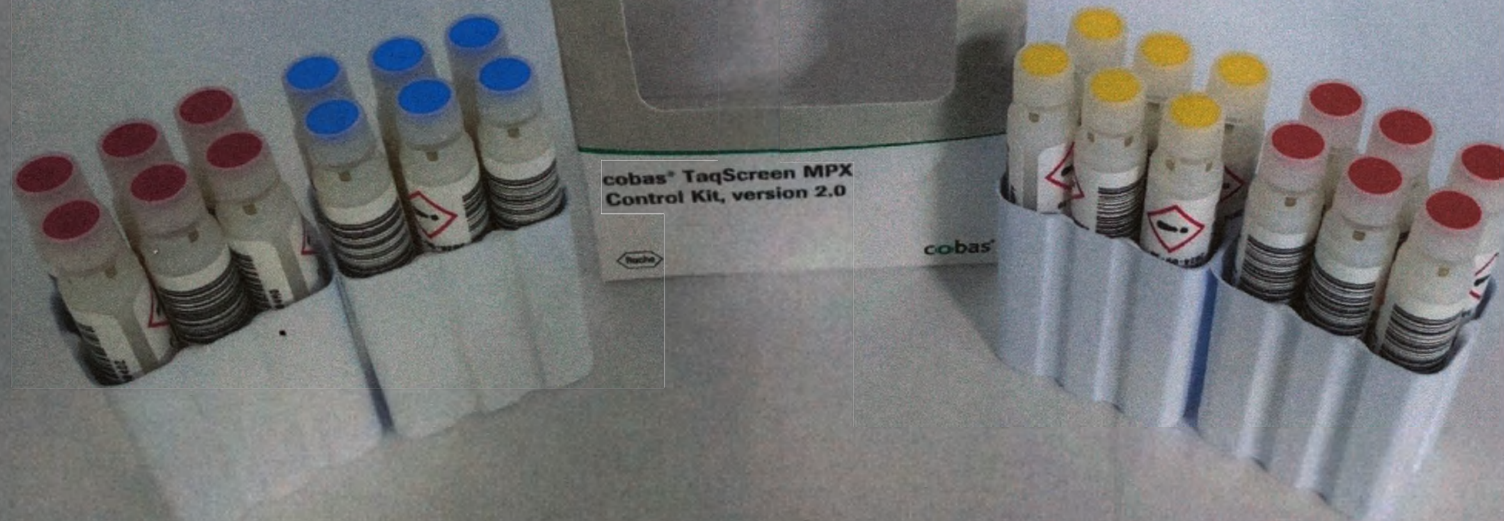

**cobas[®] TaqScreen MPX
Control Kit, version 2.0**


REF

05965390190

IVD

Rx Only

MPX CTL v2.0



cobas[®]

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒(1+2型)核
酸质控试剂 (PCR-荧光法)

cobas® TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0

预期用途: 用于cobas® TaqScreen MPX Test,
version 2.0 的质控
包装规格: 6 套
注意事项: 详见说明书

贮藏条件: 2-8℃
进口注册证号: S20181014
标准编号: JS20180024
药品上市许可持有人: Roche Molecular Systems, Inc.
地 址: 1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876, USA

生产企业: Roche Molecular Systems, Inc.
生产地址: 1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876, USA
主要经销商: 罗氏诊断产品(上海)有限公司
地 址: 中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号
7号厂房第二层1部位
联系方式: +86-21-33971000



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA

Distributed by
Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46250-0452 USA
(For Technical Assistance call the
Roche Response Center
toll-free: 1-800-526-1247)

MPX CTL v2.0

LOT

MPX M(+)/C, v2.0	J27931
MPX O(+)/C, v2.0	J27933
MPX 2(+)/C, v2.0	J27945
MPX (-) C, v2.0	J28198

L1726-02

COBAS and TAQSCREEN are trademarks of Roche. ©2021 Roche Molecular Systems, Inc.

Made in USA

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)



产品批号: J27119
生产日期: 2023-03-15
有效期至: 2024-10-31

REF (240) 05965390190
GTIN (01) 00875197004014


UDI



LOT (10) J27119
2024-10-31
2023-03-15

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

(маркировка картонной упаковки)

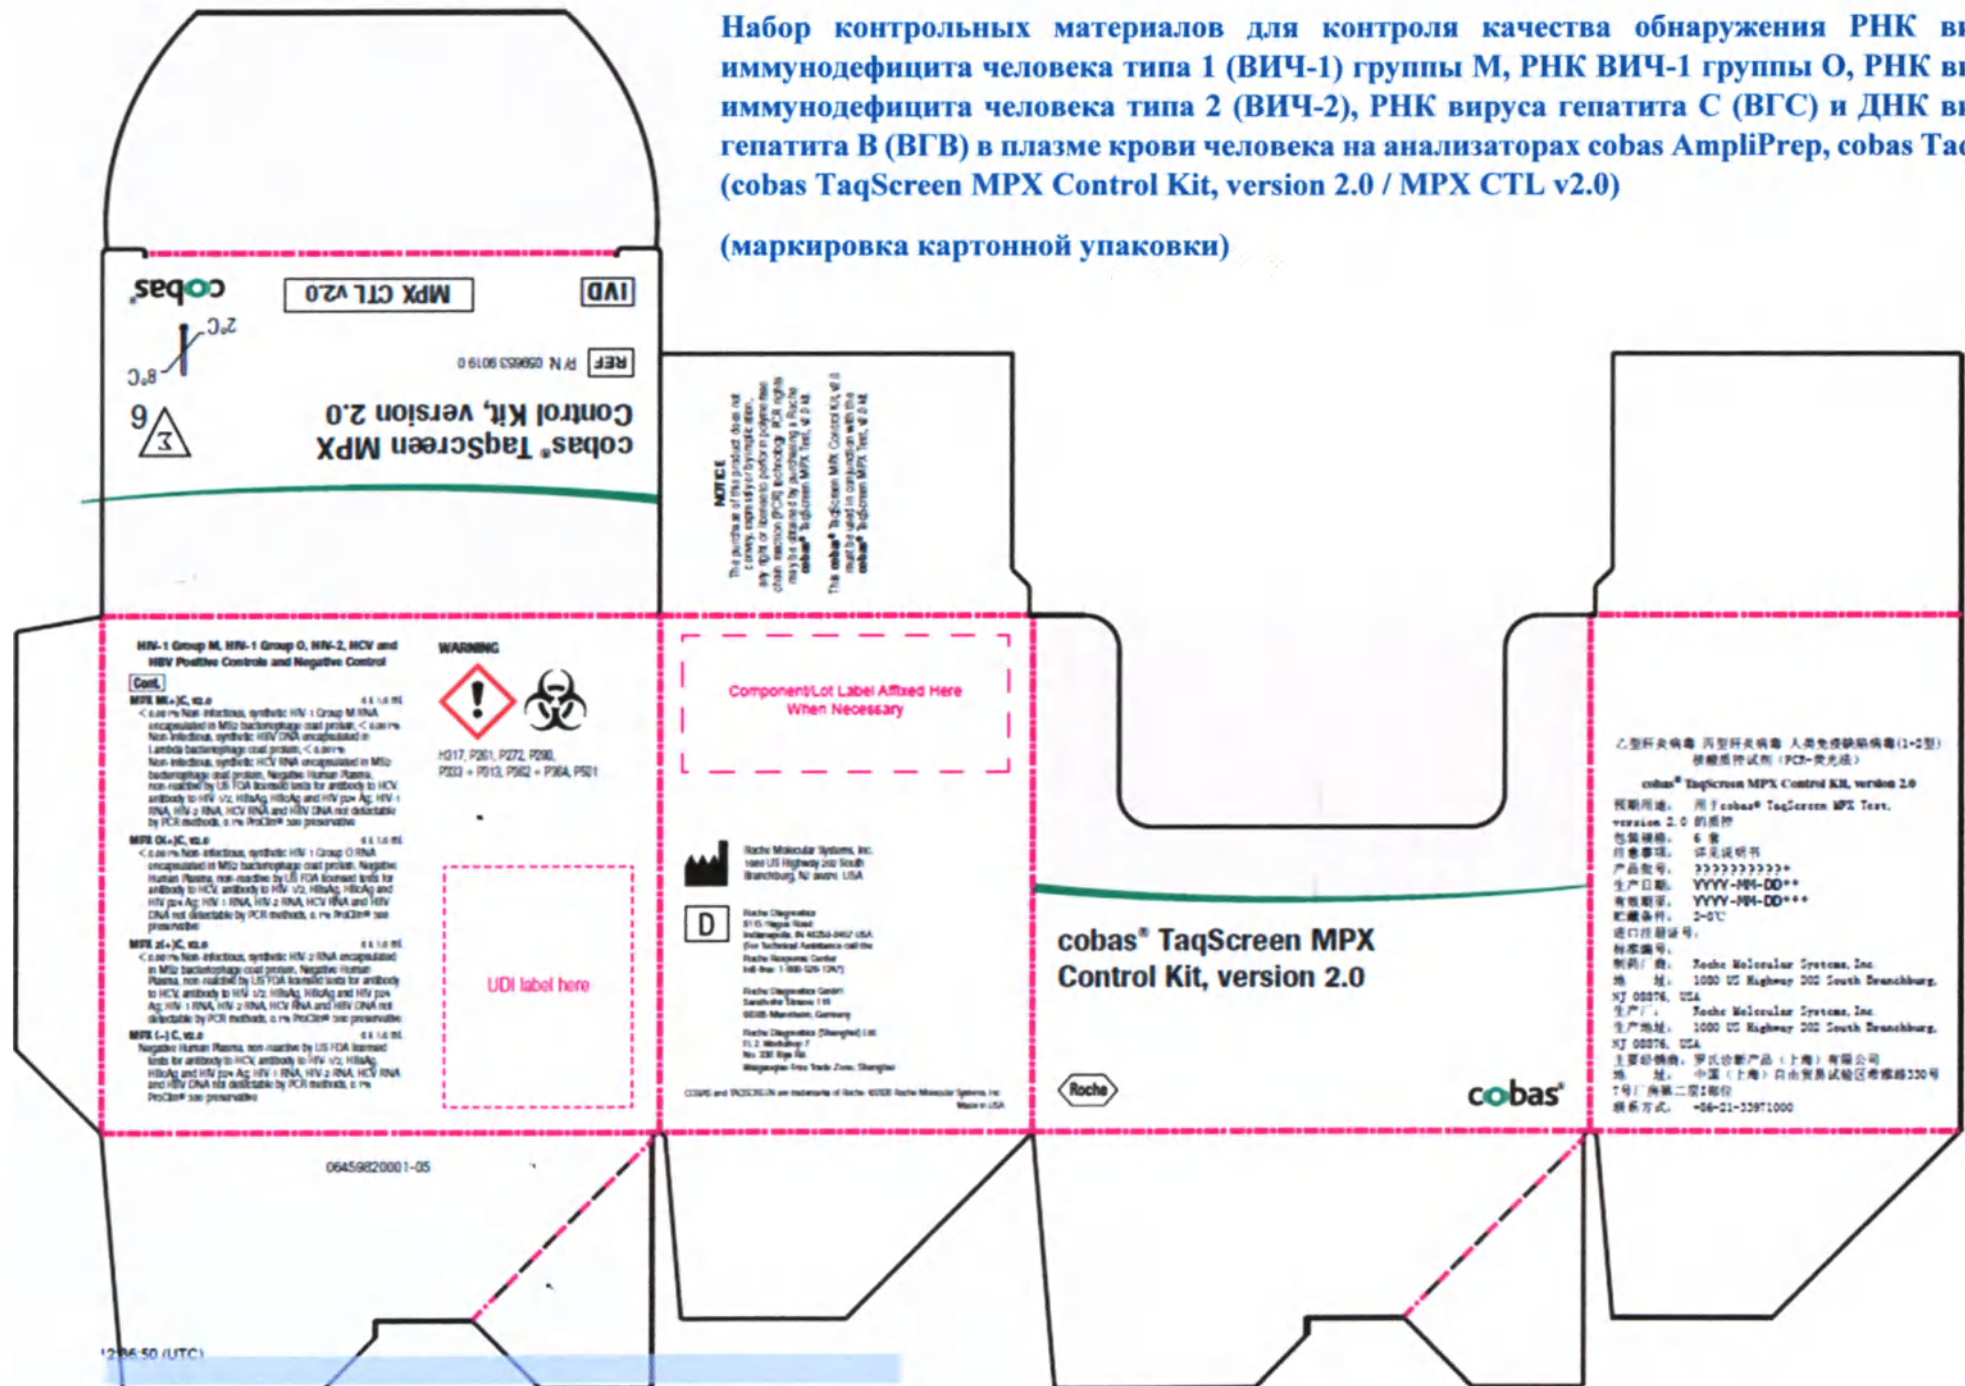

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

(маркировка на русском языке)

Набор контрольных материалов для контроля качества выявления нуклеиновых кислот вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0/ MPX CTL v2.0)

Состав:

1. Мультиположительный контроль MPX М (+) С, v2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
2. Положительный контроль ВИЧ-1 группы О MPX О (+) С, v2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
3. Положительный контроль ВИЧ-2 MPX 2 (+) С, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
4. Отрицательный контроль MPX (-) С, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13616 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc.» ("Рош Молекуляр Системс Инк."), США, 1080 US Highway 202 South, Branchburg, New Jersey, 08876, USA

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____

Кат. номер: 05965390190



Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

Состав:

1. Мультиположительный контроль MPX М (+) С, v2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
2. Положительный контроль ВИЧ-1 группы О MPX О (+) С, v2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
3. Положительный контроль ВИЧ-2 MPX 2 (+) С, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.
4. Отрицательный контроль MPX (-) С, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт.

Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

Состав:

3. Положительный контроль ВИЧ-2 MPX 2 (+) C, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт. (маркировка флакона)



Набор контрольных материалов для контроля качества обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека на анализаторах cobas AmpliPrep, cobas TaqMan (cobas TaqScreen MPX Control Kit, version 2.0 / MPX CTL v2.0)

Состав:

4. Отрицательный контроль MPX (-) C, v 2.0 во флаконе, объемом 1,6 мл, 6 шт. (маркировка флакона)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
10 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.

Васильев И. Т.