


Макет этикетки потребительской упаковки

	<p>Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (MediPAN-2G+ FAST COVID Test Kit). Lot № 0120.</p> <p>Акционерное общество «Медикофарма» (Medicofarma S.A.)</p> <p><i>Головной офис:</i> Польша, Варшава, 01-142, стр. У19, улица Соколовская, д. 9 <i>Адрес производственной площадки:</i> Польша, Радом, 26-600, улица Тарнобжеская, д. 13</p> <p>Представитель производителя в РФ:</p> <p>АО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»</p> <p>142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, дом 29 Тел. + 7 (495) 702-95-06</p>	
	<p>Для профессионального применения</p> <p>Состав набора:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BE –буфер и ферменты для реакции – 1 флакон (1430 мкл) 2. PP – праймеры и зонды для обнаружения вируса - 1 флакон (285 мкл) 3. PC – положительный контрольный образец - 1 флакон (60 мкл) 4. IC – внутренний контрольный образец – 1 флакон (1100 мкл) 5. NC - отрицательный контрольный образец 1 флакон - 100 мкл 6. Инструкция по применению – 1 шт 	
<div>REF</div>	<div>LOT</div>	
 РУ	Дата регистрации	
	<div>     </div> <div>94</div>	





INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ
Polskiej Akademii Nauk




Medicofarma

MediPAN-2G+FAST COVID test

SARS-CoV-2 Detection Kit

Real-time RT-PCR

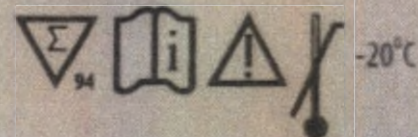

Kit contents:

1. BE - buffer and enzymes for virus detection reaction
2. PP - primers and probes for virus detection reaction
3. PC - positive control
4. IC - internal control template
5. NC - negative control

IVD

REF

MPC5

LOT

0120



2021-09-12





Medicofarma S.A.


ul. Sokołowska 9 lok. U19, 01-142 Warszawa, Poland


www.medicofarma.pl/coronavirus-test



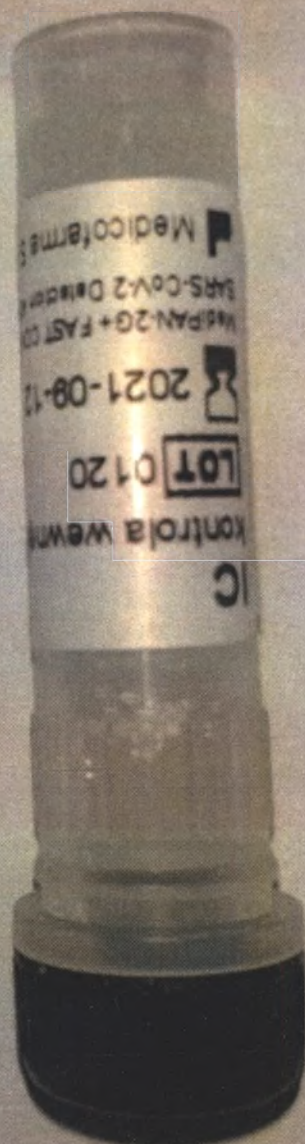

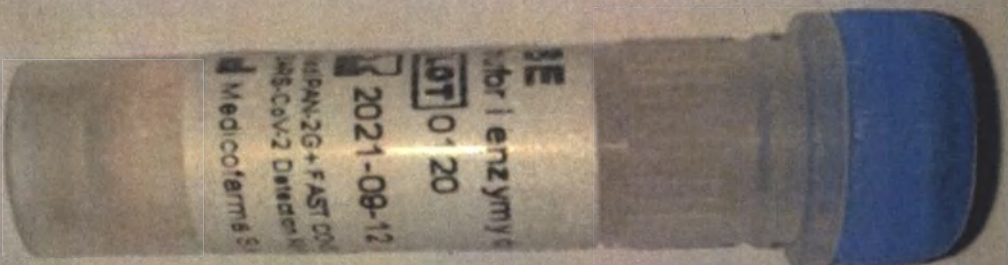

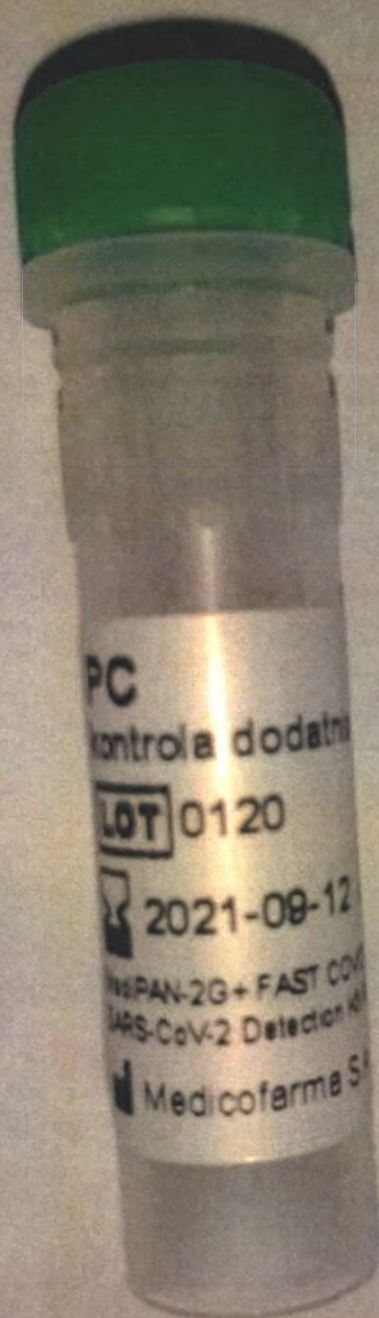

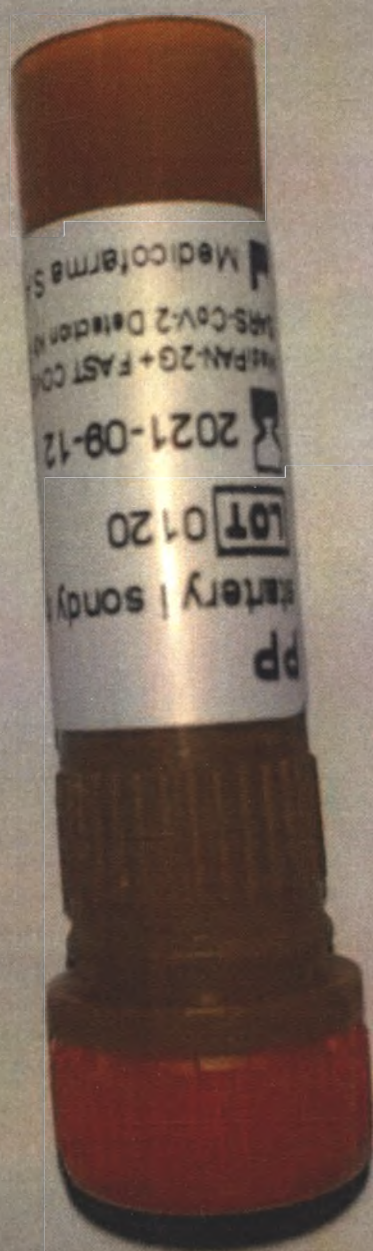

NC

kontrola ujemn

LOT 0120

2021-09-12

MedPAN-2G + FAST CO
SARS-CoV-2 Detector

Medicoforma

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 листов

Руководитель группы по регистрации
зарубежных препаратов АО «АКРИХИН»

Миронова Т.Н.

