

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ПлазмоВита»

Мехтиева Д. М.


30 сентября 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


«Инкубатор лабораторный сухого нагрева DKT200-2A»

Содержание:


Инкубатор лабораторный сухого нагрева DKT200.....	3,4
Кабель питания	5
Отвертка.....	6
Руководство по эксплуатации	7
Блок нагревательный для 10 мл пробирок	8
Блок нагревательный для 5 мл пробирок	9
Пресс-блок нагревательный с двумя выемками	10
Пресс-блок нагревательный с тремя выемками	11
Пресс для пресс-блока нагревательного с двумя выемками	12
Пресс для пресс-блока нагревательного с тремя выемками.....	13
Устройство для вынимания блока	14

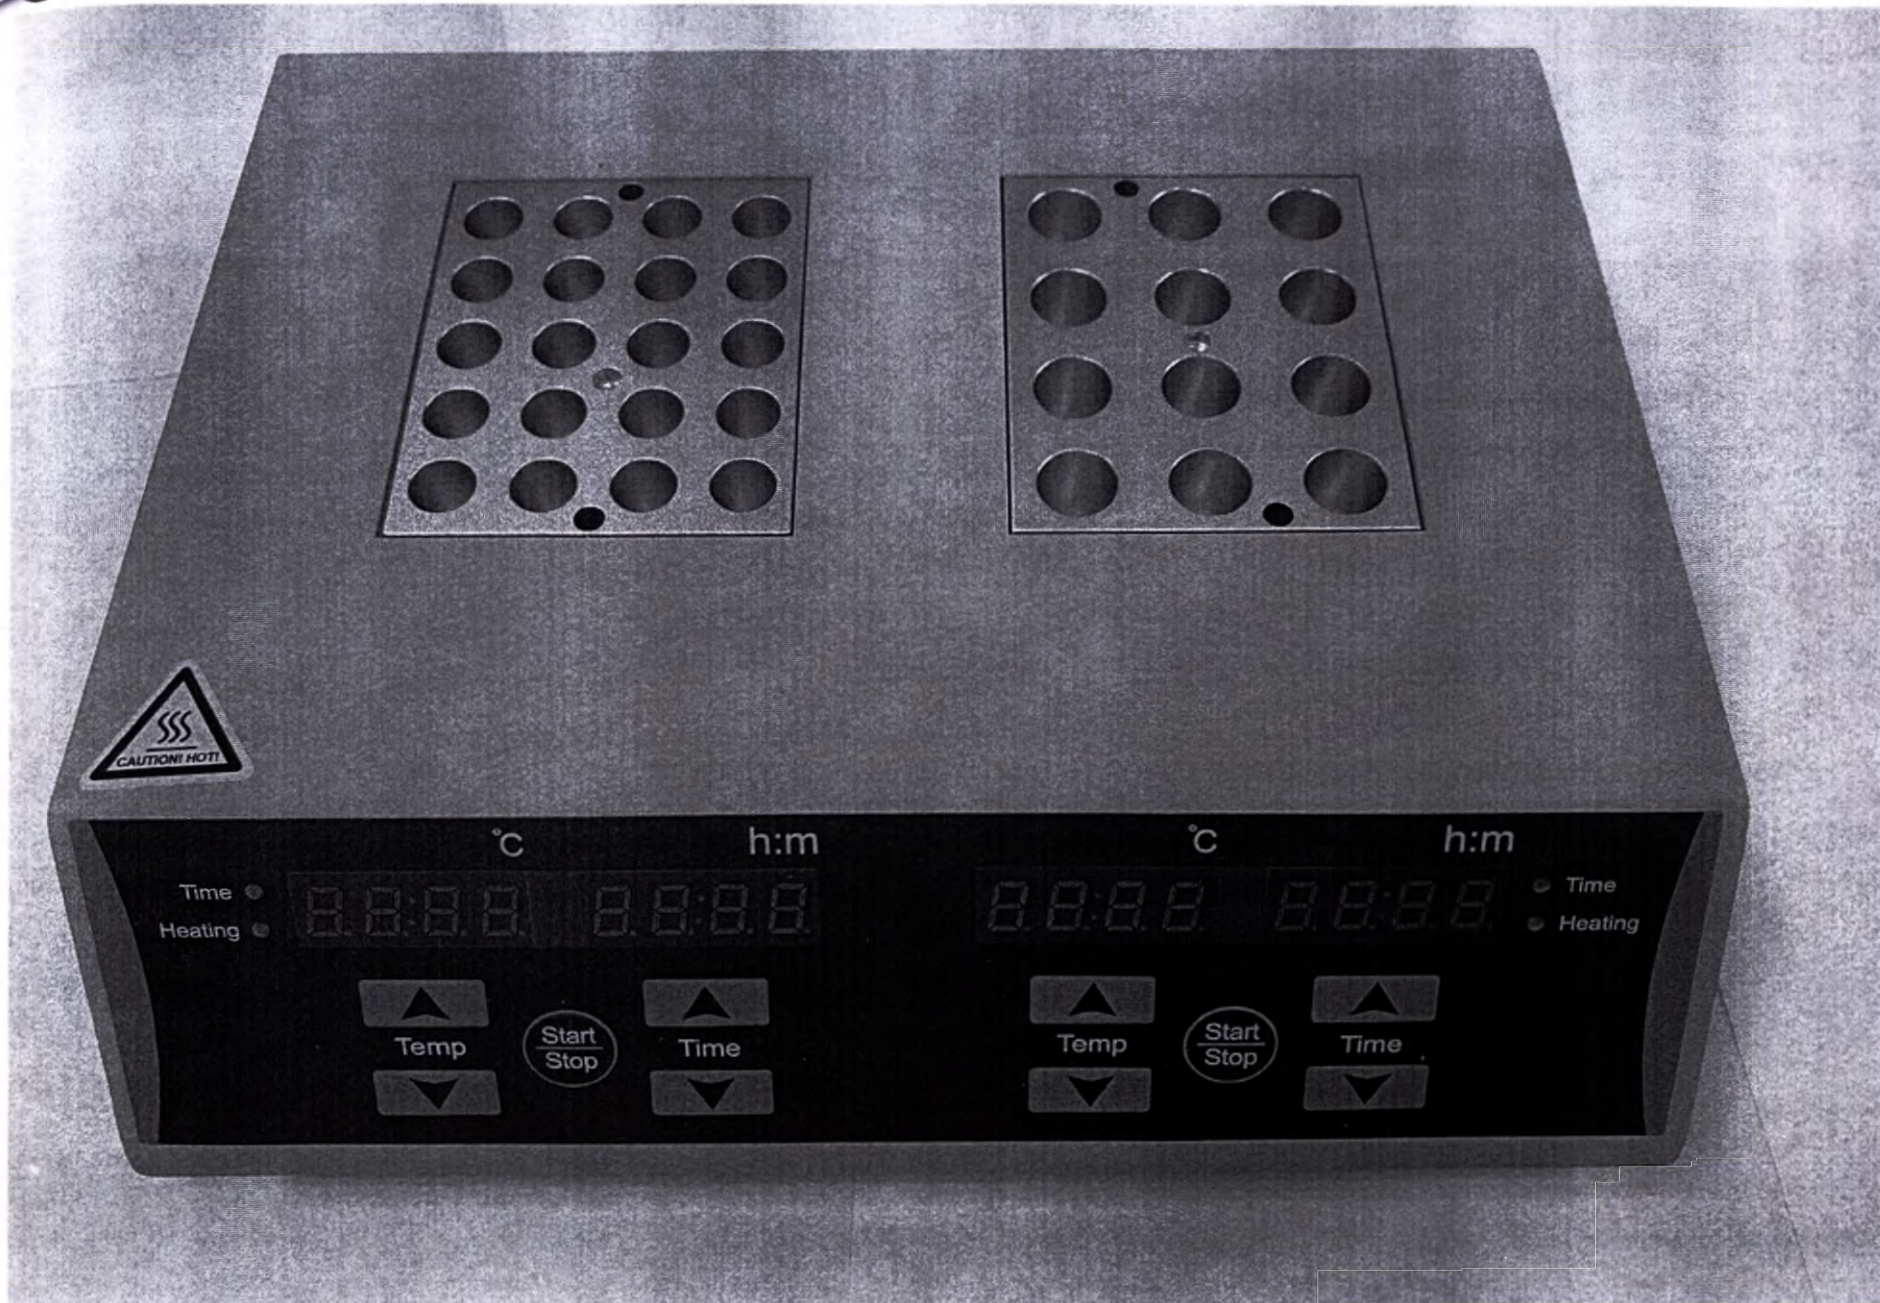

Инкубатор лабораторный сухого нагрева DKT200

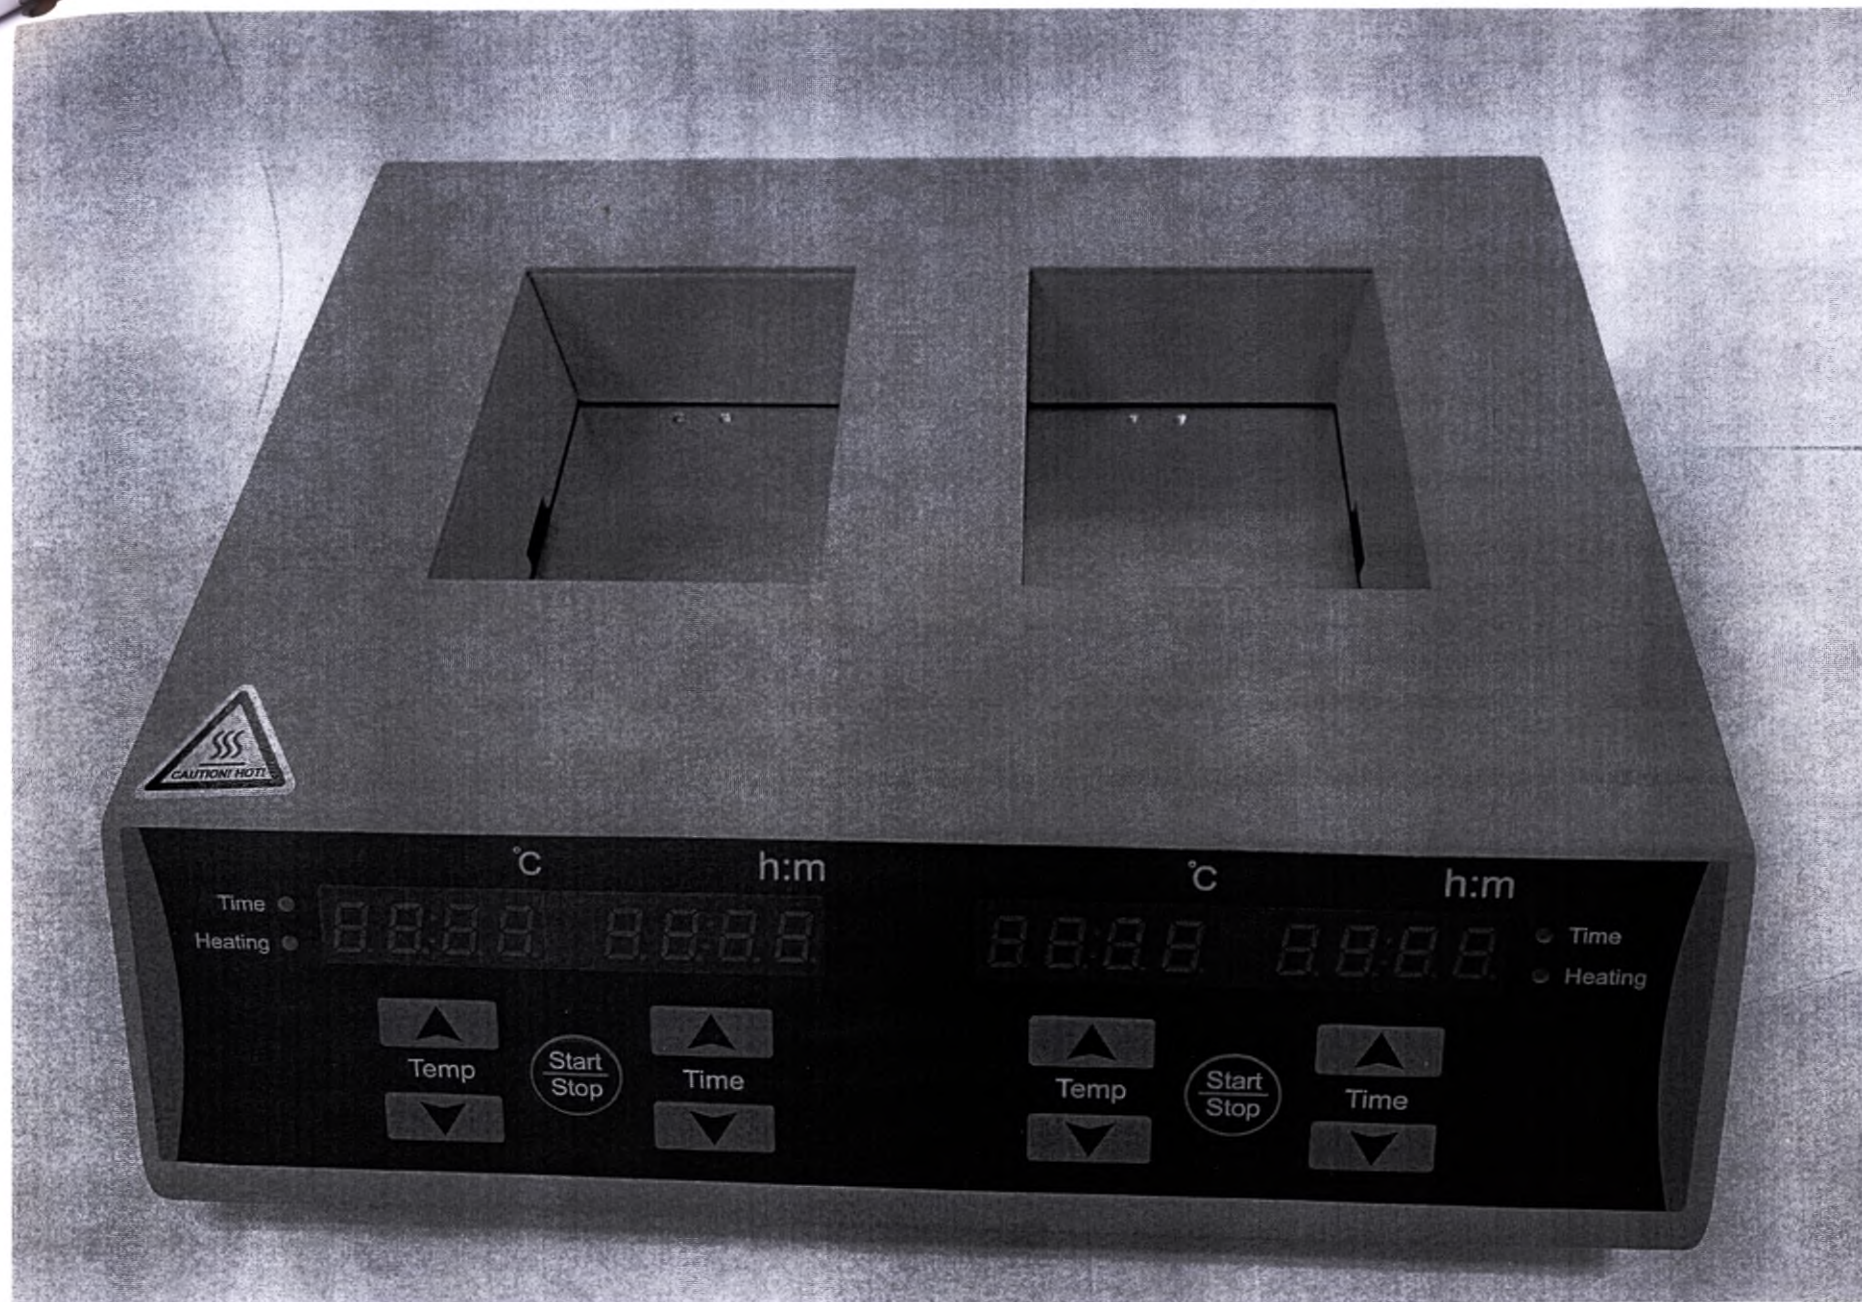

Инкубатор лабораторный сухого нагрева DKT200

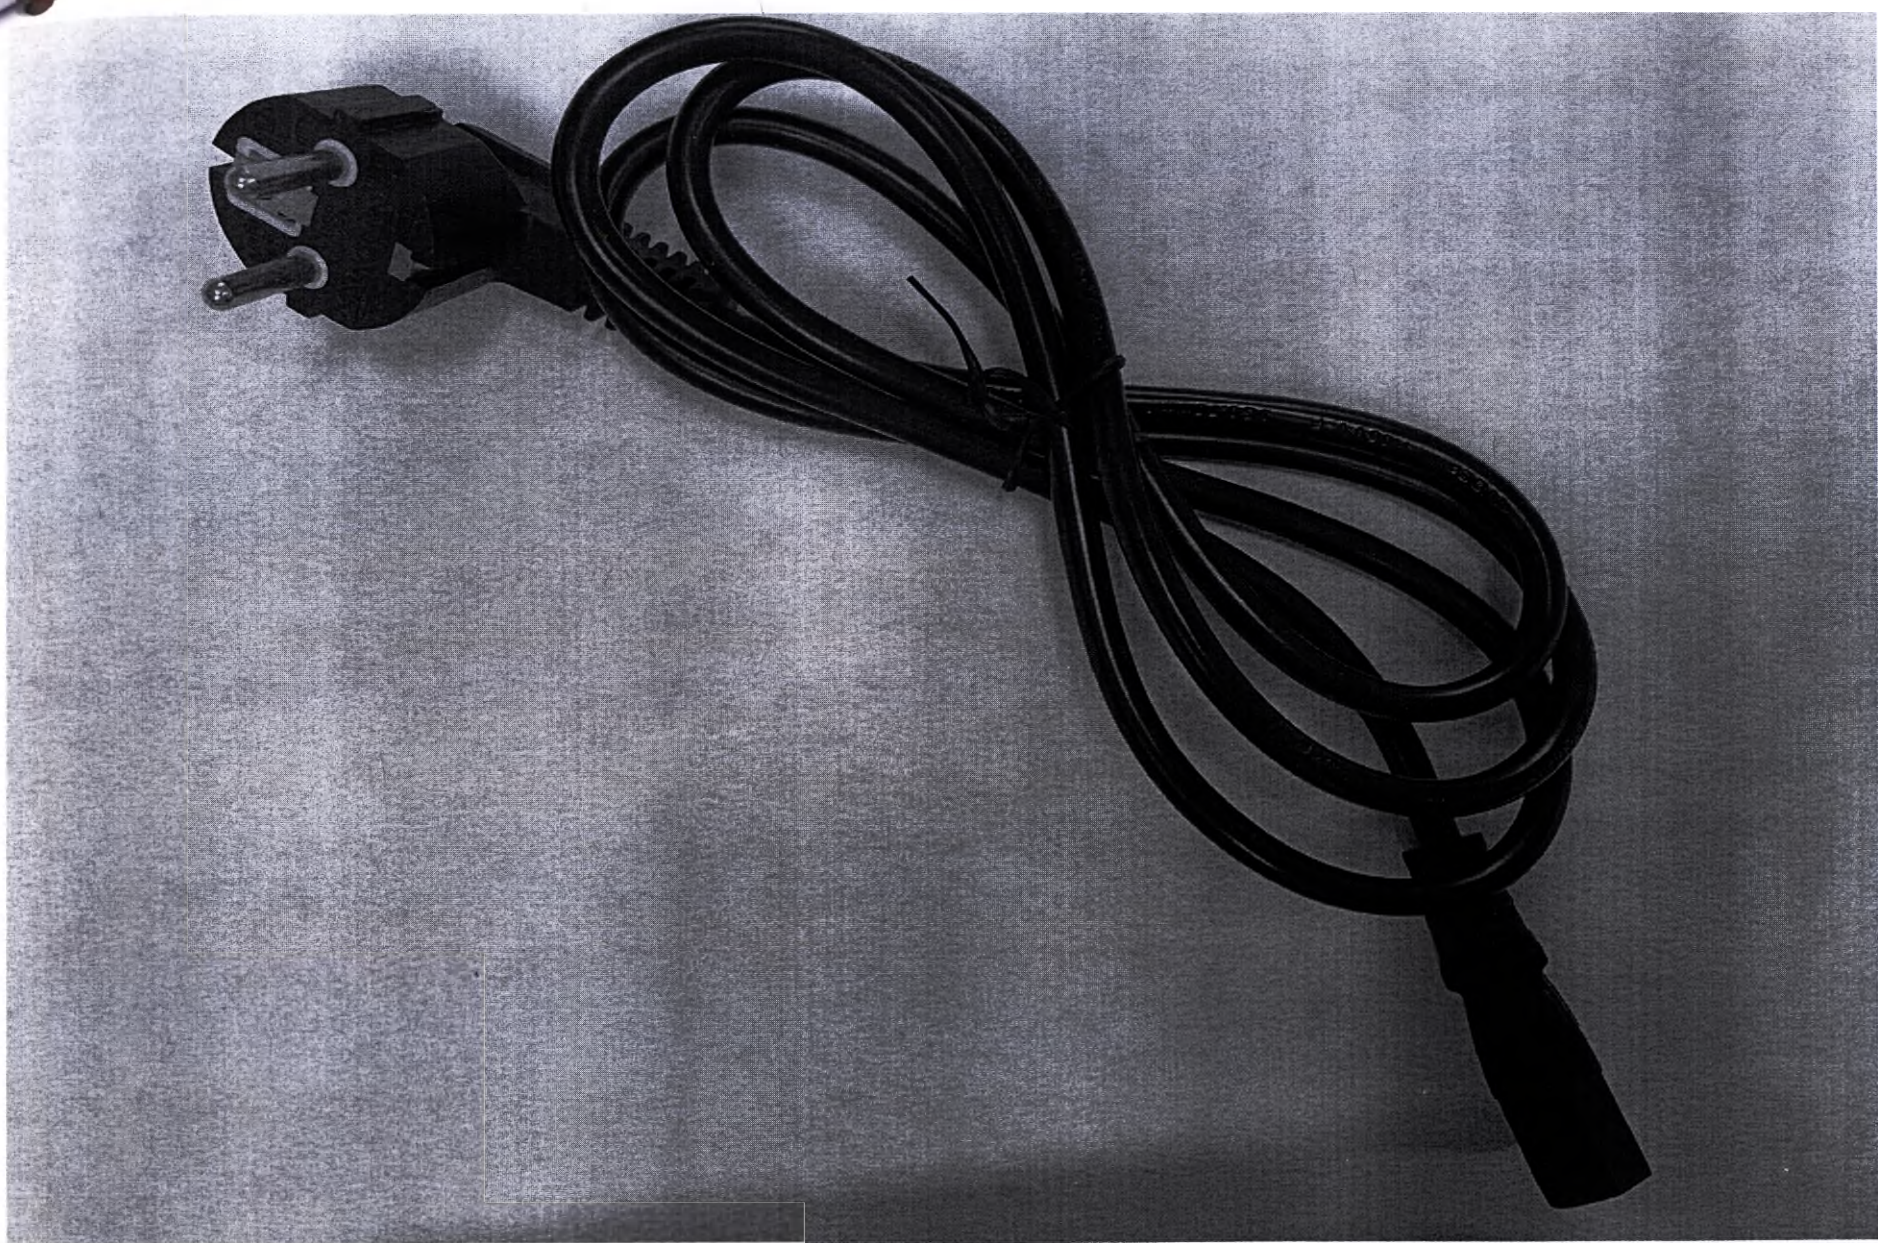

Кабель питания



Отвертка


Руководство по эксплуатации


Номер документа: MU01SM

Редакция: 1.0


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инкубатор лабораторный сухого нагрева DKT200-2A

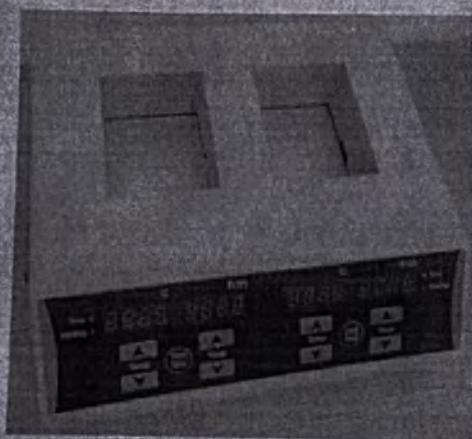


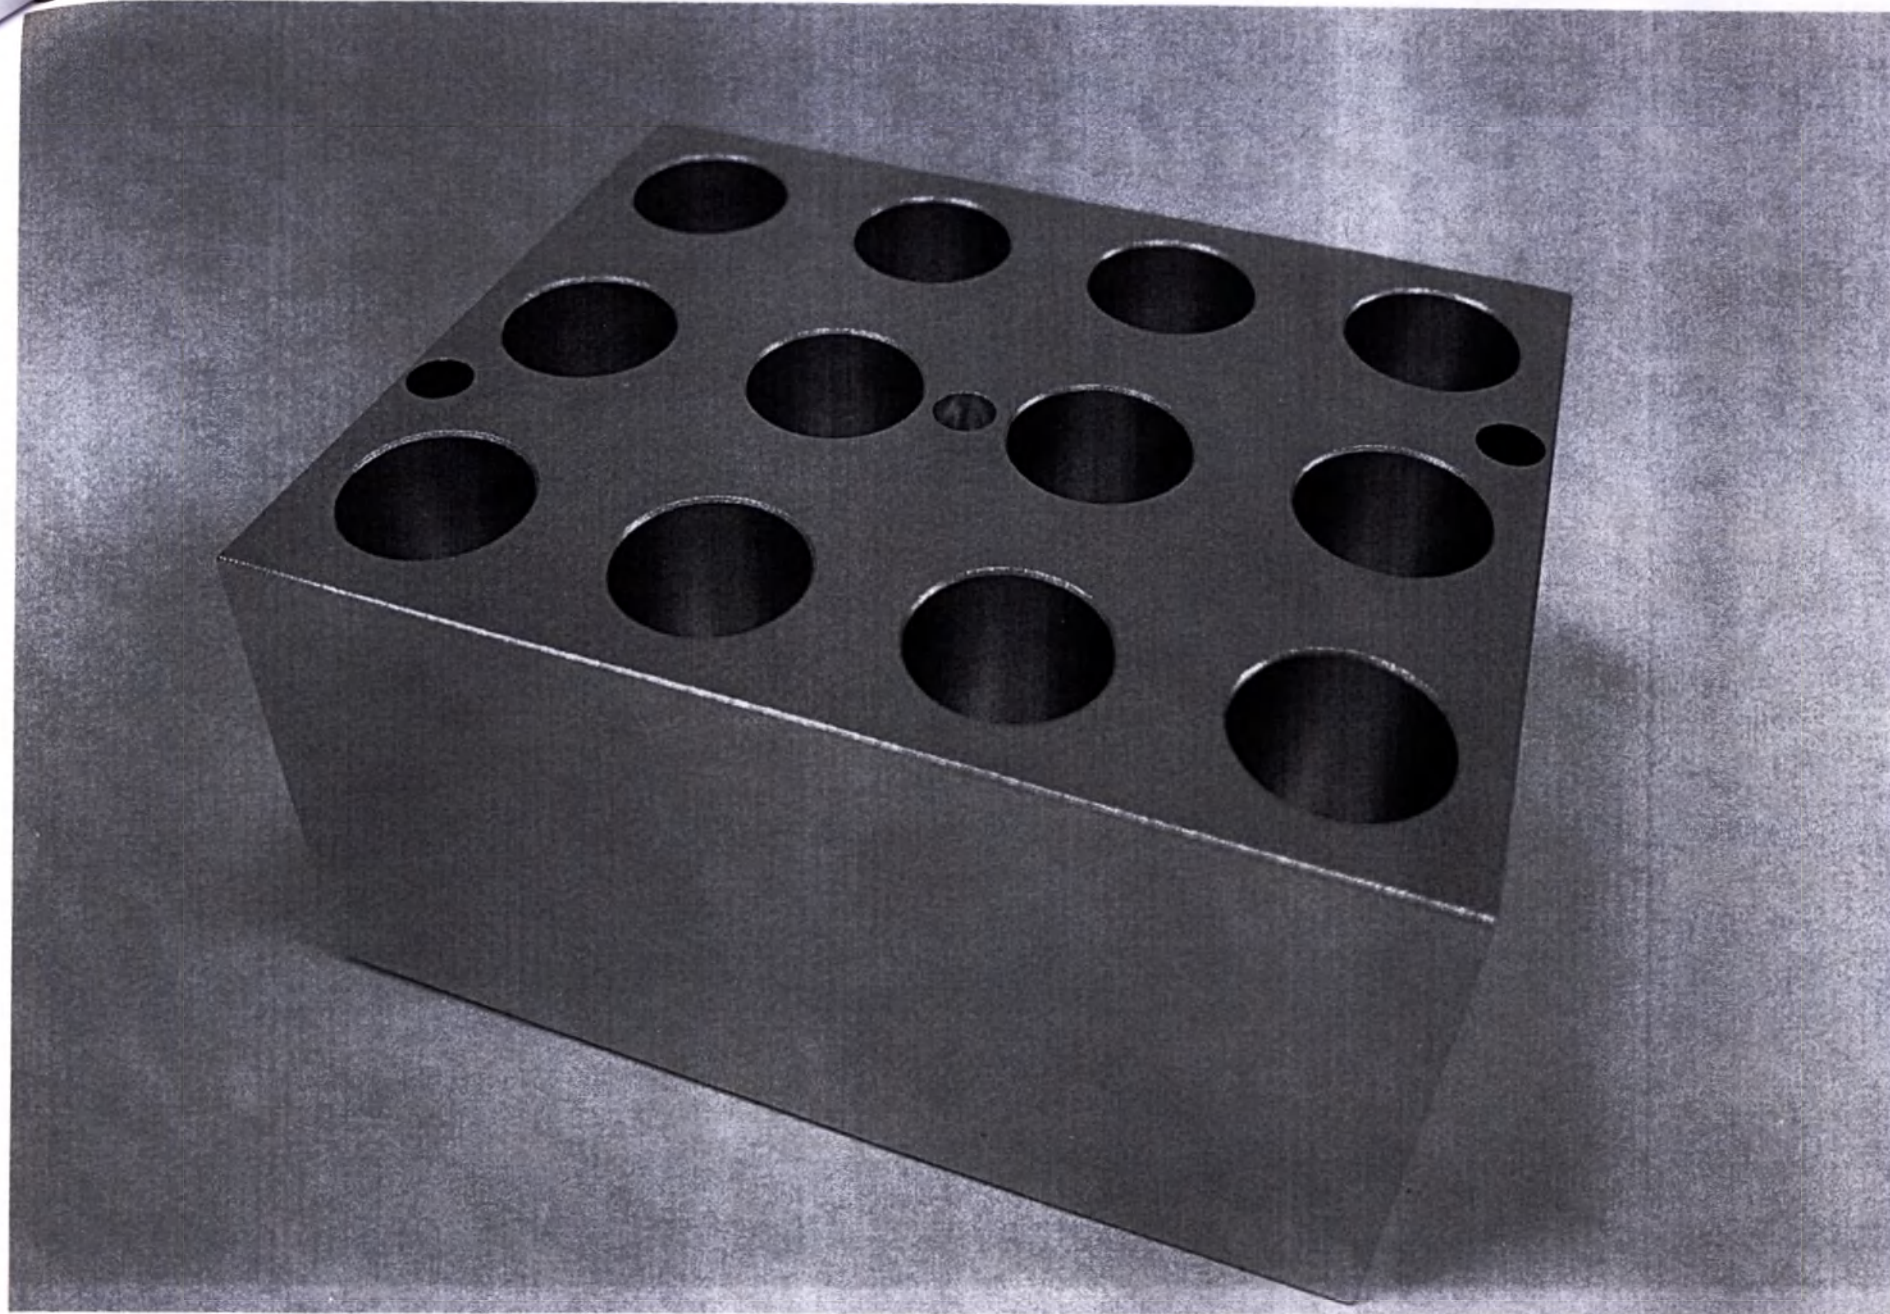


Блок нагревательный для 10 мл пробирок

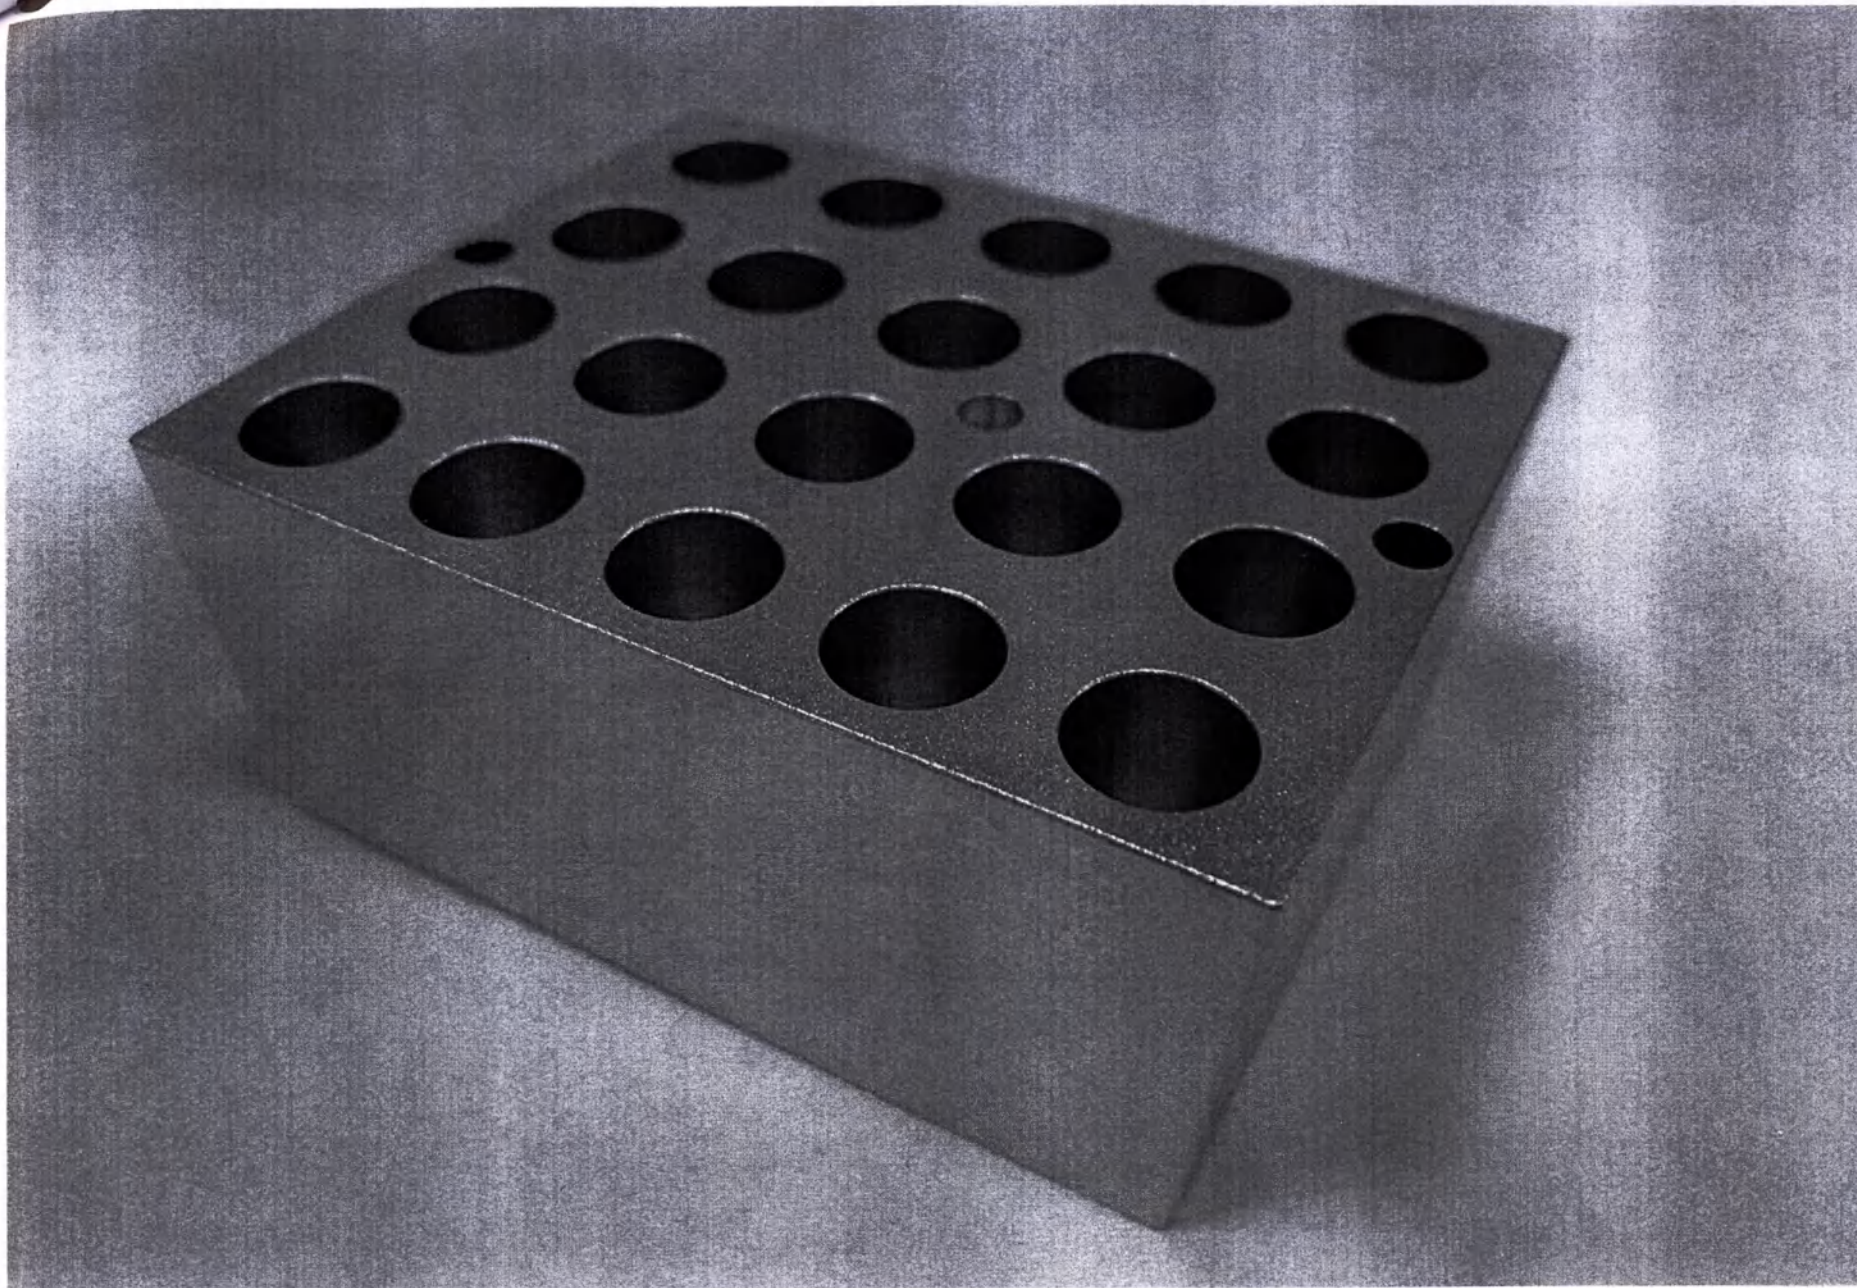


Блок нагревательный для 5 мл пробирок

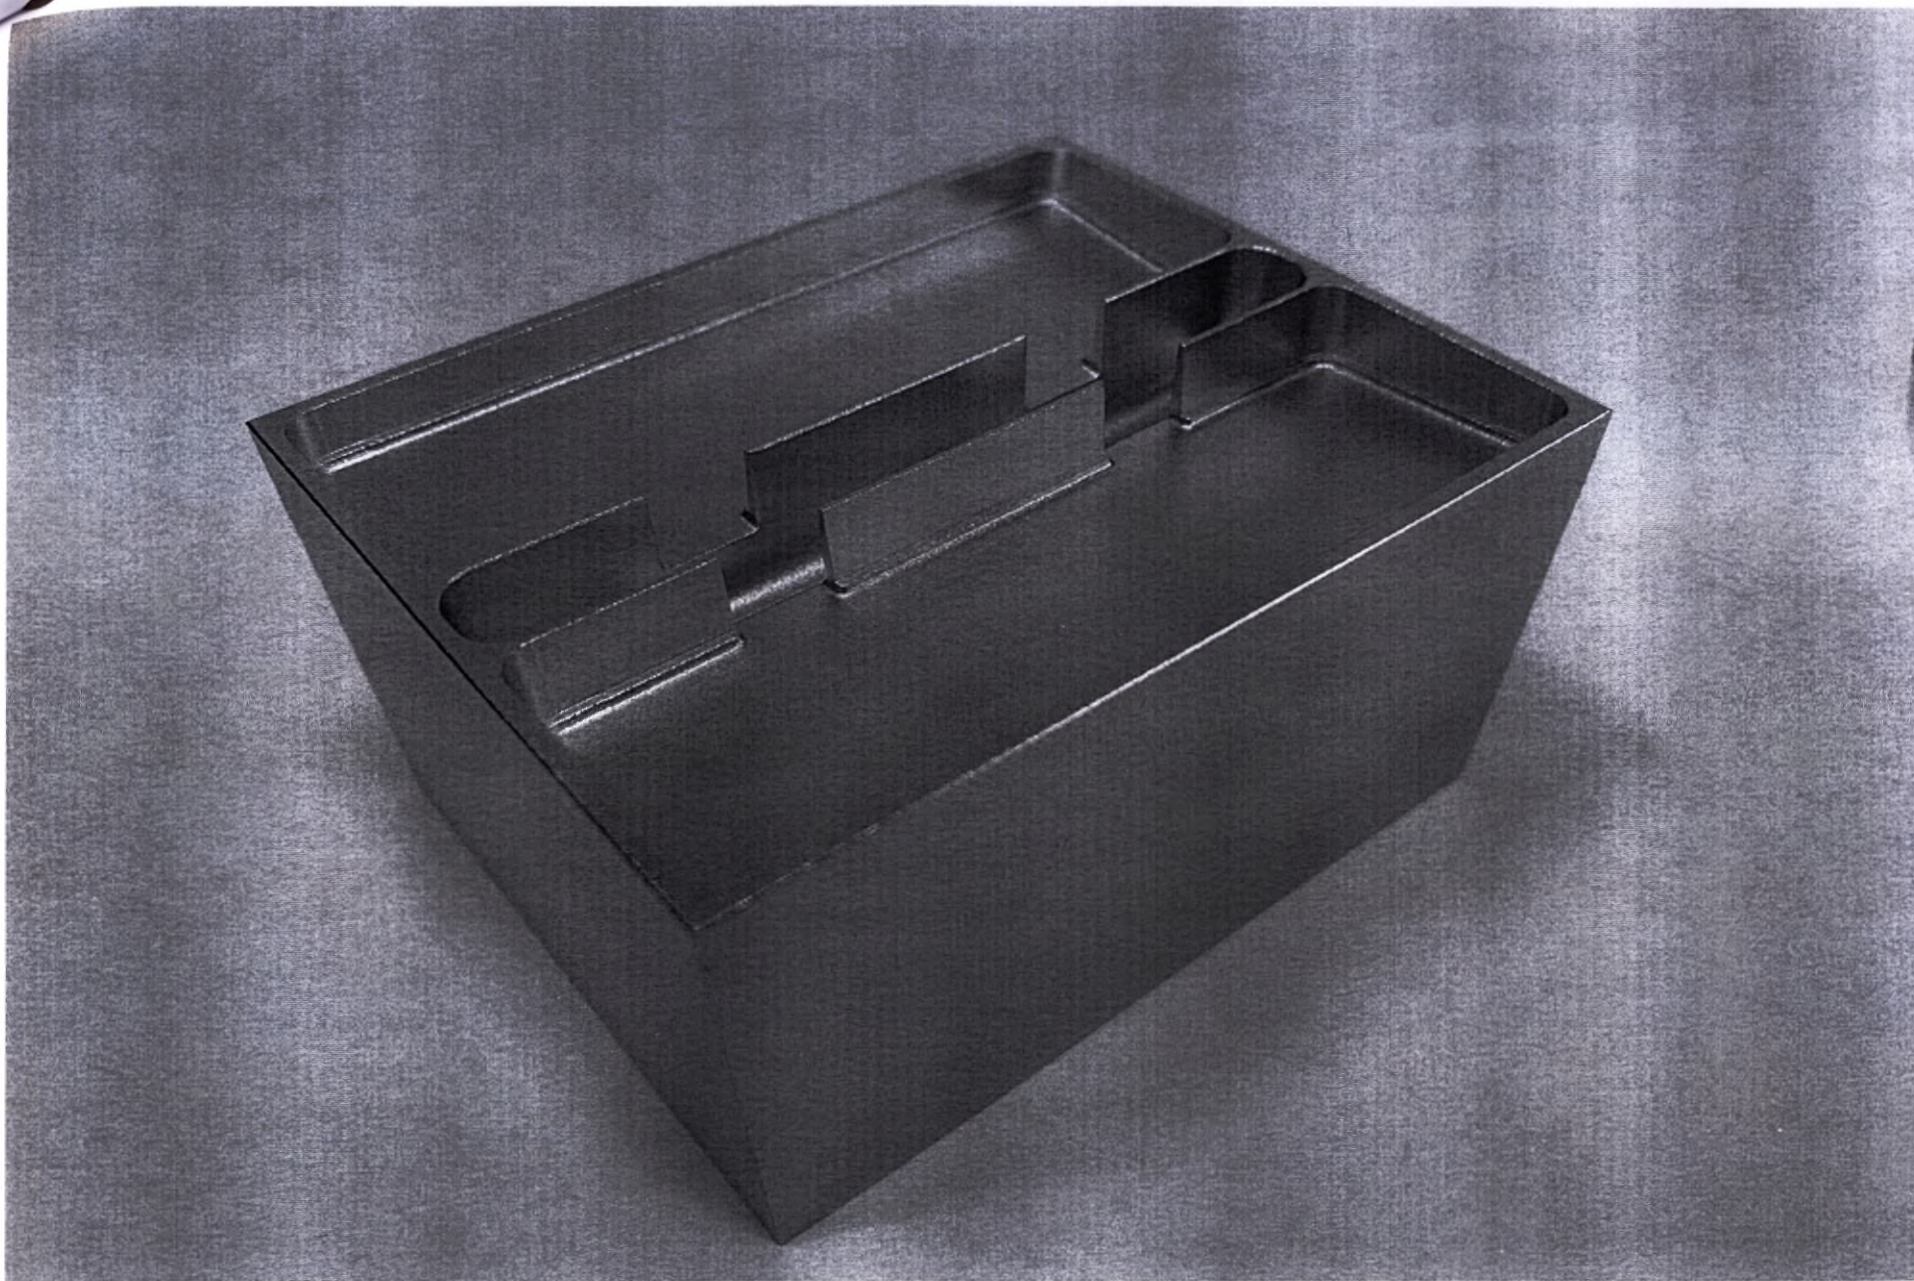


Пресс-блок нагревательный с двумя выемками

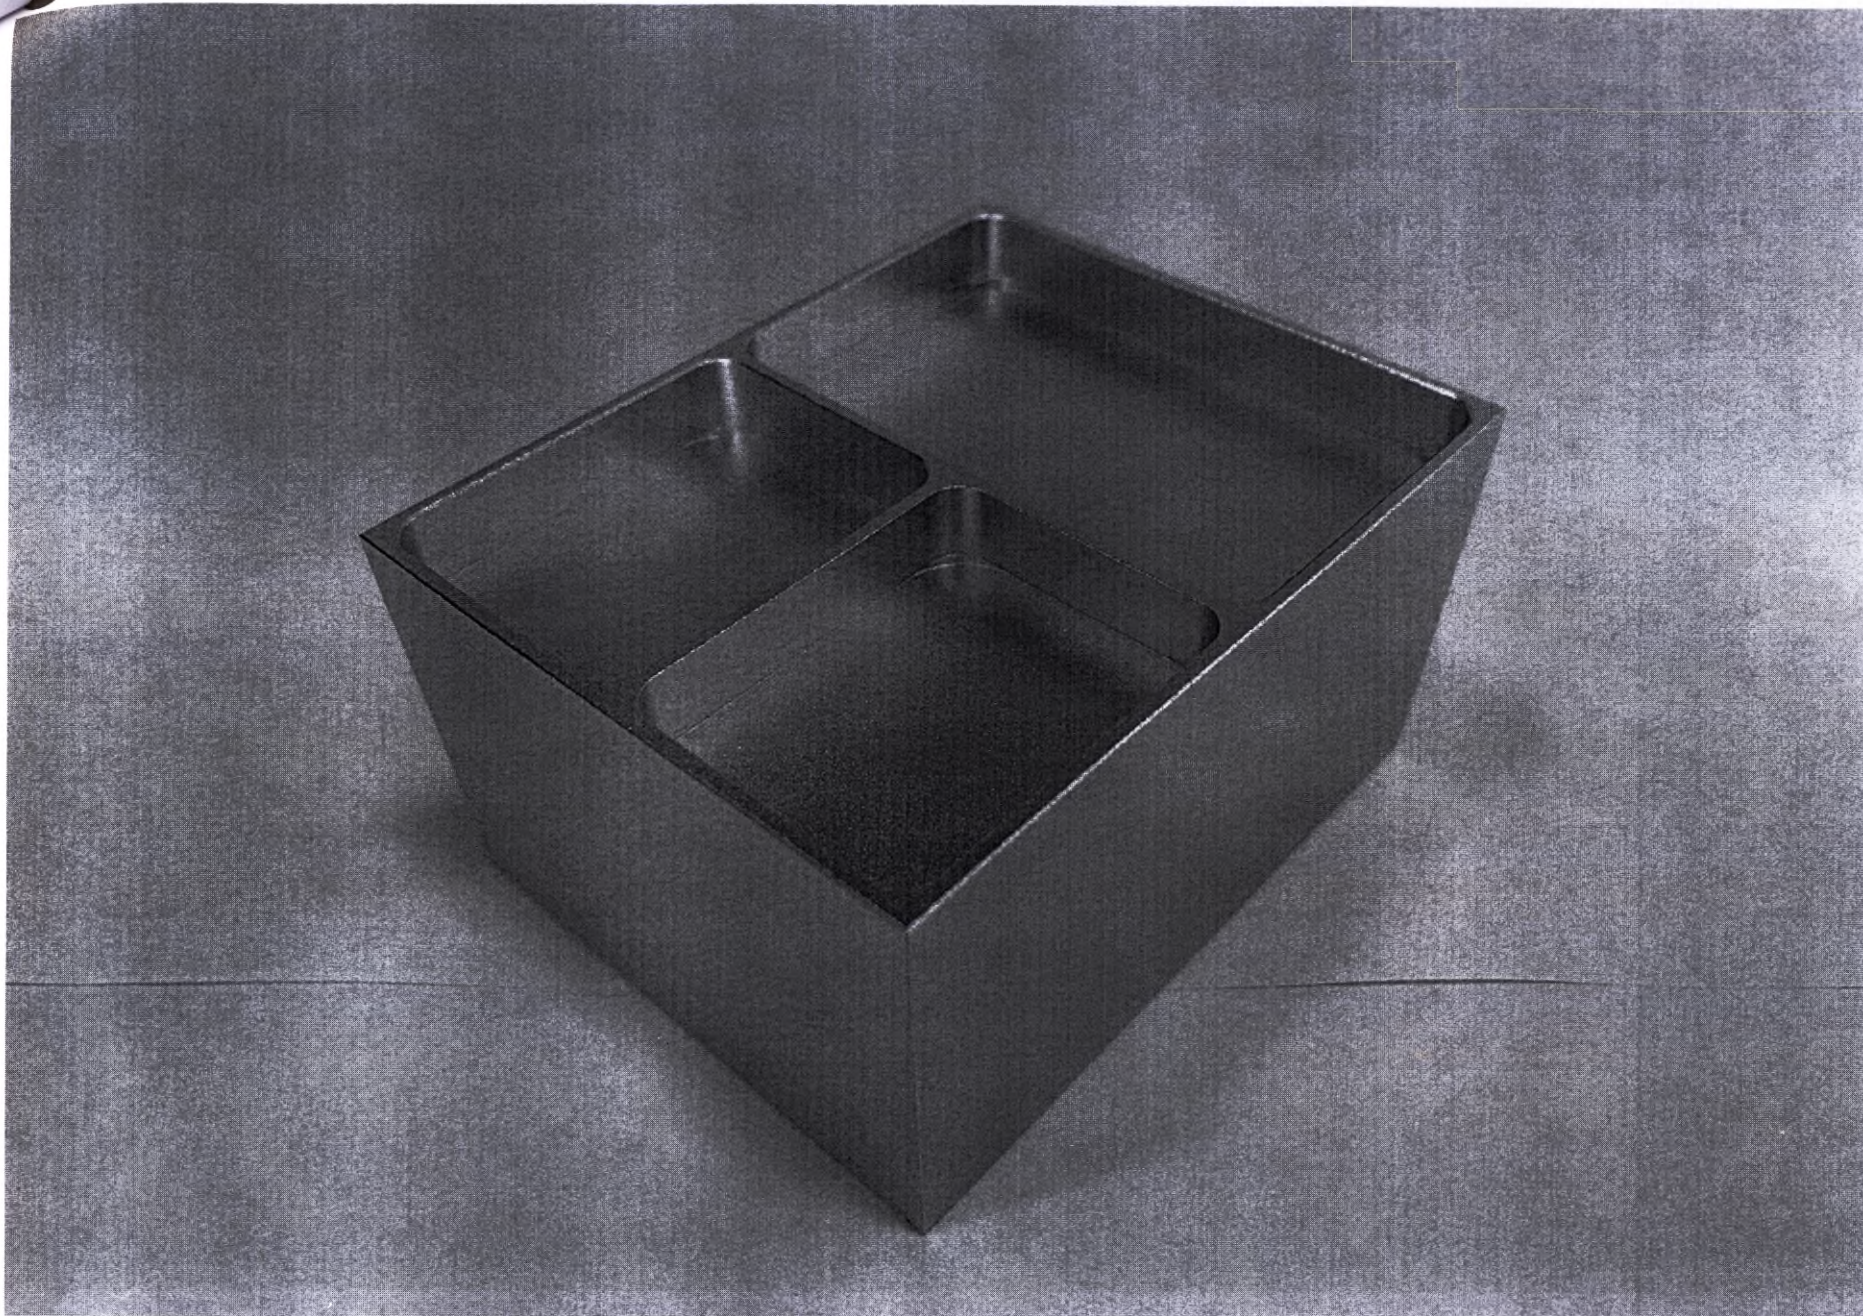

Пресс-блок нагревательный с тремя выемками

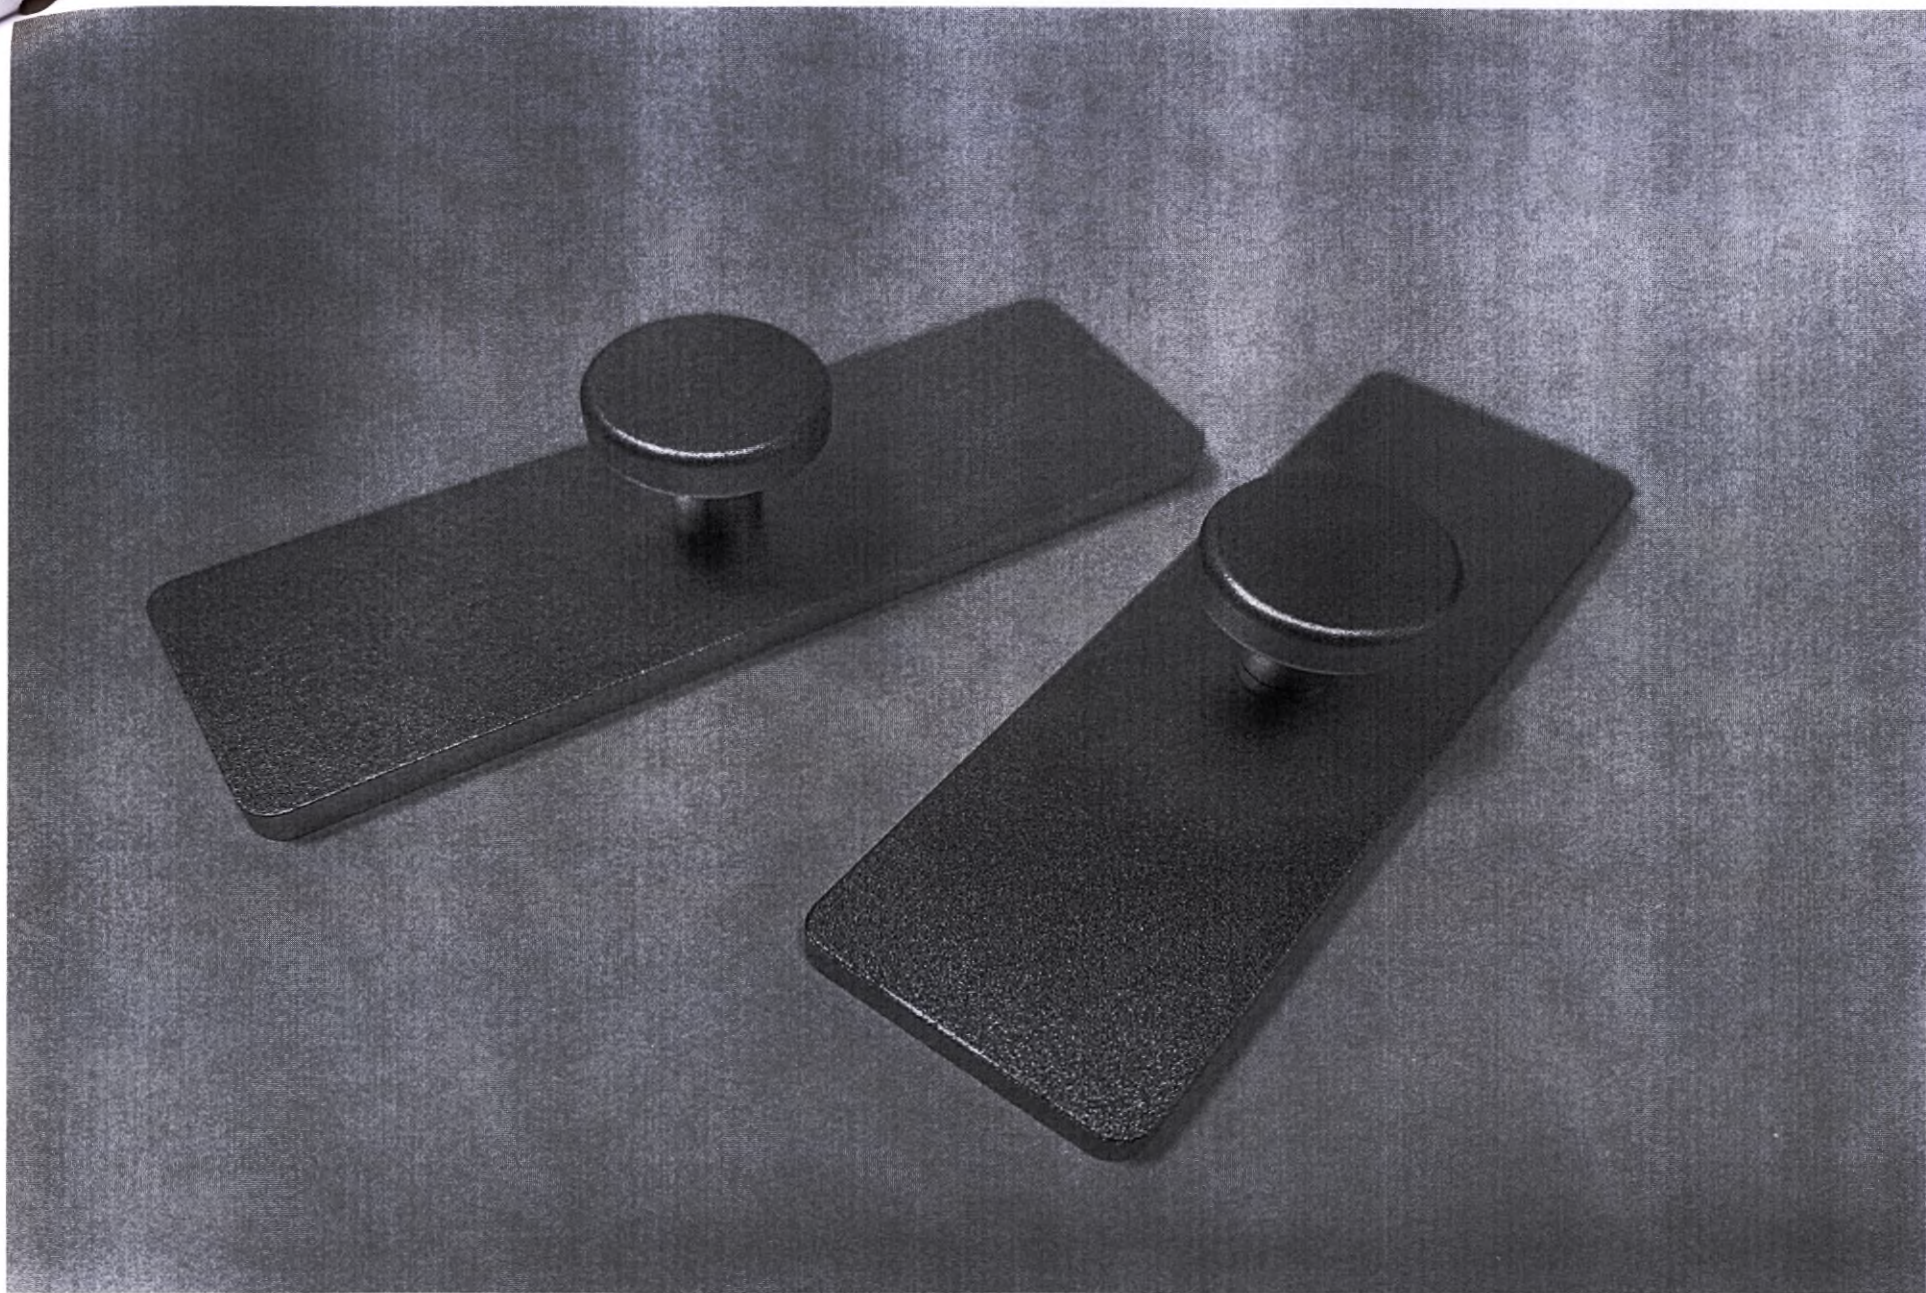

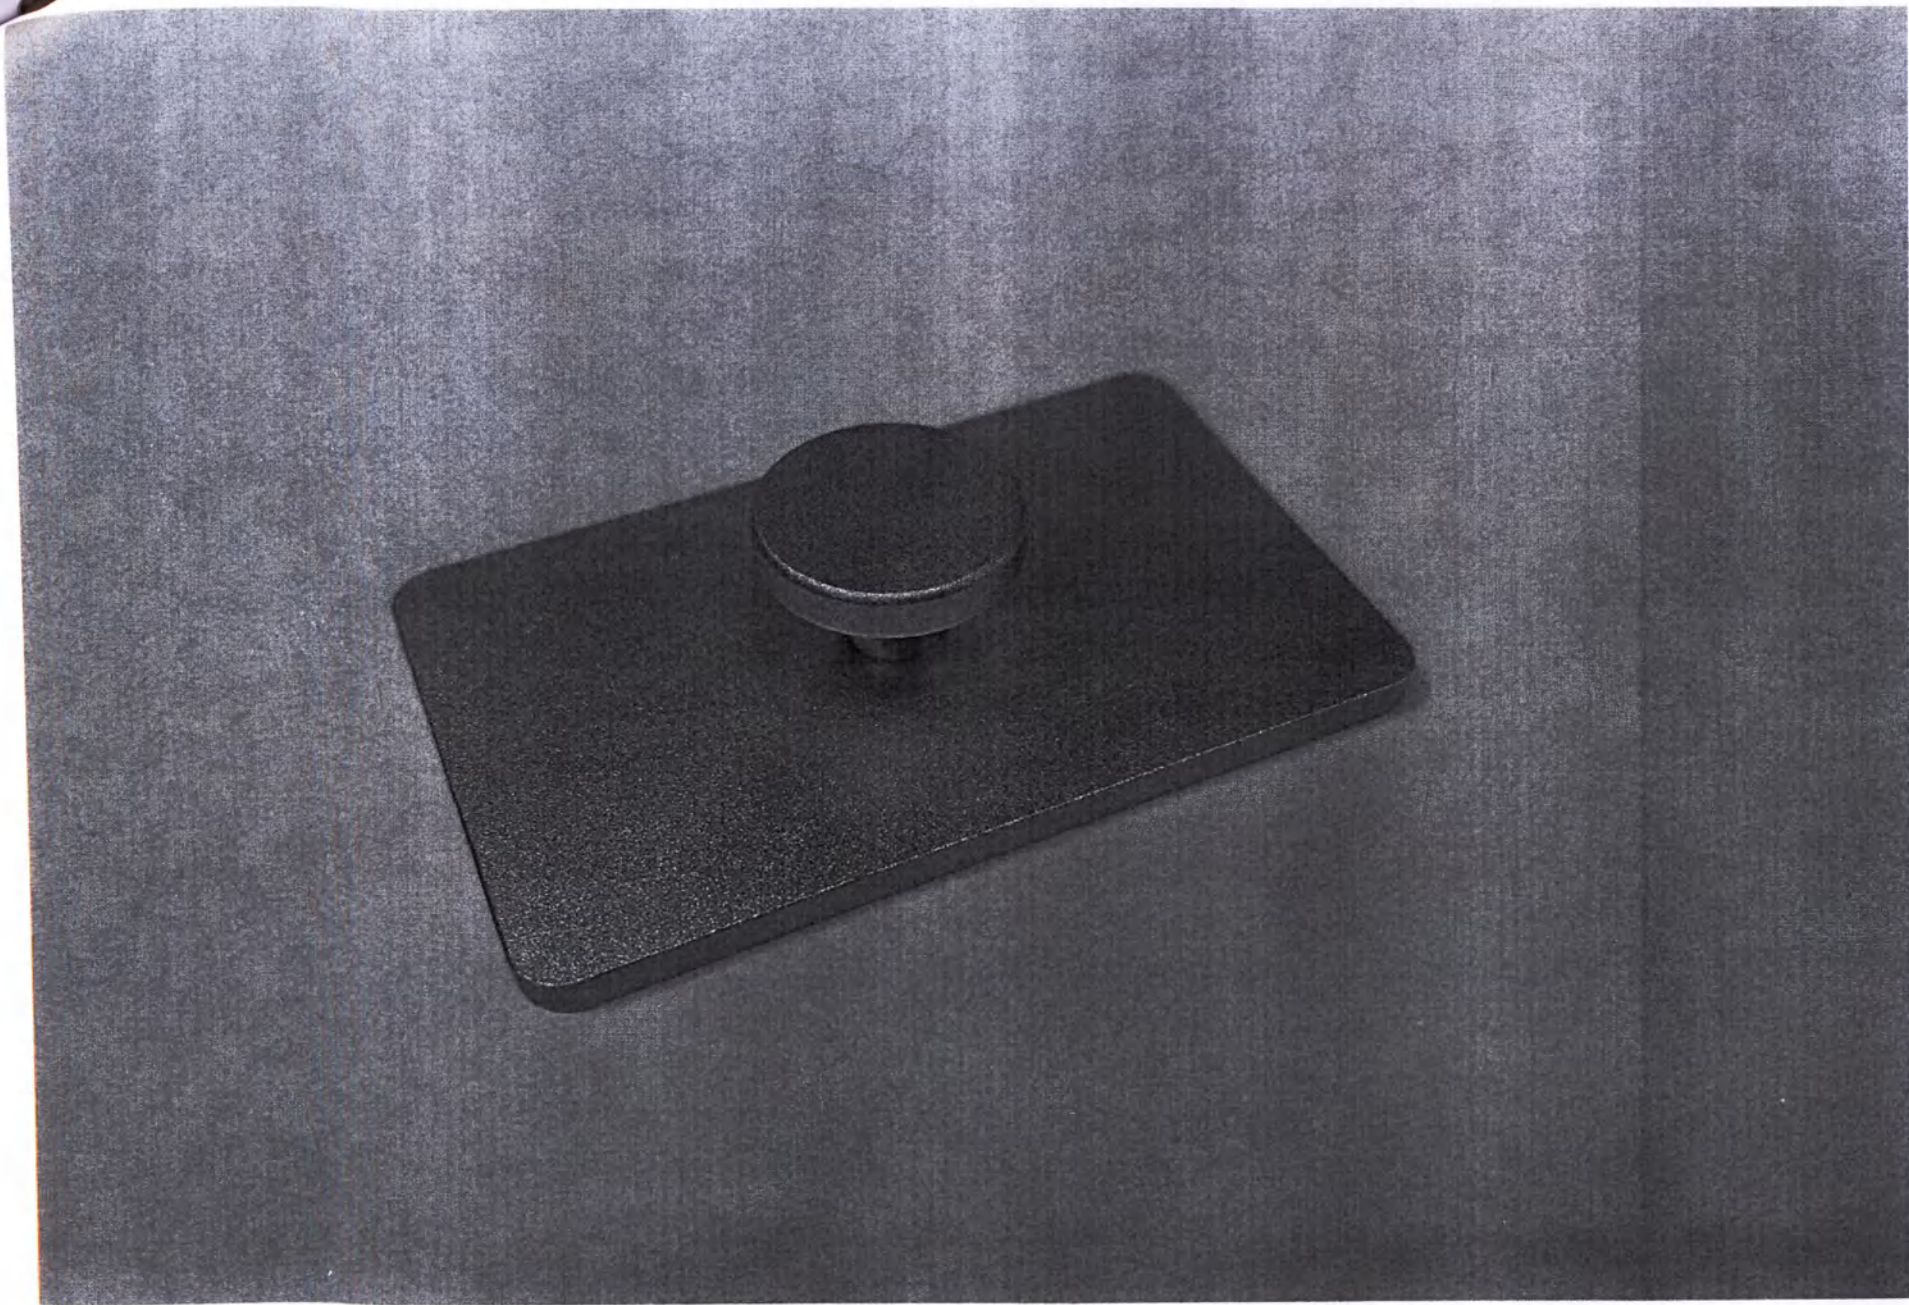



Устройство для вынимания блока

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

Пронумеровано и
прошнуровано 14 лист(ов)а

пронумеровано
и прошнуровано
14 листов

