


Макет этикетки потребительской упаковки

	Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки человека иммунохроматографическим методом (Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device). Lot: 41ADF132AA Эбботт Рэпид Диагностикас Йена ГмбХ (Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH) Орлавер 1, 07743, Йена, Германия Телефон: +49 (0) 3641 3111-0 Интернет: atj.info@abbott.com <u>Место производства:</u> Эбботт Диагностикас Корея Инк. (Abbott Diagnostics Korea Inc.) 65, Борахагал-ро, Гионг-гу, Йонгин-си, Кенги-до, 17099, Республика Корея Представитель производителя в РФ: ООО «Эбботт Лэбораториз» 125171, Москва, Ленинградское шоссе, Д. 16 А. Стр 1 Тел 7 (495) 258-42-80
Для профессионального применения Состав набора: 1. Тест-кассеты (в индивидуальной вакуумной упаковке с осушителем) – 25 шт 2. Буфер - 1 флакон 3. Пробирки экстракционные – 25 шт 4. Колпачки для пробирок экстракционных – 25 шт 5. Положительный контрольный образец – 1 шт 6. Отрицательный контрольный образец – 1 шт 7. Стерильные тампоны (тупферы) для сбора мазков из носоглотки – 25 шт 8. Штатив – 1 шт 9. Краткое руководство – 1 шт 10. Инструкция по применению – 1 шт	
REF LOT	   
РУ	Дата регистрации 
        25  	




COVID-19 Ag
RAPID TEST DEVICE
(NASOPHARYNGEAL)

RoHS REACH VCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Penbio

COVID-19 Ag **RAPID TEST DEVICE**
(NASOPHARYNGEAL)



RoHS REACH VCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100




Panbio

COVID-19

Ag

RAPID TEST DEVICE
(NASOPHARYNGEAL)



4 051892 001183



Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Ortsweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/ipost

LOT

41ADF132A

Sub: A

Diluent: 41ADF135

Mfg: 2020.10.05





2021.10.04
(YYYY.MM.DD)




(01)04051892001183

117)211004

(10)41ADF132A

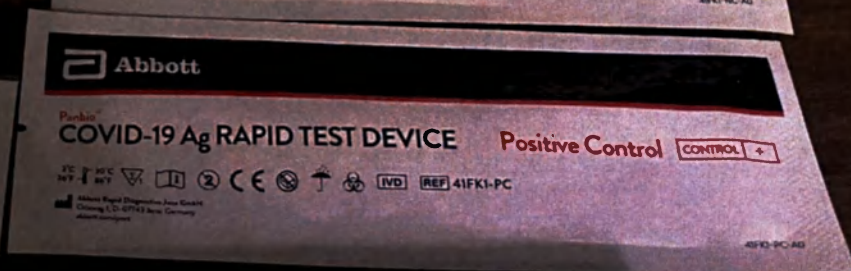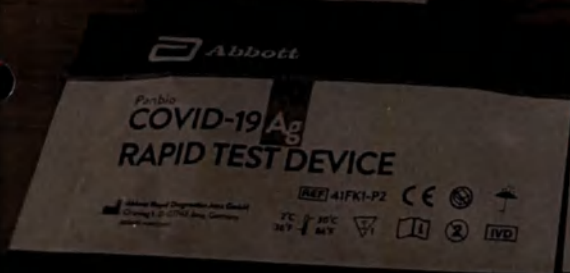



Panbio
COVID-19 Ag
RAPID TEST DEVICE

 Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
Orlenweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/panbio

REF 41FK1-P2



2°C 30°C
36°F 86°F



LOT LOT NO.:

 MFG. DATE:

(YYYY.MM.DD)

 EXP. DATE:


(YYYY.MM.DD)

41ADF132A
2020 10 05
2021 10 04

B114C

41FK1-P2-AG


40





Panbio
COVID-19 Ag
RAPID TEST DEVICE


Abbott Rapid Diagnostics, Inc. GmbH
Ortsweg 1, D-07743 Jena, Germany
abbott.com/poct

REF 41FK1-P2



2°C - 30°C
36°F - 86°F

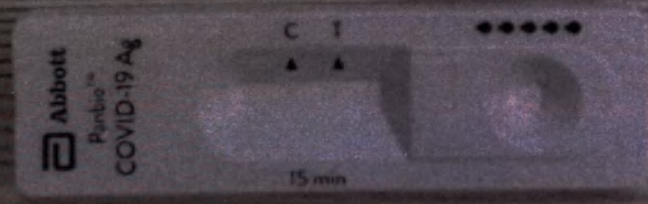



PanBio[®]
COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE


Positive Control

CONTROL +

2°C 36°F 16.7°C 62°F     41FK1-PC

Abbott Rapid Diagnostics Inc. GmbH
Chausweg 1, D-67743 Jena, Germany
abbott.com/ger

41FK1-PC-AQ



Panbio

COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE

Negative Control

CONTROL

2°C to 35°C
35°F to 95°F



Abbott Rapid Diagnostic Test GmbH
Charing, 5, D-85748 Jena, Germany
abbott-rapid-test


41FK1 NC AD






EXTRACTION TUBES

QUANTITY : 25 PCS
CAT. NO. : P78-010/009
LOT NO. : N2006001



Noble Biosciences, Inc.
13-50, Sinbaek-gil, Jeongnam-myeon,
Hwasong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
18521



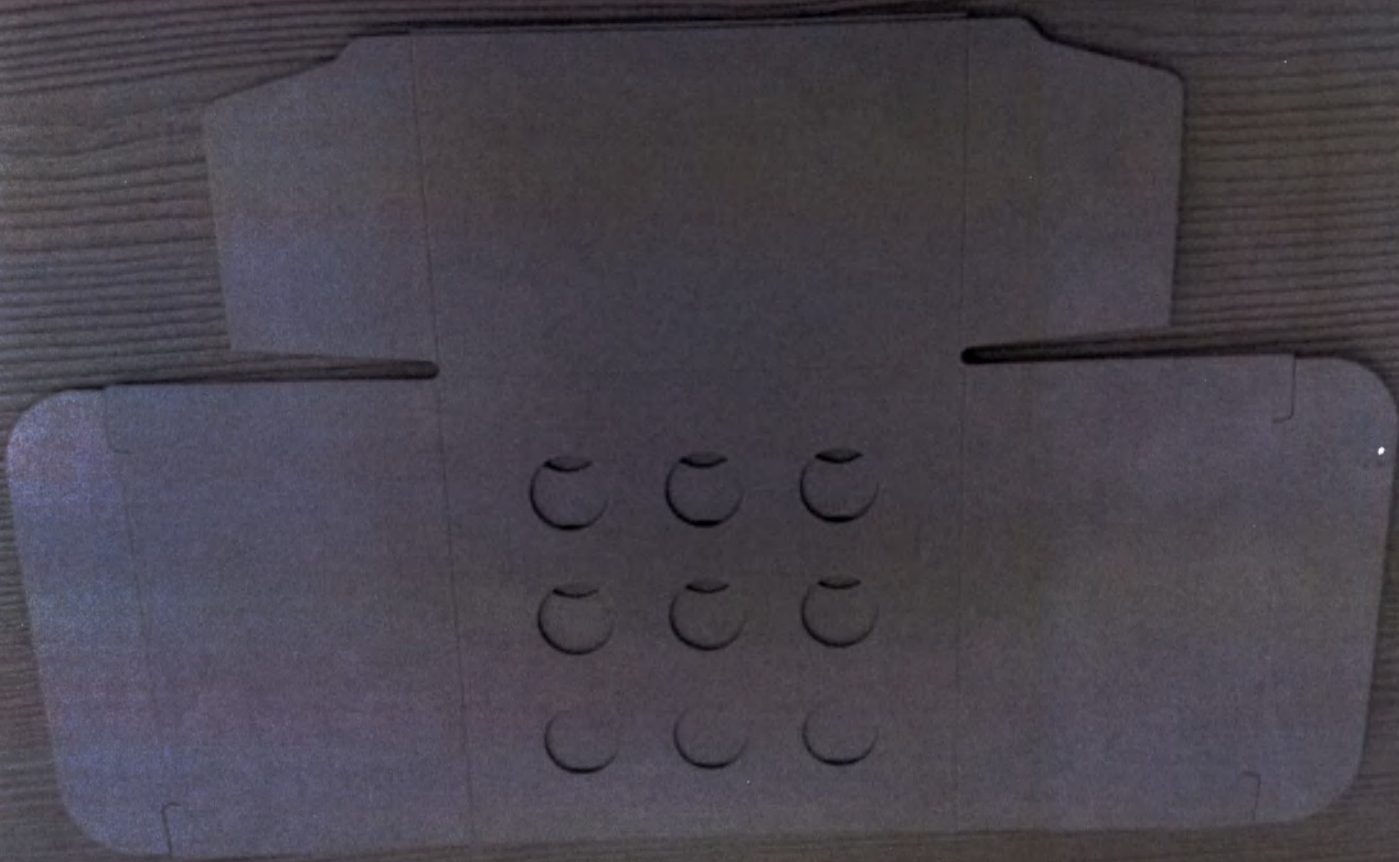

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 12 листов

Менеджер регуляторного отдела Подразделения экспресс-диагностики
инфекционных заболеваний ООО «Эбботт Лэбораториз»
в России, странах СНГ и Восточной Европы


А.А. Хайруллина

