


**Установка рентгенодиагностическая телеуправляемая цифровая ОМЕГА
по ТУ 9442-001-91526802-2011 Исполнение 1**



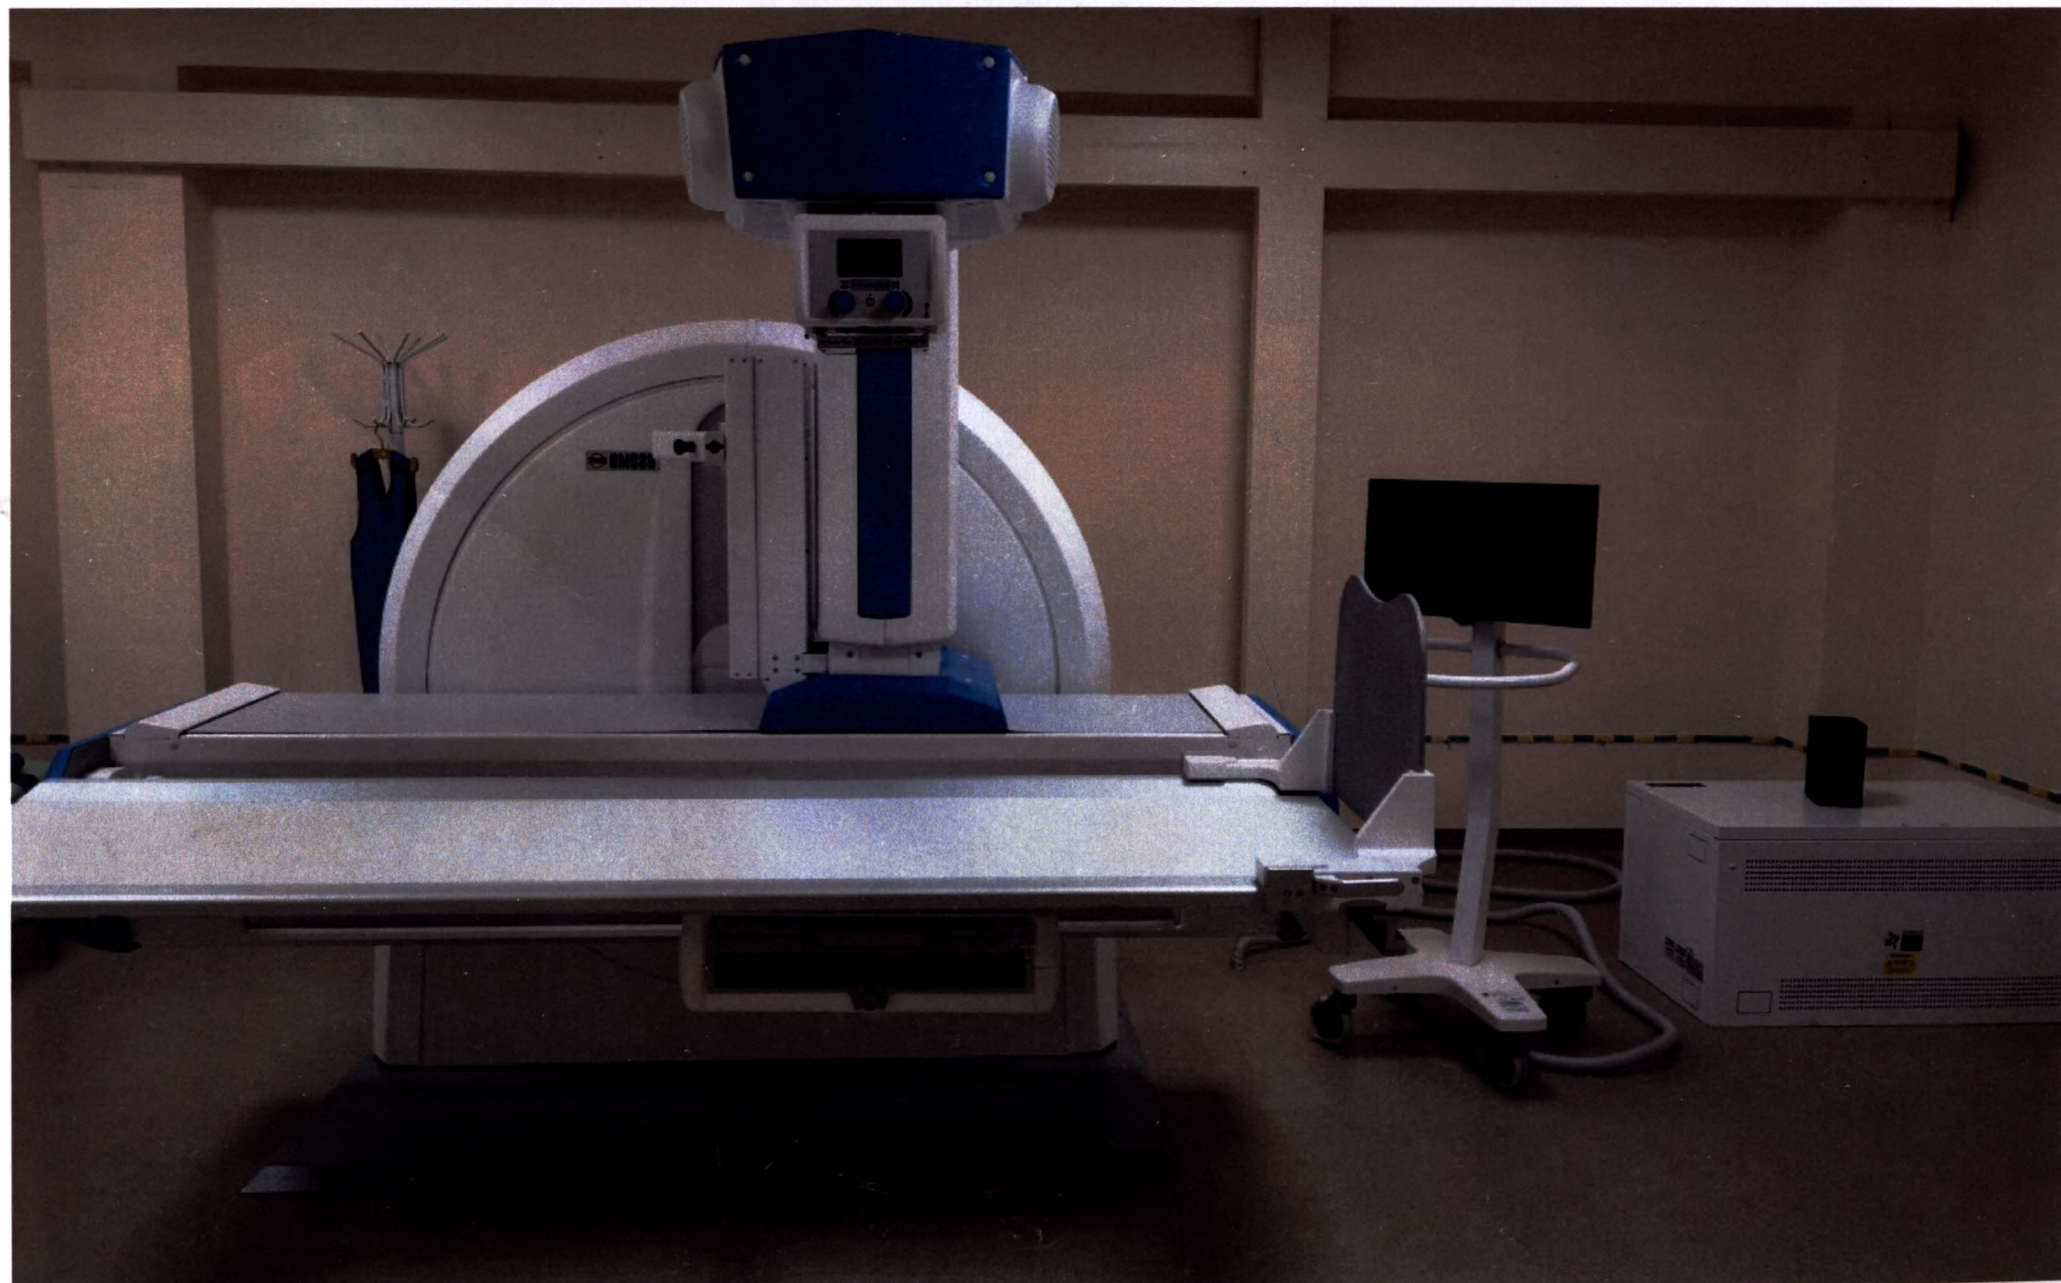

**SECOND SET OF LABELS
IN-OPERATOR**

For product images and brief responses to life challenges, a representative sample of students completed approximately 1000 questions. Questions included:

THE

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198


2199

2200

2201</



SIEMENS




1

Germany is Germany



**1.1. Стол-штатив телеуправляемый CLINODIGIT OMEGA - 1 шт.,
производства фирмы Italtay S.r.l., Италия.**

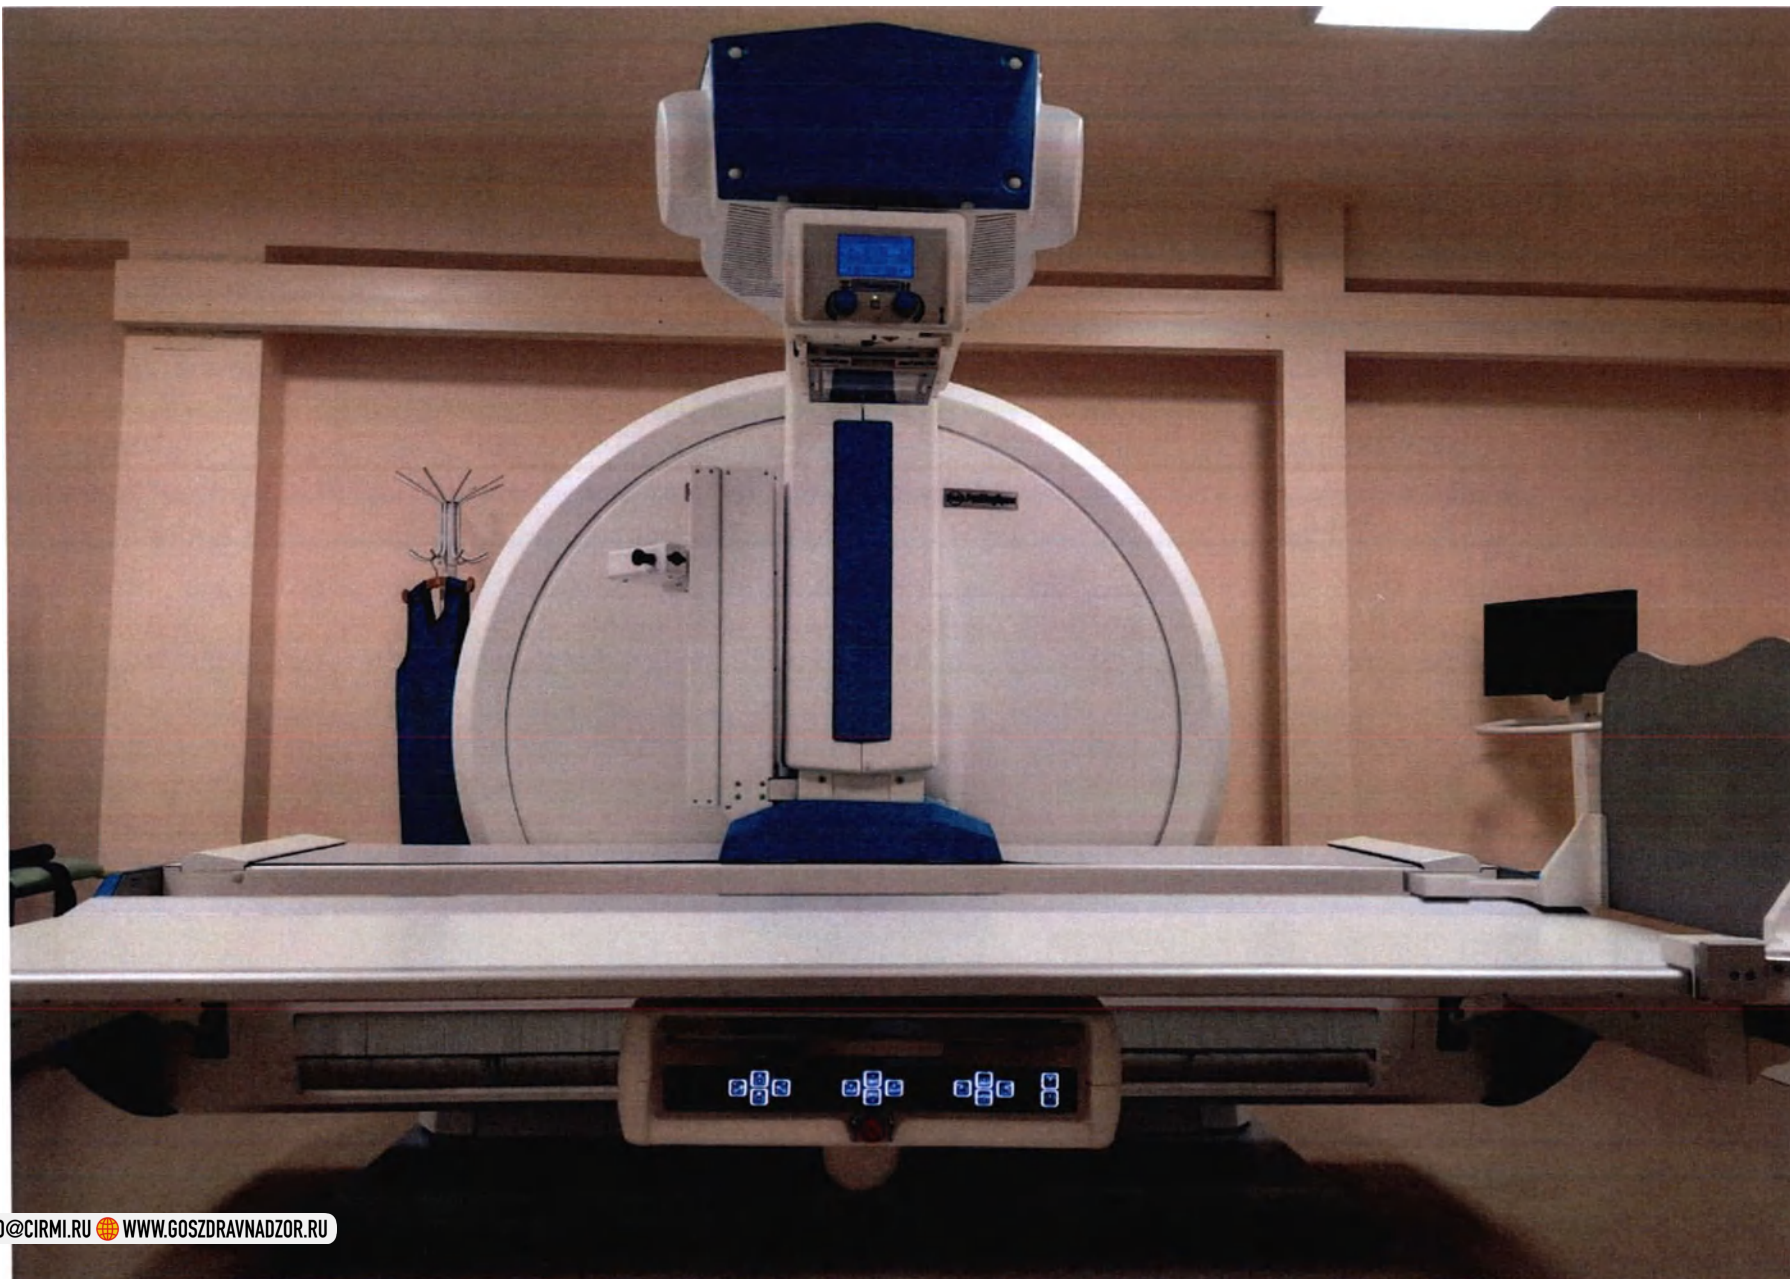





ITALRAY s.r.l. Via del P. Europeo 9D - 50010
SCANDICCI (Firenze) ITALY
tel. +39 055 7228511 fax. +39 055 7228512
e-mail: info@italray.it web: www.italray.it



DEVICE
NAME

Clinodigit OMEGA

REF

MTECOM00

SN

M20-185-119541512

POWER
SUPPLY

380/400 V / 3~ /5 A/ 50/60 Hz

Made in ITALY

2020



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ ШТАТИВ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ

ИЗДЕЛИЕ № РМП 01-074-20

⚠ ⚡ Ⓢ 3~ 380 В +/- 10% 50Гц 130 кВА

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска 08.2020

1.1.1. Дистанционный пульт управления стола штатива телеуправляемого CLINODIGIT OMEGA – 1 шт., производства фирмы Italray S.r.l., Италия.



1.1.2. Педаль для включения/выключения рентгеновского излучения стола штатива телеуправляемого CLINODIGIT OMEGA, не более 2 шт., производства фирмы Italray S.r.l., Италия.





Your X-ray Solution

ITALRAY s.r.l. Via del P. Europeo 9D - 50010
SCANDICCI (Firenze) ITALY
tel. +39 055 7228511 fax. +39 055 7228512
e-mail: info@italray.it web: www.italray.it

**DEVICE
NAME**

On and off pedal XRAY

SN

M20-186-119542336

~ 220Vac $\pm$ 10% 50Hz IPX2

2020



1.1.3. Электронный коллиматор OPTICA 40-CF002 - 1 шт., производства фирмы Varex Imaging, Нидерланды.



000 РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОЛЛИМАТОР

ИЗДЕЛИЕ 01-074-20
№ РМП

24 В / 80 VA

постоянная фильтрация 1,2 мм Al / 75 кВ

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска 08.2020



VAREX
IMAGING



Fabriekstraat 41
7806 AP Doetinchem
The Netherlands
www.vareximaging.com



CE 1639

SGS
710383

FCC R_X Only

Model: Optica 40-CF002

Medical Device

REF 50126-21-OEM

SN WOE019229/1-1



2020-07

Made in: the Netherlands

24V / 80VA

Min. inherent filtration

Al equiv.: 1.2mm Al/75kV


X-ray rating up to: 150kVp


IP20



(01)08718755000436(11)2007(21)WOE019229/1-1


This product complies with the requirements of 21 CFR Subchapter J for radiation emitting products as of the date of manufacture.
This product complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No.88, dated July 28, 2001.

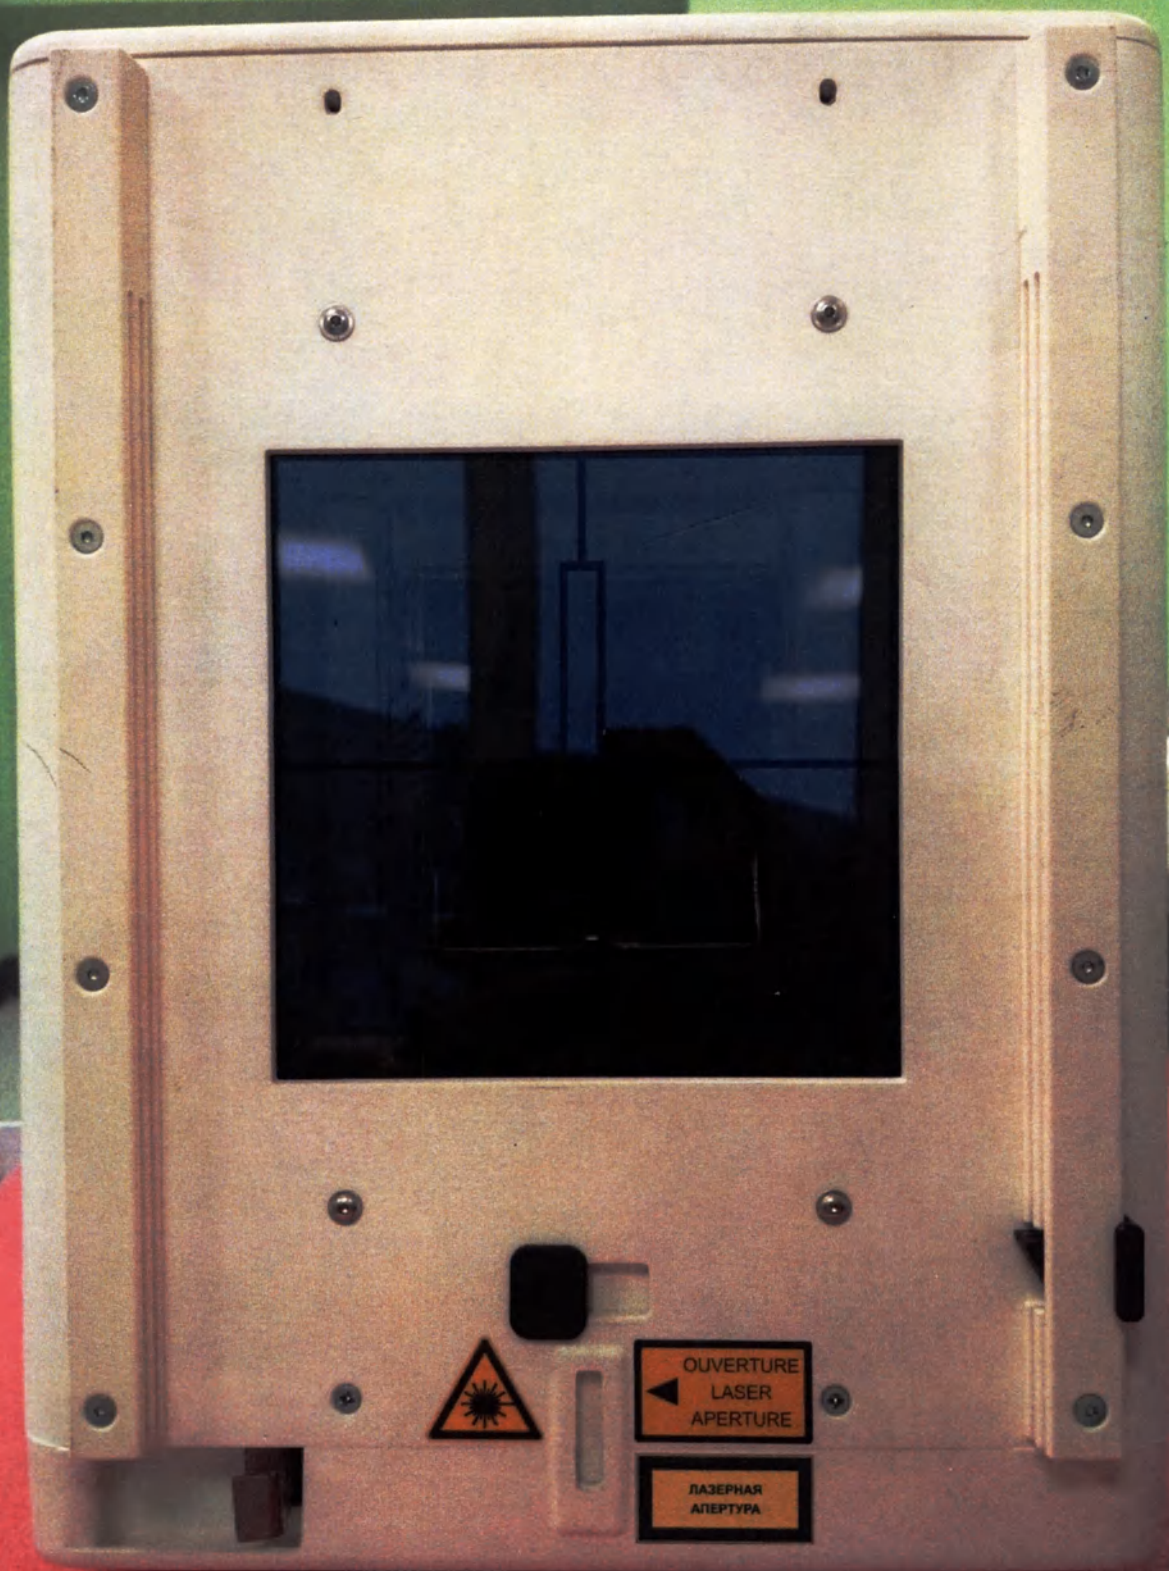

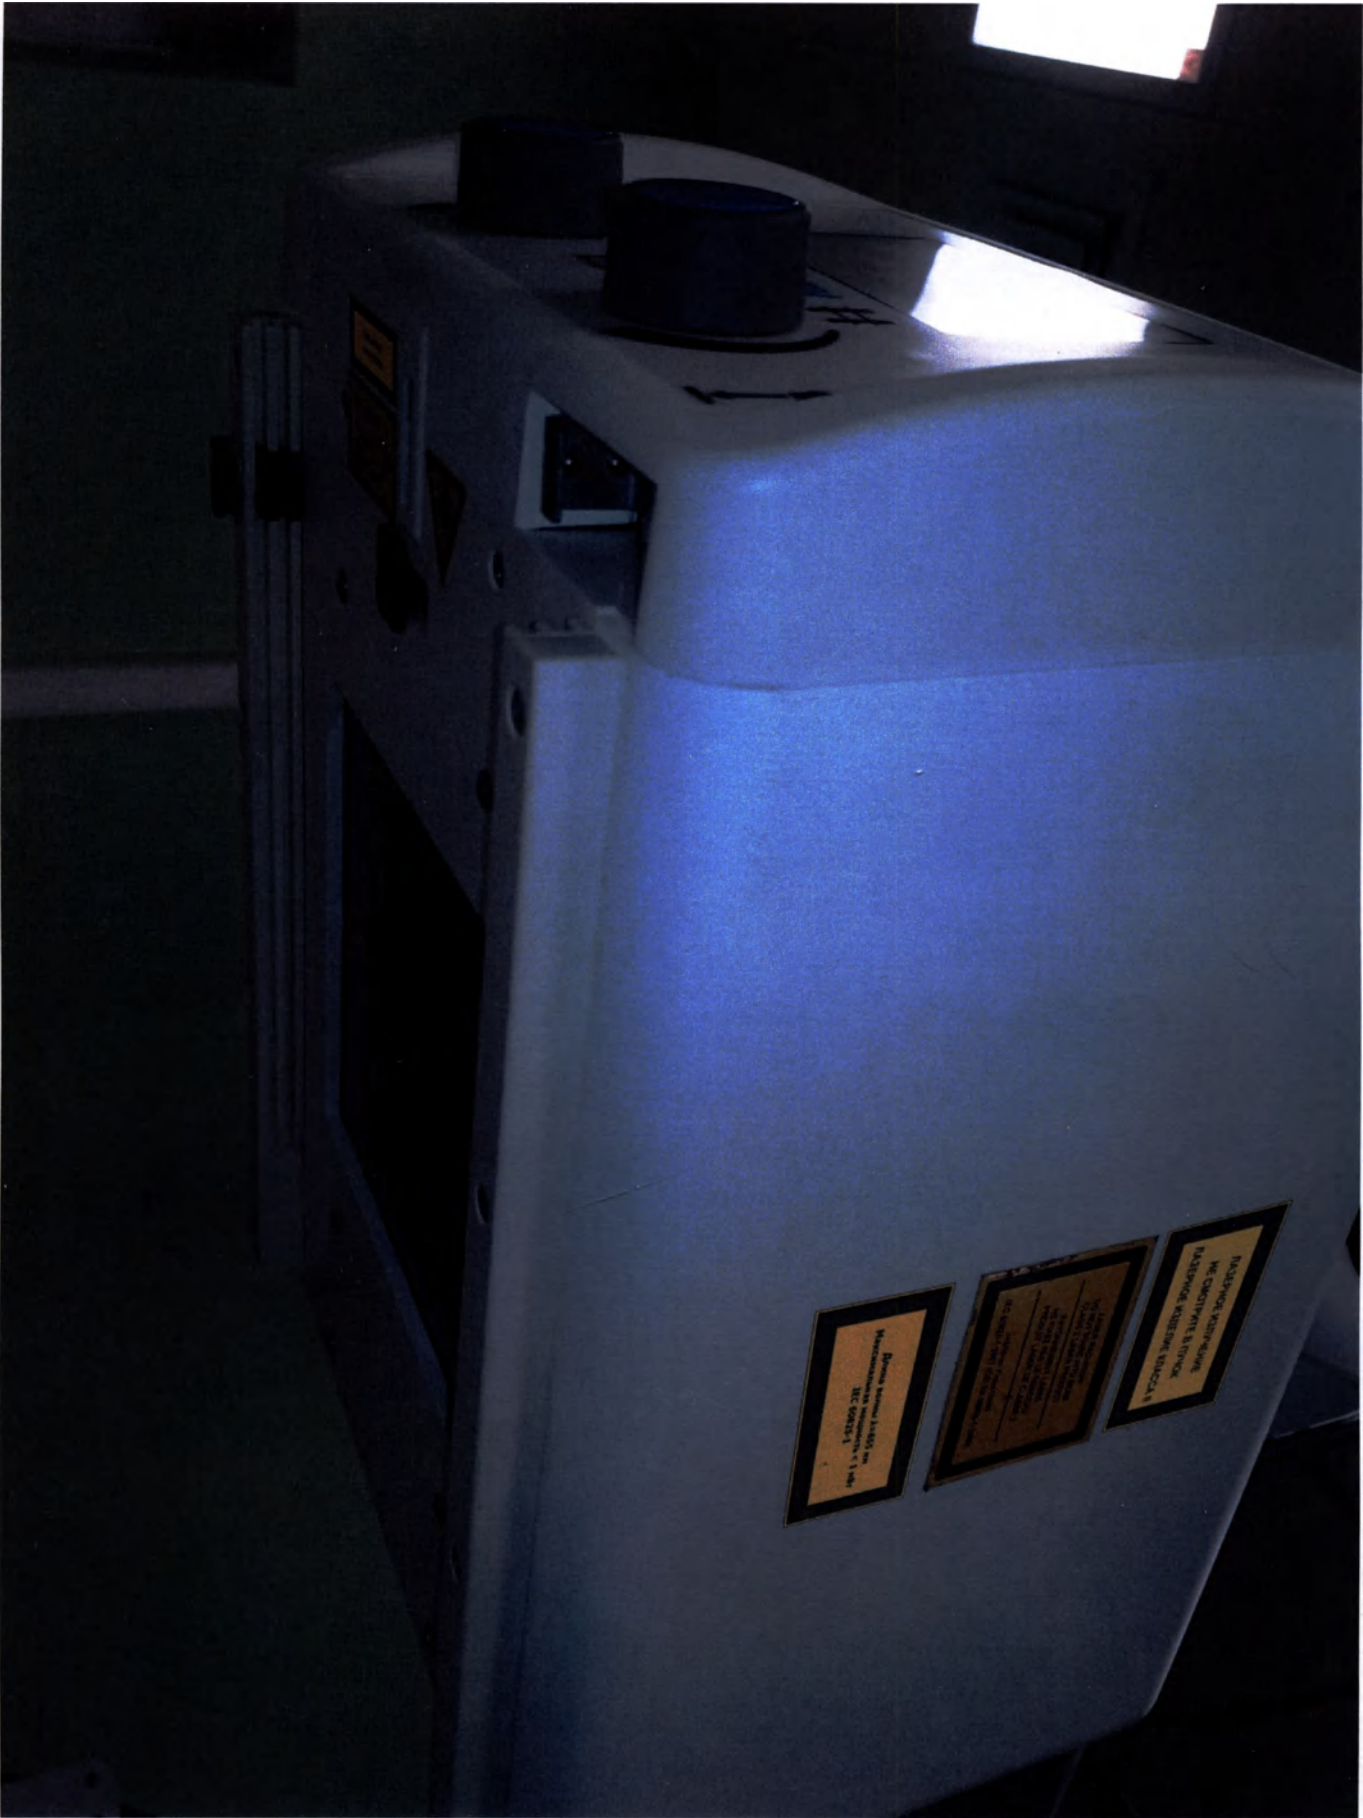



1.1.4. Отсеивающий рентгеновский растр JPI – 1 шт., производства фирмы JPI Healthcare Co. Ltd., Республика Корея.

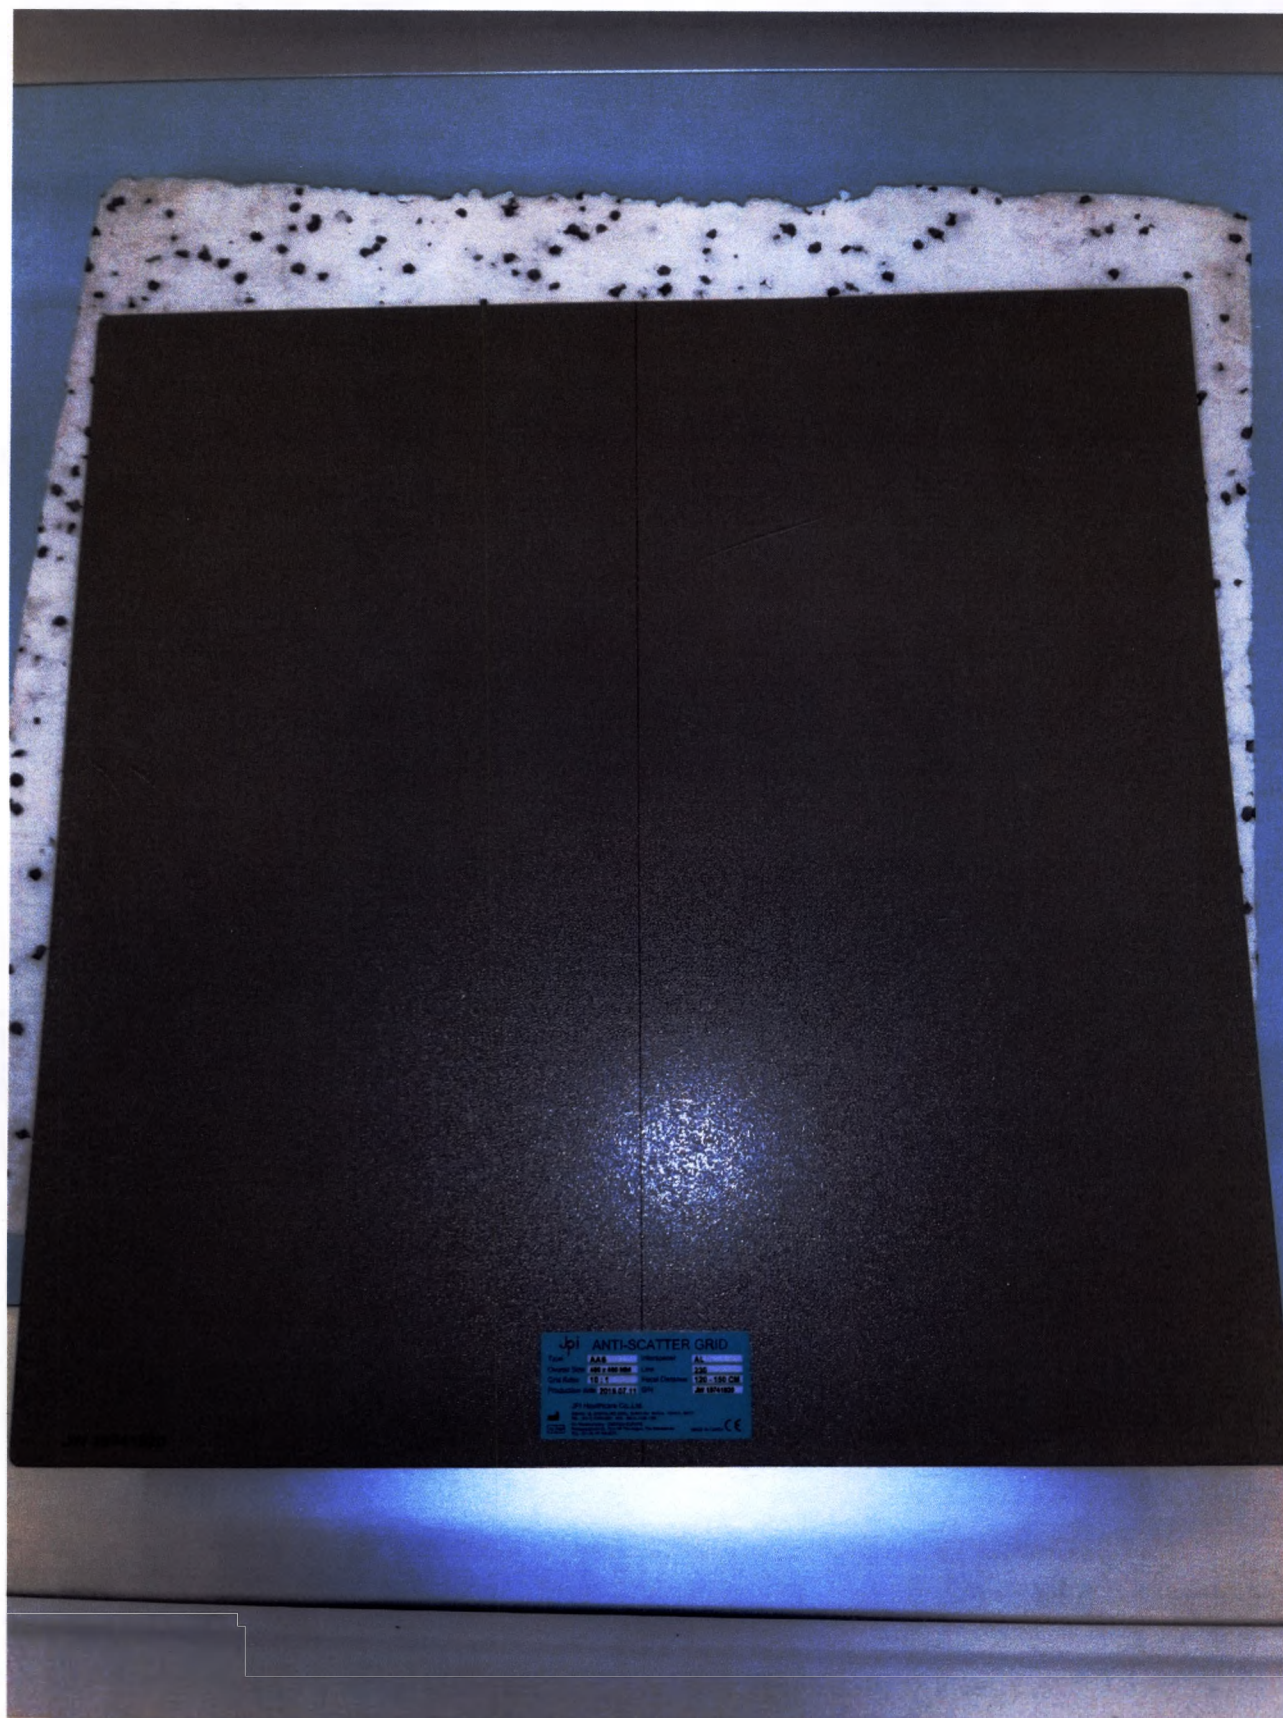




ANTI-SCATTER GRID

Type	AAS	Interspacer	AL
Overall Size	460 x 460 MM	Line	230
Grid Ratio	10 : 1	Focal Distance	120 - 150 CM
Production date	2019.07.11	S/N	JW 19741920

JPI Healthcare Co.,Ltd.




608-HO, 28, DIGITAL-RO 33GIL, GURO-GU, SEOUL, KOREA, 08377
TEL (82-2) 2108-2580 FAX (82-2) 2108-1180



EU Representative EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands
TEL. (31) (0) 70 345 8570

MADE IN KOREA 

1.1.5. Высоковольтный кабель с наконечниками Cable Assy 16 метров - 2 шт., производства фирмы Varex Imaging Нидерланды или производства фирмы Varex maging Филиппины.

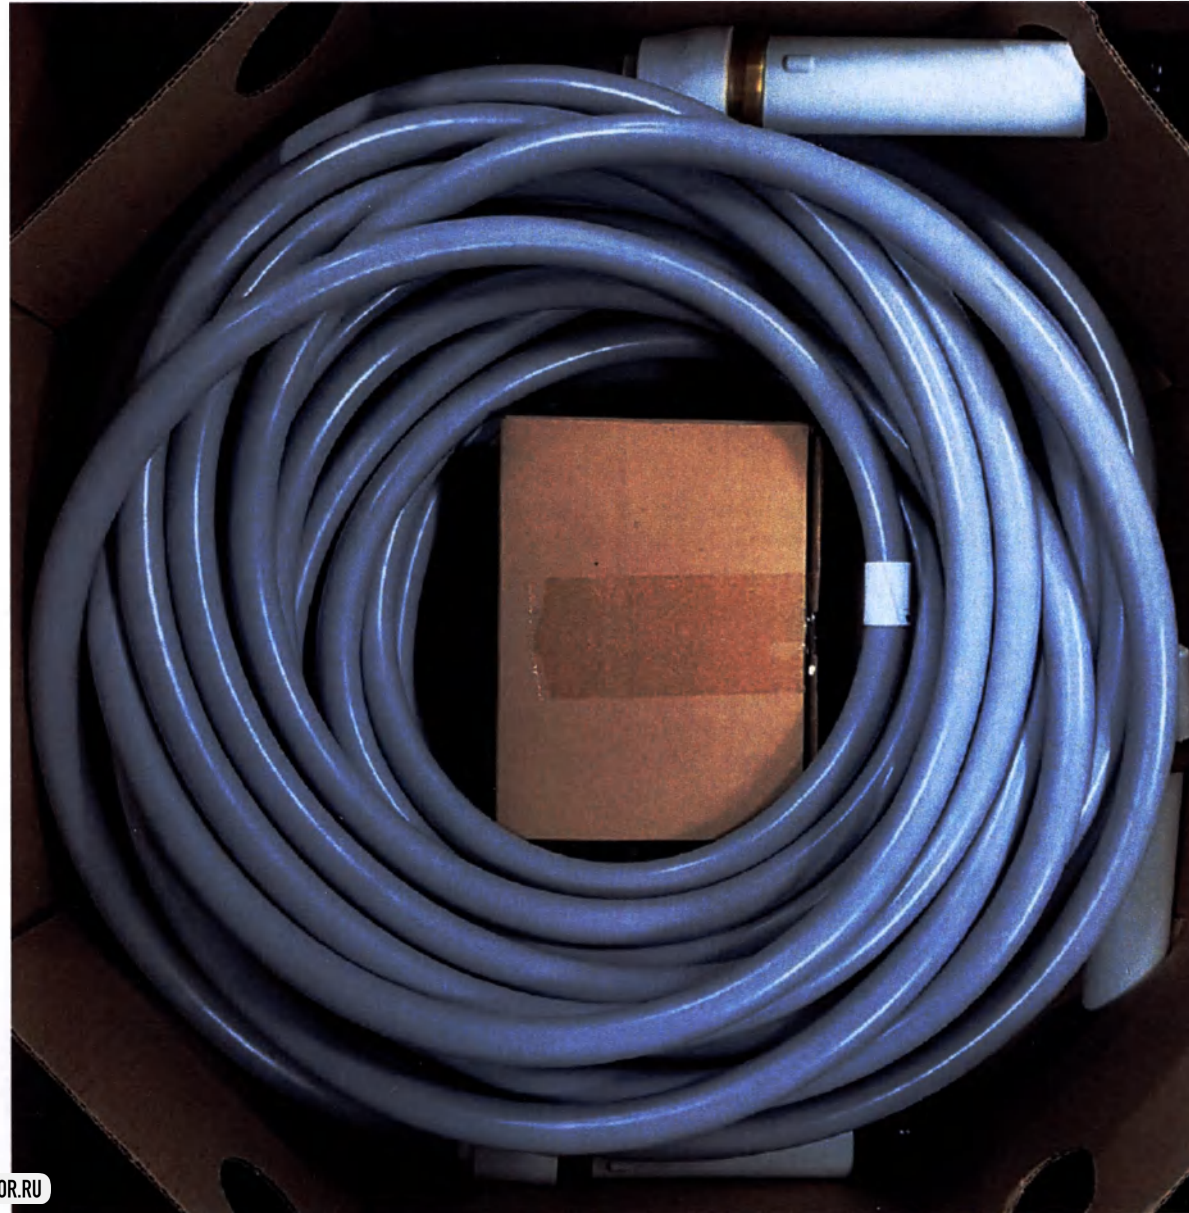

VAREX
IMAGING

www.vareximaging.com

CABLE ASSY, L3, CAL, CAL, L3
10457

W04017490/1-7

Philippines
75kVDC

1.2.1. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное высоковольтное ZEN HF – 1 шт., производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария, в составе:

1.2.1.1. Шкаф электроники с высоковольтным трансформатором.



ООО РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3 Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ
ПИТАЮЩЕЕ

ИЗДЕЛИЕ № РМП **01-075-20**

380 В +/- 10% 50Гц 130 кВА

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**



Vasil Levski 86 Str., district Vrabnitsa,
Sofia-1261, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19

MEDRAY
Digital Radiology

XRAY GENERATOR GEN HF

REF

MTEGNF03

SN

M20-186-119542336



380Vac 50Hz




2020



1.2.1.2. Дистанционный пульт управления – 1 шт, производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария.




1.2.1.3. Ионизационная камера автоматического контроля экспозиции KRL - 1шт., производства фирмы Siemens Healthcare GmbH, Германия.

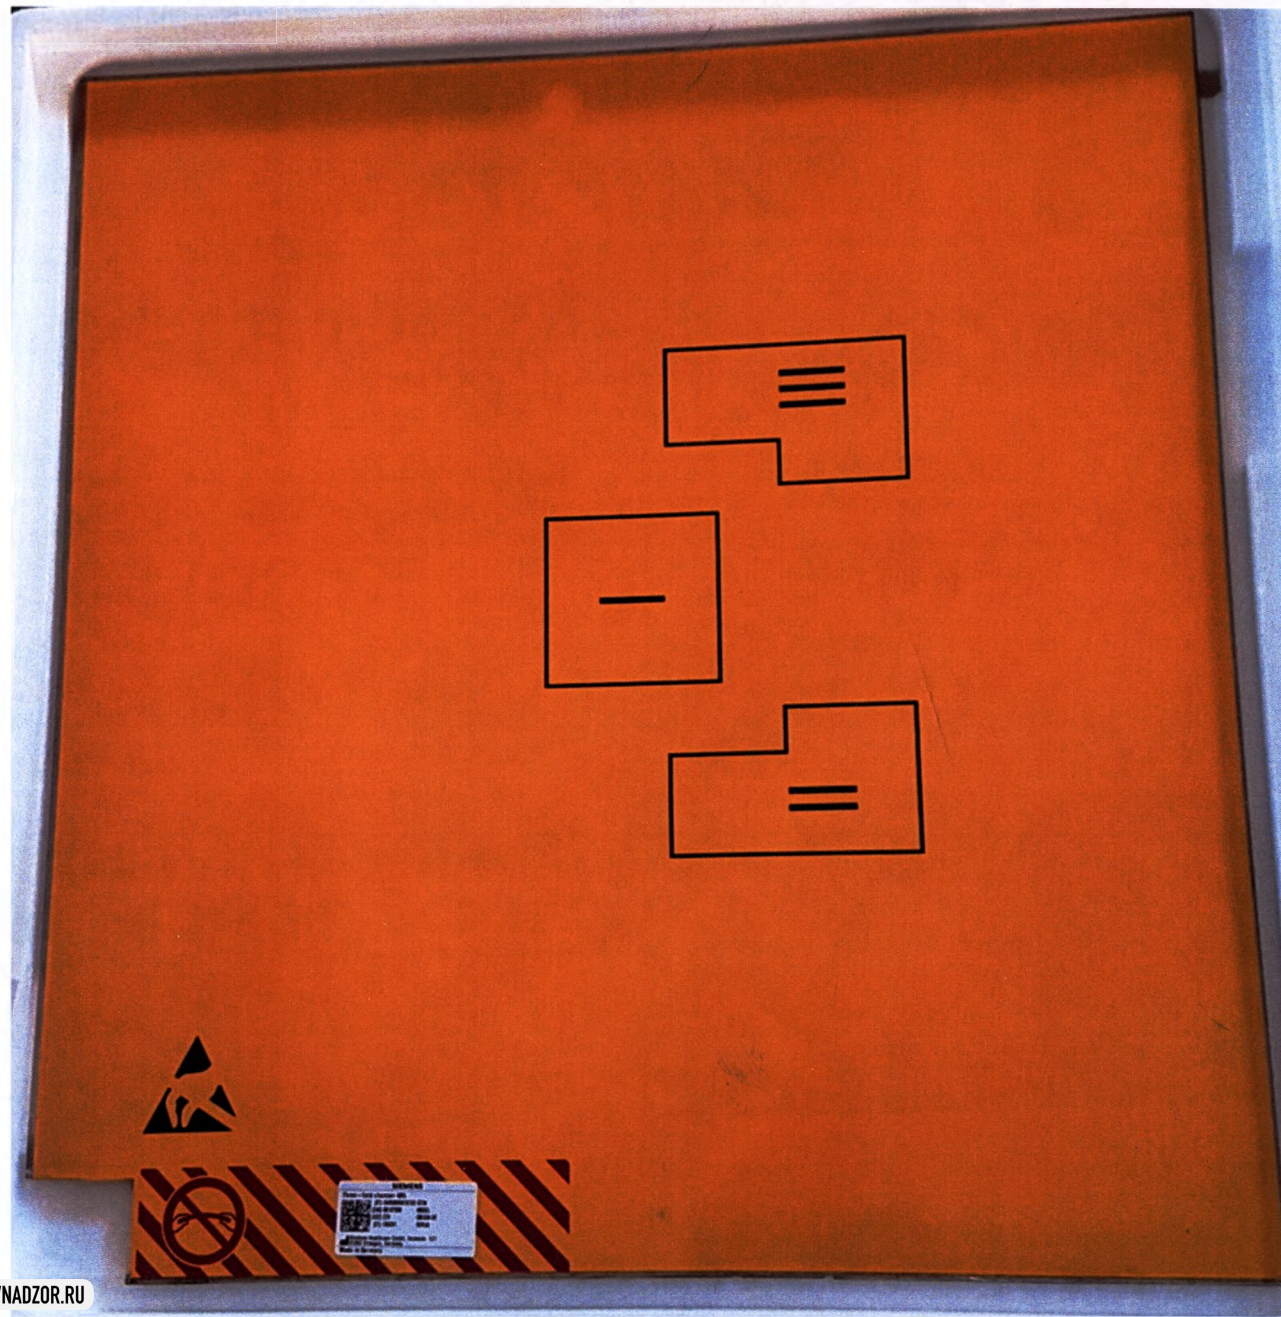

SIEMENS

Three – field chamber KRL

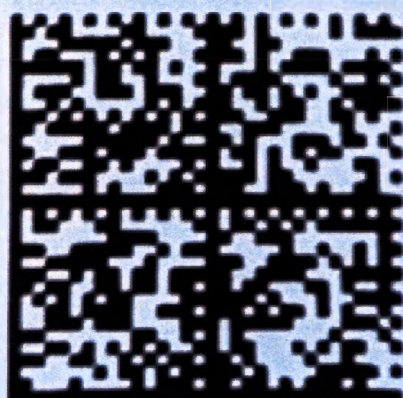

(01) 04056869018102 GTIN

(240) 08167538

MODEL

(422) 276

ORIGIN DE

(21) 105291

SERIAL



Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany

1.2.2. Устройство рентгеновское питающее высокочастотное высоковольтное Polydoros RF 80 - 1 шт., производства фирмы Siemens Healthcare GmbH, Германия, в составе:

1.2.2.1. Шкаф электроники с высоковольтным трансформатором - 1шт, производства фирмы Siemens Healthcare GmbH, Германия.





127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

ИСПОЛНЕНИЕ 1

ИЗДЕЛИЕ 01-074-20
№ РМП

380 В +/- 10% 50Гц 130 кВА

ТУ 9442-001-91526502-2011

Дата выпуска 08.2020



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

УСТРОЙСТВО РЕНТГЕНОВСКОЕ
ПИТАЮЩЕЕ

ИЗДЕЛИЕ 01-074-20
№ РМП

380 В +/- 10% 50Гц 130 кВА

ТУ 9442-001-91526502-2011

Дата выпуска 08.2020



E347424

SECOND SET OF LABELS
HV-GENERATOR

This product complies with DHHS regulations
21 CFR Subchapter J, applicable at date of
manufacture.

Manufactured: FEBRUARY 2019
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127, 91052 Erlangen
Germany

SIEMENS

ME LC80



(01) 04050000012957 GTIN
(240) 10000040 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 7714 SERIAL

IVK


Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Made in Germany

SIEMENS

Polydoras RF 80



(01) 0405000002712 GTIN
(240) 10307350 MODEL
(422) 276 ORIGIN DE
(21) 4159 SERIAL




IVK


Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany

Made in Germany

**1.2.2.2. Дистанционный пульт управления - 1 шт,
производства фирмы Siemens Healthcare GmbH,
Германия.**

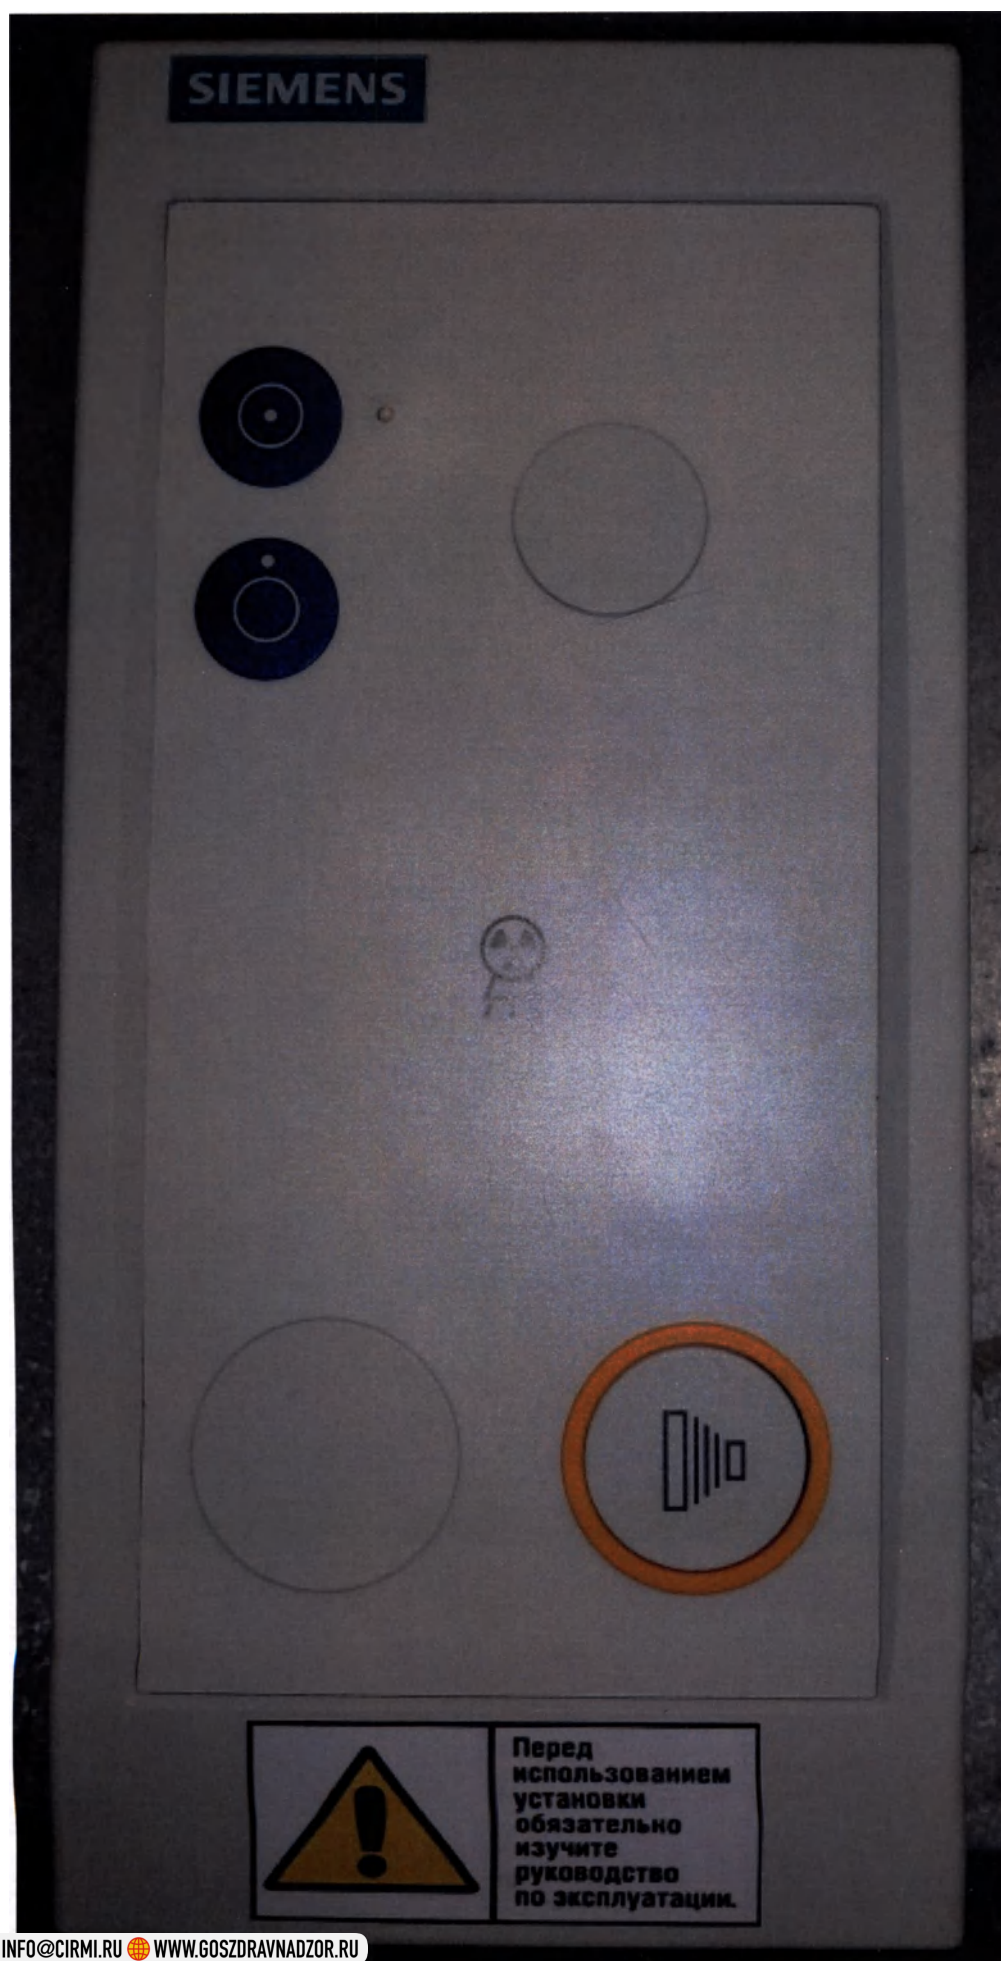

1.3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения:
1.3.1. Рентгеновский излучатель C52 Super с рентгеновской трубкой RTC600HS или RTC700HS или RTC1000HS - 1 шт., производства фирмы I.A.E. SpA, Италия.

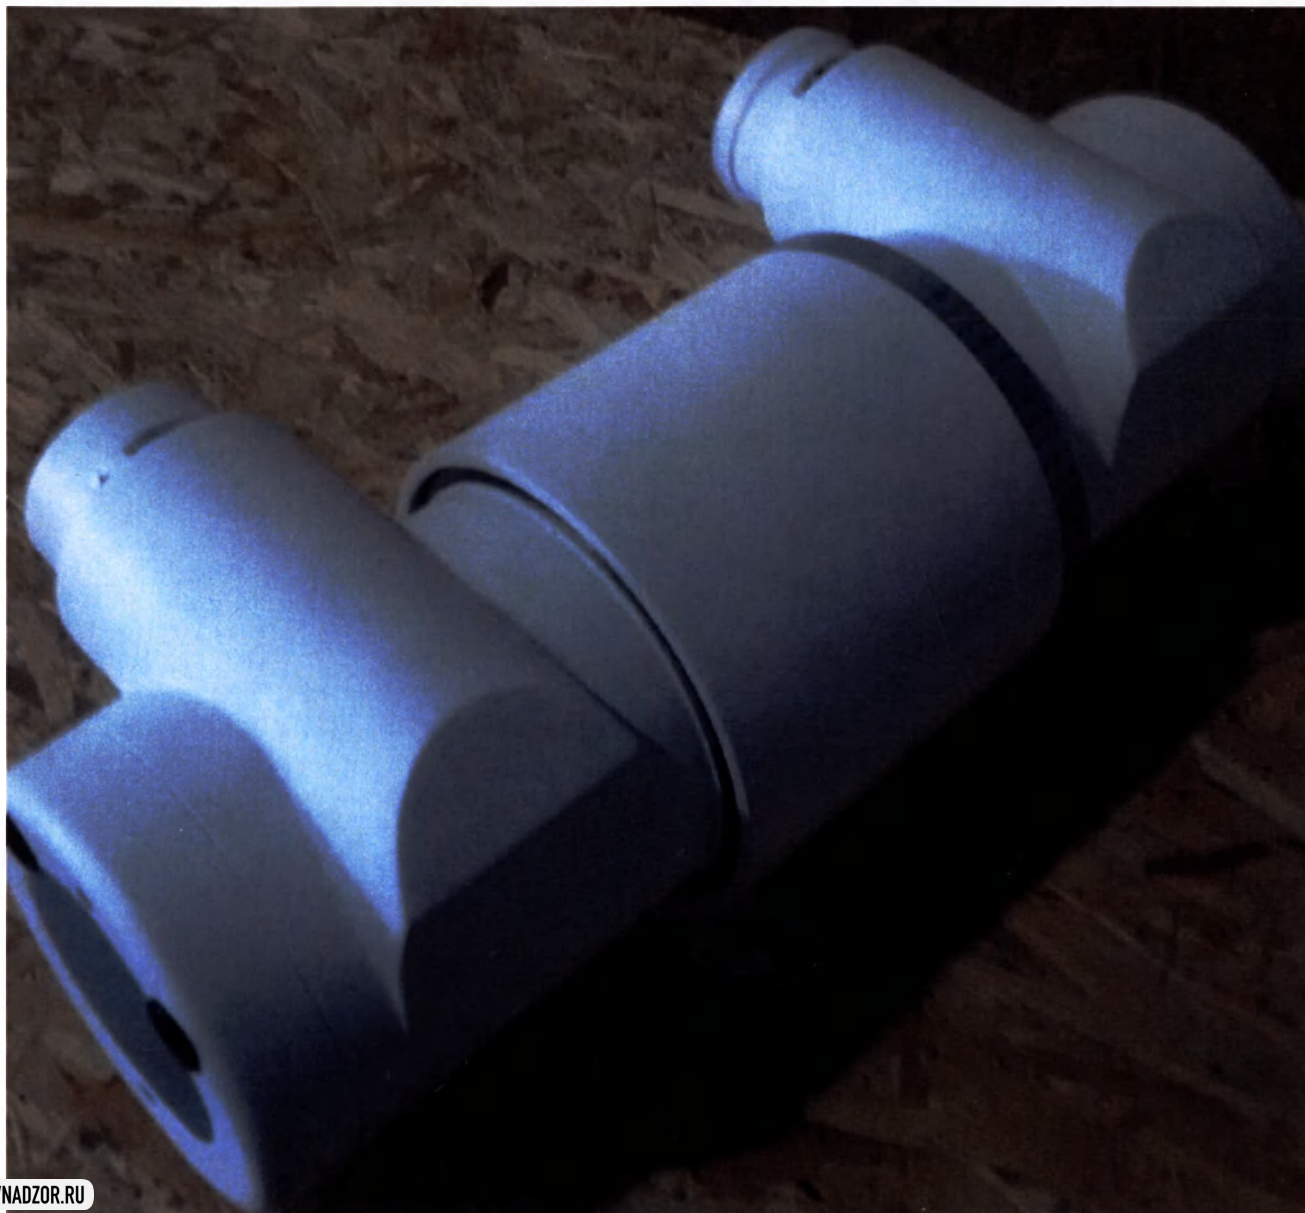

РентМедПром

127200, Москва, Рязанская, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

РУССКАЯ РЕНТЕХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРОДУКЦИОННАЯ ФИЛИАЛ ОМЕГА

**РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
С РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКОЙ**

ИЗДЕЛИЕ **01-075-20**
№ РМП


 150kV, дистанция фильтра 1.5 мм Al/75kV

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**



I.A.E. SpA
CORMANO (MI) - Italy



Tube No. 437103

Type RTC 600 HS

 0.6

 1.0

10000 rpm 150 kV



I.A.E. SpA
CORMANO (MI) - Italy



Housing No. 100559

Type C52SUPER

Filtr. 1.2 Al + 0.3 Al = 1.5 Al 150 kV

1.3.2. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой SV 150/40/80C-100 или SV 150/40/80HC-100 - 1 шт., производства фирмы Siemens Healthcare GmbH, Германия.




1.4. Приемник рентгеновский цифровой: Плоскопанельный цифровой детектор (динамическая панель) FLAT DR - 1 шт., производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария.







Vasil Levski 88 Str., district Vrabnitsa,
Sofia-1201, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 13



REF
SN

Digital Flat Panel Detector 43x43

IR 02-201-01/D

M20-186-119542336

24V - 0.75A, 11.5V - 1.5A



2020



127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-91-98

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ - ОМЕГА

ПРИЕМНИК РЕНТГЕНОВСКИЙ
ЦИФРОВОЙ

ИЗДЕЛИЕ № РМП 01-075-20


24В - 0,75А / 11,5В - 1,5 А

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска 08.2020

1.5. Автоматизированное рабочее место рентгенлаборанта: Аппаратно-программный комплекс АРМ лаборант - 1шт., производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия или производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария.



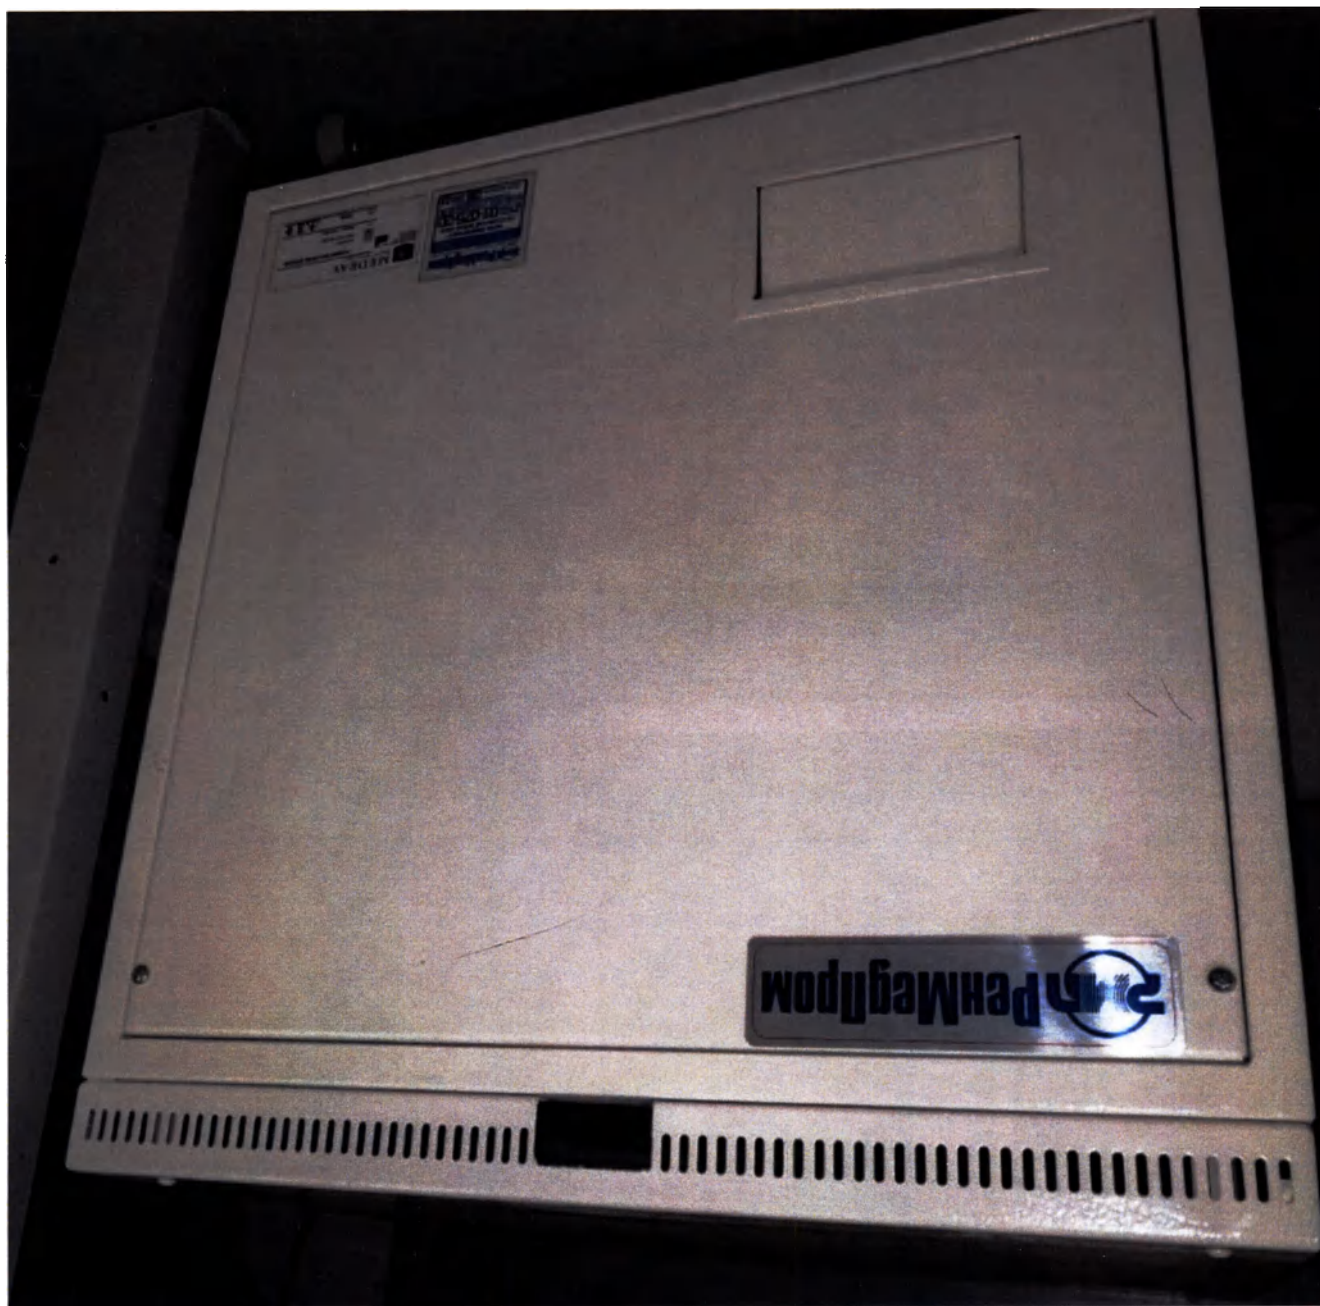

РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ **ОМЕГА**

**АРМ ЛАБОРАНТ
ОСНОВНОЙ БЛОК AWS**

ИЗДЕЛИЕ № РМП **01-074-20**

220 В +/-10% 50Гц 150 ВА

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**

РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ **ОМЕГА**

**АРМ ЛАБОРАНТ
МОНИТОР**

ИЗДЕЛИЕ № РМП **01-074-20**

220 В +/-10% 50Гц 150 ВА

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**

РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ **ОМЕГА**

**АРМ ЛАБОРАНТ
ОСНОВНОЙ БЛОК AWS**

ИЗДЕЛИЕ № РМП **01-075-20**

220 В +/-10% 50Гц 150 ВА

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**

DR MEDRAY
Digital Radiology

YINKE LAYOU 80 SD, 80000 VISIONAL
3000-1201, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19

ACQUISITION WORK STATION

REF
SN


MTXF02

M20-186-119542330


220Vac ± 10% 50Hz



2020



1.6. Мобильный рентгенопрозрачный стол ОМЕГА - 1 шт., производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия или Мобильный рентгенопрозрачный стол STRETCHER - 1 шт., производства фирмы Italray S.r.l., Италия.

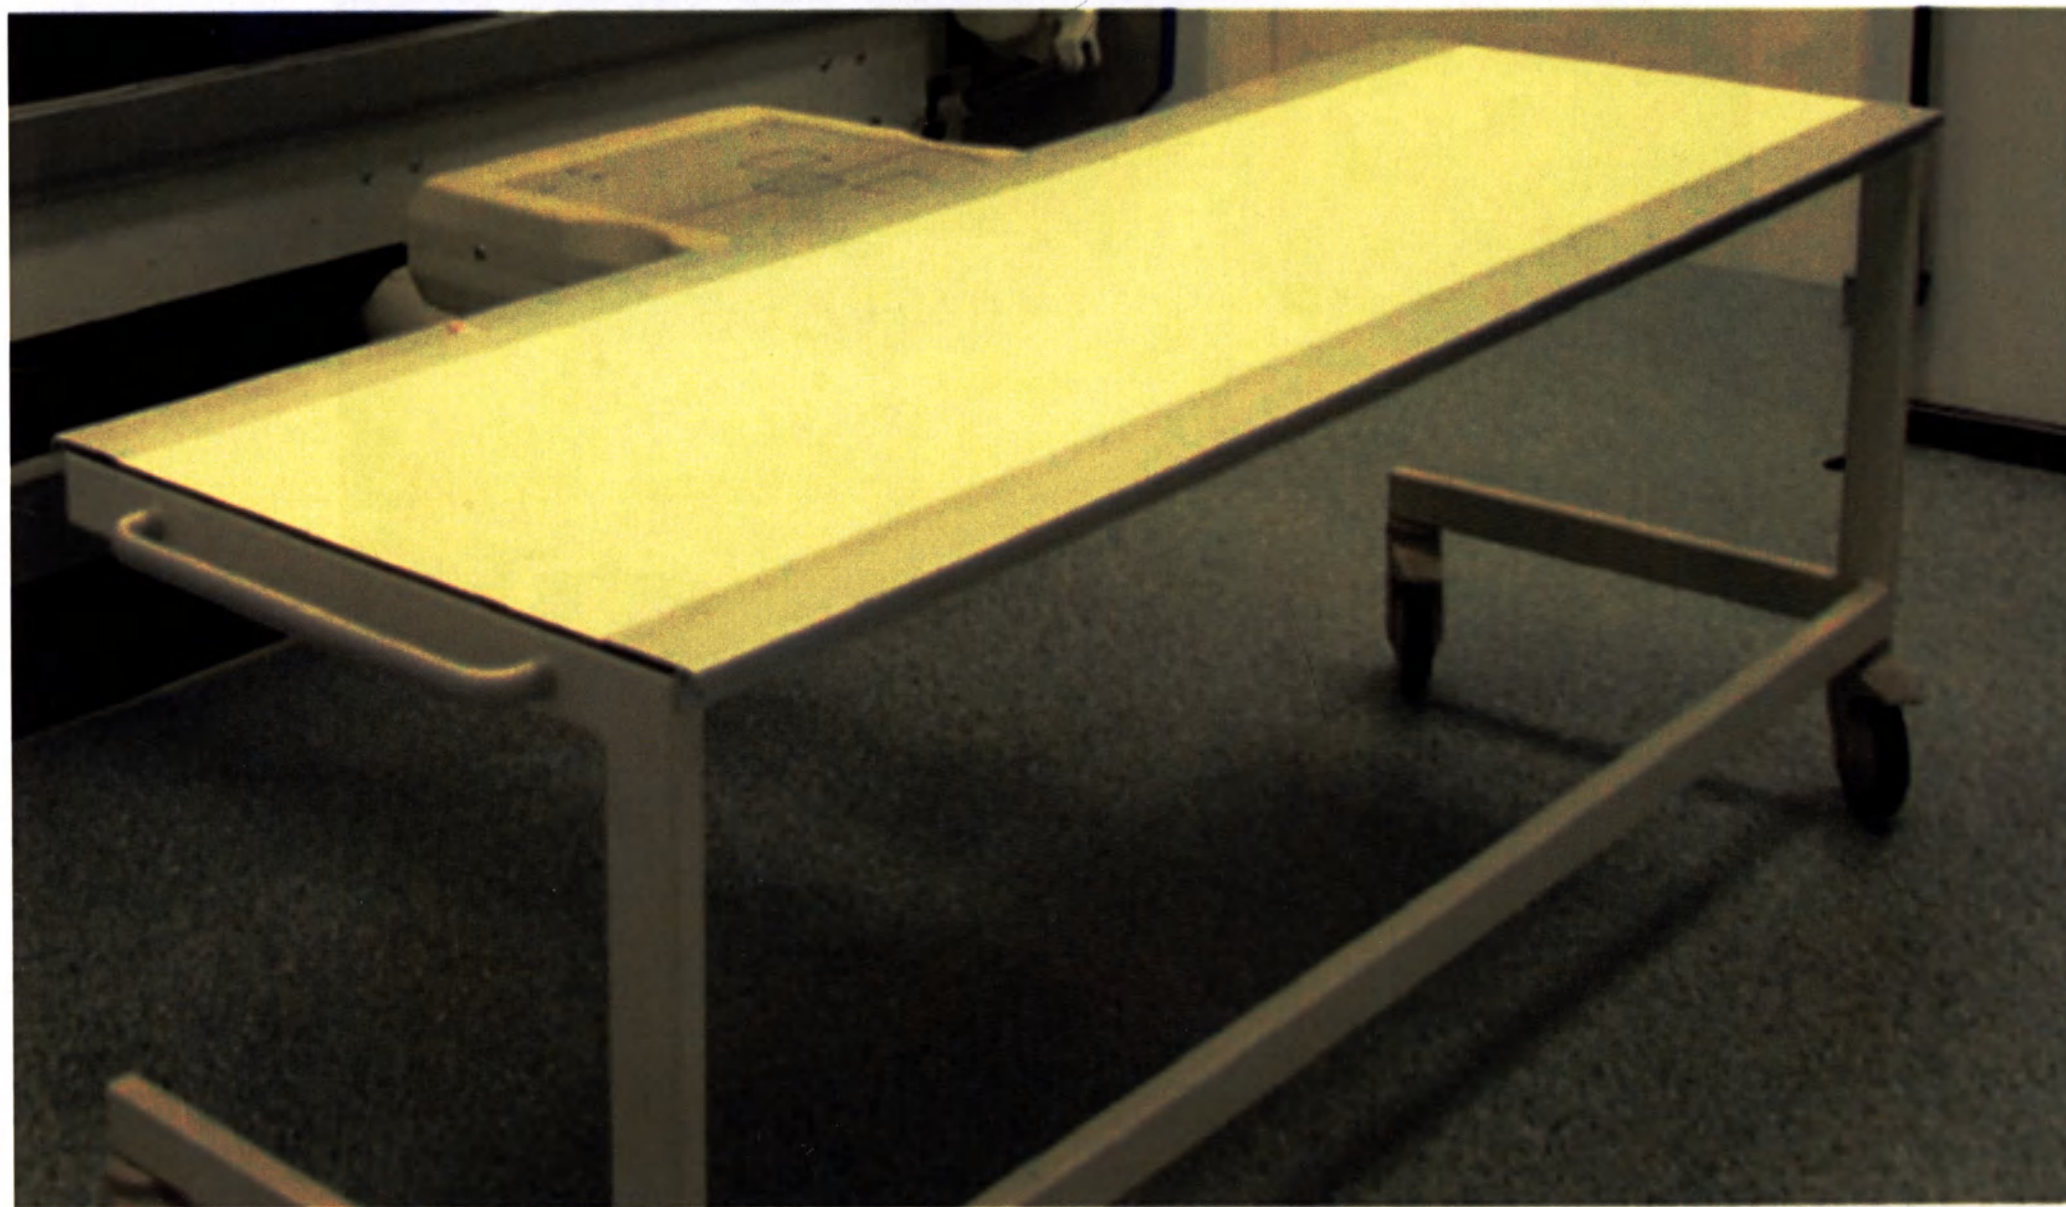



ITALRAY s.r.l. Via del P. Europeo 90 - 36010
SCANDICCI (Firenze) ITALY
tel. +39 055 7220911 fax. +39 055 7220912
e-mail: info@italray.it web: www.italray.it



Mobile xray transparent table STRETCHER

REF

MTESTRET01

SN

M20-185-119541512



2020



 **РенМедПром**

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

**МОБИЛЬНЫЙ
РЕНТГЕНОПРОЗРАЧНЫЙ
СТОЛ**

МОДЕЛЬ **01-074-20**


Т/У 0412-091-01020002-2011

Год выпуска **01.2020**


1.7. Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства "ВакуТек Месстехник ГмбХ", Германия.



Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012, производства ООО НПП "Доза", Россия.

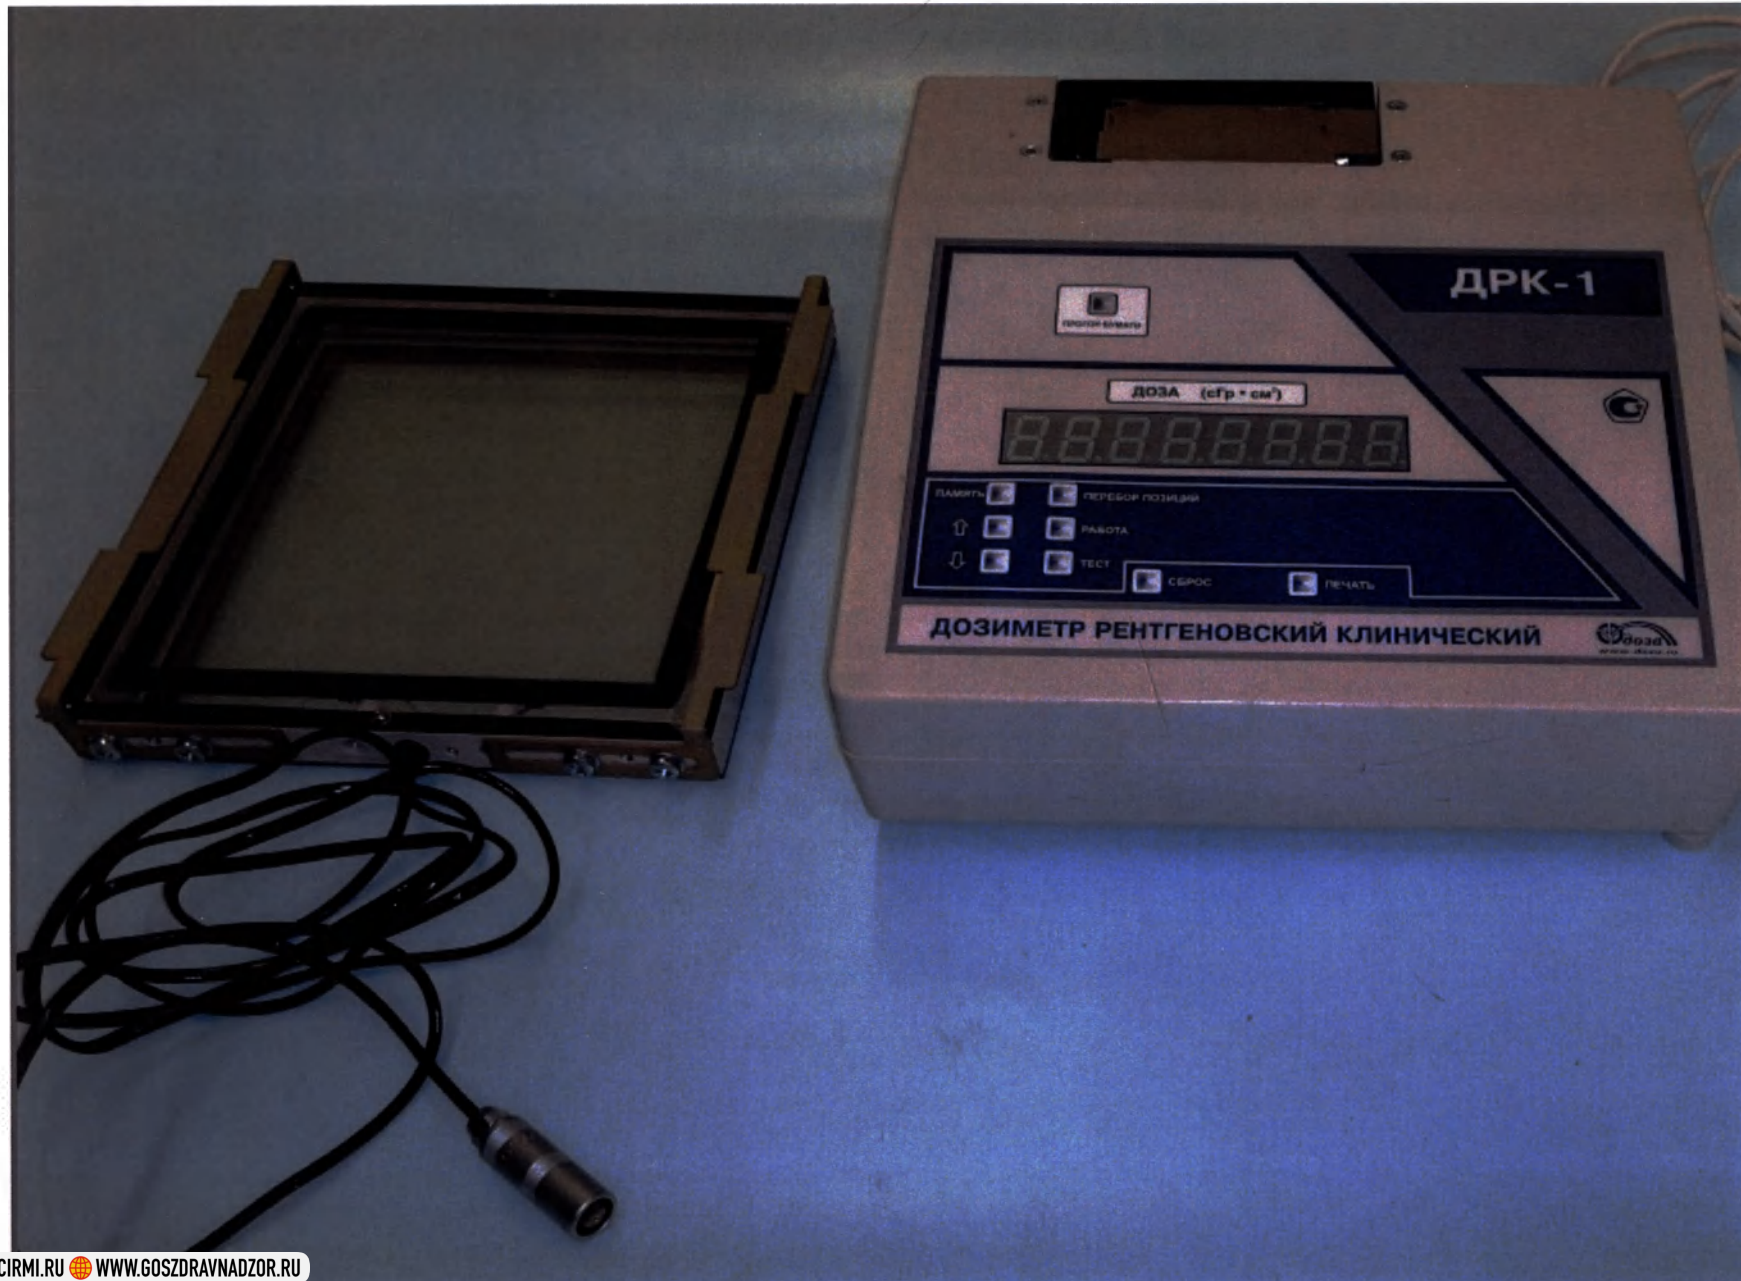

2.1. Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога: Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей» Россия.

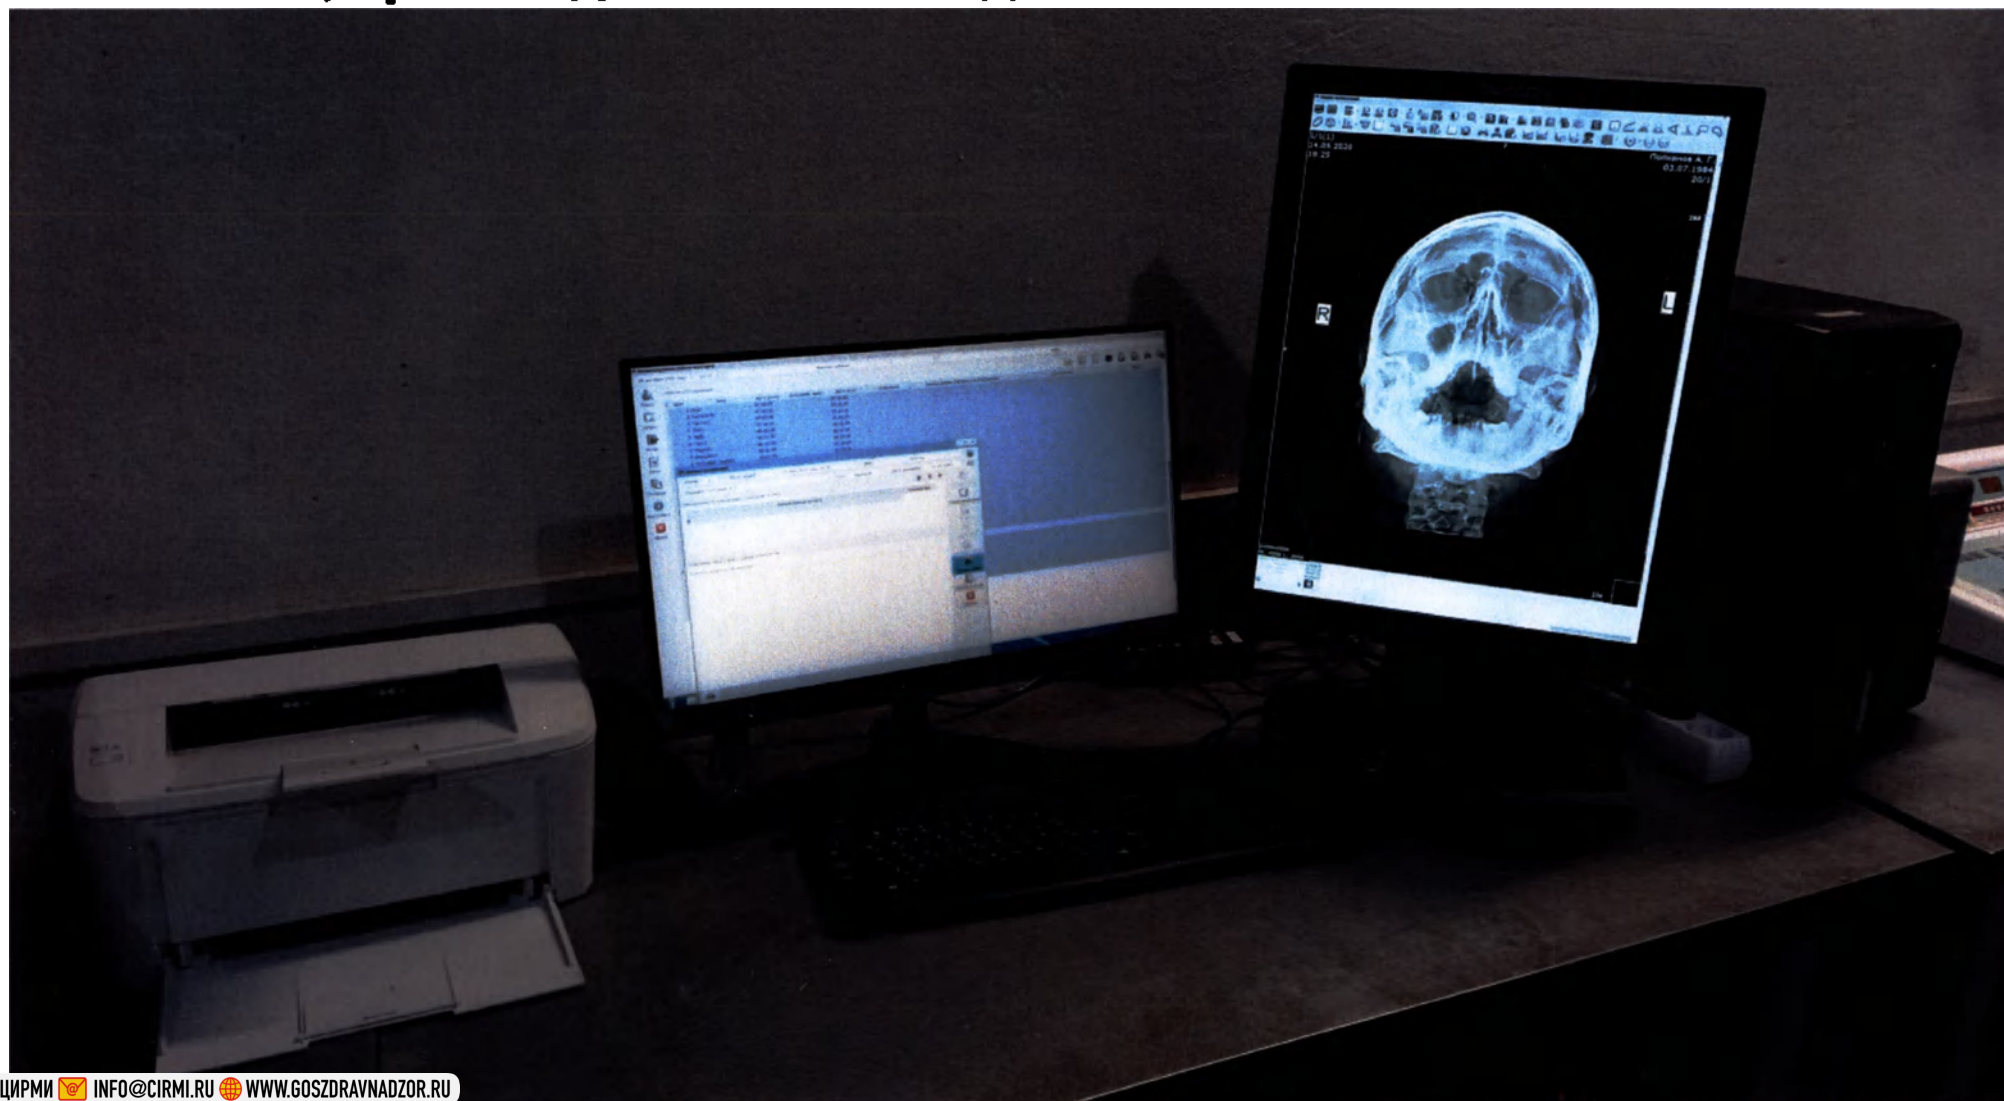



Изделие:

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной
обработки и протоколирования медицинских диагностических
исследований «АрхиМед»

Серийный номер: А-0103839-11

ТУ 9440-001-98944313-2007

Изготовитель: ООО «Мед-Рей»

Дата выпуска: 01.10.2020

Наименование части ТС комплекс: Монитор


2.2. Тележка мобильная под монитор – 1 шт, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия или производства фирмы «Медрей» ООД (MEDRAY LTD), Болгария.





MEDRAY
Digital Radiology

Med Ray 88 St., district Vratska,
Sofia-1201, BULGARIA
www.medray.bg
+359 2 444 12 12
+359 2 444 19 19



Monitor Trolley

TRC+IM904/A

M20-185-119541512



2020



РенМедПром

127322, Москва, Яблочкова, 21, к. 3. Тел. (495) 610-99-08

УСТАНОВКА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ **ОМЕГА**

ТЕЛЕЖКА МОБИЛЬНАЯ
ПОД МОНИТОР

ИЗДЕЛИЕ
№ РМП

01-074-20

ТУ 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска

08.2020

2.3. Переговорное устройство лаборант-пациент SP-400, производства ООО «РЕНМЕДПРОМ», Россия.



ЗАО ЦРМИ
РентгенМедпром

127322, Москва, Ямской ул. 21, к. 3, Тел: (495) 610-99-06

УСТАНОВКА РЕНТЕГНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦИФРОВАЯ ОМЕГА

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

ЛАБОРАНТ-ПАЦИЕНТ

ИЗДАНИЕ № РМН **01-075-20**

¥ Δ C +12B SBA

TY 9442-001-91526802-2011

Дата выпуска **08.2020**

Всего прошито
и скреплено печатью
44 (сорок четыре) листов
Генеральный директор
ООО «РЕНМЕДИПРОМ»
Кудренко О.В.

