

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Синерджи Консалтинг»



Система картирования Rhythmia HDx с принадлежностями

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Бостон Сайентифик Корпорейшн », США.

Boston Scientific Corporation, 300 Boston Scientific Way, Marlborough , MA 01752, USA

I. Фотографические изображения медицинского изделия



Общий вид медицинского изделия в сборе

Система картирования Rhythmia HDx

Система картирования Rhythmia HDx

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX
«Система картирования Rhythmia HDx
с принадлежностями»

RHYTHMIA HDx™

Boston
Scientific

INSTALL BUNDLE ROW

Mapping System

Sistema de mapeo, Système de cartographie, Mapping-System, Sistema di mappatura, Mappingsysteem, Kortlægningssystem, Σύστημα χαρτογράφησης, Sistema de Mapeamento, Mappingsystem, Térképező rendszer, Mapovací systém, System mapowania, Kartleggingssystem, Haritalama Sistem, Kartotusjärjestelmä, Sistem de cartografie, Mapovací systém

 Contents (1)

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|
| (2) Breakout Box | (1) Refurbished Signal Station | (1) Cable, Equipotential Grind |
| (1) Patch Cable | (2) RF6 Serial Data Tap | (1) LC FIBER Coupler - Duplex |
| (1) Power Supply | (1) Global IEC Power Strip | (1) USB to DB9 RS232 Adapter M-M |
| (1) Workstation PC | (2) Stimulator Jumper Cable | (1) DB9 RS232 Serial Cable Strt Thr M-F 10ft |
| (2) Breakout Box Cable | (1) Optical DVI - Duplex Kit | |

GTIN 08714729993162

REF Catalog No.
M004RBINSTALL2RWR0



90950582-01

Internal BSC Bar Code

91109129-05A



91109129-05A

CE 0086

Kit Assembled in USA:
4100 Hamline Avenue North
Saint Paul, MN 55112 USA

Breakout Box
Manufactured in Canada
Breakout Box Cable, Patch Cable
Manufactured in Mexico

EC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway
IRELAND

Legal Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA

USA Customer Service 888-272-1001

 ONLY

 Separate Collection

 Do not use if package is damaged.

 Recyclable Package



CAUTION
Attention: Consult
ACCOMPANYING DOCUMENTS.

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>



LOT 1000001106

SN Serial Number
1000001106

Date of Manufacture

2019-12-16



90910781-01

Internal BSC Bar Code

91110914-12A



(01)08714729993162(11)191216(10)1000001106

GS1




(21)1000001106

GS1

Система картирования Rhythmia HDx – маркировка общей коробки

1. Сигнальная станция Rhythmia HDx.

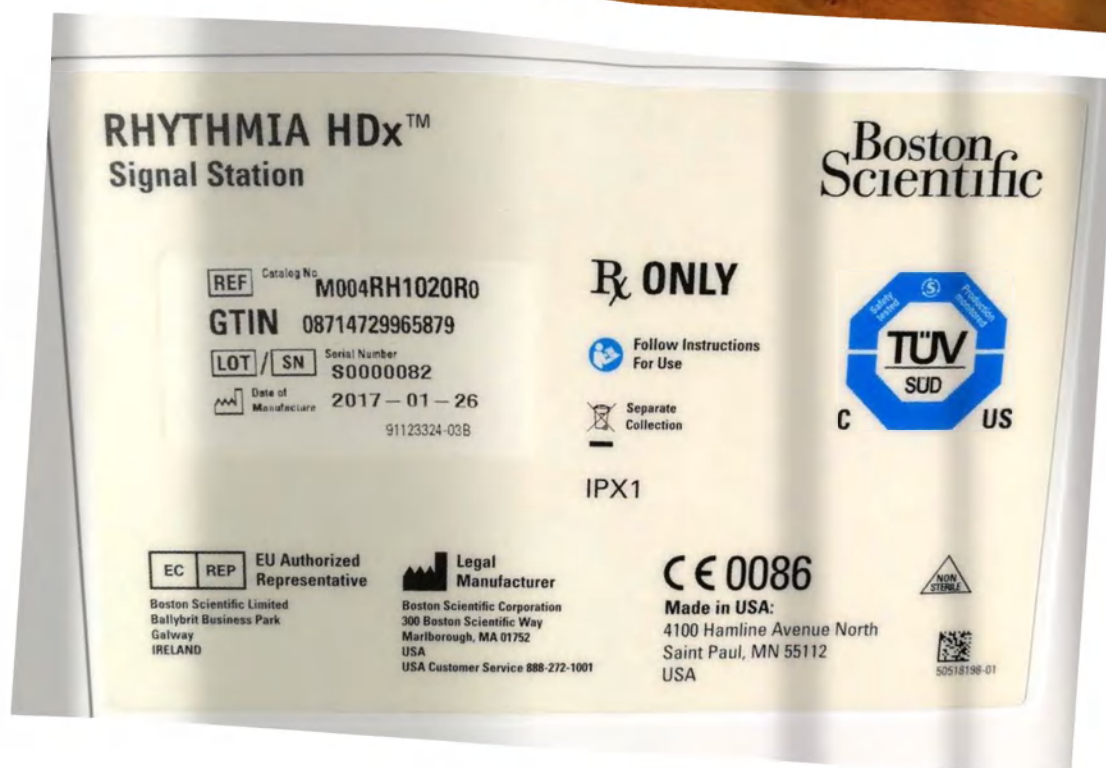


2. Кабель соединительный Rhythmia HDx.



3. Рабочая станция Rhythmia HDx.



Рабочая станция Rhythmia HDx

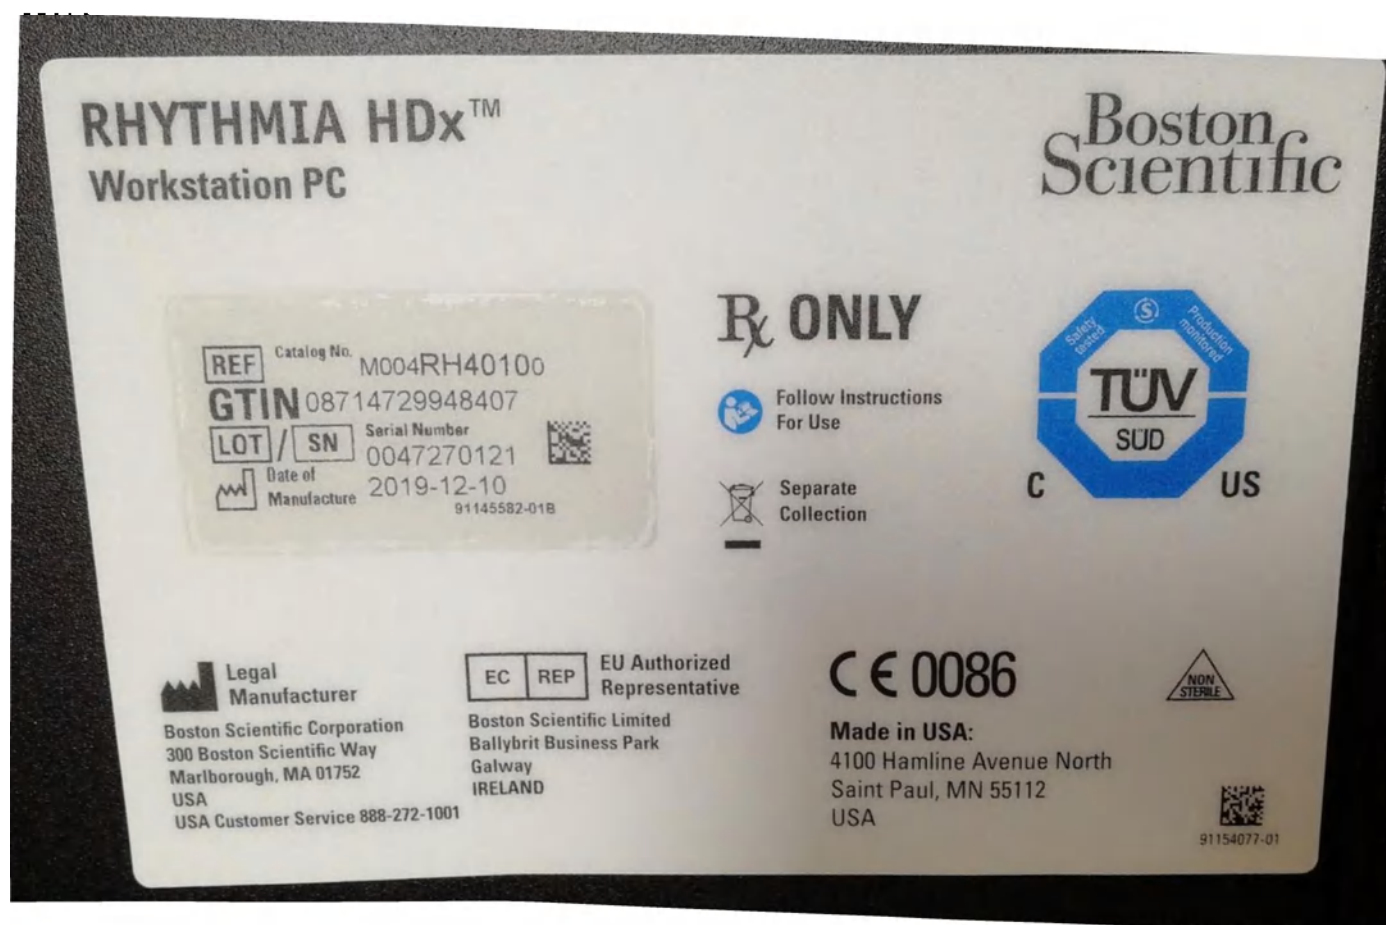

Маркировка на изделии

4. Блок питания Rhythmia HDx.



4. Блок питания Rhythmia HDx.




Маркировка на изделии

5. Распределительная коробка Rhythmia HDx – 2шт.



5. Распределительная коробка Rhythmia HDx – 2шт.

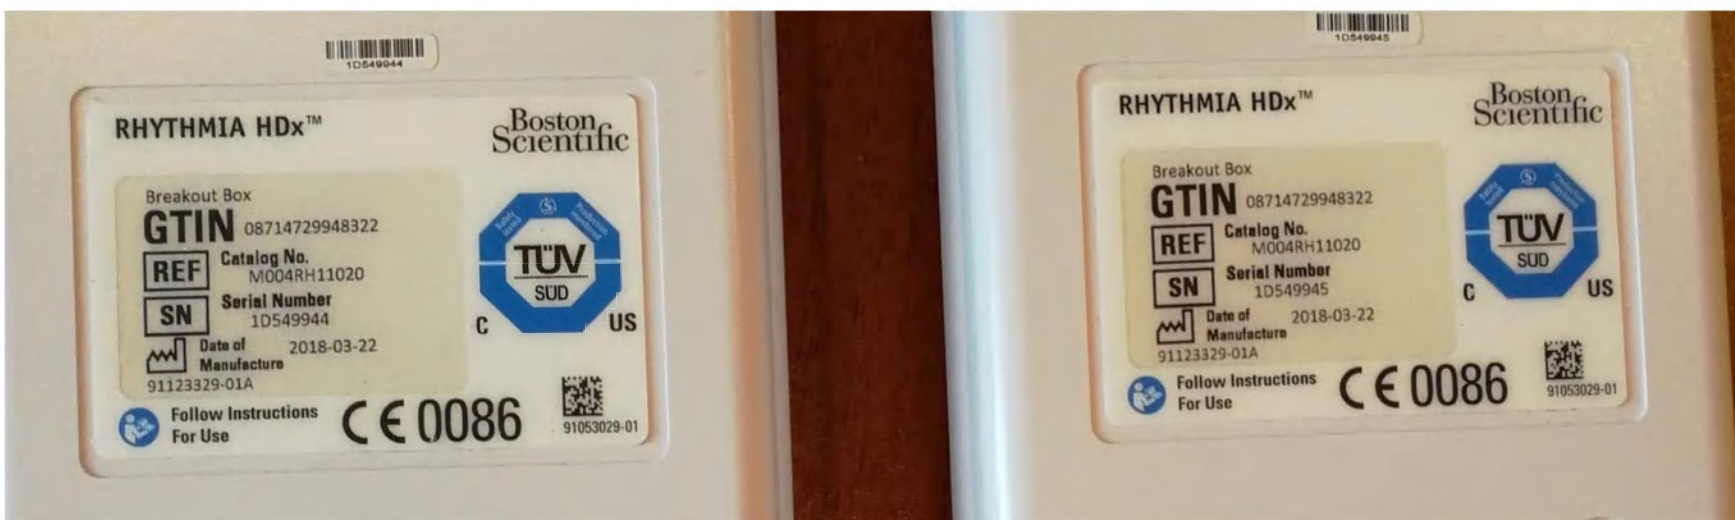

Маркировка на изделии

6. Кабель распределительной коробки Rhythmia HDx – 2 шт.



7. Кабель для подключения стимулятора к сигнальной станции 2-х пиновый ("папа-папа") – 2 шт.




8. Удлинитель, тип ИЕС.



9. Адаптер DVI-Duplex в наборе.



10. Адаптер оптоволоконный Coupler –Duplex.

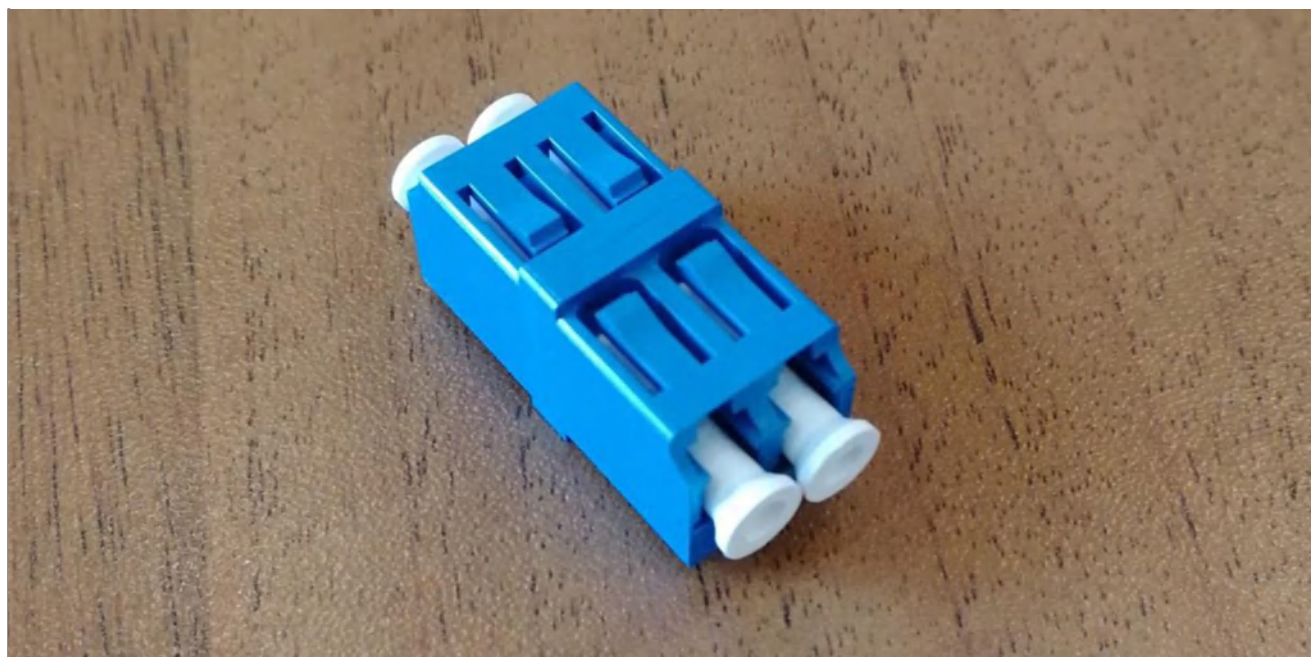


11. Кабель заземления.




12. Кабель передачи данных RS-232 ("папа-мама"), длина 3 м (10 фт.).



13. Кабель "папа-папа" (USB к DB9 RS232).

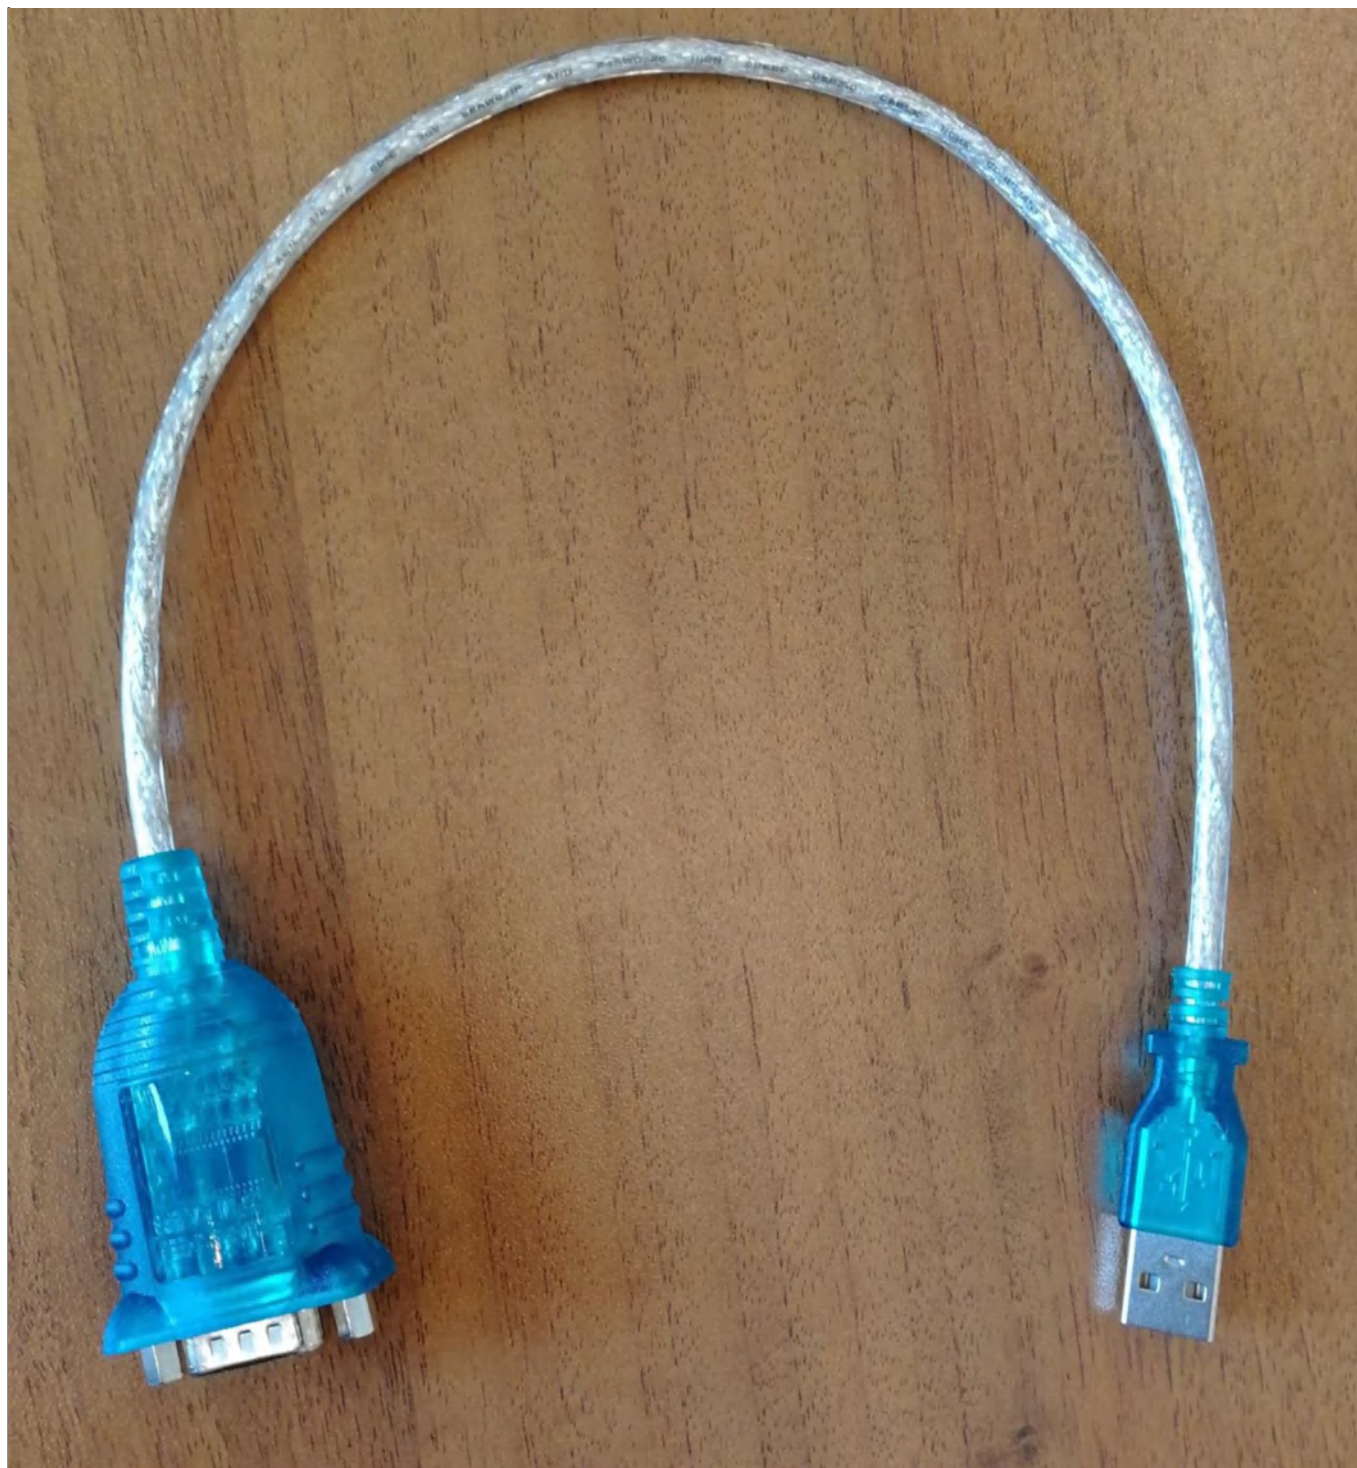

14. Адаптер для передачи данных RFG–2шт.

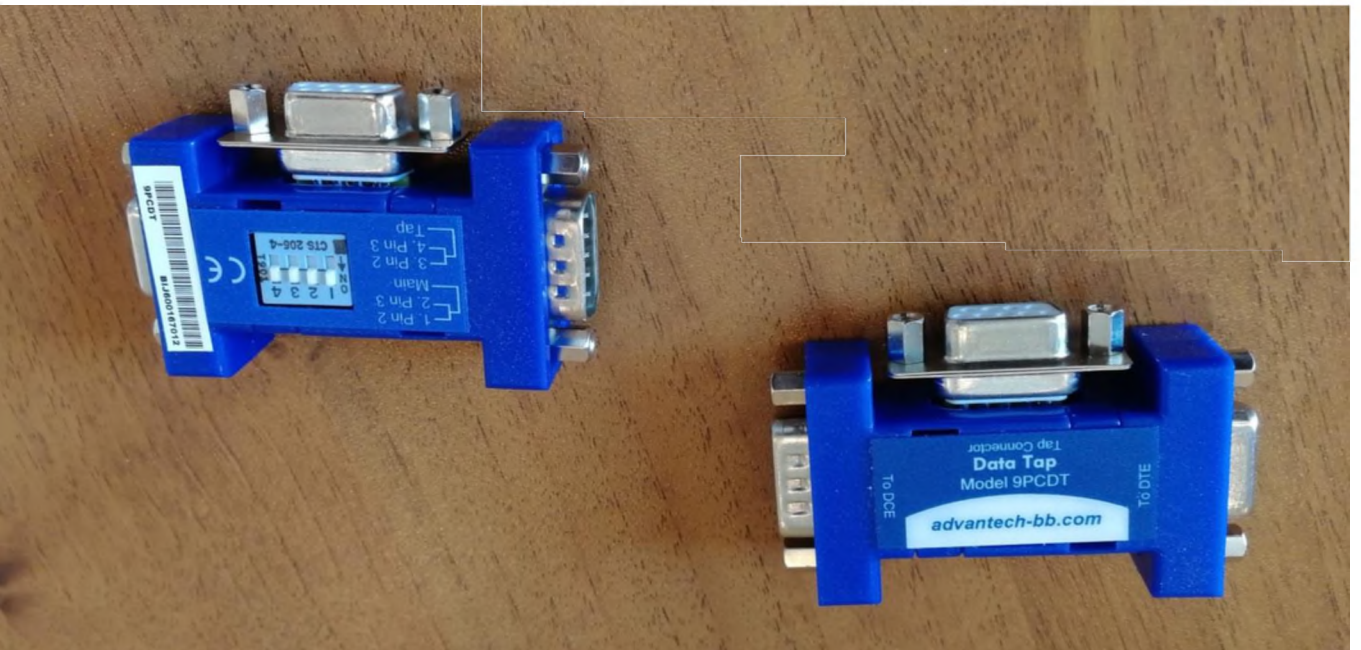


15. Соединительная коробка для устройства абляции (EP Shuttle) Rhythmia HDx



16. Соединительная коробка для устройства абляции (Maestro) Rhythmia HDx.



17. Педаль ножная Rhythmia HDx.

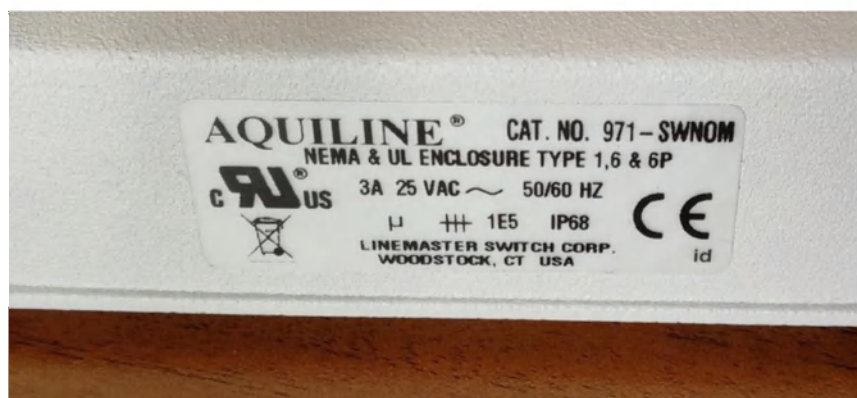

18. Локализационный генератор Rhythmia HDx



19. Крепление локализационного генератора Rhythmia HDx (ремень).



20. Крепление локализационного генератора Rhythmia HDx (прикроватное крепление)



21. Кабель локализационного генератора Rhythmia HDx



22. Кабель поверхностного ЭКГ (магистральный)



23. Кабель поверхностного ЭКГ (конечности/грудь)



24. Коробка выходного сигнала ЭКГ IEC Rhythmia HDx



25. Кабель прямого соединения (ЭКГ) Clearsign Direct Connect ECG Rhythmia HDx, длина: 3м



26. Кабель прямого соединения (ЭКГ) Clearsign Direct Connect ECG Rhythmia HDx, длина: 3м



27. Кабель для передачи исходящих внутрисердечных сигналов, 72-пиновый Rhythmia HDx



28. Кабель прямого соединения (внутрисердечное) Clearsign Direct Connect IC A/B Rhythmia HDx ,
длина: 6м



29. Кабель прямого соединения (внутрисердечн.) Clearsign Direct Connect IC Orion Rhythmia HDx,
длина: 3м



30. Кабель прямого соединения (внутрисердечн.) CardioLab Direct Connect IC Rhythmia HDx, длина: 6м



31. Кабель питания.



32. Переходник DB9



33. Переходник изолирующий оптический RS-232 в наборе.



34. Разветвитель для кабеля питания в наборе с адаптером.




35. Кабель питания C14, C13, длина: 3м



36. Кабель питания в сборе, длина: 30 м



37. Изолирующий трансформатор .

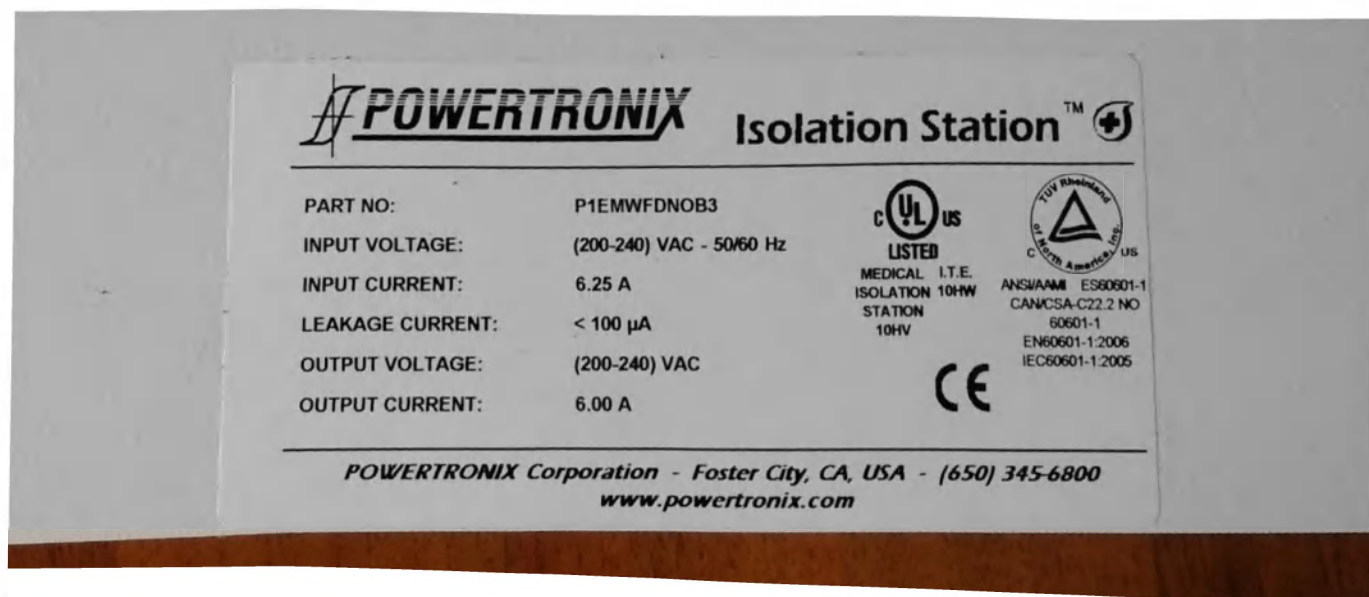


Изолирующий трансформатор

38. Комплект 1 оптоволоконных кабелей с адаптером.



39. Комплект 2 оптоволоконных кабелей с адаптером.

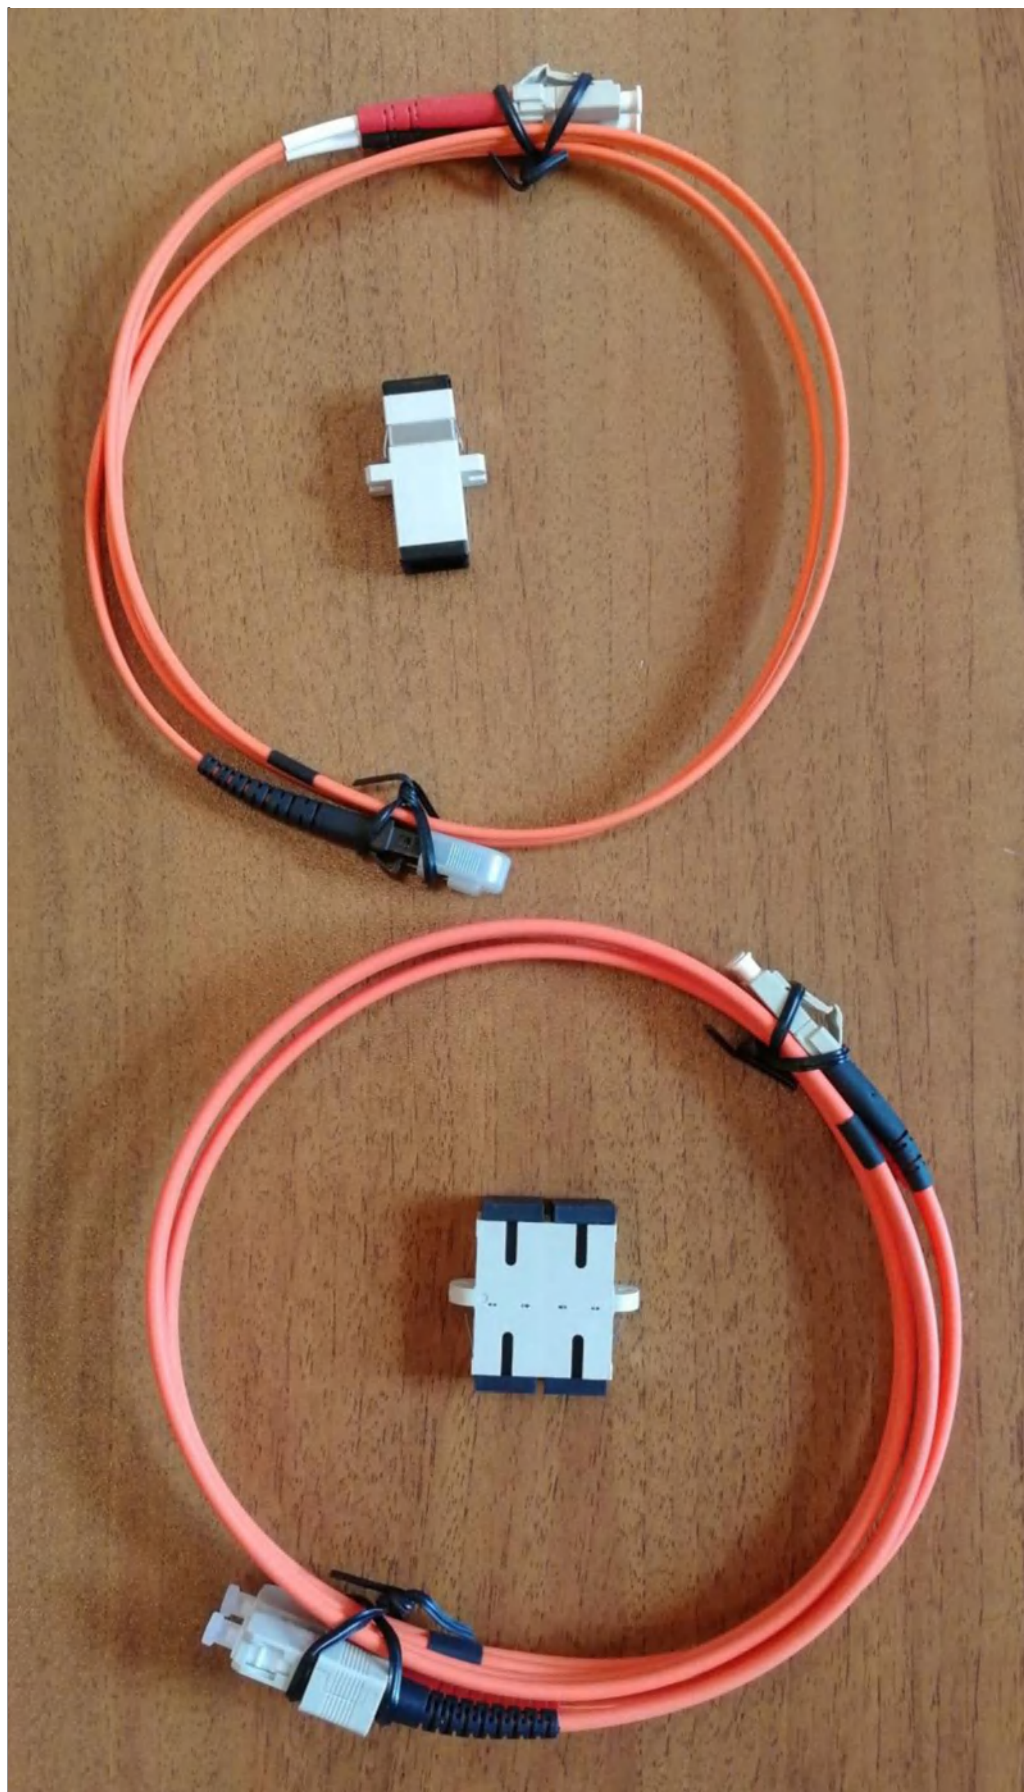

40. Кабель передачи данных RS-232 ("мама-мама"), длина 3 м (10 фт.).



41. Кабель оптоволоконный, длина 30 м.




42. Кабель RS-232 для РЧ-генераторов систем ЕРТ, Maestro, Attack, IBI, Osypka, длина: 30 м (100 футов).



43. Кабель нуль - модемный для генератора Stockert длина 30 м (100 футов)




44. Разветвитель заземления

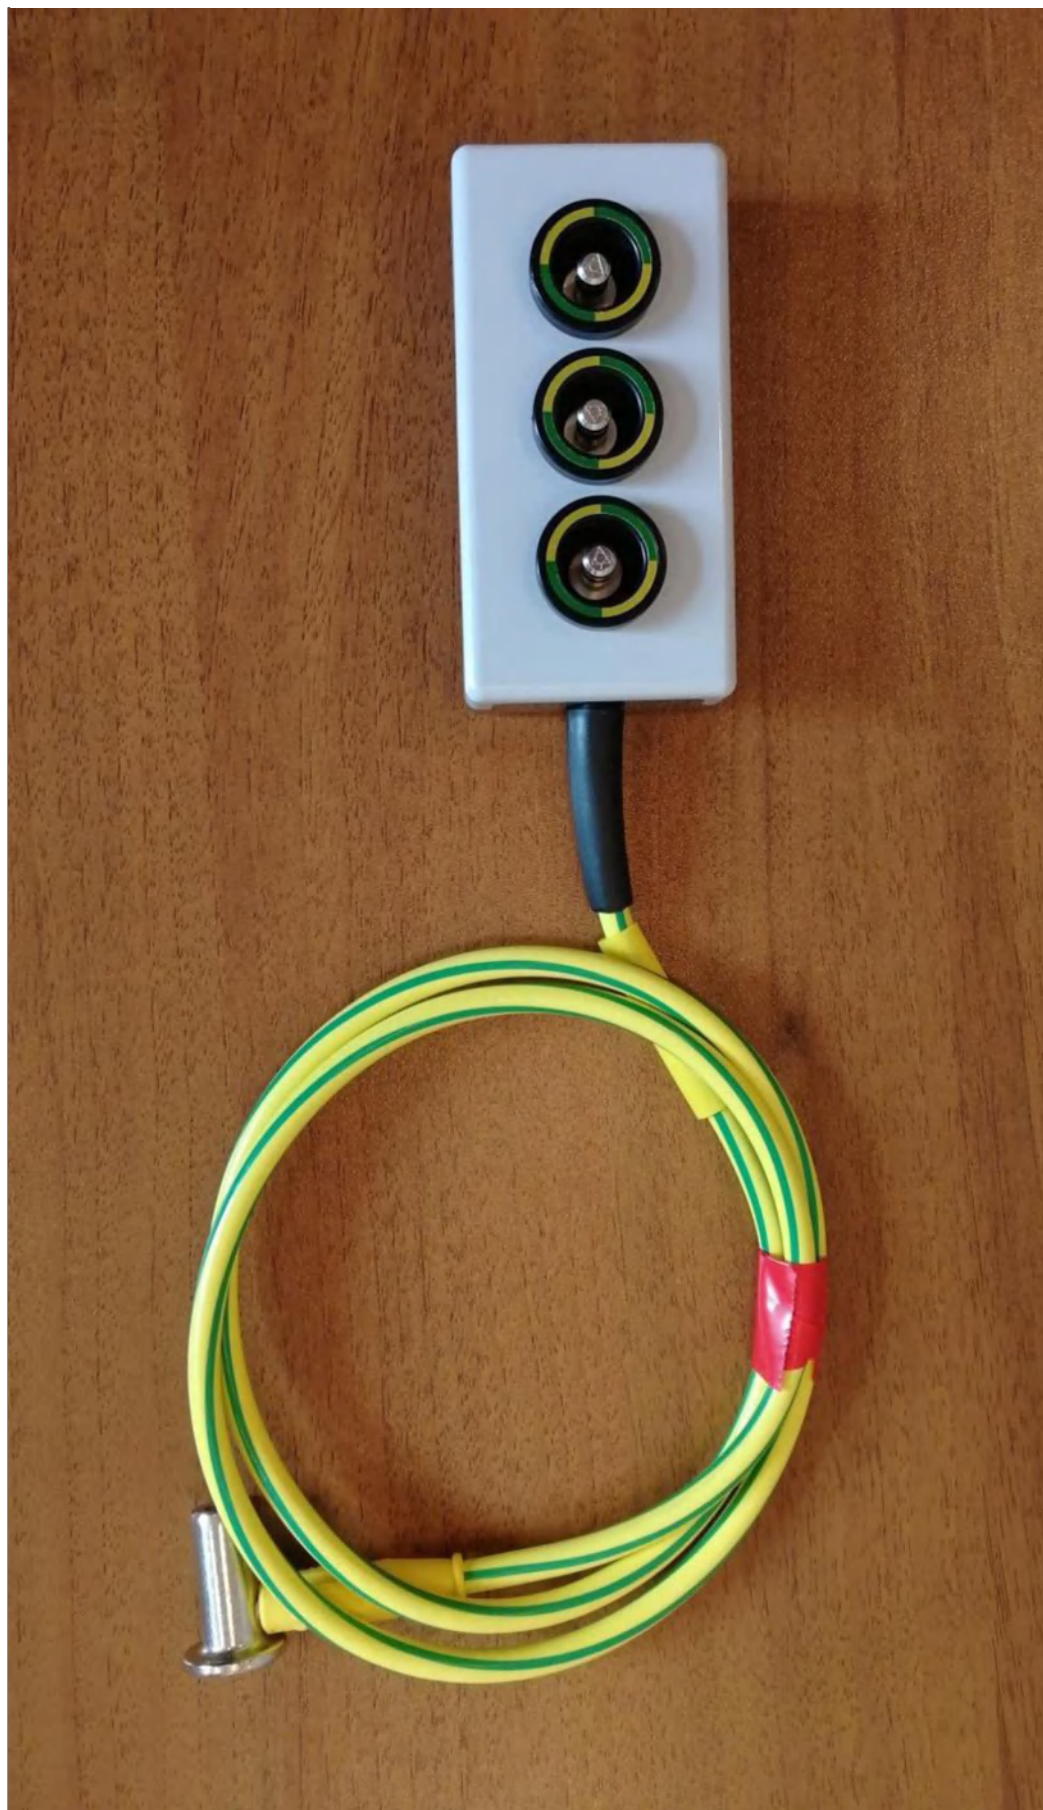

45. Клавиатура.



46. Мышь

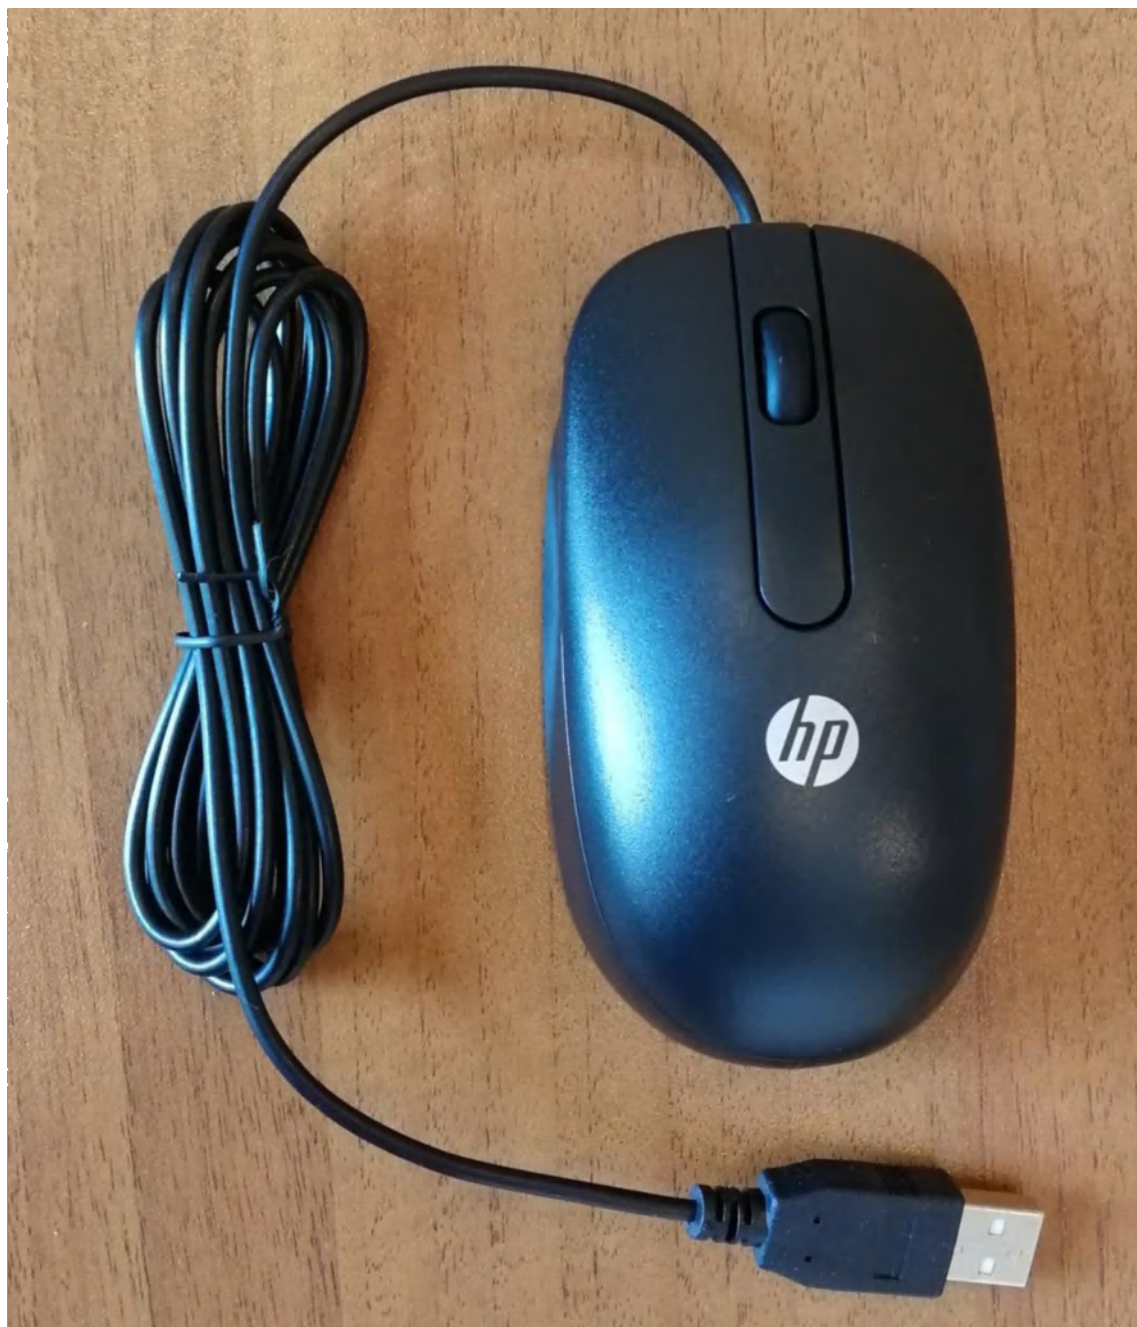

47. Соединительная коробка для подключения катетера IntellaNav к генератору Stockert.



48. Соединительная коробка для подключения катетера IntellaNav к генератору Maestro 4000.




49. Кабель адаптера для подключения катетера IntellaNav к блокам обработки сигналов SIU.



50. Система настройки картирующего катетера



50. Система настройки картирующего катетера

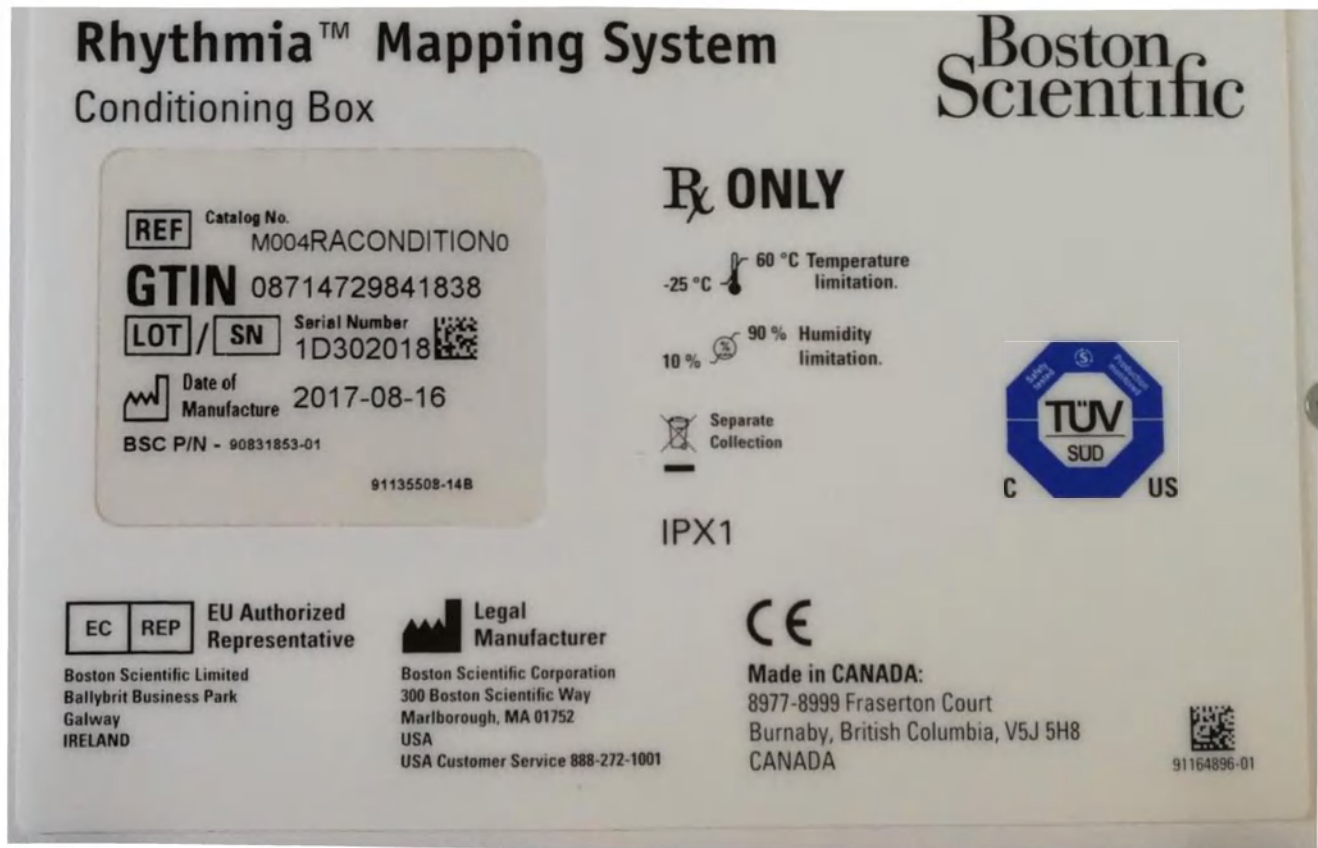

Маркировка на изделии

51. Кабель выходной для подключения генератора ИВІ к сигнальной станции



52. Кабель выходной для подключения генератора Stockert к сигнальной станции



54. Кабель USB.



55. Соединительная коробка для устройства абляции (SmartAblate) Rhythmia HDx.



Общий вид

55. Соединительная коробка для устройства абляции (SmartAblate) Rhythmia HDx.



Маркировка

56. Соединительная коробка для устройства абляции - IntellaNav StablePoint Rhythmia HDx.



Общий вид

56. Соединительная коробка для устройства абляции - IntellaNav StablePoint Rhythmia HDx.



Маркировка

57. Соединительная коробка для устройства абляции (IBI/Ampere) Rhythmia HDx.



Общий вид

57. Соединительная коробка для устройства абляции (IBI/Ampere) Rhythmia HDx.



Маркировка

Принадлежности:

1. Тележка для перемещения системы Rhythmia HDx.



2. Тележка для перемещения рабочей станции.



3. Кронштейн тележки для монитора и удлинитель кронштейна тележки для монитора.



4. Монитор рабочей станции.



5. Кронштейн тележки для двух мониторов.



II. Упаковка медицинского изделия

Компоненты системы картирования Rhythmia HDx с принадлежностями упаковываются в несколько картонных коробок, которые объединяются в общий блок с единой маркировкой и транспортируется организацией, специализирующейся на общих перевозках



Единая транспортная упаковка системы



Прошито, пронумеровано
(73 лист(ов))
скреплено печатью

