

«Утверждаю»

Директор

ООО «ФтизисБиоМед»




М.В.Кудрина

«30» ноября 2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:


- **Программа автоматизированного анализа цифровых рентгенограмм органов грудной клетки/флюорограмм по ТУ 62.01.29-001-96876180-2019**

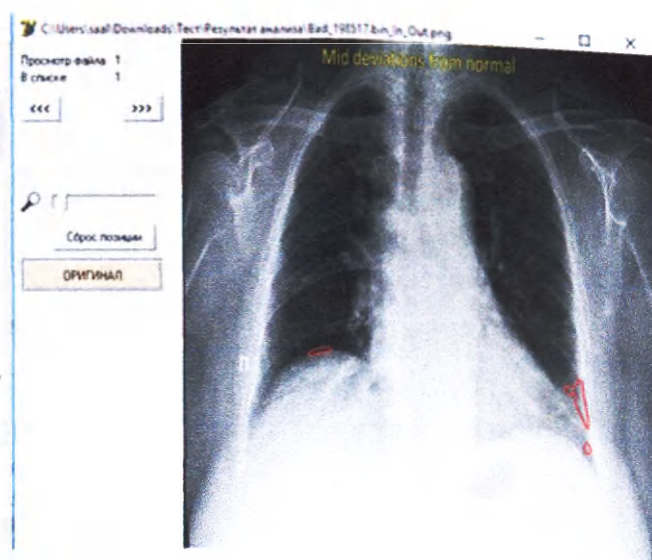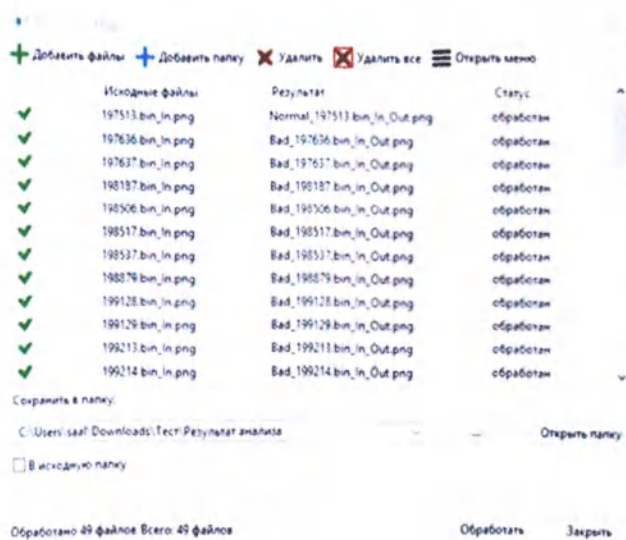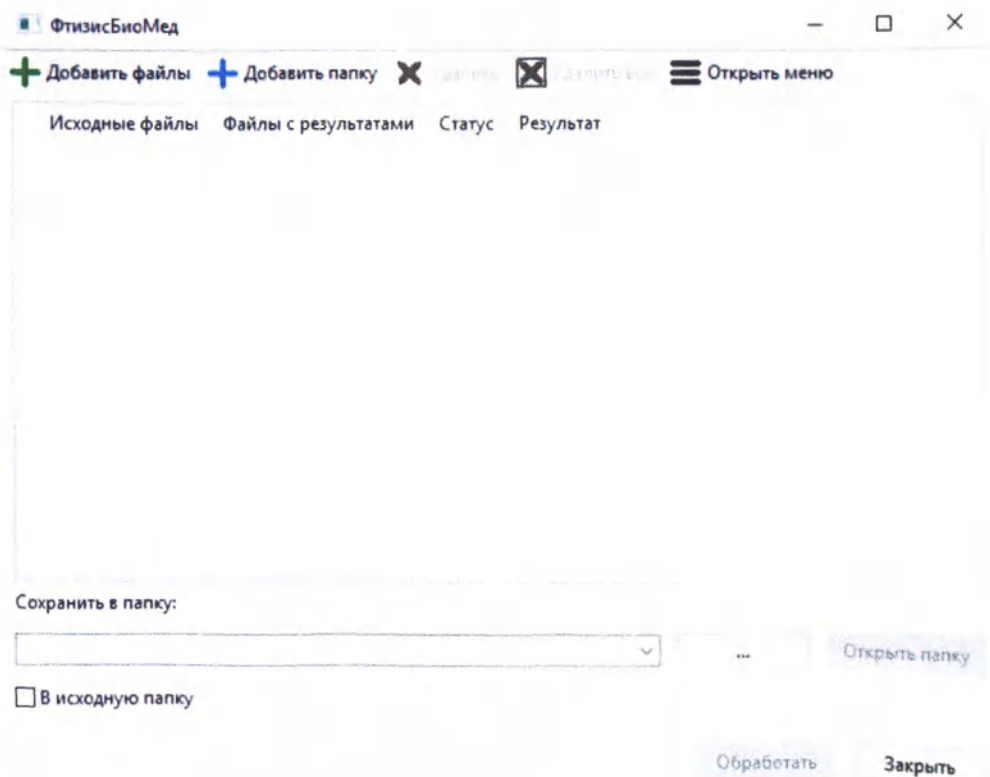

Интерфейс программного обеспечения.



Транспортный вид упаковки.

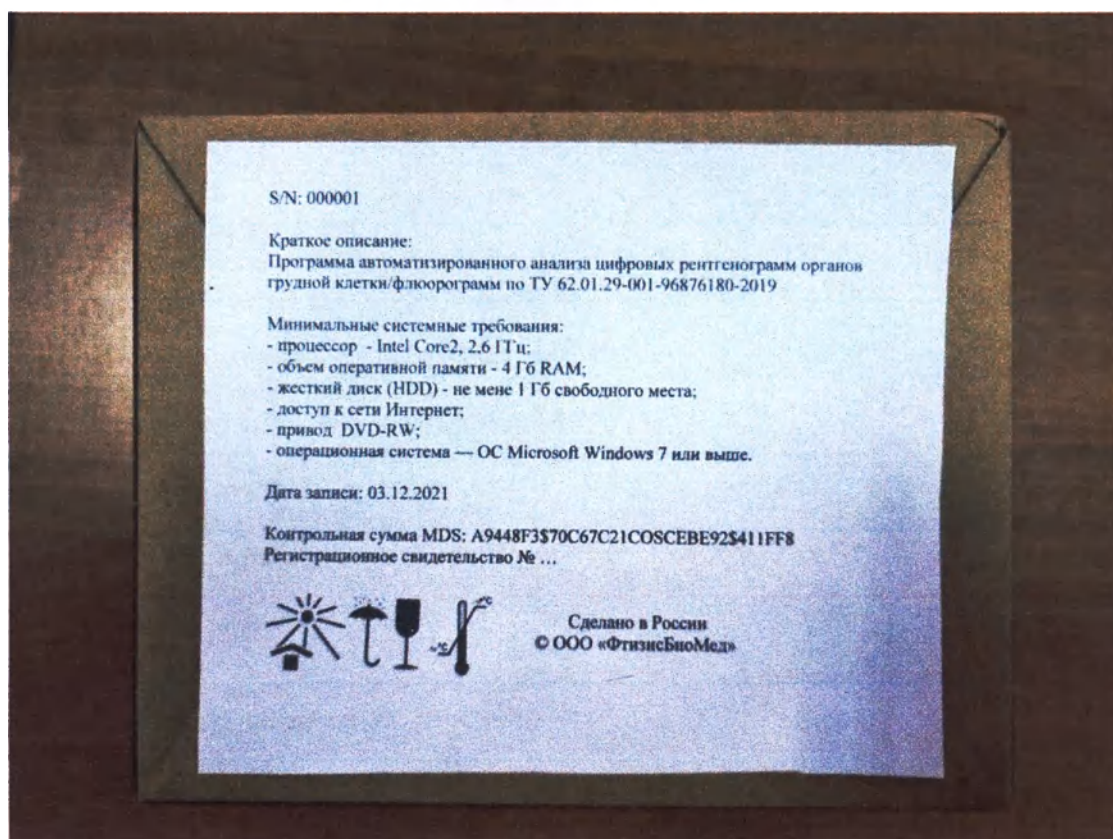

Индивидуальный вид упаковки.



ФТИЗИСБИОМЕД
BIOMEDICAL TECHNOLOGIES

**ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОГРАММ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ/ФЛЮОРОГРАММ
ПО ТУ 62.01.29-001-96876180-2019**

ВЕР. 0.0.1

S/N: 000001



Краткое описание:

Программа автоматизированного анализа цифровых рентгенограмм
Органов грудной клетки/флюорограмм по ТУ 62.01.29-001-96876180-2019

Минимальные системные требования:

- процессор - Intel Core2, 2,6 ГГц;
- объем оперативной памяти - 4 Гб RAM;
- жесткий диск (HDD) - не менее 1 Гб свободного места;
- доступ к сети Интернет;
- привод DVD-RW;
- операционная система — ОС Microsoft Windows 7 или выше.


Дата записи: 03.12.2021

Контрольная сумма MDS: A9448F3\$70C67C21COSCEBE92\$411FF8
Регистрационное свидетельство № ...



Сделано в России
© ООО «ФтизисБиоМед»

Маркировка упаковки.

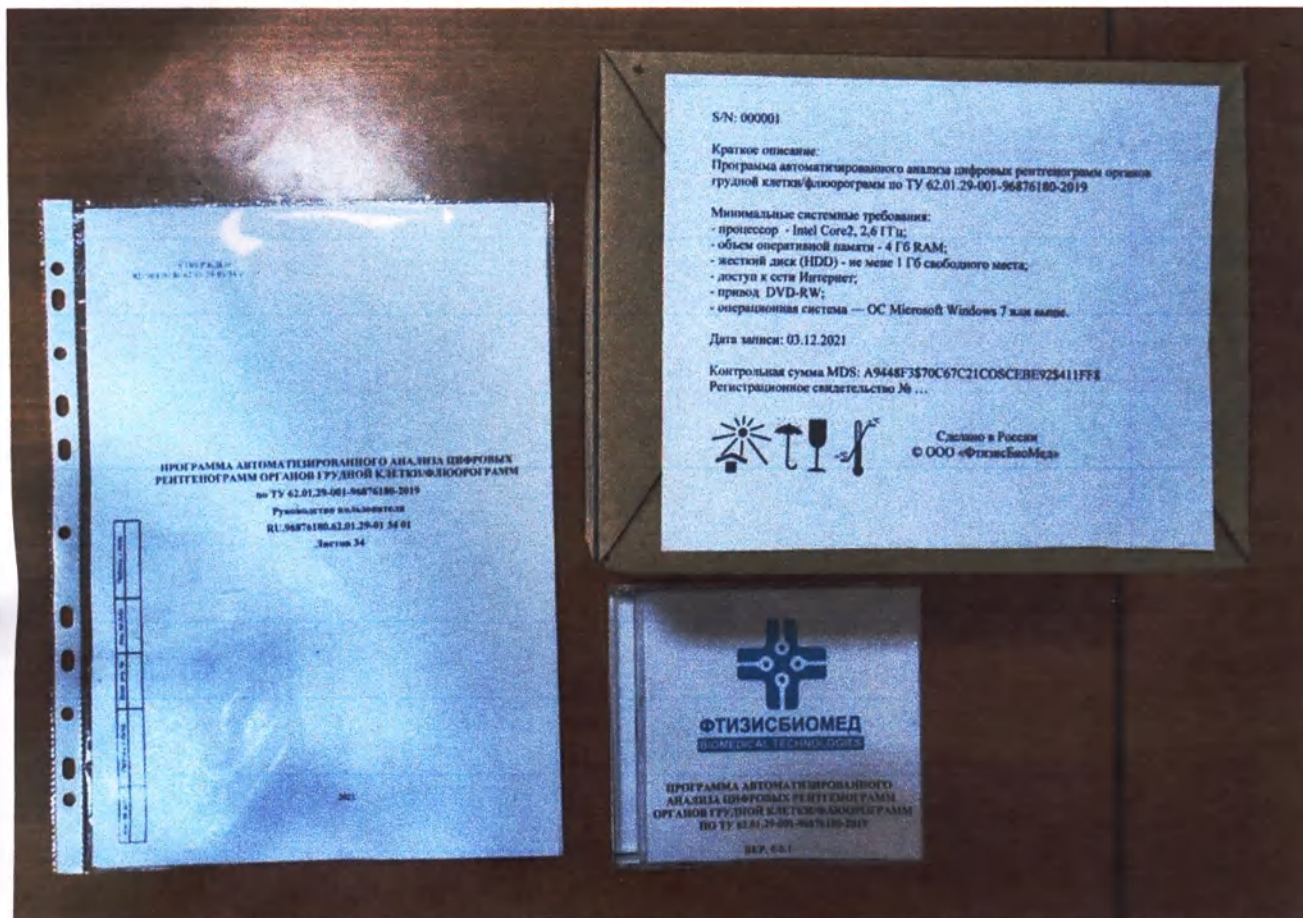

Общий вид изделия и индивидуальной упаковки.

5 (пять) ЛИСТОВ.

М.В.Кудрина

