


Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибя- CBL18/03, 18G x 3 см; CBL18/05, 18G x 5 см; CBL18/09, 18G x 9 см; CBL18/10, 18G x 10 см; CBL18/11, 18G x 11 см; CBL18/15, 18G x 15 см; CBL18/20, 18G x 20 см; CBL18/25, 18G x 25 см; CBL18/35, 18G x 35 см; CBL19/09, 19G x 9 см; CBL19/11, 19G x 11 см; CBL19/15, 19G x 15 см; CBL19/20, 19G x 20 см; CBL20/03, 20G x 3 см; CBL20/05, 20G x 5 см; CBL20/09, 20G x 9 см; CBL20/10, 20G x 10 см; CBL20/11, 20G x 11 см; CBL20/15, 20G x 15 см; CBL20/20, 20G x 20 см; CBL20/25, 20G x 25 см; CBL20/35, 20G x 35 см; CBL21/03, 21G x 3 см; CBL21/05, 21G x 5 см; CBL21/09, 21G x 9 см; CBL21/10, 21G x 10 см; CBL21/11, 21G x 11 см; CBL21/15, 21G x 15 см; CBL21/20, 21G x 20 см; CBL21/25, 21G x 25 см; CBL22/03, 22G x 3 см; CBL22/05, 22G x 5 см; CBL22/09, 22G x 9 см; CBL22/11, 22G x 11 см; CBL22/15, 22G x 15 см; CBL22/20, 22G x 20 см; CBL22/25, 22G x 25 см; CBL22/30, 22G x 30 см; CBL23/05, 23G x 5 см; CBL23/09, 23G x 9 см; CBL23/11, 23G x 11 см; CBL23/15, 23G x 15 см; CBL23/20, 23G x 20 см; CBL23/25, 23G x 25 см; CBL25/03, 25G x 3 см; CBL25/05, 25G x 5 см; CBL25/09, 25G x 9 см; CBL25/11, 25G x 11 см; CBL25/15, 25G x 15 см; CBL25/20, 25G x 20 см; CBL25/25, 25G x 25 см

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибэ- 18/03, 18G x 3 см

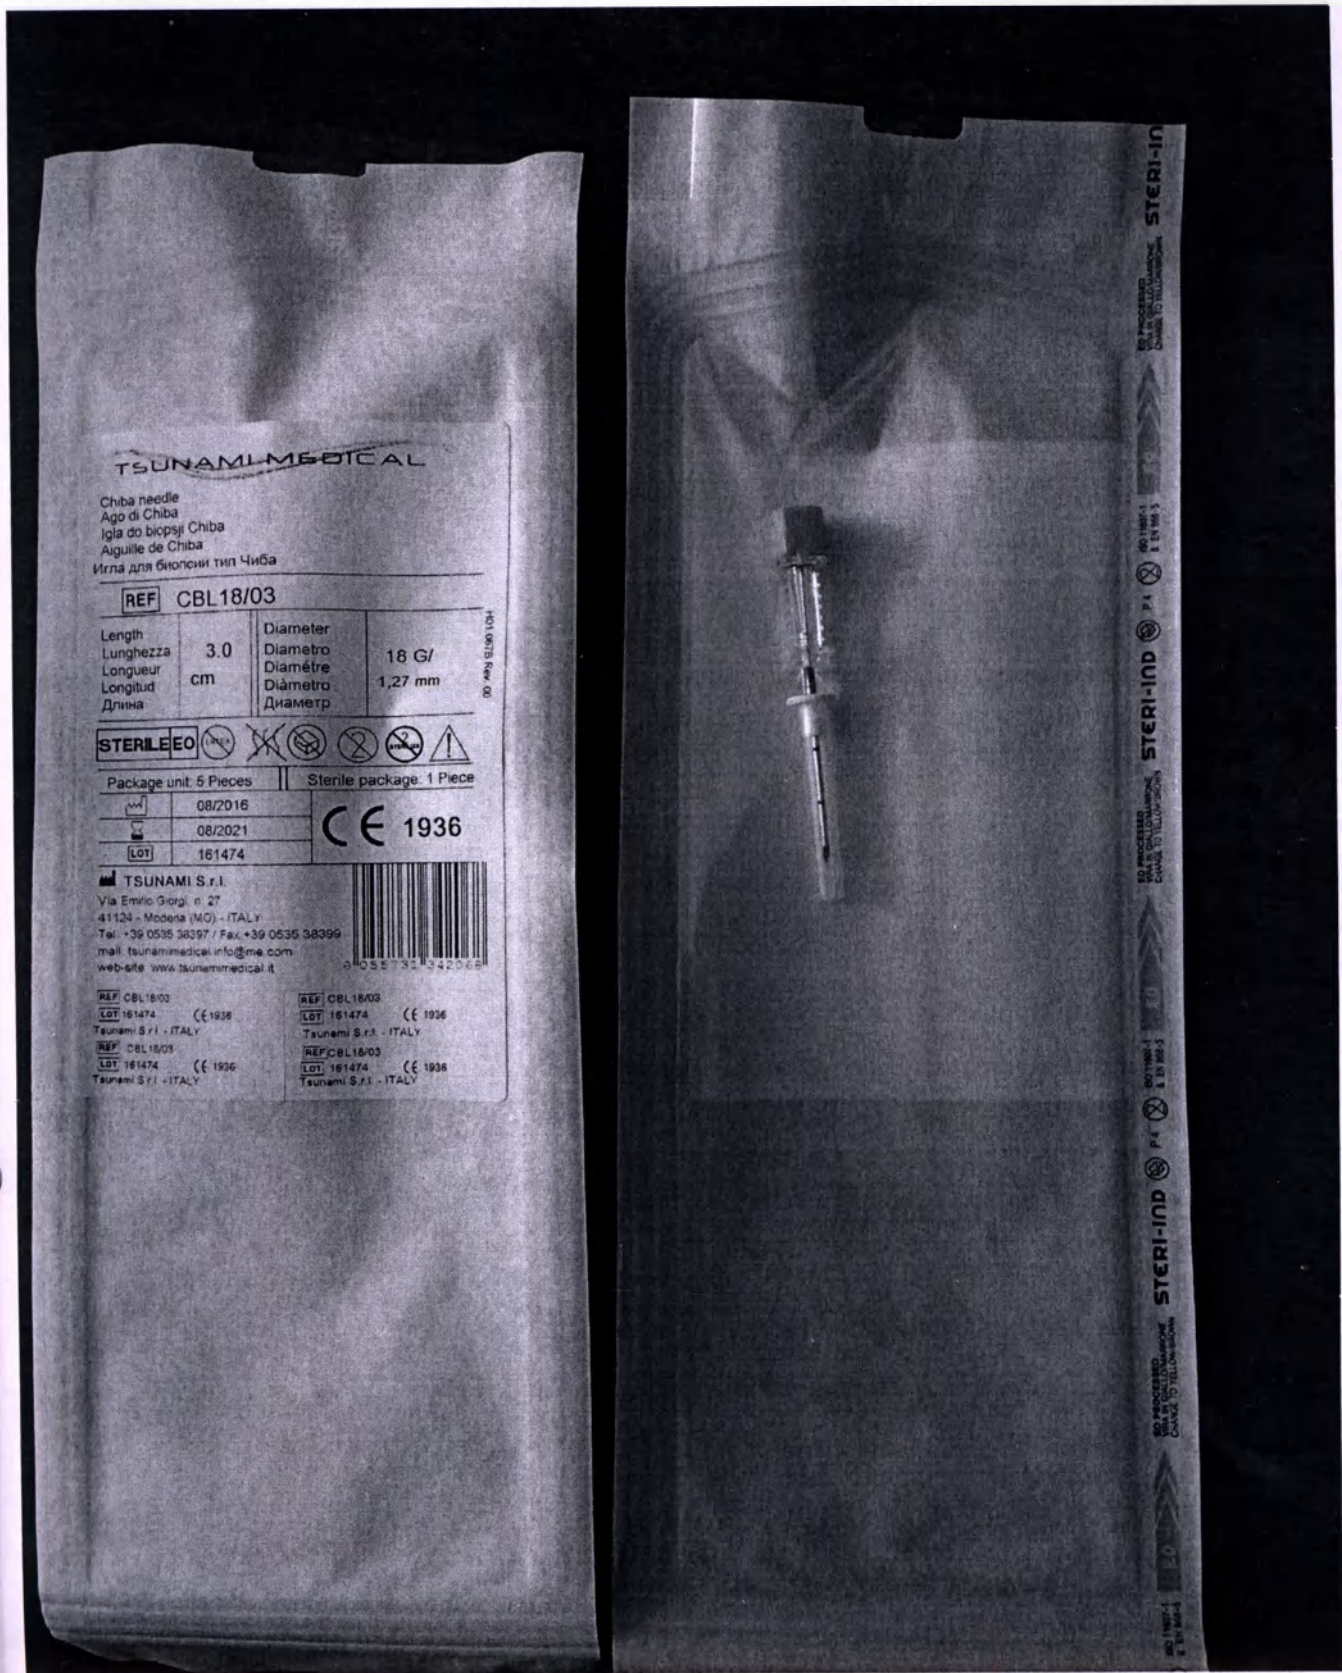


Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибя, эхогенная - CBL18/03E, 18G x 3 см; CBL18/05E, 18G x 5 см; CBL18/09E, 18G x 9 см; CBL18/11E, 18G x 11 см; CBL18/15E, 18G x 15 см; CBL18/20E, 18G x 20 см; CBL18/25E, 18G x 25 см; CBL18/35E, 18G x 35 см; CBL20/03E, 20G x 3 см; CBL20/05E, 20G x 5 см; CBL20/09E, 20G x 9 см; CBL20/11E, 20G x 11 см; CBL20/15E, 20G x 15 см; CBL20/20E, 20G x 20 см; CBL20/25E, 20G x 25 см; CBL20/35E, 20G x 35 см; CBL21/03E, 21G x 3 см; CBL21/05E, 21G x 5 см; CBL21/09E, 21G x 9 см; CBL21/11E, 21G x 11 см; CBL21/15E, 21G x 15 см; CBL21/20E, 21G x 20 см; CBL21/25E, 21G x 25 см; CBL22/03E, 22G x 3 см; CBL22/05E, 22G x 5 см; CBL22/09E, 22G x 9 см; CBL22/11E, 22G x 11 см; CBL22/15E, 22G x 15 см; CBL22/20E, 22G x 20 см; CBL22/25E, 22G x 25 см; CBL23/05E, 23G x 5 см; CBL23/09E, 23G x 9 см; CBL23/11E, 23G x 11 см; CBL23/15E, 23G x 15 см; CBL23/20E, 23G x 20 см; CBL23/25E, 23G x 25 см; CBL25/03E, 25G x 3 см; CBL25/05E, 25G x 5 см; CBL25/09E, 25G x 9 см; CBL25/11E, 25G x 11 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибя, эхогенная- CBL25/11E, 25G x 11 см;

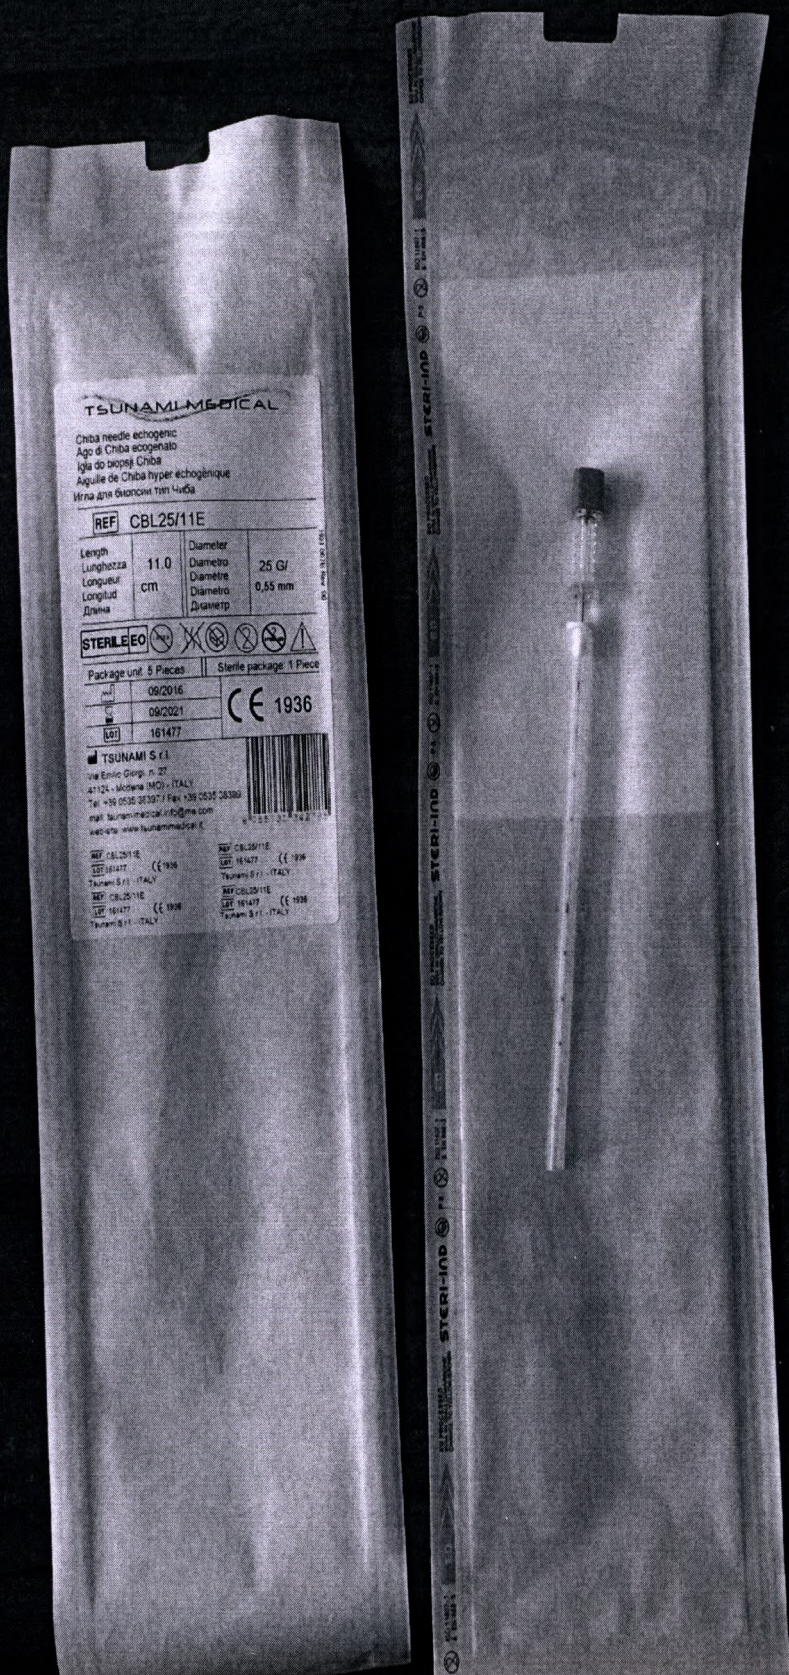

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чиза, срез Квинке- QBL18/03, 18G x 3 см; QBL18/05, 18G x 5 см;; QBL18/09, 18G x 9 см; QBL18/11, 18G x 11 см; QBL18/15, 18G x 15 см; QBL18/20, 18G x 20 см; QBL18/25, 18G x 25 см; QBL18/30, 18G x 30 см; QBL18/35, 18G x 35 см; QBL20/03, 20G x 3 см; QBL20/05, 20G x 5 см; QBL20/09, 20G x 9 см; QBL20/11, 20G x 11 см; QBL20/15, 20G x 15 см; QBL20/20, 20G x 20 см; QBL20/25, 20G x 25 см; QBL20/35, 20G x 35 см; QBL21/03, 21G x 3 см; QBL21/05, 21G x 5 см; QBL21/09, 21G x 9 см; QBL21/11, 21G x 11 см; QBL21/15, 21G x 15 см; QBL21/20, 21G x 20 см; QBL21/25, 21G x 25 см; QBL22/03, 22G x 3 см; QBL22/05, 22G x 5 см; QBL22/09, 22G x 9 см; QBL22/11, 22G x 11 см; QBL22/15, 22G x 15 см; QBL22/20, 22G x 20 см; QBL22/25, 22G x 25 см; QBL25/03, 25G x 3 см; QBL25/05, 25G x 5 см; QBL25/09, 25G x 9 см; QBL25/11, 25G x 11 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибя, срез Квинке - QBL21/15, 21G x 15 см;



Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чибя, срез Квинке, эхогенная- QBL18/03E, 18G x 3 см; QBL18/05E, 18G x 5 см; QBL18/09E, 18G x 9 см; QBL18/11E, 18G x 11 см; QBL18/15E, 18G x 15 см; QBL18/20E, 18G x 20 см; QBL18/25E, 18G x 25 см; QBL18/35E, 18G x 35 см; QBL20/03E, 20G x 3 см; QBL20/05E, 20G x 5 см; QBL20/09E, 20G x 9 см; QBL20/11E, 20G x 11 см; QBL20/15E, 20G x 15 см; QBL20/20E, 20G x 20 см; QBL20/25E, 20G x 25 см; QBL20/35E, 20G x 35 см; QBL21/03E, 21G x 3 см; QBL21/05E, 21G x 5 см; QBL21/09E, 21G x 9 см; QBL21/11E, 21G x 11 см; QBL21/15E, 21G x 15 см; QBL21/20E, 21G x 20 см; QBL21/25E, 21G x 25 см; QBL22/03E, 22G x 3 см; QBL22/05E, 22G x 5 см; QBL22/09E, 22G x 9 см; QBL22/11E, 22G x 11 см; QBL22/15E, 22G x 15 см; QBL22/20E, 22G x 20 см; QBL22/25E, 22G x 25 см; QBL25/03E, 25G x 3 см; QBL25/05E, 25G x 5 см; QBL25/09E, 25G x 9 см; QBL25/11E, 25G x 11 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Чива, срез Квинке, эхогенная- QBL21/15E, 21G x 15 см




Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнении

Игла для биопсии тип Франзена - FBL18/10,18G x 10 cm; FBL18/15,18G x 15 cm; FBL18/20,18G x 20 cm; FBL18/25,18G x 25 cm; FBL19/10,19G x 10 cm; FBL19/15,19G x 15 cm; FBL19/20,19G x 20 cm; FBL19/25,19G x 25 cm; FBL20/10,20G x 10 cm; FBL20/15,20G x 15 cm; FBL20/20,20G x 20 cm; FBL20/25,20G x 25 cm; FBL21/10,21G x 10 cm; FBL21/15,21G x 15 cm; FBL21/20,21G x 20 cm; FBL21/25,21G x 25 cm; FBL22/10,22G x 10 cm; FBL22/15,22G x 15 cm; FBL22/20,22G x 20 cm; FBL22/25,22G x 25 cm;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Франзена- FBL22/25,22G x 25 см;

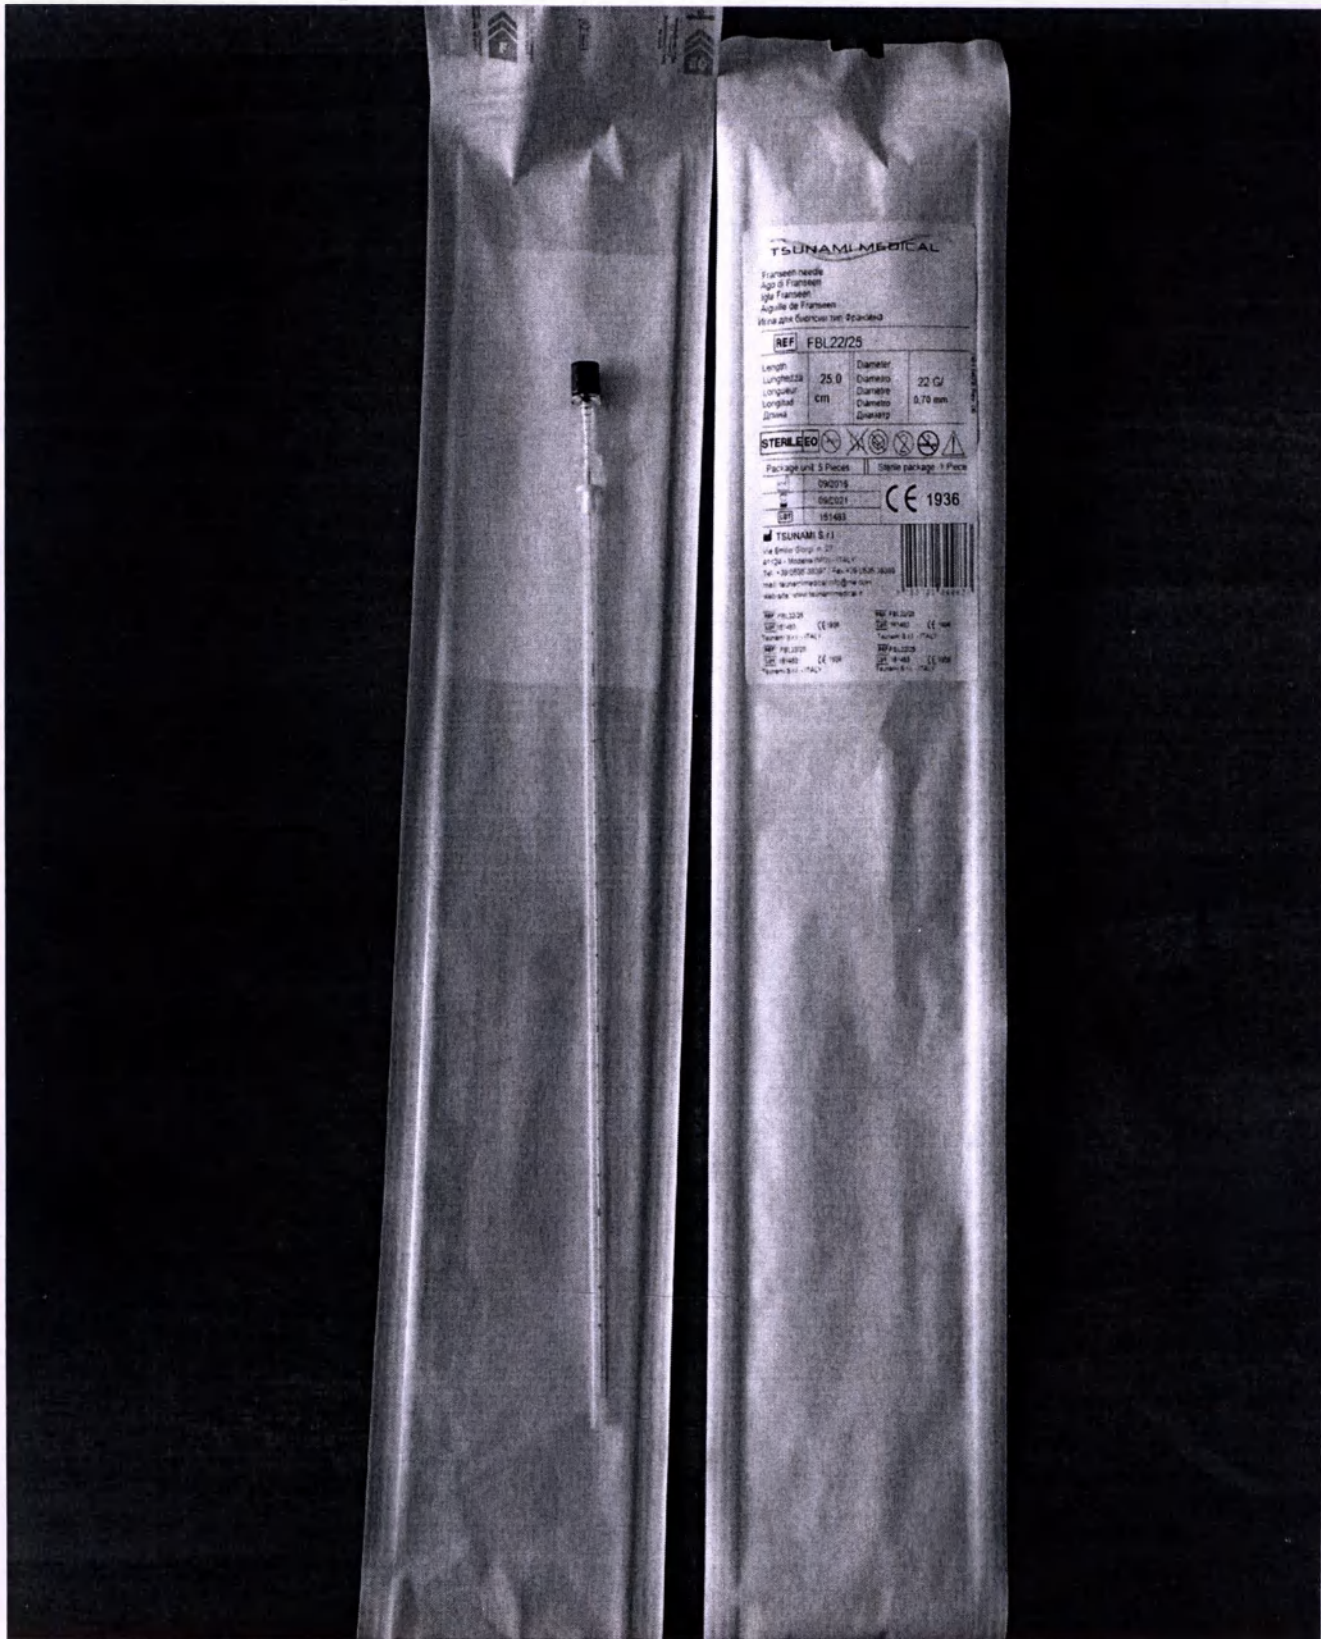

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Франзена, эхогенная- FBL18/10E,18G x 10 см; FBL18/15E,18G x 15 см; FBL18/20E,18G x 20 см; FBL18/25E,18G x 25 см; FBL19/10E,19G x 10 см; FBL19/15E,19G x 15 см; FBL19/20E,19G x 20 см; FBL19/25E,19G x 25 см; FBL20/10E,20G x 10 см; FBL20/15E,20G x 15 см; FBL20/20E,20G x 20 см; FBL20/25E,20G x 25 см; FBL21/10E,21G x 10 см; FBL21/15E,21G x 15 см; FBL21/20E,21G x 20 см; FBL21/25E,21G x 25 см; FBL22/10E,22G x 10 см; FBL22/15E,22G x 15 см; FBL22/20E,22G x 20 см; FBL22/25E,22G x 25 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Франзена, эхогенная - FBL22/25E, 22G x 25 см;




Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии гистологическая- IBL16/10,16G x 10 см; IBL16/15,16G x 15 см; I BL16/20,16G x 20 см;IBL18/10,18G x 10 см;IBL18/15,18G x 15 см;IBL18/20,18G x 20 см;IBL19/10,19G x 10 см;IBL19/15,19G x 15 см;IBL19/20,19G x 20 см;IBL20/10,20G x 10 см;IBL22/10,22G x 10 см;IBL20/15,20G x 15 см;IBL20/20,20G x 20 см;IBL21/10,21G x 10 см;IBL21/15,21G x 15 см;IBL21/20,21G x 20 см;IBL22/15,22G x 15 см;IBL22/20,22G x20 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии гистологическая- 16/10,16G x 10 см

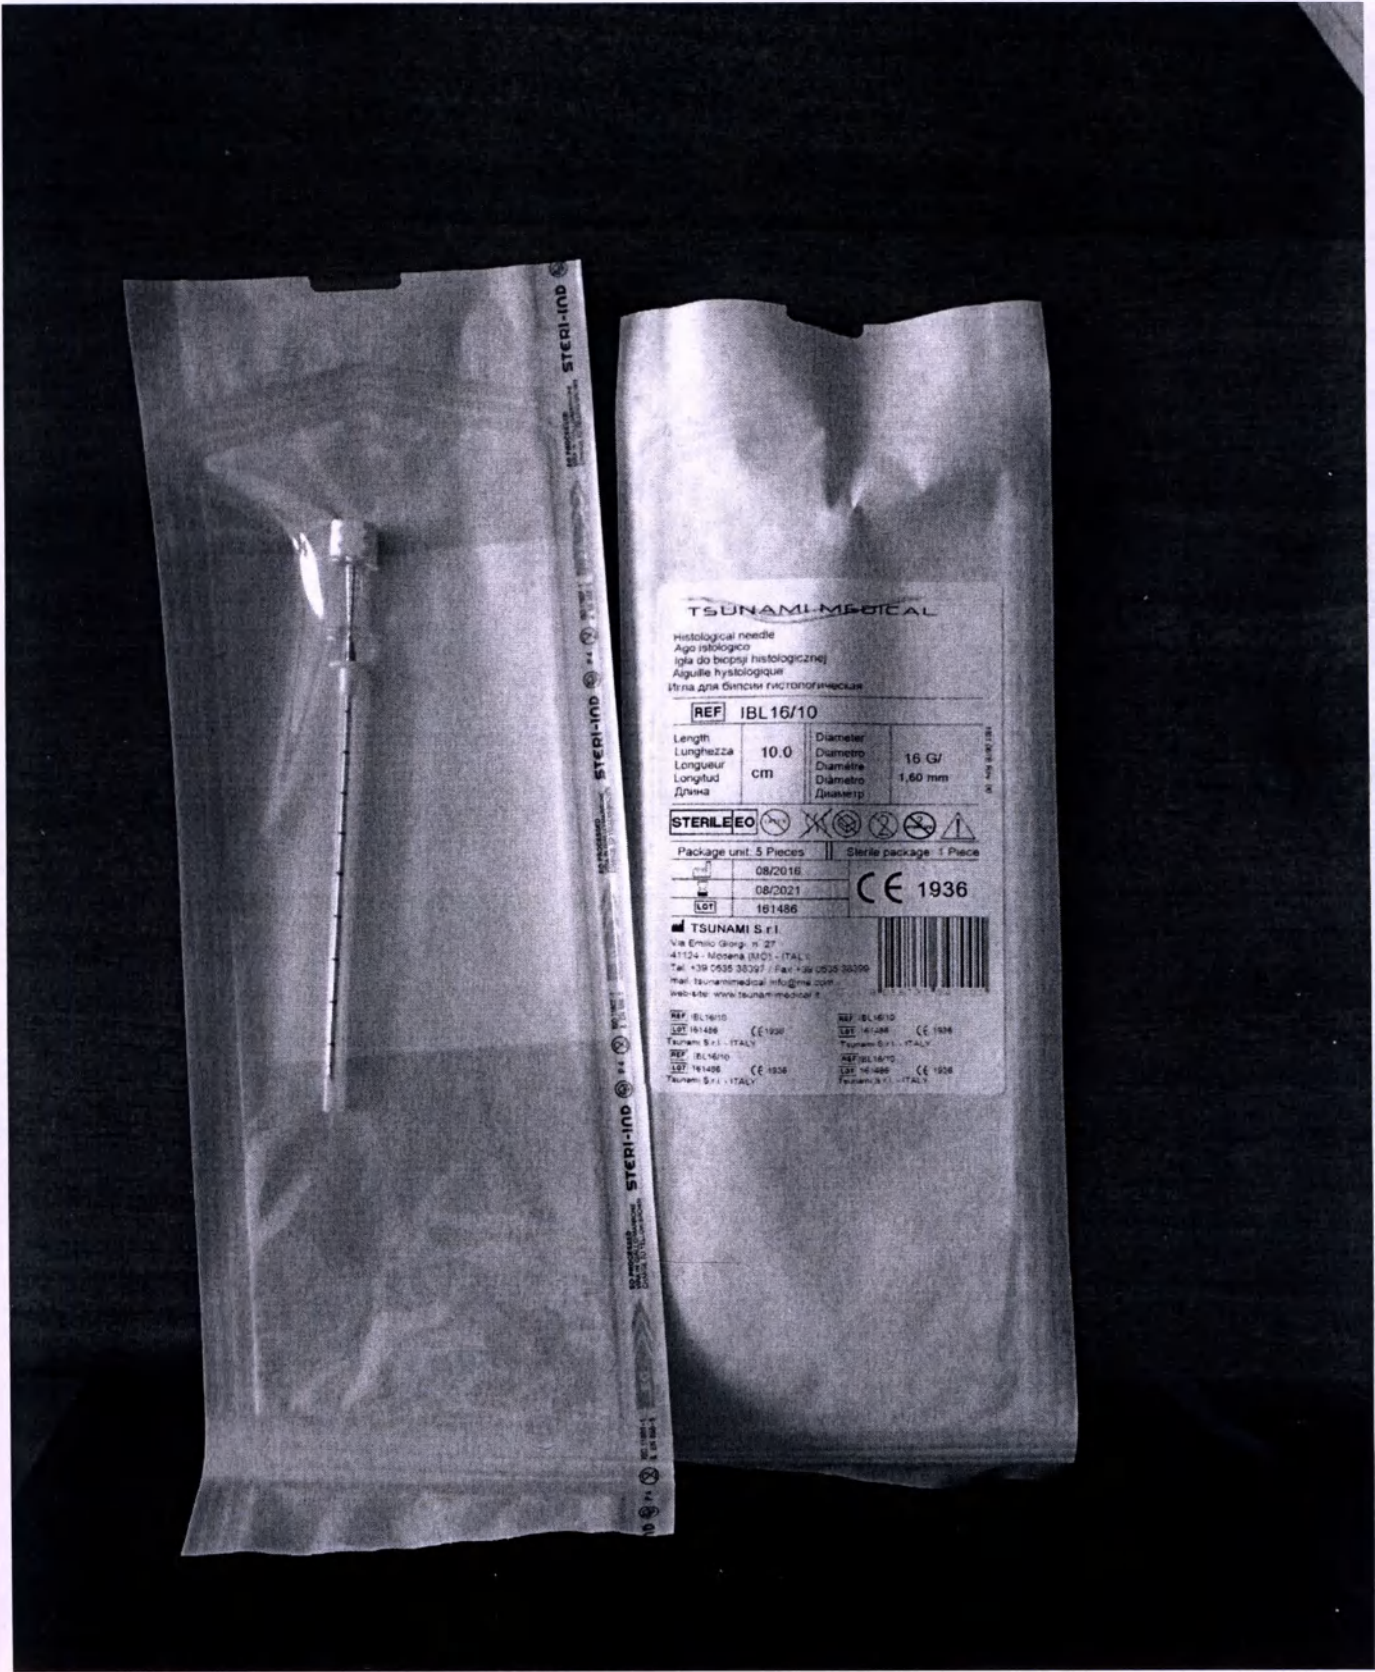


Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии гистологическая, эхогенная- IBL16/10E,16G x 10 см;IBL16/15E,16G x 15 см;IBL16/20E,16G x 20 см;IBL18/10E,18G x 10 см;IBL18/15E,18G x 15 см;IBL18/20E,18G x 20 см;IBL19/10E,19G x 10 см;IBL19/15E,19G x 15 см;IBL19/20E,19G x 20 см;IBL20/10E,20G x 10 см;IBL20/15E,20G x 15 см;IBL20/20E,20G x 20 см;IBL21/10E,21G x 10 см;IBL21/15E,21G x 15 см;IBL21/20E,21G x 20 см;IBL22/15E,22G x 15 см;IBL22/20E,22G x 20 см;IBL22/10E,22G x 10 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях


Игла для биопсии гистологическая, эхогенная -- IBL16/10E,16G x 10

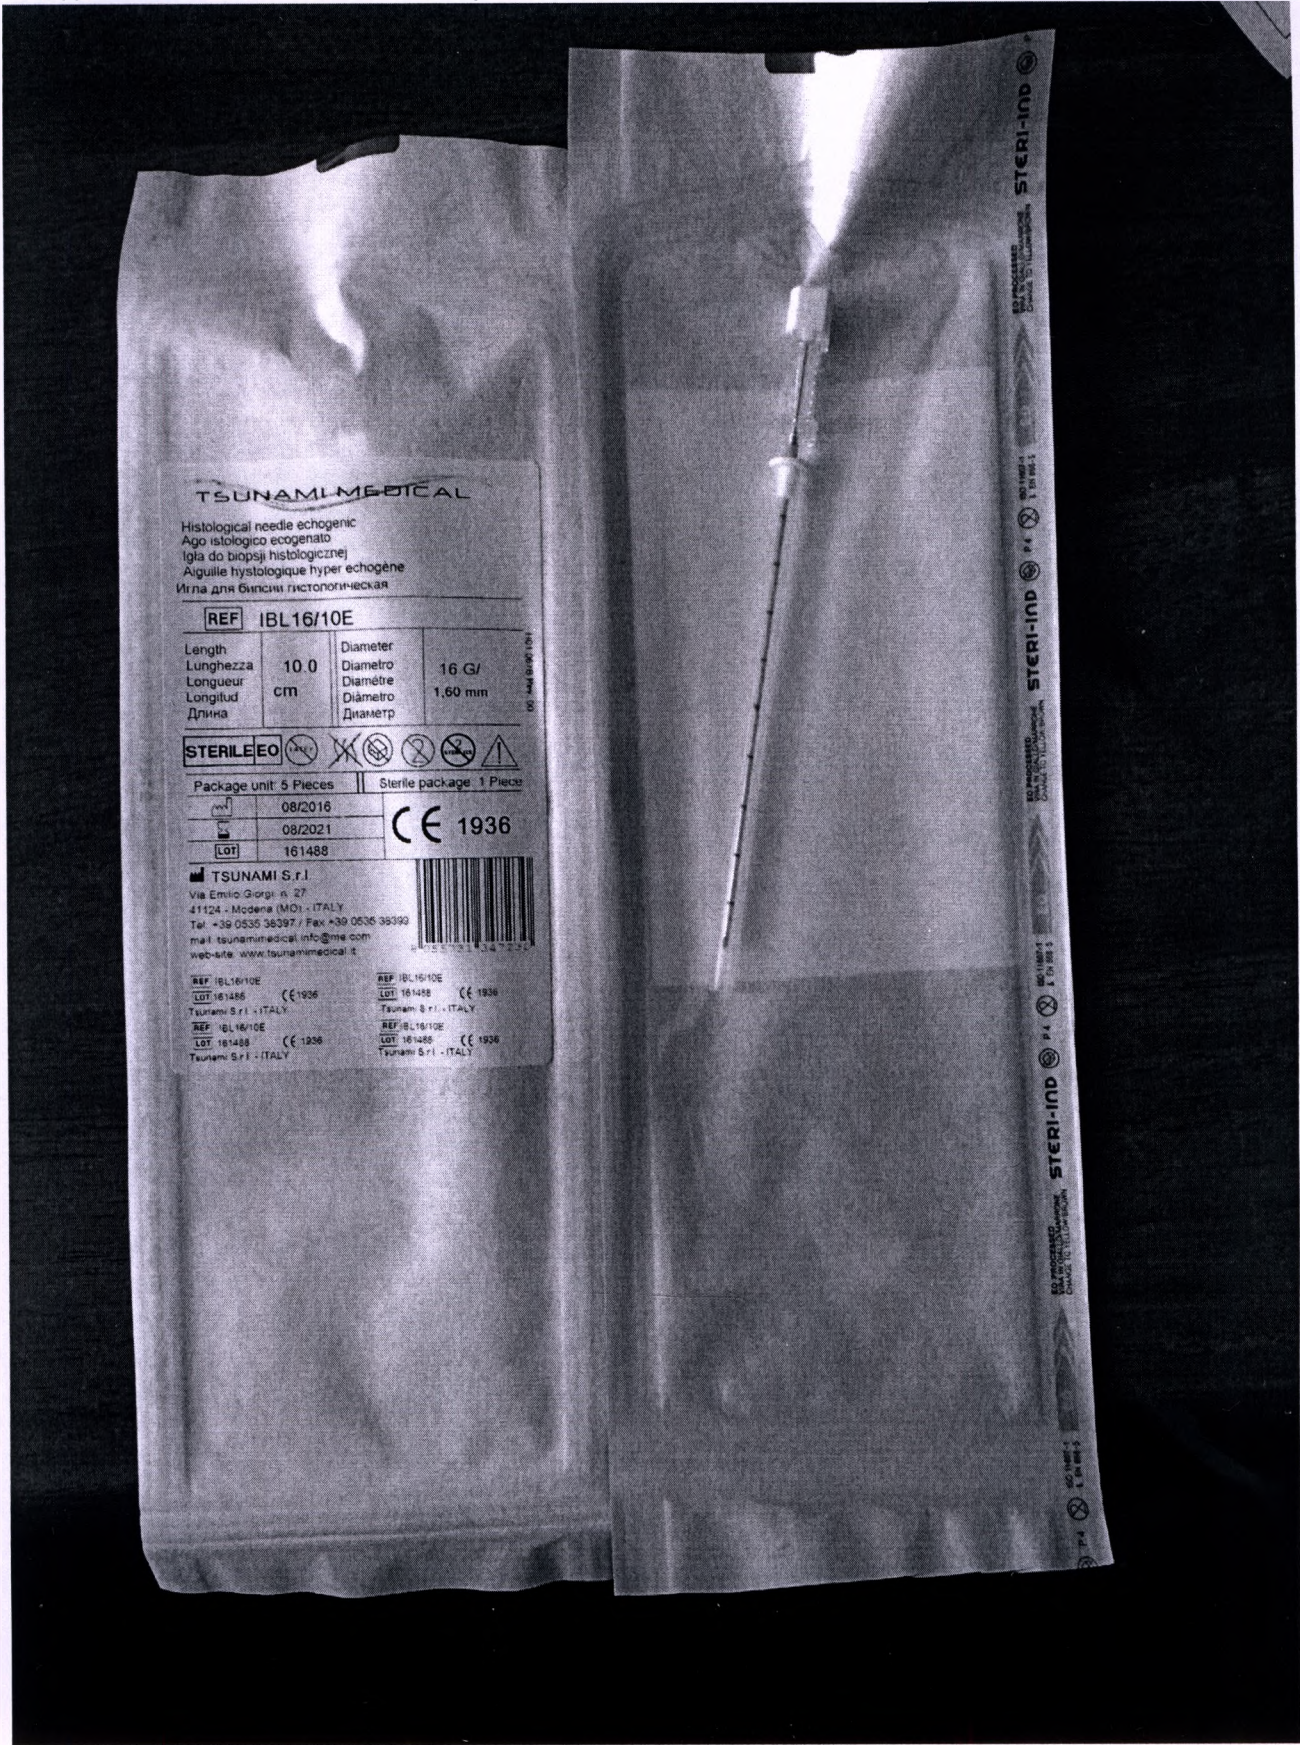

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Весткотт- WBL18/10,18G x 10 см;WBL18/15,18G x 15 см;WBL18/20,18G x 20 см;WBL18/25,18G x 25 см;WBL19/10,19G x 10 см;WBL19/15,19G x 15 см;WBL19/20,19G x 20 см;WBL19/25,19G x 25 см;WBL20/10,20G x 10 см;WBL20/15,20G x 15 см;WBL20/20,20G x 20 см;WBL20/25,20G x 25 см;WBL21/10,21G x 10 см;WBL21/15,21G x 15 см;WBL21/20,21G x 20 см;WBL21/25,21G x 25 см;WBL22/10,22G x 10 см;WBL22/15,22G x 15 см;WBL22/20,22G x 20 см;WBL22/25,22G x 25 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

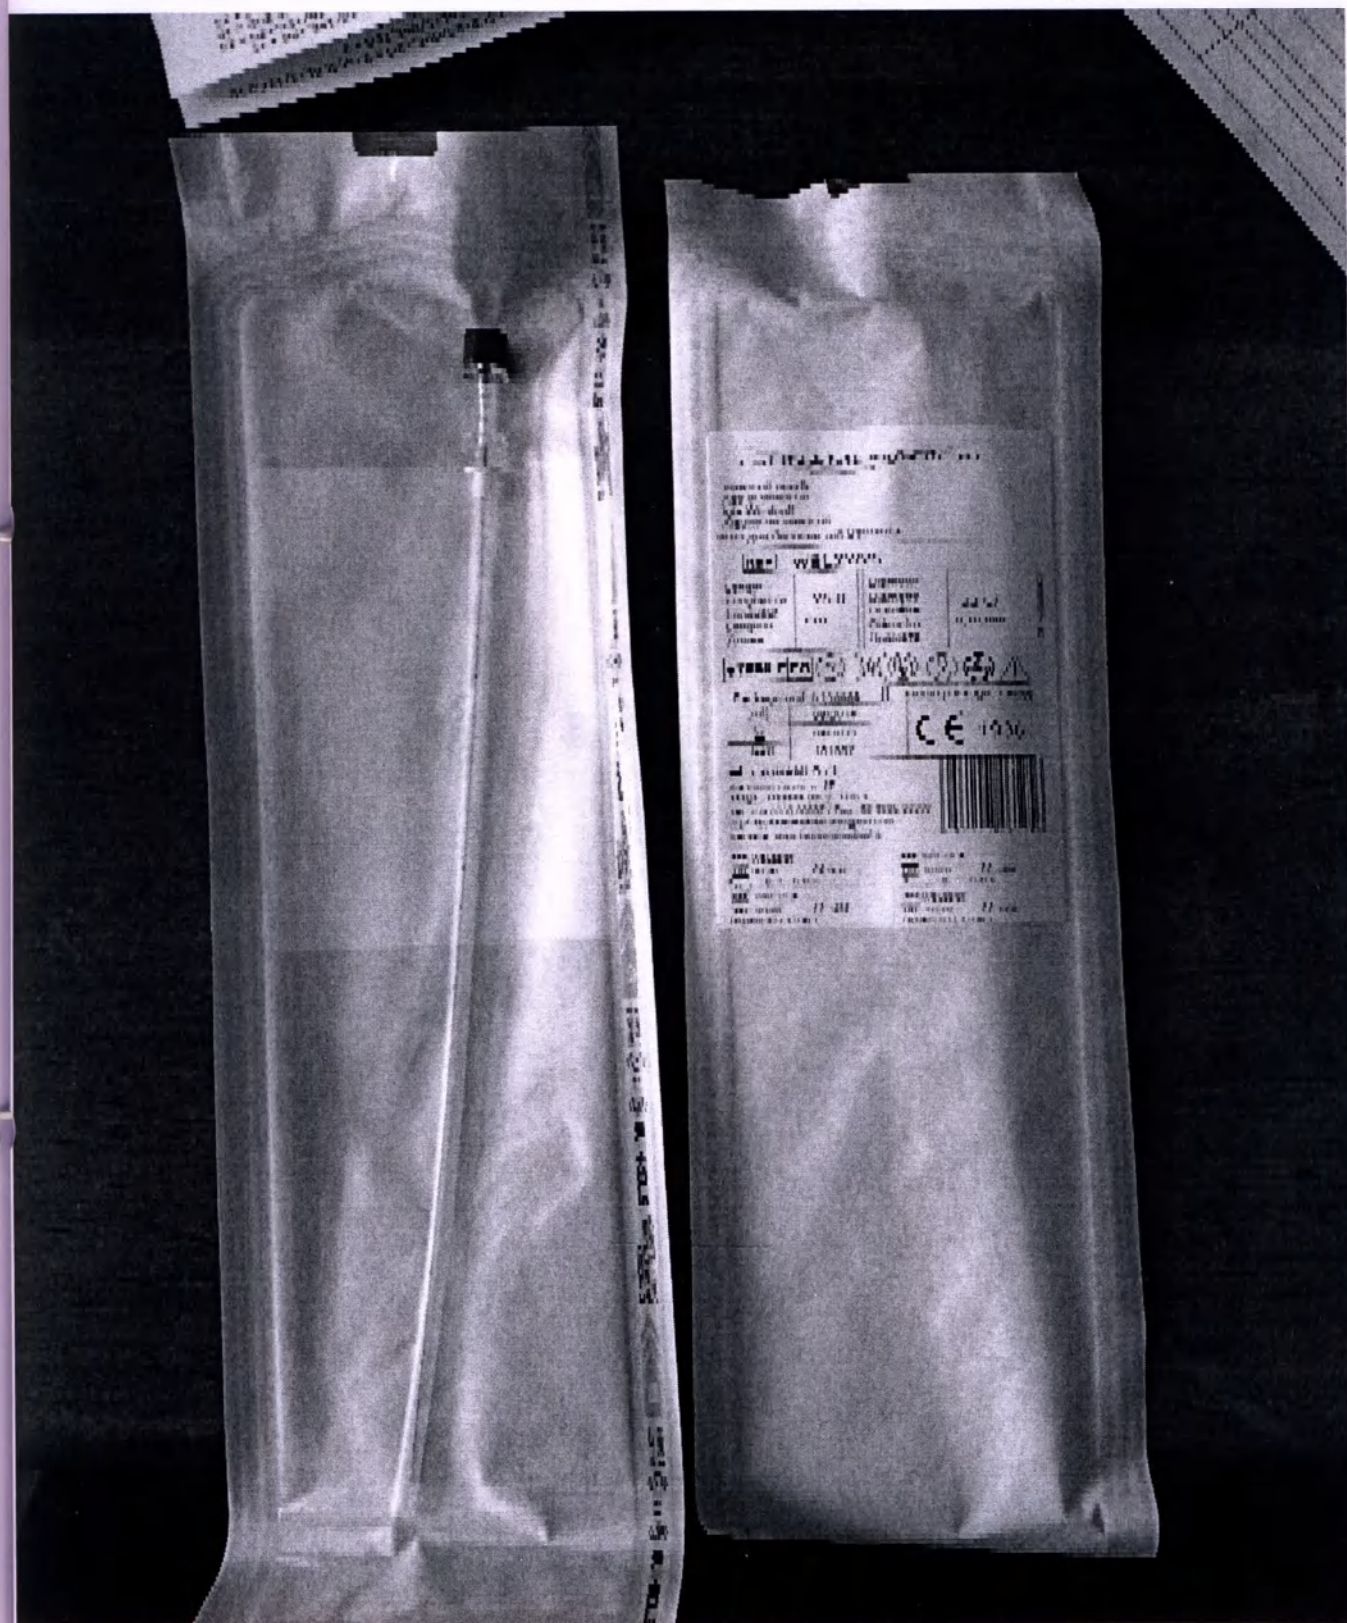


Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная- WBL18/10E, 18G x 10 см; WBL18/15E, 18G x 15 см; WBL18/20E, 18G x 20 см; WBL18/25E, 18G x 25 см; WBL19/10E, 19G x 10 см; WBL19/15E, 19G x 15 см; WBL19/20E, 19G x 20 см; WBL19/25E, 19G x 25 см; WBL20/10E, 20G x 10 см; WBL20/15E, 20G x 15 см; WBL20/20E, 20G x 20 см; WBL20/25E, 20G x 25 см; WBL21/10E, 21G x 10 см; WBL21/15E, 21G x 15 см; WBL21/20E, 21G x 20 см; WBL21/25E, 21G x 25 см; WBL22/10E, 22G x 10 см; WBL22/15E, 22G x 15 см; WBL22/20E, 22G x 20 см; WBL22/25E, 22G x 25 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная- WBL22/25E,22G x 25 см

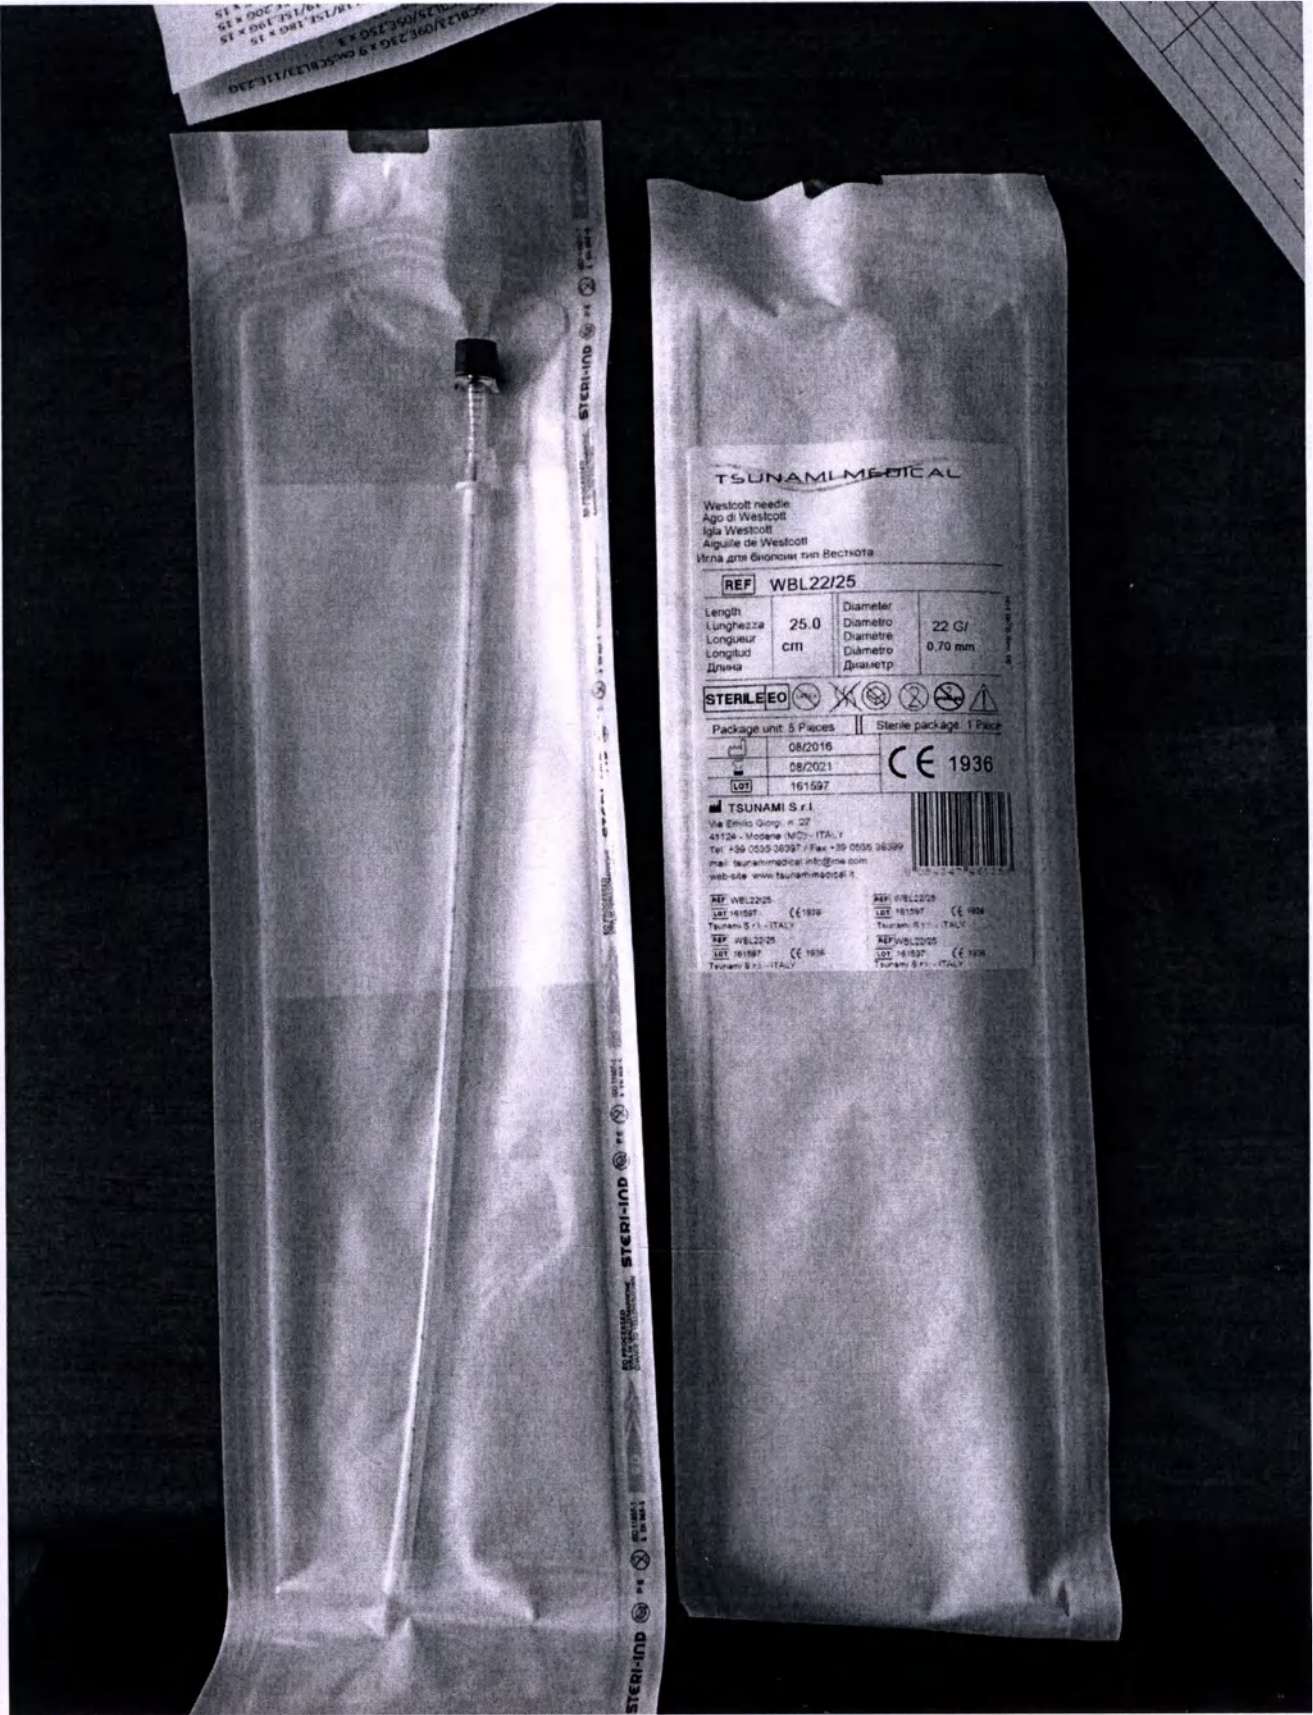

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чибя- SCBL16/09,16G x 9 см; SCBL16/20,16G x 20 см; SCBL18/03,18G x 3 см; SCBL18/05,18G x 5 см; SCBL18/09,18G x 9 см; SCBL18/11,18G x 11 см; SCBL18/15,18G x 15 см; SCBL18/20,18G x 20 см; SCBL18/25,18G x 25 см; SCBL20/03,20G x 3 см; SCBL20/05,20G x 5 см; SCBL20/09,20G x 9 см; SCBL20/11,20G x 11 см; SCBL20/12,20G x 12 см; SCBL20/15,20G x 15 см; SCBL20/16,20G x 16 см; SCBL20/20,20G x 20 см; SCBL21/03,21G x 3 см; SCBL21/05,21G x 5 см; SCBL21/09,21G x 9 см; SCBL21/10,21G x 10 см; SCBL21/11,21G x 11 см; SCBL21/12,21G x 12 см; SCBL21/15,21G x 15 см; SCBL21/18,21G x 18 см; SCBL21/20,21G x 20 см; SCBL22/03,22G x 3 см; SCBL22/05,22G x 5 см; SCBL22/09,22G x 9 см; SCBL22/11,22G x 11 см; SCBL22/15,22G x 15 см; SCBL22/20,22G x 20 см; SCBL22/30,22G x 30 см; SCBL23/03,23G x 3 см; SCBL23/05,23G x 5 см; SCBL23/09,23G x 9 см; SCBL23/11,23G x 11 см; SCBL23/15,23G x 15 см; SCBL23/20,23G x 20 см; SCBL25/03,25G x 3 см; SCBL25/05,25G x 5 см; SCBL25/09,25G x 9 см; SCBL25/11,25G x 11 см; SCBL25/15,25G x 15 см;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чибя - SCBL25/15,25G x 15 см;



Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чиба, эхогенная- SCBL18/03E,18G x 3 см;SCBL18/05E,18G x 5 см;SCBL18/09E,18G x 9 см;SCBL18/11E,18G x 11 см;SCBL18/15E,18G x 15 см;SCBL18/20E,18G x 20 см;SCBL20/03E,20G x 3 см;SCBL20/05E,20G x 5 см;SCBL20/09E,20G x 9 см;SCBL20/11E,20G x 11 см;SCBL20/15E,20G x 15 см;SCBL20/20E,20G x 20 см;SCBL21/03E,21G x 3 см;SCBL21/05E,21G x 5 см;SCBL21/09E,21G x 9 см;SCBL21/11E,21G x 11 см;SCBL21/15E,21G x 15 см;SCBL21/20E,21G x 20 см;SCBL22/03E,22G x 3 см;SCBL22/05E,22G x 5 см;SCBL22/09E,22G x 9 см;SCBL22/11E,22G x 11 см;SCBL22/15E,22G x 15 см;SCBL22/20E,22G x 20 см;SCBL23/03E,23G x 3 см;SCBL23/05E,23G x 5 см;SCBL23/09E,23G x 9 см;SCBL23/11E,23G x 11 см;SCBL23/15E,23G x 15 см;SCBL23/20E,23G x 20 см;SCBL25/05E,25G x 3 см;SCBL25/03E,25G x 5 см;SCBL25/09E,25G x 9 см;SCBL25/11E,25G x 11 см;SCBL25/15E,25G x 15 см;

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чиза, эхогенная SCBL25/15E, 25G x 15 см;



Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии 15/09,15G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии 16/09,16G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL17/09,17G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL18/09,18G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии 15/09, 15G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

TSUNAMI MEDICAL

Hepatic biopsy needle Menghini
Set per biopsia epatica Menghini
Zestaw do biopsji wątroby
Set pour biopsie hépatique Menghini
Игла для биопсии тип Менгини

REF		LBL15/09	
Length	9.0 cm	Diameter	15 G/ 1,80 mm
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diámetro	
Longitud		Diámetro	
Длина		Диаметр	

NOT 06/18 Rev. 00

STERILE EO     

Package unit: 10 Pieces | Sterile package: 1 Piece

	07/2015
	07/2020
LOT	150912


CE 1936

TSUNAMI S.r.l.
Via Emilio Giorgi n. 27
41124 - Modena (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 / Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedical.info@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF	LBL15/09	REF	LBL15/09
LOT	150912 CE 1936	LOT	150912 CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

REF	LBL15/09	REF	LBL15/09
LOT	150912 CE 1936	LOT	150912 CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

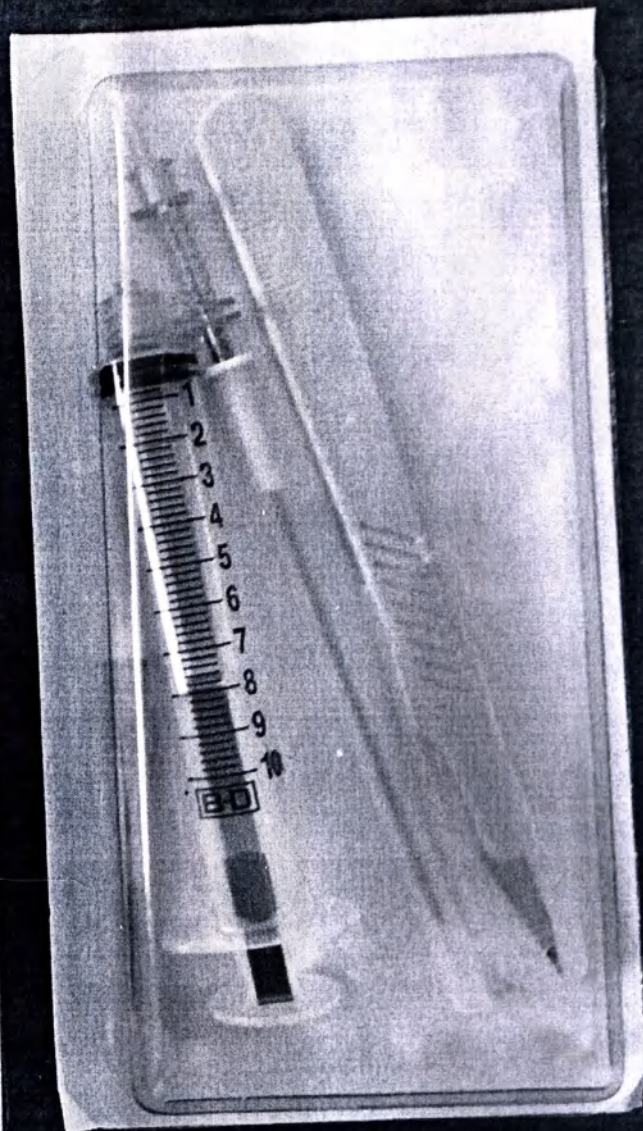

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL15/09E,15G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;


Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL16/09E,16G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL17/09E,17G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL18/09E,18G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях


Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL15/0 x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

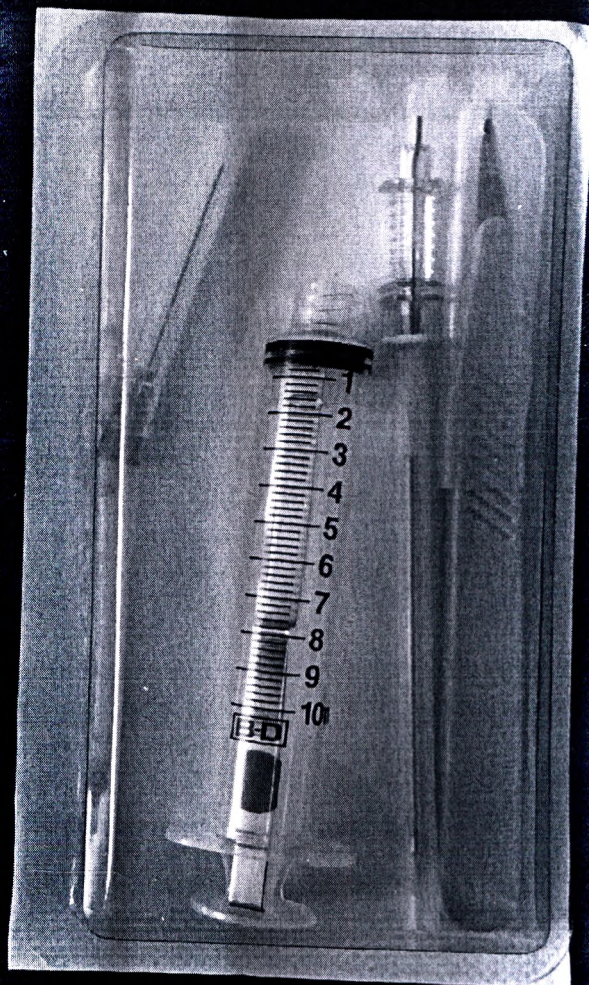

- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии - 16/10,16G x 10 см, шприц 10мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL16/15,16G x 15 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL16/20,16G x 20 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL16/25,16G x 25 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL18/10,18G x 10 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL18/15,18G x 15 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL18/20,18G x 20 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL18/25,18G x 25 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL20/10,20G x 10 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL20/15,20G x 15 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL20/20,20G x 20 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL20/25,20G x 25 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL21/10,21G x 10 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL21/15,21G x 15 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL21/20,21G x 20 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL21/25,21G x 25 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL22/10,22G x 10 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL22/15,22G x 15 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL22/20,22G x 20 см, шприц 10 мл;
- Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в составе:
игла для биопсии MBL22/25,22G x 25 см, шприц 10 мл;

Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках для выполнения

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, «модифицированный», в комплекте с шприцем 10 мл; игла для биопсии MBL20/15, 20G x 15 см, шприц 10 мл;

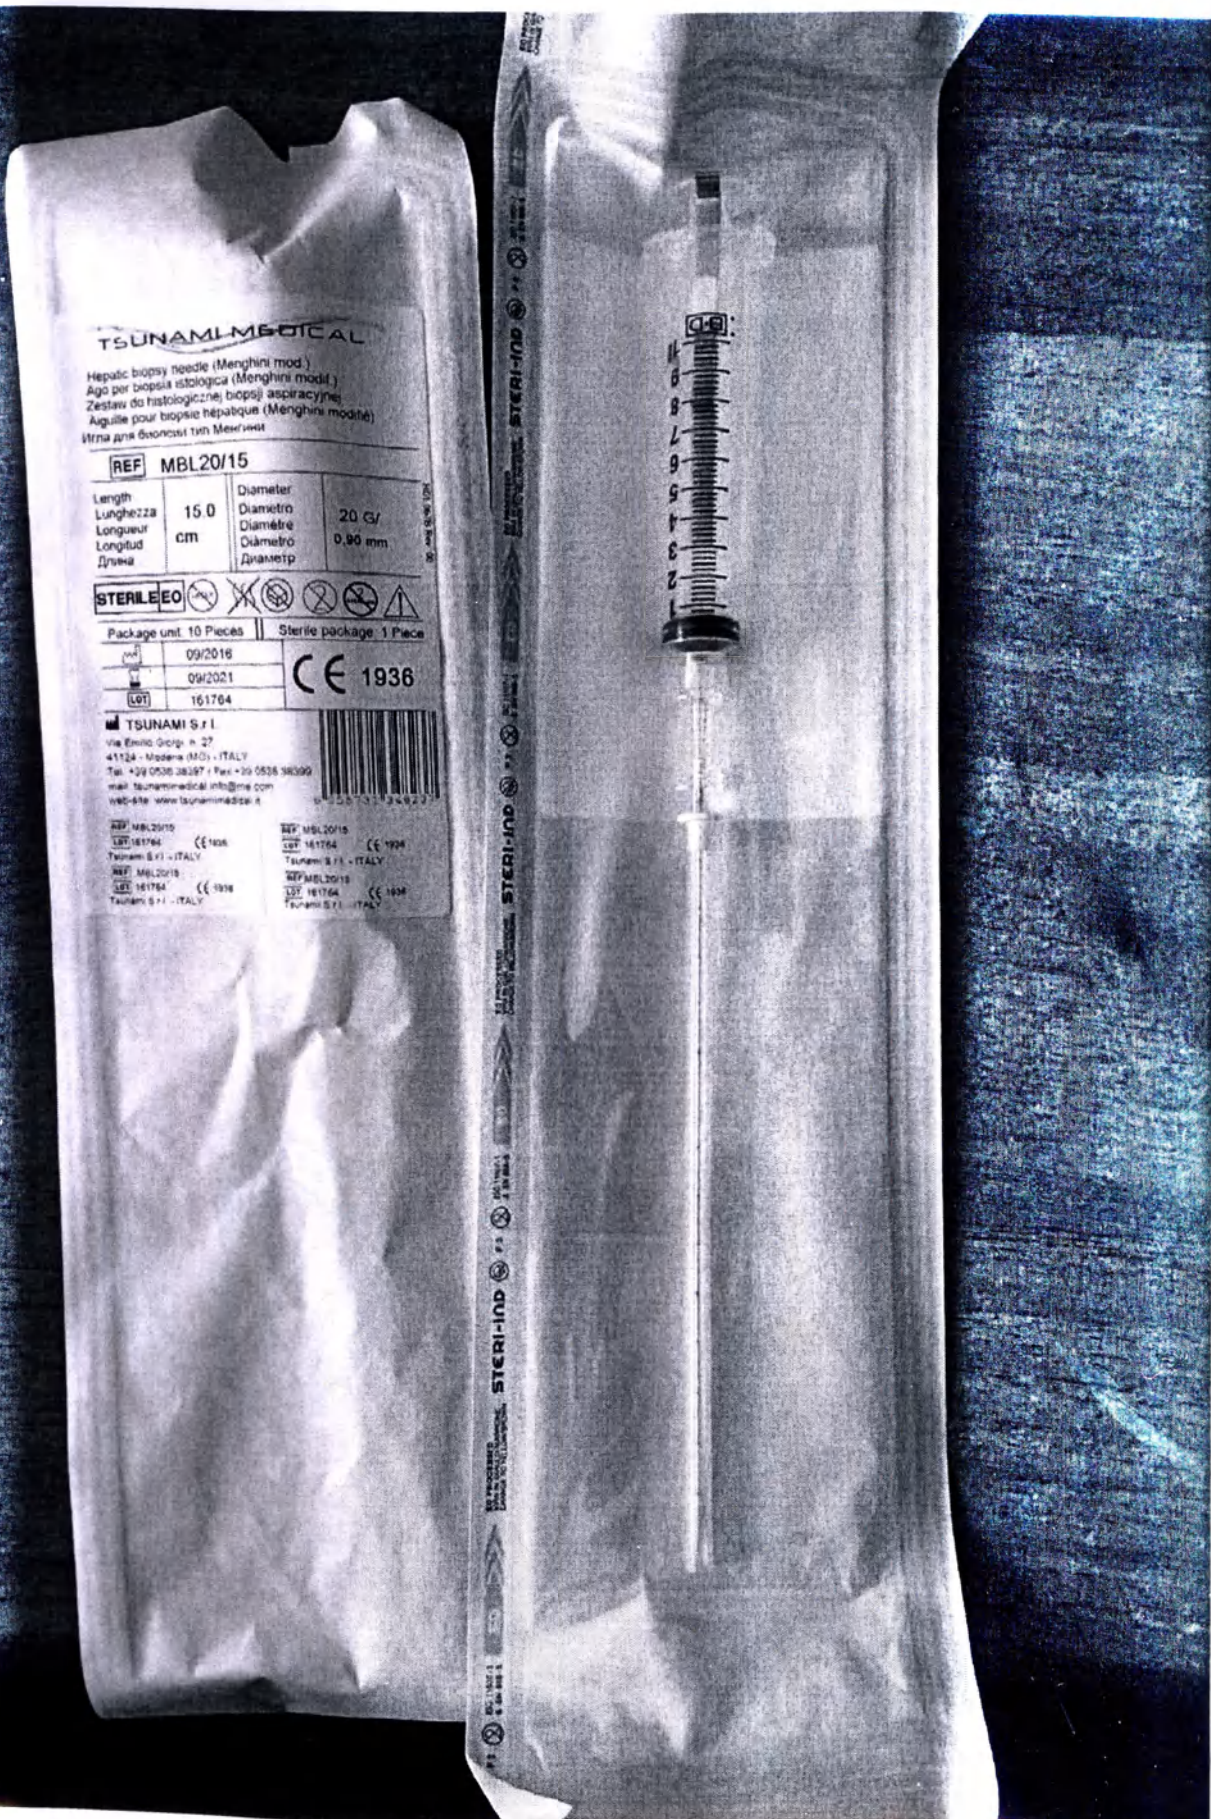

Принято и пронумеровано
30 (тридцать) листов



Handwritten signature in blue ink.

**Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"**

I. Игла для биопсии тип Чибя- CBL18/03, 18G x 3 см; CBL18/05, 18G x 5 см; CBL18/09, 18G x 9 см;
CBL18/10, 18G x 10 см; CBL18/11, 18G x 11 см; CBL18/15, 18G x 15 см; CBL18/20, 18G x 20 см;
CBL18/25, 18G x 25 см; CBL18/30, 18G x 30 см; CBL18/35, 18G x 35 см; CBL19/09, 19G x 9 см;
CBL19/11, 19G x 11 см; CBL19/15, 19G x 15 см; CBL19/20, 19G x 20 см; CBL20/03, 20G x 3 см;
CBL20/05, 20G x 5 см; CBL20/09, 20G x 9 см; CBL20/10, 20G x 10 см; CBL20/11, 20G x 11 см;
CBL20/15, 20G x 15 см; CBL20/20, 20G x 20 см; CBL20/25, 20G x 25 см; CBL20/30, 20G x 30 см;
CBL20/35, 20G x 35 см; CBL21/03, 21G x 3 см; CBL21/05, 21G x 5 см; CBL21/09, 21G x 9 см;
CBL21/10, 21G x 10 см; CBL21/11, 21G x 11 см; CBL21/15, 21G x 15 см; CBL21/20, 21G x 20 см;
CBL21/25, 21G x 25 см; CBL21/30, 21G x 30 см; CBL22/03, 22G x 3 см; CBL22/05, 22G x 5 см;
CBL22/09, 22G x 9 см; CBL22/11, 22G x 11 см; CBL22/15, 22G x 15 см; CBL22/20, 22G x 20 см;
CBL22/25, 22G x 25 см; CBL22/30, 22G x 30 см; CBL23/05, 23G x 5 см; CBL23/09, 23G x 9 см;
CBL23/11, 23G x 11 см; CBL23/15, 23G x 15 см; CBL23/20, 23G x 20 см; CBL23/25, 23G x 25 см;
CBL25/03, 25G x 3 см; CBL25/05, 25G x 5 см; CBL25/09, 25G x 9 см; CBL25/11, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL

Игла для биопсии тип Чибя

REF

CBL XX/YY



Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO



№РУ

от

В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	CE 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxyyyy	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Ѓиорѓи. 27- 41124
Модена. Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байосен Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

2. Игла для биопсии тип Чибя, эхогенная - CBL18/09E, 18G x 9 см; CBL18/11E, 18G x 11 см; CBL18/15E, 18G x 15 см; CBL18/20E, 18G x 20 см; CBL18/25E, 18G x 25 см; CBL18/35E, 18G x 35 см; CBL20/03E, 20G x 3 см; CBL20/05E, 20G x 5 см; CBL20/09E, 20G x 9 см; CBL20/11E, 20G x 11 см; CBL20/15E, 20G x 15 см; CBL20/20E, 20G x 20 см; CBL20/25E, 20G x 25 см; CBL20/35E, 20G x 35 см; CBL21/03E, 21G x 3 см; CBL21/05E, 21G x 5 см; CBL21/09E, 21G x 9 см; CBL21/11E, 21G x 11 см; CBL21/15E, 21G x 15 см; CBL21/20E, 21G x 20 см; CBL21/25E, 21G x 25 см; CBL22/03E, 22G x 3 см; CBL22/05E, 22G x 5 см; CBL22/09E, 22G x 9 см; CBL22/11E, 22G x 11 см; CBL22/15E, 22G x 15 см; CBL22/20E, 22G x 20 см; CBL22/25E, 22G x 25 см; CBL23/05E, 23G x 5 см; CBL23/09E, 23G x 9 см; CBL23/11E, 23G x 11 см; CBL23/15E, 23G x 15 см; CBL23/20E, 23G x 20 см; CBL23/25E, 23G x 25 см; CBL25/03E, 25G x 3 см; CBL25/05E, 25G x 5 см; CBL25/09E, 25G x 9 см; CBL25/11E, 25G x 11 см;



Игла для биопсии тип Чибя, эхогенная

REF CBL XX/YY E 

Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO     

№РУ от В стерильной упаковке 1 шт


	xx/yyyy	  1936
	xx/yyyy	
LOT	xxxxxx	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия


Уполномоченный представитель:
ООО "Байосен Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н

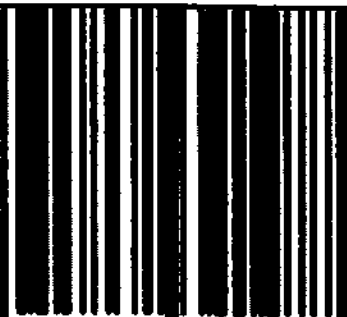

8 055731 340484

**Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"**

3. Игла для биопсии тип Чиза, срез Квинке- QBL16/15, 16G x 15 см; QBL16/20, 16G x 20 см;
QBL16/25, 16G x 25 см; QBL16/30, 16G x 30 см; QBL18/03, 18G x 3 см; QBL18/05, 18G x 5 см;
QBL18/07, 18G x 7 см; QBL18/09, 18G x 9 см; QBL18/11, 18G x 11 см; QBL18/15, 18G x 15 см;
QBL18/20, 18G x 20 см; QBL18/25, 18G x 25 см; QBL18/30, 18G x 30 см; QBL18/35, 18G x 35 см;
QBL20/03, 20G x 3 см; QBL20/05, 20G x 5 см; QBL20/07, 20G x 7 см; QBL20/09, 20G x 9 см;
QBL20/11, 20G x 11 см; QBL20/15, 20G x 15 см; QBL20/20, 20G x 20 см; QBL20/25, 20G x 25 см;
QBL20/30, 20G x 30 см; QBL20/35, 20G x 35 см; QBL21/03, 21G x 3 см; QBL21/05, 21G x 5 см;
QBL21/07, 21G x 7 см; QBL21/09, 21G x 9 см; QBL21/11, 21G x 11 см; QBL21/15, 21G x 15 см;
QBL21/20, 21G x 20 см; QBL21/25, 21G x 25 см; QBL22/03, 22G x 3 см; QBL22/05, 22G x 5 см;
QBL22/09, 22G x 9 см; QBL22/11, 22G x 11 см; QBL22/15, 22G x 15 см; QBL22/20, 22G x 20 см;
QBL22/25, 22G x 25 см; QBL25/03, 25G x 3 см; QBL25/05, 25G x 5 см; QBL25/09, 25G x 9 см;
QBL25/11, 25G x 11 см;

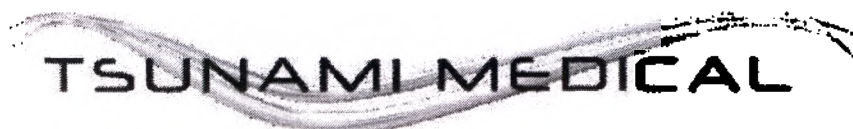

Игла для биопсии тип Чиза, срез Квинке

REF	QBL XX/YY	
Length	YY см	Diameter
Lunghezza		Diametro
Longueur		Diametre
Longitud		Diametro
Длина		Диаметр
		XX G



№РУ **от** **В стерильной упаковке 1 шт**


	xx/yyyy	CE 1936
	xx/yyyy	
LOT	ххуууу	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н

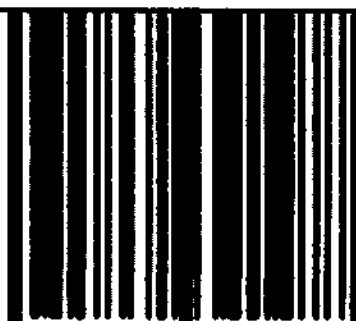

8 055731 340484

Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические
в отдельных упаковках в исполнениях"

4. Игла для биопсии тип Чиба, срез Квинке, экзогенная-QBL18/03E, 18Gx3см; QBL18/05E, 18G x 5 см;
QBL18/09E, 18G x 9 см; QBL18/11E, 18G x 11 см; QBL18/15E, 18G x 15 см; QBL18/20E, 18G x 20 см;
QBL18/25E, 18G x 25 см; QBL18/35E, 18G x 35 см; QBL20/03E, 20G x 3 см; QBL20/05E, 20G x 5 см;
QBL20/09E, 20G x 9 см; QBL20/11E, 20G x 11 см; QBL20/15E, 20G x 15 см; QBL20/20E, 20G x 20 см;
QBL20/25E, 20G x 25 см; QBL20/35E, 20G x 35 см; QBL21/03E, 21G x 3 см; QBL21/05E, 21G x 5 см;
QBL21/09E, 21G x 9 см; QBL21/11E, 21G x 11 см; QBL21/15E, 21G x 15 см; QBL21/20E, 21G x 20 см;
QBL21/25E, 21G x 25 см; QBL22/03E, 22G x 3 см; QBL22/05E, 22G x 5 см; QBL22/09E, 22G x 9 см;
QBL22/11E, 22G x 11 см; QBL22/15E, 22G x 15 см; QBL22/20E, 22G x 20 см; QBL22/25E, 22G x 25 см;
QBL25/03E, 25G x 3 см; QBL25/05E, 25G x 5 см; QBL25/09E, 25G x 9 см; QBL25/11E, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL

Игла для биопсии тип Чиба, срез Квинке, экзогенная

REF QBL XX/YY E 

Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO     

№РУ от В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxyyyy	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Эмилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Биопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

5. Игла для биопсии тип Франзена- FBL18/10,18G x 10 см; FBL18/15,18G x 15 см;
FBL18/20,18G x 20 см; FBL18/25,18G x 25 см; FBL19/10,19G x 10 см;
FBL19/15,19G x 15 см; FBL19/20,19G x 20 см; FBL19/25,19G x 25 см;
FBL20/10,20G x 10 см; FBL20/15,20G x 15 см; FBL20/20,20G x 20 см;
FBL20/25,20G x 25 см; FBL21/10,21G x 10 см; FBL21/15,21G x 15 см;
FBL21/20,21G x 20 см; FBL21/25,21G x 25 см; FBL22/10,22G x 10 см;
FBL22/15,22G x 15 см; FBL22/20,22G x 20 см; FBL22/25,22G x 25 см;



Игла для биопсии тип Франзена

REF		FBL XX/YY			
Length	YY см	Diameter	XX G		
Lunghezza		Diametro			
Longueur		Diametre			
Longitud		Diametro			
Длина		Диаметр			
STERILE EO					
№РУ		от		В стерильной упаковке 1 шт	
	xx/yyyy	CE 1936			
	xx/yyyy				
LOT	xxyyyy				



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Эмилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия


Уполномоченный представитель:
ООО "Байосен Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

0. Игла для биопсии тип Франзена, экзогенная- FBL16/10E, 16G x 10 см;
FBL18/15E, 18G x 15 см; FBL18/20E, 18G x 20 см; FBL18/25E, 18G x 25 см;
FBL19/10E, 19G x 10 см; FBL19/15E, 19G x 15 см; FBL19/20E, 19G x 20 см;
FBL19/25E, 19G x 25 см; FBL20/10E, 20G x 10 см; FBL20/15E, 20G x 15 см;
FBL20/20E, 20G x 20 см; FBL20/25E, 20G x 25 см; FBL21/10E, 21G x 10 см;
FBL21/15E, 21G x 15 см; FBL21/20E, 21G x 20 см; FBL21/25E, 21G x 25 см;
FBL22/10E, 22G x 10 см; FBL22/15E, 22G x 15 см; FBL22/20E, 22G x 20 см;
FBL22/25E, 22G x 25 см;

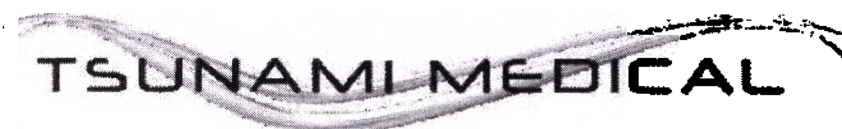

Игла для биопсии тип Франзена, экзогенная

REF FBL XX/YY E 

Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	



№РУ от В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxyyyy	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Ѓиорѓи, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байосен Диагностик"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

7. Игла для биопсии гистологическая- IBL16/10,16G x 10 см; IBL16/15,16G x 15 см; IBL16/20,16G x 20 см; IBL18/10,18G x 10 см; IBL18/15,18G x 15 см; IBL18/20,18G x 20 см; IBL19/10,19G x 10 см; IBL19/15,19G x 15 см; IBL19/20,19G x 20 см; IBL20/10,20G x 10 см; IBL22/10,22G x 10 см; IBL20/15,20G x 15 см; IBL20/20,20G x 20 см; IBL21/10,21G x 10 см; IBL21/15,21G x 15 см; IBL21/20,21G x 20 см; IBL22/15,22G x 15 см; IBL22/20,22G x 20 см;



Игла для биопсии гистологическая

REF IBL XX/YY



Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO



№РУ от

В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	CE 1936
	xx/yyyy	
LOT	ххуууу	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

8. Игла для биопсии гистологическая, эхогенная- IBL16/10E,16G x 10 см;
IBL16/15E,16G x 15 см; IBL16/20E,16G x 20 см; IBL18/10E,18G x 10 см;
IBL18/15E,18G x 15 см; IBL18/20E,18G x 20 см; IBL19/10E,19G x 10 см;
IBL19/15E,19G x 15 см; IBL19/20E,19G x 20 см; IBL20/10E,20G x 10 см;
IBL20/15E,20G x 15 см; IBL20/20E,20G x 20 см; IBL21/10E,21G x 10 см;
IBL21/15E,21G x 15 см; IBL21/20E,21G x 20 см; IBL22/15E,22G x 15 см;
IBL22/20E,22G x 20 см; IBL22/10E,22G x 10см;



Игла для биопсии гистологическая, эхогенная

REF IBL XX/YY E 

Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO



№ПУ от

В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	 € 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxyyyy	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"

9. Игла для биопсии тип Весткотт- WBL18/10,18G x 10 см; WBL18/15,18G x 15см;
WBL18/20,18G x 20 см; WBL18/25,18G x 25 см; WBL19/10,19G x 10 см;
WBL19/15,19G x 15 см; WBL19/20,19G x 20 см; WBL19/25,19G x 25 см;
WBL20/10,20G x 10 см; WBL20/15,20G x 15 см; WBL20/20,20G x 20 см;
WBL20/25,20G x 25 см; WBL21/10,21G x 10 см; WBL21/15,21G x 15 см;
WBL21/20,21G x 20 см; WBL21/25,21G x 25 см; WBL22/10,22G x 10 см;
WBL22/15,22G x 15 см; WBL22/20,22G x 20 см; WBL22/25,22G x 25 см;



Игла для биопсии тип Весткотт

REF

WBL XX/YY



Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE EO



№ПУ

от

В стерильной упаковке 1 шт

	xx/yyyy	CE 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxyyyy	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия


Уполномоченный представитель:
ООО "Биопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

Маркет маркировки "Иглы биопсииные одноразовые аспирационно-гистологические в отдельных упаковках в исполнениих"

10. Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная-WBL18/10E,18G x 10 cm;
WBL18/15E,18G x 15 cm; WBL18/20E,18G x 20 cm; WBL18/25E,18G x 25 cm;
WBL19/10E,19G x 10 cm; WBL19/15E,19G x 15 cm; WBL19/20E,19G x 20 cm;
WBL19/25E,19G x 25 cm; WBL20/10E,20G x 10 cm; WBL20/15E,20G x 15 cm;
WBL20/20E,20G x 20 cm; WBL20/25E,20G x 25 cm; WBL21/10E,21G x 10 cm;
WBL21/15E,21G x 15 cm; WBL21/20E,21G x 20 cm; WBL21/25E,21G x 25 cm;
WBL22/10E,22G x 10 cm; WBL22/15E,22G x 15 cm; WBL22/20E,22G x 20 cm;
WBL22/25E,22G x 25 cm;

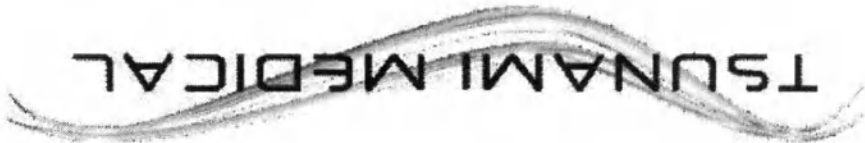

Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная



WBL XX/YY E

REF

Length	Lunghezza	Longueur	Longitud	Длина
YY cm	Diameter	Diametro	Diametre	Diametro
	Diameter	Diametro	Diametre	Diametro
	Diameter	Diametro	Diametre	Diametro
	Diameter	Diametro	Diametre	Diametro
	Diameter	Diametro	Diametre	Diametro
XX G				

STERILE EO



Непы OT

В стрепильной упаковке 1 шт

	xx/yyy	LOT
	xx/yyy	
	xx/yyy	

TSUNAMI S.r.l.




Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Bvia Emillino Torino, 27- 41124
Modena, Италия
Уполномоченный представитель:
ООО "Биониси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



**Макет маркировки "Иглы биопсийные одноразовые аспирационно -
гистологические в отдельных упаковках в исполнениях"**

11. ИГЛЫ ДЛЯ БИОПСИИ И АМНИОЦЕНТЕЗА, ТИП ЧИБА- SCBL10/09,10G x 9 см; SCBL10/20,10G x 20 см;
SCBL16/25,16G x 25 см; SCBL16/30,16G x 30 см; SCBL18/03,18G x 3 см; SCBL18/05,18G x 5 см;
SCBL18/09,18G x 9 см; SCBL18/11,18G x 11 см; SCBL18/15,18G x 15 см; SCBL18/20,18G x 20 см;
SCBL18/25,18G x 25 см; SCBL20/03,20G x 3 см; SCBL20/05,20G x 5 см; SCBL20/09,20G x 9 см;
SCBL20/11,20G x 11 см; SCBL20/12,20G x 12 см; SCBL20/15,20G x 15 см; SCBL20/16,20G x 16 см;
SCBL20/20,20G x 20 см; SCBL21/03,21G x 3 см; SCBL21/05,21G x 5 см; SCBL21/09,21G x 9 см;
SCBL21/10,21G x 10 см; SCBL21/11,21G x 11 см; SCBL21/12,21G x 12 см; SCBL21/15,21G x 15 см;
SCBL21/18,21G x 18 см; SCBL21/20,21G x 20 см; SCBL22/03,22G x 3 см; SCBL22/05,22G x 5 см;
SCBL22/09,22G x 9 см; SCBL22/11,22G x 11 см; SCBL22/15,22G x 15 см; SCBL22/20,22G x 20 см;
SCBL22/30,22G x 30 см; SCBL23/03,23G x 3 см; SCBL23/05,23G x 5 см; SCBL23/09,23G x 9 см;
SCBL23/11,23G x 11 см; SCBL23/15,23G x 15 см; SCBL23/20,23G x 20 см; SCBL25/03,25G x 3 см;
SCBL25/05,25G x 5 см; SCBL25/09,25G x 9 см; SCBL25/11,25G x 11 см; SCBL25/15,25G x 15 см;

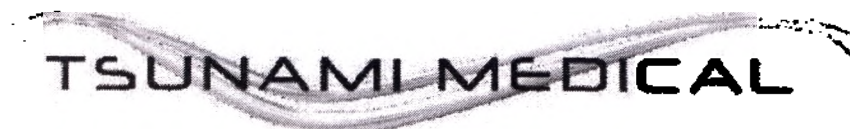

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чибя

REF SCBL XX/YY 

Length	YY см	Diameter	XX G
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diametre	
Longitud		Diametro	
Длина		Диаметр	

STERILE
EO






№РУ **от** **В стерильной упаковке 1 шт**

	xx/yyyy	 1936
	xx/yyyy	
LOT	xxxxxx	



TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Виа Емилио Гиорги, 27- 41124
Модена, Италия

Уполномоченный представитель:
ООО "Байопси Диагностика"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н



8 055731 340484

17. Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чига, эхогенная-SCBL18/03E,18G x 3 cm;
SCBL18/05E,18G x 5 cm; SCBL18/09E,18G x 9 cm; SCBL18/11E,18G x 11 cm; SCBL18/15E,18G x 15 cm;
SCBL18/20E,18G x 20 cm; SCBL20/03E,20G x 3 cm; SCBL20/05E,20G x 5 cm; SCBL20/09E,20G x 9 cm;
SCBL20/11E,20G x 11 cm; SCBL20/15E,20G x 15 cm; SCBL20/20E,20G x 20 cm; SCBL21/03E,21G x 3
cm; SCBL21/05E,21G x 5 cm; SCBL21/09E,21G x 9 cm; SCBL21/11E,21G x 11cm; SCBL21/15E,21G x 15
cm; SCBL21/20E,21G x 20 cm; SCBL22/03E,22G x 3 cm; SCBL22/05E,22G x 5 cm; SCBL22/09E,22G x 9
cm; SCBL22/11E,22G x 11 cm; SCBL22/15E,22G x 15 cm; SCBL22/20E,22G x 20 cm; SCBL23/03E,23G x
3 cm; SCBL23/05E,23G x 5 cm; SCBL23/09E,23G x 9 cm; SCBL23/11E,23Gx 11 cm; SCBL23/15E,23G x
15 cm; SCBL23/20E,23G x 20 cm; SCBL25/03E,25G x 3 cm; SCBL25/05E,25G x 5 cm; SCBL25/09E,25G x
9 cm; SCBL25/11E,25G x 11 cm; SCBL25/15E,25G x 15 cm;



Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чига,

эхогенная



REF

SCBL XX/YV E

Length	Lunghezza	Longueur	Longitud	Длина
YV cm	Diameter	Diametre	Diametro	Диаметр
XX G				

STERILE EO




Napy OT В стерильной упаковке 1 шт

LOT	xx/yy
	xx/yy
	xx/yy

€ 1936

TSUNAMI S.r.l.

Via Emilio Giorgi 27- 41124, Modena,
Italy/Bvia Фаминьо Гюрри, 27- 41124
Модена, Италия
Уполномоченный представитель:
ООО "Байонес Диалогистик"
190020, город Санкт-Петербург,
набережная Обводного Канала, дом
223-225 литер "с", помещение 1н

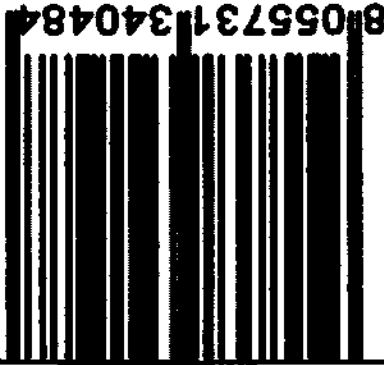

8 055731 340484

Генеральный директор
ООО «Байонет Диагностика»
Иванов Н.В.
Пропито, пронумеровано
и скреплено печатью
листов



Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Чибя- CBL18/03, 18G x 3 см; CBL18/05, 18G x 5 см; CBL18/09, 18G x 9 см; CBL18/10, 18G x 10 см; CBL18/11, 18G x 11 см; CBL18/15, 18G x 15 см; CBL18/20, 18G x 20 см; CBL18/25, 18G x 25 см; CBL18/35, 18G x 35 см; CBL19/09, 19G x 9 см; CBL19/11, 19G x 11 см; CBL19/15, 19G x 15 см; CBL19/20, 19G x 20 см; CBL20/03, 20G x 3 см; CBL20/05, 20G x 5 см; CBL20/09, 20G x 9 см; CBL20/10, 20G x 10 см; CBL20/11, 20G x 11 см; CBL20/15, 20G x 15 см; CBL20/20, 20G x 20 см; CBL20/25, 20G x 25 см; CBL20/35, 20G x 35 см; CBL21/03, 21G x 3 см; CBL21/05, 21G x 5 см; CBL21/09, 21G x 9 см; CBL21/10, 21G x 10 см; CBL21/11, 21G x 11 см; CBL21/15, 21G x 15 см; CBL21/20, 21G x 20 см; CBL21/25, 21G x 25 см; CBL22/03, 22G x 3 см; CBL22/05, 22G x 5 см; CBL22/09, 22G x 9 см; CBL22/11, 22G x 11 см; CBL22/15, 22G x 15 см; CBL22/20, 22G x 20 см; CBL22/25, 22G x 25 см; CBL22/30, 22G x 30 см; CBL23/05, 23G x 5 см; CBL23/09, 23G x 9 см; CBL23/11, 23G x 11 см; CBL23/15, 23G x 15 см; CBL23/20, 23G x 20 см; CBL23/25, 23G x 25 см; CBL25/03, 25G x 3 см; CBL25/05, 25G x 5 см; CBL25/09, 25G x 9 см; CBL25/11, 25G x 11 см; CBL25/15, 25G x 15 см; CBL25/20, 25G x 20 см; CBL25/25, 25G x 25 см;


TSUNAMI MEDICAL

Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Чибя

REF CBL 18/03

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	3.0 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	18G/ 1.27 mm
--	--------	---	-----------------

H01 06/B Rev 00



№ РУ... от ...

В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019



YYXXXX

CE 1936



TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedicalinfo@tsunamimedical.it
web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Чива, эхогенная - CBL18/03E, 18G x 3 см; CBL18/05E, 18G x 5 см; CBL18/09E, 18G x 9 см; CBL18/11E, 18G x 11 см; CBL18/15E, 18G x 15 см; CBL18/20E, 18G x 20 см; CBL18/25E, 18G x 25 см; CBL18/35E, 18G x 35 см; CBL20/03E, 20G x 3 см; CBL20/05E, 20G x 5 см; CBL20/09E, 20G x 9 см; CBL20/11E, 20G x 11 см; CBL20/15E, 20G x 15 см; CBL20/20E, 20G x 20 см; CBL20/25E, 20G x 25 см; CBL20/35E, 20G x 35 см; CBL21/03E, 21G x 3 см; CBL21/05E, 21G x 5 см; CBL21/09E, 21G x 9 см; CBL21/11E, 21G x 11 см; CBL21/15E, 21G x 15 см; CBL21/20E, 21G x 20 см; CBL21/25E, 21G x 25 см; CBL22/03E, 22G x 3 см; CBL22/05E, 22G x 5 см; CBL22/09E, 22G x 9 см; CBL22/11E, 22G x 11 см; CBL22/15E, 22G x 15 см; CBL22/20E, 22G x 20 см; CBL22/25E, 22G x 25 см; CBL23/05E, 23G x 5 см; CBL23/09E, 23G x 9 см; CBL23/11E, 23G x 11 см; CBL23/15E, 23G x 15 см; CBL23/20E, 23G x 20 см; CBL23/25E, 23G x 25 см; CBL25/03E, 25G x 3 см; CBL25/05E, 25G x 5 см; CBL25/09E, 25G x 9 см; CBL25/11E, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL


Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Чива, эхогенная

REF CBL 18/03 E

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	3.0 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	18G/ 1.27 mm
--	--------	---	-----------------

MD1 06/78 Rev 00



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

	10/2014	CE 1936
	10/2019	
LOT	YYXXXX	

TSUNAMI S.r.l.
Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedica.info@me.com
web-site: www.tsunamimedica.it



REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. ITALY		Tsunami S.r.l. ITALY	
REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. ITALY		Tsunami S.r.l. ITALY	

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Чибя, срез Квинке- QBL21/15, 21G x 15 см; QBL18/03, 18G x 3 см; QBL18/05, 18G x 5 см; QBL18/09, 18G x 9 см; QBL18/11, 18G x 11 см; QBL18/15, 18G x 15 см; QBL18/20, 18G x 20 см; QBL18/25, 18G x 25 см; QBL18/30, 18G x 30 см; QBL18/35, 18G x 35 см; QBL20/03, 20G x 3 см; QBL20/05, 20G x 5 см; QBL20/09, 20G x 9 см; QBL20/11, 20G x 11 см; QBL20/15, 20G x 15 см; QBL20/20, 20G x 20 см; QBL20/25, 20G x 25 см; QBL20/35, 20G x 35 см; QBL21/03, 21G x 3 см; QBL21/05, 21G x 5 см; QBL21/09, 21G x 9 см; QBL21/11, 21G x 11 см; QBL21/20, 21G x 20 см; QBL21/25, 21G x 25 см; QBL22/03, 22G x 3 см; QBL22/05, 22G x 5 см; QBL22/09, 22G x 9 см; QBL22/11, 22G x 11 см; QBL22/15, 22G x 15 см; QBL22/20, 22G x 20 см; QBL22/25, 22G x 25 см; QBL25/03, 25G x 3 см; QBL25/05, 25G x 5 см; QBL25/09, 25G x 9 см; QBL25/11, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Чибя, срез Квинке.

REF QBL 21/15

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	15 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	21G/ 0.80 mm
--	-------	---	-----------------

STERILE EO



№ РУ... от ...

В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019



YYXXXX

CE 1936



TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 / Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF QBL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF QBL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF QBL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF QBL14/30

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Чива, срез Квинке, экзогенная- QBL21/15E, 21G x 15 см QBL18/03E, 18G x 3 см; QBL18/05E, 18G x 5 см; QBL18/09E, 18G x 9 см; QBL18/11E, 18G x 11 см; QBL18/15E, 18G x 15 см; QBL18/20E, 18G x 20 см; QBL18/25E, 18G x 25 см; QBL18/35E, 18G x 35 см; QBL20/03E, 20G x 3 см; QBL20/05E, 20G x 5 см; QBL20/09E, 20G x 9 см; QBL20/11E, 20G x 11 см; QBL20/15E, 20G x 15 см; QBL20/20E, 20G x 20 см; QBL20/25E, 20G x 25 см; QBL20/35E, 20G x 35 см; QBL21/03E, 21G x 3 см; QBL21/05E, 21G x 5 см; QBL21/09E, 21G x 9 см; QBL21/11E, 21G x 11 см; QBL21/20E, 21G x 20 см; QBL21/25E, 21G x 25 см; QBL22/03E, 22G x 3 см; QBL22/05E, 22G x 5 см; QBL22/09E, 22G x 9 см; QBL22/11E, 22G x 11 см; QBL22/15E, 22G x 15 см; QBL22/20E, 22G x 20 см; QBL22/25E, 22G x 25 см; QBL25/03E, 25G x 3 см; QBL25/05E, 25G x 5 см; QBL25/09E, 25G x 9 см; QBL25/11E, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL


Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction medullaire ancora
Iгла до aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Чива, срез Квинке, экзогенная

REF QBL 21/15E

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	15 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	21G/ 0.80 mm
--	-------	---	-----------------

101 06/16 Rev 00



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019



YYXXXX

CE 1936

TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedical.info@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30
LOT YYXXXX CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30
LOT YYXXXX CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30
LOT YYXXXX CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30
LOT YYXXXX CE 1936
Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Франзена- FBL22/25,22G x 25 см;FBL18/10,18G x 10 см;FBL18/15,18G x 15 см;FBL18/20,18G x 20 см;FBL18/25,18G x 25 см;FBL19/10,19G x 10 см;FBL19/15,19G x 15 см;FBL19/20,19G x 20 см;FBL19/25,19G x 25 см;FBL20/10,20G x 10 см;FBL20/15,20G x 15 см;FBL20/20,20G x 20 см;FBL20/25,20G x 25 см;FBL21/10,21G x 10 см;FBL21/15,21G x 15 см;FBL21/20,21G x 20 см;FBL21/25,21G x 25 см;FBL22/10,22G x 10 см;FBL22/15,22G x 15 см;FBL22/20,22G x 20 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction medullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Франзена.

REF FBL 22/25

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	25.0 CM	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	22G/ 0.70 MM
STERILE EO			
№ РУ... от ...		В стерильной упаковке: 1 шт	
	10/2014	CE 1936	
	10/2019		
LOT	YYXXXX		

TSUNAMI S.r.l.
Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 - Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedicalinfo@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	
REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»


Игла для биопсии тип Франзена, эхогенная- FBL22/25E, 22G x 25 см; FBL18/10E, 18G x 10 см; FBL18/15E, 18G x 15 см; FBL18/20E, 18G x 20 см; FBL18/25E, 18G x 25 см; FBL19/10E, 19G x 10 см; FBL19/15E, 19G x 15 см; FBL19/20E, 19G x 20 см; FBL19/25E, 19G x 25 см; FBL20/10E, 20G x 10 см; FBL20/15E, 20G x 15 см; FBL20/20E, 20G x 20 см; FBL20/25E, 20G x 25 см; FBL21/10E, 21G x 10 см; FBL21/15E, 21G x 15 см; FBL21/20E, 21G x 20 см; FBL21/25E, 21G x 25 см; FBL22/10E, 22G x 10 см; FBL22/15E, 22G x 15 см; FBL22/20E, 22G x 20 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Франзена, эхогенная

REF FBL 22/25 E

Length	25.0	Diameter	22G/
Lunghezza		Diametro	0.70 mm
Longueur	CM	Diamètre	
Longitud		Diámetro	
Длина		Диаметр	



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

10/2014

10/2019

LOT YYXXXX

CE 1936

TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 / Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL1430

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL1430

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL1430

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL1430

LOT YYXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»


Игла для биопсии гистологическая- IBL16/10,16G x 10 см; IBL16/15,16G x 15 см; IBL16/20,16G x 20 см; IBL18/10,18G x 10 см; IBL18/15,18G x 15 см; IBL18/20,18G x 20 см; IBL19/10,19G x 10 см; IBL19/15,19G x 15 см; IBL19/20,19G x 20 см; IBL20/10,20G x 10 см; IBL22/10,22G x 10 см; IBL20/15,20G x 15 см; IBL20/20,20G x 20 см; IBL21/10,21G x 10 см; IBL21/15,21G x 15 см; IBL21/20,21G x 20 см; IBL22/15,22G x 15 см; IBL22/20,22G x 20 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии гистологическая.

REF IBL 16/10

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	10 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	16G/ 1.60 mm
--	-------	---	-----------------



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

10/2014

10/2019

LOT YYXXXX

CE 1936

TSUNAMI S.r.l.


Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 / Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF 48L14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF 48L14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF 48L14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF 48L14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии гистологическая, эхогенная- IBL16/10E, 16G x 10 см; IBL16/15E, 16G x 15 см; IBL16/20E, 16G x 20 см; IBL18/10E, 18G x 10 см; IBL18/15E, 18G x 15 см; IBL18/20E, 18G x 20 см; IBL19/10E, 19G x 10 см; IBL19/15E, 19G x 15 см; IBL19/20E, 19G x 20 см; IBL20/10E, 20G x 10 см; IBL20/15E, 20G x 15 см; IBL20/20E, 20G x 20 см; IBL21/10E, 21G x 10 см; IBL21/15E, 21G x 15 см; IBL21/20E, 21G x 20 см; IBL22/15E, 22G x 15 см; IBL22/20E, 22G x 20 см; IBL22/10E, 22G x 10 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии гистологическая, эхогенная.

REF IBL 16/10E

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	10 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	16G/ 1.60 mm
--	-------	---	-----------------



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

	10/2014	CE 1936
	10/2019	
LOT	YYXXXX	

TSUNAMI S.r.l.
Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedical.info@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	
REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байоски Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmo@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Весткотт- WBL20/25,20G x 25 см;WBL18/10,18G x 10 см;WBL18/15,18G x 15 см;WBL18/20,18G x 20 см;WBL18/25,18G x 25 см;WBL19/10,19G x 10 см;WBL19/15,19G x 15 см;WBL19/20,19G x 20 см;WBL19/25,19G x 25 см;WBL20/10,20G x 10 см;WBL20/15,20G x 15 см;WBL20/20,20G x 20 см;WBL21/10,21G x 10 см;WBL21/15,21G x 15 см;WBL21/20,21G x 20 см;WBL21/25,21G x 25 см;WBL22/10,22G x 10 см;WBL22/15,22G x 15 см;WBL22/20,22G x 20 см;WBL22/25,22G x 25 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Весткотт

REF WBL20/25

Length	25.0	Diameter	22G/
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diamètre	0.70 mm
Longitud	CM	Diámetro	
Длина		Диаметр	

401 06/25 Rev. 00

STERILE EO



№ РУ... от ...

В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019

LOT

YYXXXX

CE 1936



TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 / Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопек Диагностик»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная- WBL20/25E, 20G x 25 см; WBL18/10E, 18G x 10 см; WBL18/15E, 18G x 15 см; WBL18/20E, 18G x 20 см; WBL18/25E, 18G x 25 см; WBL19/10E, 19G x 10 см; WBL19/15E, 19G x 15 см; WBL19/20E, 19G x 20 см; WBL19/25E, 19G x 25 см; WBL20/10E, 20G x 10 см; WBL20/15E, 20G x 15 см; WBL20/20E, 20G x 20 см; WBL21/10E, 21G x 10 см; WBL21/15E, 21G x 15 см; WBL21/20E, 21G x 20 см; WBL21/25E, 21G x 25 см; WBL22/10E, 22G x 10 см; WBL22/15E, 22G x 15 см; WBL22/20E, 22G x 20 см; WBL22/25E, 22G x 25 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии тип Весткотт, эхогенная.

REF WBL20/25E

Length	25.0	Diameter	22G/ 0.70 mm
Lunghezza		Diametro	
Longueur		Diamètre	
Longitud		Diámetro	
Длина		Диаметр	

STERILE

EO



№ PY... от ...

В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019

LOT

YYXXXX

CE 1936



TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

REF ABL14/30

LOT YYXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чибя- SCBL25/15,25G x 15 см; SCBL16/09,16G x 9 см; SCBL16/20,16G x 20 см; SCBL18/03,18G x 3 см; SCBL18/05,18G x 5 см; SCBL18/09,18G x 9 см; SCBL18/11,18G x 11 см; SCBL18/15,18G x 15 см; SCBL18/20,18G x 20 см; SCBL18/25,18G x 25 см; SCBL20/03,20G x 3 см; SCBL20/05,20G x 5 см; SCBL20/09,20G x 9 см; SCBL20/11,20G x 11 см; SCBL20/12,20G x 12 см; SCBL20/15,20G x 15 см; SCBL20/16,20G x 16 см; SCBL20/20,20G x 20 см; SCBL21/03,21G x 3 см; SCBL21/05,21G x 5 см; SCBL21/09,21G x 9 см; SCBL21/10,21G x 10 см; SCBL21/11,21G x 11 см; SCBL21/12,21G x 12 см; SCBL21/15,21G x 15 см; SCBL21/18,21G x 18 см; SCBL21/20,21G x 20 см; SCBL22/03,22G x 3 см; SCBL22/05,22G x 5 см; SCBL22/09,22G x 9 см; SCBL22/11,22G x 11 см; SCBL22/15,22G x 15 см; SCBL22/20,22G x 20 см; SCBL22/30,22G x 30 см; SCBL23/03,23G x 3 см; SCBL23/05,23G x 5 см; SCBL23/09,23G x 9 см; SCBL23/11,23G x 11 см; SCBL23/15,23G x 15 см; SCBL23/20,23G x 20 см; SCBL25/03,25G x 3 см; SCBL25/05,25G x 5 см; SCBL25/09,25G x 9 см; SCBL25/11,25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Igla do aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чибя

REF SCBL 25/15

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	15.0 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	25G/ 0.55 mm
--	---------	---	-----------------



№ PY... от ... В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019



YYXXXX

CE 1936

TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399
mail: tsunamimedical@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30

LOT XXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. ITALY

REF ABL14/30

LOT XXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. ITALY

REF ABL14/30

LOT XXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. ITALY

REF ABL14/30

LOT XXXXX (CE 1936)

Tsunami S.r.l. ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопекс Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чива, экзогенная- SCBL25/15E, 25G x 15 см; SCBL18/03E, 18G x 3 см; SCBL18/05E, 18G x 5 см; SCBL18/09E, 18G x 9 см; SCBL18/11E, 18G x 11 см; SCBL18/15E, 18G x 15 см; SCBL18/20E, 18G x 20 см; SCBL20/03E, 20G x 3 см; SCBL20/05E, 20G x 5 см; SCBL20/09E, 20G x 9 см; SCBL20/11E, 20G x 11 см; SCBL20/15E, 20G x 15 см; SCBL20/20E, 20G x 20 см; SCBL21/03E, 21G x 3 см; SCBL21/05E, 21G x 5 см; SCBL21/09E, 21G x 9 см; SCBL21/11E, 21G x 11 см; SCBL21/15E, 21G x 15 см; SCBL21/20E, 21G x 20 см; SCBL22/03E, 22G x 3 см; SCBL22/05E, 22G x 5 см; SCBL22/09E, 22G x 9 см; SCBL22/11E, 22G x 11 см; SCBL22/15E, 22G x 15 см; SCBL22/20E, 22G x 20 см; SCBL23/03E, 23G x 3 см; SCBL23/05E, 23G x 5 см; SCBL23/09E, 23G x 9 см; SCBL23/11E, 23G x 11 см; SCBL23/15E, 23G x 15 см; SCBL23/20E, 23G x 20 см; SCBL25/05E, 25G x 5 см; SCBL25/09E, 25G x 9 см; SCBL25/11E, 25G x 11 см;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла до aspiracji szpiku kostnego
Игла для биопсии и амниоцентеза, тип Чива, экзогенная

REF SCBL 25/15 E

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	15.0 cm	Diameter Diámetro Diamètre Diámetro Диаметр	25G/ 0.55 mm
--	---------	---	-----------------




№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

10/2014
10/2019
LOT YYXXXX

CE 1936

TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 38397 Fax: +39 0535 38399
mail: tsunamimedicalinfo@me.com
web-site: www.tsunamimedical.it



REF ABL14/30 LOT YYXXXX CE 1936 Tsunami S.r.l. - ITALY
REF ABL14/30 LOT YYXXXX CE 1936 Tsunami S.r.l. - ITALY
REF ABL14/30 LOT YYXXXX CE 1936 Tsunami S.r.l. - ITALY
REF ABL14/30 LOT YYXXXX CE 1936 Tsunami S.r.l. - ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
т. (812) 010-10-19
e-mail: bmb@peterlink.ru

Не использовать при нарушении целостности упаковки

MD106/1 Rev.00

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»


Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL15/09,15G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;
Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL16/09,16G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G скальпель;
Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL17/09,17G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G скальпель;
Набор для биопсии с иглой типа Менгини в составе: игла для биопсии LBL18/09,18G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G скальпель;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
 Ago per aspirazione midollare
 Trocart ponction médullaire ancora
 Iгла do aspiracji szpiku kostnego
 Набор для биопсии с иглой типа Менгини

REF LBL 15/09

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	9.0 cm	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	15G/ 1.80 mm
--	--------	---	--------------



№ РУ... от ... В стерильной упаковке: 1 шт

	10/2014	CE 1936
	10/2019	
LOT	YYXXXX	

TSUNAMI S.r.l.
 Via XXV Aprile 22 I -
 41037 Mirandola (MO) - ITALY
 Tel. +39 0535 36397 Fax +39 0535 36399
 mail: tsunamimedica.info@me.com
 web-site: www.tsunamimedical.it



REF	ABL 14/30	REF	ABL 14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	
REF	ABL 14/30	REF	ABL 14/30
LOT	YYXXXX (CE 1936)	LOT	YYXXXX (CE 1936)
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
 Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
 пр. Римского-Корсакова, д.45

Ф.п.и. ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 2) 318 19 19
 E-mail: hmb@peterlink.ru

Не использовать при нарушении целостности упаковки

M01 06/16 Rev. 00

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL15/09E, 15G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL16/09E, 16G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL17/09E, 17G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный, в составе: игла для биопсии LBL18/09E, 18G x 9 см, шприц 10 мл, игла для шприца 21G, скальпель;

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle

Ago per aspirazione midollare

Trocart ponction medullaire ancora

Igla do aspiracji szpiku kostnego


Набор для биопсии с иглой типа Менгини, эхогенный

REF LBL 15/09 E

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	9.0 cm	Diameter Diametro Diametre Diámetro Диаметр	15G/ 1.80 mm
--	--------	---	--------------

101 06/20 Rev 00



№ РУ... от ...

В стерильной упаковке: 1 шт



10/2014



10/2019



YYXXXX

CE 1936



TSUNAMI S.r.l.

Via XXV Aprile 22 I -

41037 Mirandola (MO) - ITALY

Tel. +39 0535 38397 Fax +39 0535 38399

mail: tsunamimedicalinfo@me.com

web-site: www.tsunamimedical.it



REF AB11430

LOT XXXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. ITALY

REF AB11430

LOT XXXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. ITALY

REF AB11430

LOT XXXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. ITALY

REF AB11430

LOT XXXXXX CE 1936

Tsunami S.r.l. ITALY

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»

Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,

пр. Римского-Корсакова, д.45

Телефон: +7 (812) 318 19 19

E-mail: bmb@peterlink.ru

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии - MBL16/10,16G x 10 см, шприц 10мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL16/15,16G x 15 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL16/20,16G x 20 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL16/25,16G x 25 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL18/10,18G x 10 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL18/15,18G x 15 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL18/20,18G x 20 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL18/25,18G x 25 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL20/10,20G x 10 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL20/15,20G x 15 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL20/20,20G x 20 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL20/25,20G x 25 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL21/10,21G x 10 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL21/15,21G x 15 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL21/20,21G x 20 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL21/25,21G x 25 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL22/10,22G x 10 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL22/15,22G x 15 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL22/20,22G x 20 см, шприц 10 мл;

Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный, в составе: игла для биопсии MBL22/25,22G x 25 см, шприц 10 мл;

Макет маркировки «Иглы биопсийные одноразовые аспирационно - гистологические в наборах и отдельных упаковках в исполнениях»

TSUNAMI MEDICAL

Myelo aspiration needle
Ago per aspirazione midollare
Trocart ponction médullaire ancora
Iгла do aspiracji szpiku kostnego
Набор для биопсии с иглой типа Менгини, модифицированный

REF MBL 20/15

Не использовать при нарушении целостности упаковки

Length Lunghezza Longueur Longitud Длина	15.0 CM	Diameter Diametro Diamètre Diámetro Диаметр	20G/ 0.90 MM
STERILE EO			
№ PY... от ...		В стерильной упаковке: 1 шт	
	10/2014	1936	
	10/2019		
LOT	YYXXXX		

TSUNAMI S.r.l.
Via XXV Aprile 22 I -
41037 Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 38397 Fax: +39 0535 38399
mail: tsunamimedicalinfo@me.com
Web site: www.tsunamimedical.it



REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (€1936	LOT	YYXXXX (€1936
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	
REF	ABL14/30	REF	ABL14/30
LOT	YYXXXX (€1936	LOT	YYXXXX (€1936
Tsunami S.r.l. - ITALY		Tsunami S.r.l. - ITALY	

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Байопси Диагностика»
Россия, 190068, г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, д.45
Телефон: +7 (812) 318 19 19
E-mail: bmb@peterlink.ru

Аннотировано и
процессировано
16/медицинской сестры

