


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы
крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)**

**«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЛАБТРОНИКА»**

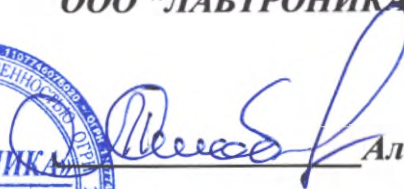


Альбертян Л.Л.

» апреля 2021 г.

Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
Вариант исполнения 1. Внешняя упаковка



Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
 Вариант исполнения 1.





Одноразовый наконечник с фильтром — 96 шт



Пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12шт.; Крышка пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12 шт.,



Крышка пробирки для элюирования , 12 шт

Пробирки для элюирования

Пробирка для загрузки образца – 96 шт



Пробирка для загрузки образца с внутренним контролем ДНК – 96 шт



Лоток для отходов — 3 шт



Защитная крышка—12 шт.



Защитное устройство от загрязнений из фильтровальной бумаги – 12 шт.



**Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
Вариант исполнения 1. Макеты дополнительной маркировки для РФ**



**Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
(Вариант исполнения 1)**

Пробирка для загрузки образца с внутренним контролем ДНК – 96 шт.

РУ № _____ от _____ 20__ г



REF

См. на упаковке



См. на упаковке

LOT

См. на упаковке



См. на упаковке

IVD

Bioneer Corporation
8-11 Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302,
Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "ЛАБТРОНИКА" Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1

**Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx
(для «in vitro» диагностики)
(Вариант исполнения 1)**

РУ № _____ от _____ 20__ г

Картридж с буфером 1 – 6 шт.

Картридж с буфером 2 – 6 шт.

Одноразовый наконечник с фильтром – 96 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12шт.

Крышка пробирки для элюирования 0,2 мл. - 12шт.

Пробирка для загрузки образца – 96 шт.

Лоток для отходов – 3 шт.

Защитная крышка – 12 шт.

Защитное устройство от загрязнений из фильтровальной бумаги – 12 шт.



REF

См. на упаковке



См. на упаковке

LOT

См. на упаковке



См. на упаковке

IVD

Bioneer Corporation
8-11 Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "ЛАБТРОНИКА" Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1

Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
Вариант исполнения 2. Внешняя упаковка



Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
Вариант исполнения 2.






Одноразовый наконечник с фильтром –96 шт



Пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12шт.; Крышка пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12 шт.;

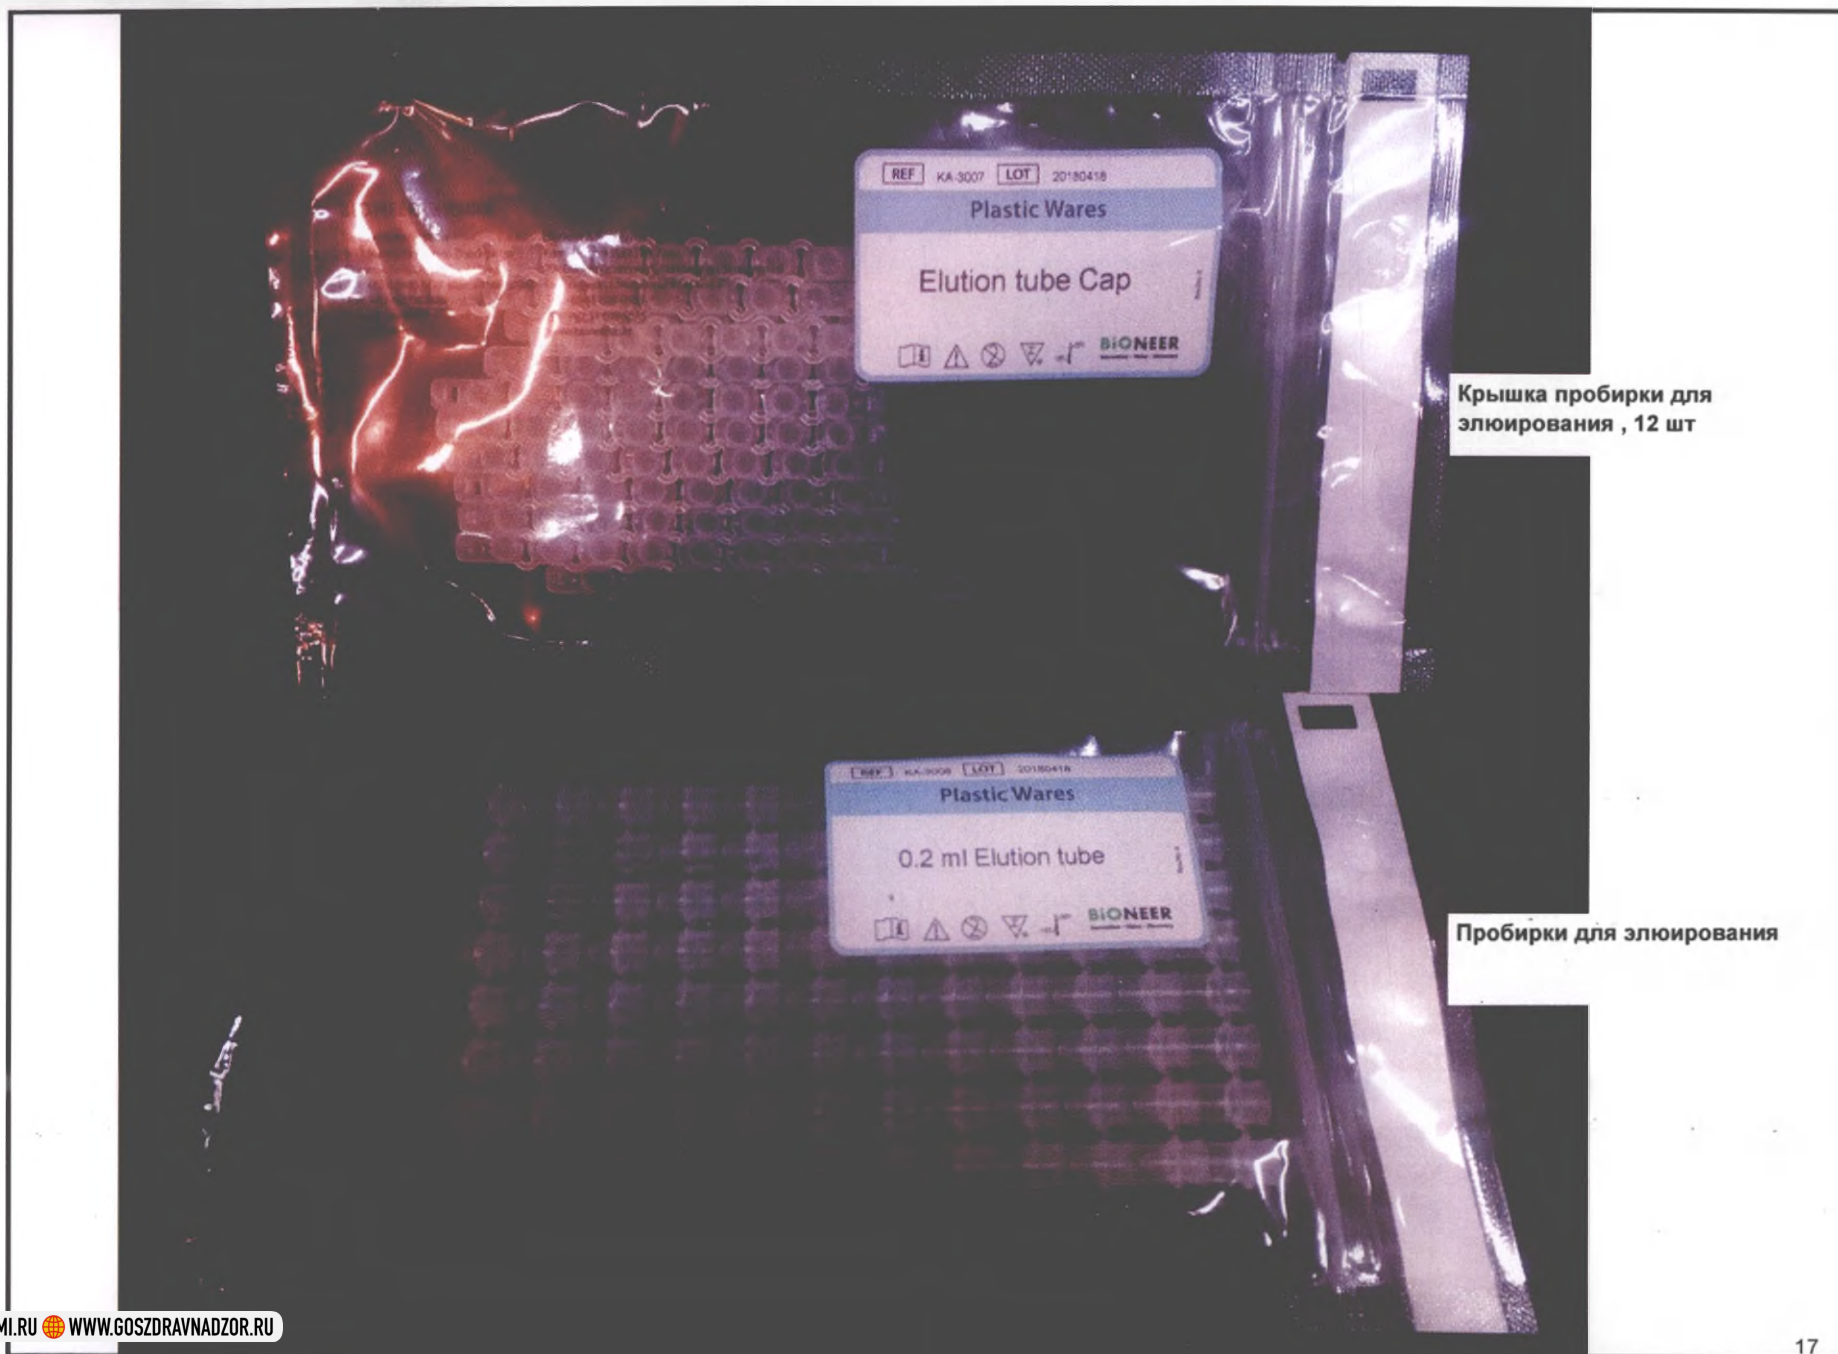

Крышка пробирки для элюирования , 12 шт

Пробирки для элюирования

Пробирка для загрузки образца – 96 шт



Пробирка для загрузки образца с внутренним контролем РНК – 96 шт



Лоток для отходов — 3 шт



Защитная крышка—12 шт.



Защитное устройство от загрязнений из фильтровальной бумаги – 12 шт.



Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики).
Вариант исполнения 2. Макеты дополнительной маркировки для РФ



Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx (для «in vitro» диагностики)
(Вариант исполнения 2)

Пробирка для загрузки образца с внутренним контролем РНК – 96 шт.

РУ № _____ от _____ 20__ г

REF

См. на упаковке



См. на упаковке

LOT

См. на упаковке



См. на упаковке



IVD

Bioneer Corporation
8-11 Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302,
Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "ЛАБТРОНИКА" Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1

Набор для выделения вирусной ДНК/РНК из образцов сыворотки и плазмы крови ExiPrep Dx
(для «in vitro» диагностики)
(Вариант исполнения 2)

РУ № _____ от _____ 20__ г

Картридж с буфером 1 – 6 шт.

Картридж с буфером 2 – 6 шт.

Одноразовый наконечник с фильтром – 96 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Пробирки для элюирования 0,2 мл. – 12шт.

Крышка пробирки для элюирования 0,2 мл. - 12шт.

Пробирка для загрузки образца – 96 шт.

Лоток для отходов – 3 шт.

Защитная крышка – 12 шт.

Защитное устройство от загрязнений из фильтровальной бумаги – 12 шт.

REF

См. на упаковке



См. на упаковке

LOT

См. на упаковке



См. на упаковке



IVD

Bioneer Corporation
8-11 Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО "ЛАБТРОНИКА" Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.2, стр.1

Прошито и пронумеровано
24 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ЛАБТРОНИКА»
Л.Л. Альбертян

