


Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101.

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101.

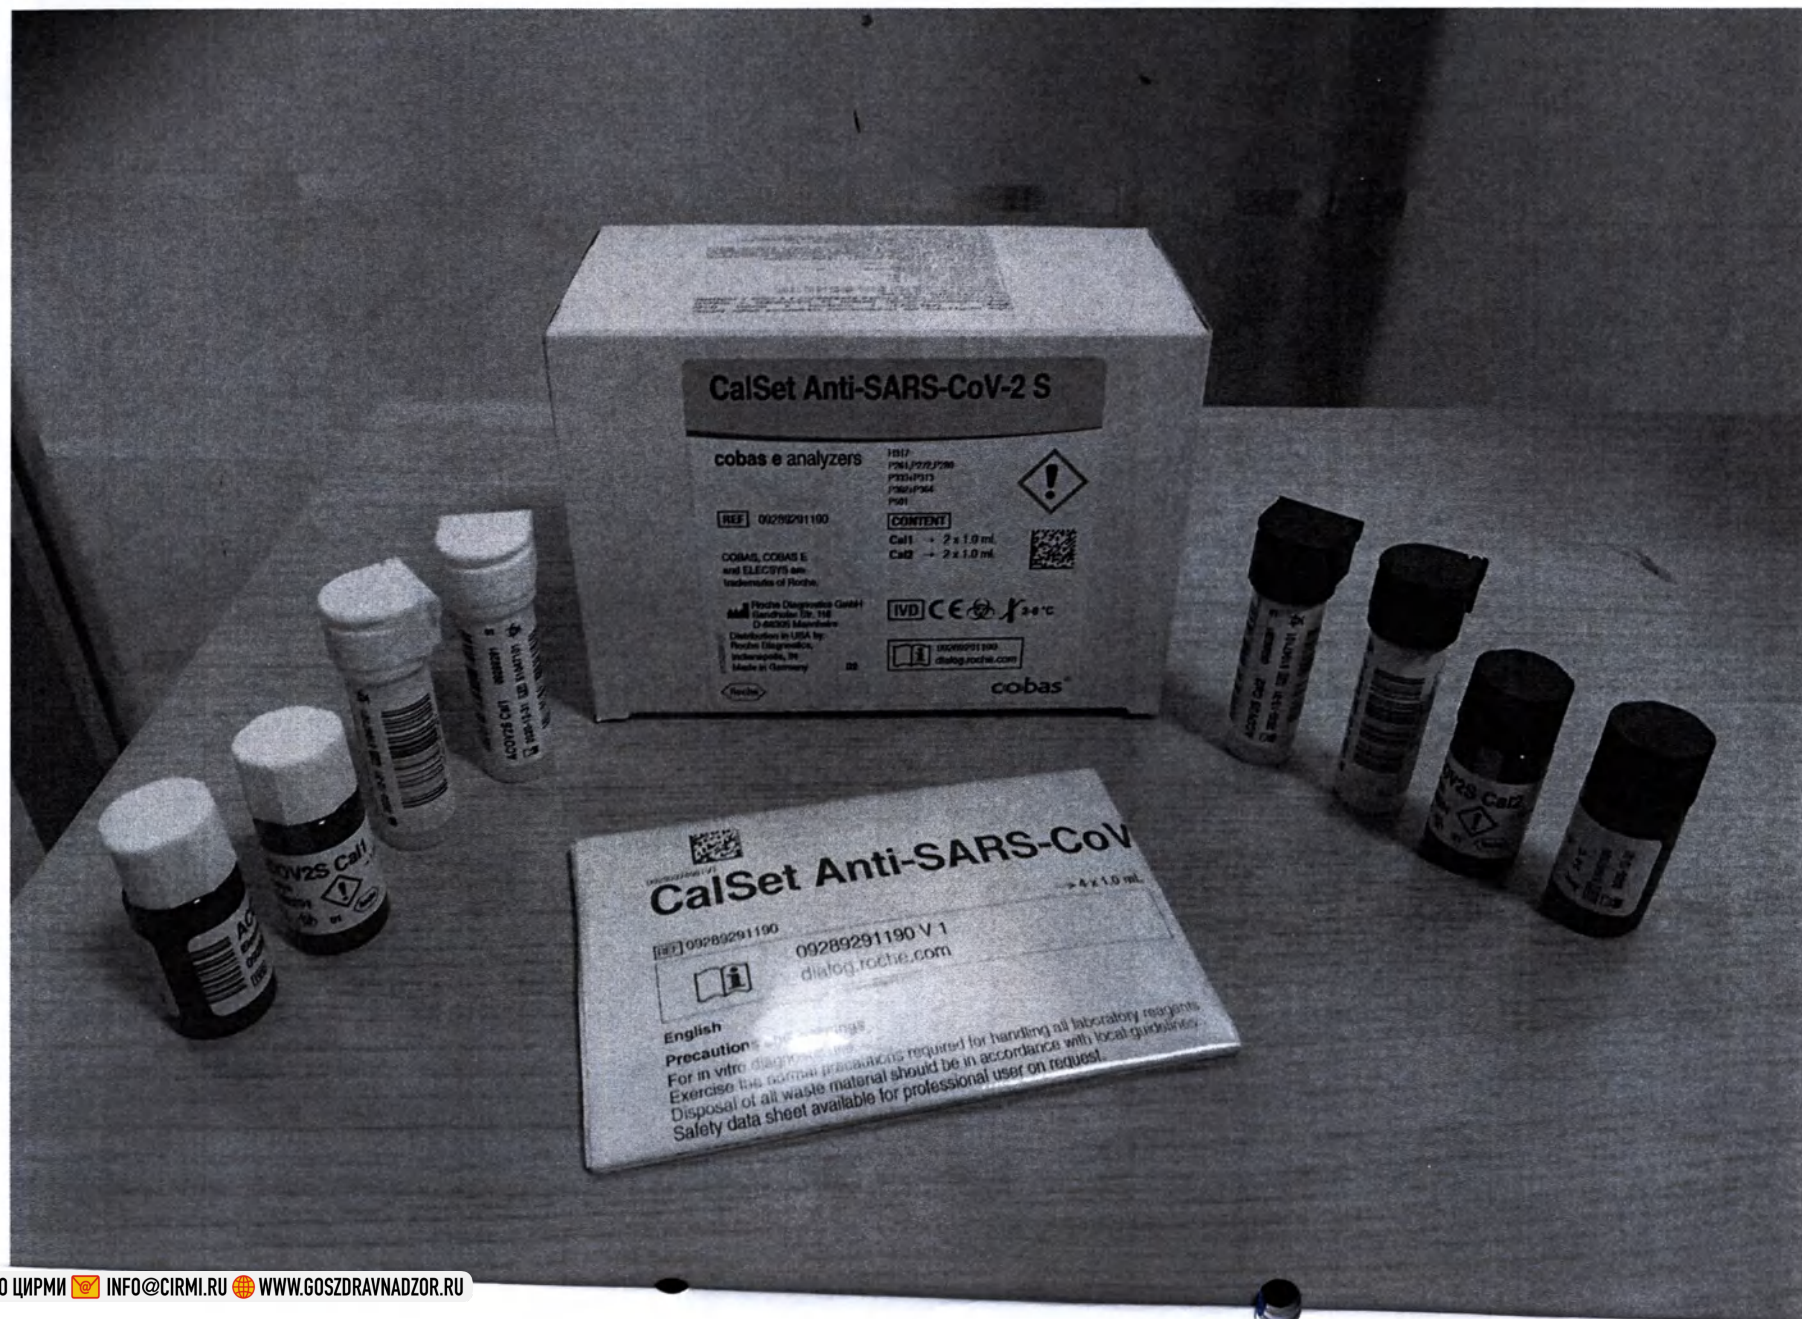

CalSet Anti-SARS-CoV-2 S

cobas e analyzers

REF 09289291190

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

01020293001(1)

02

H317
P261,P272,P280
P333+P313
P362+P364
P501

CONTENT

Cal1 → 2 x 1.0 mL

Cal2 → 2 x 1.0 mL



IVD   2-8 °C

 09289291190
dialog.roche.com

cobas®

CalSet Anti-SARS-CoV-2 S

For USA: **CONTENT**

For Emergency Use Authorization only

Cal1: Serum spiked with serum from
anti-SARS-CoV-2-S positive donors

Cal2: Serum spiked with serum from
anti-SARS-CoV-2-S positive donors

REF 09289291190

LOT 51047101

 2020-12-31

 2020-09-04

GTIN 07613336180686

Rx only

01



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101, в составе:

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт;
2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт;
3. Флакон пустой – 4 шт;
4. Карта со штрих-кодом – 1 шт;
5. Этикетки для флаконов – 12 шт;
6. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HbAg отсутствуют
Содержащая анти-SARS-CoV-2 антитела сыворотка крови, использованная для приготовления калибратора, была инактивирована нагреванием в течение 30 минут при 56 °C.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2
Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64
E-mail: moscow.reception_dia@roche.com
Кат. номер 09289291190


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;




Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

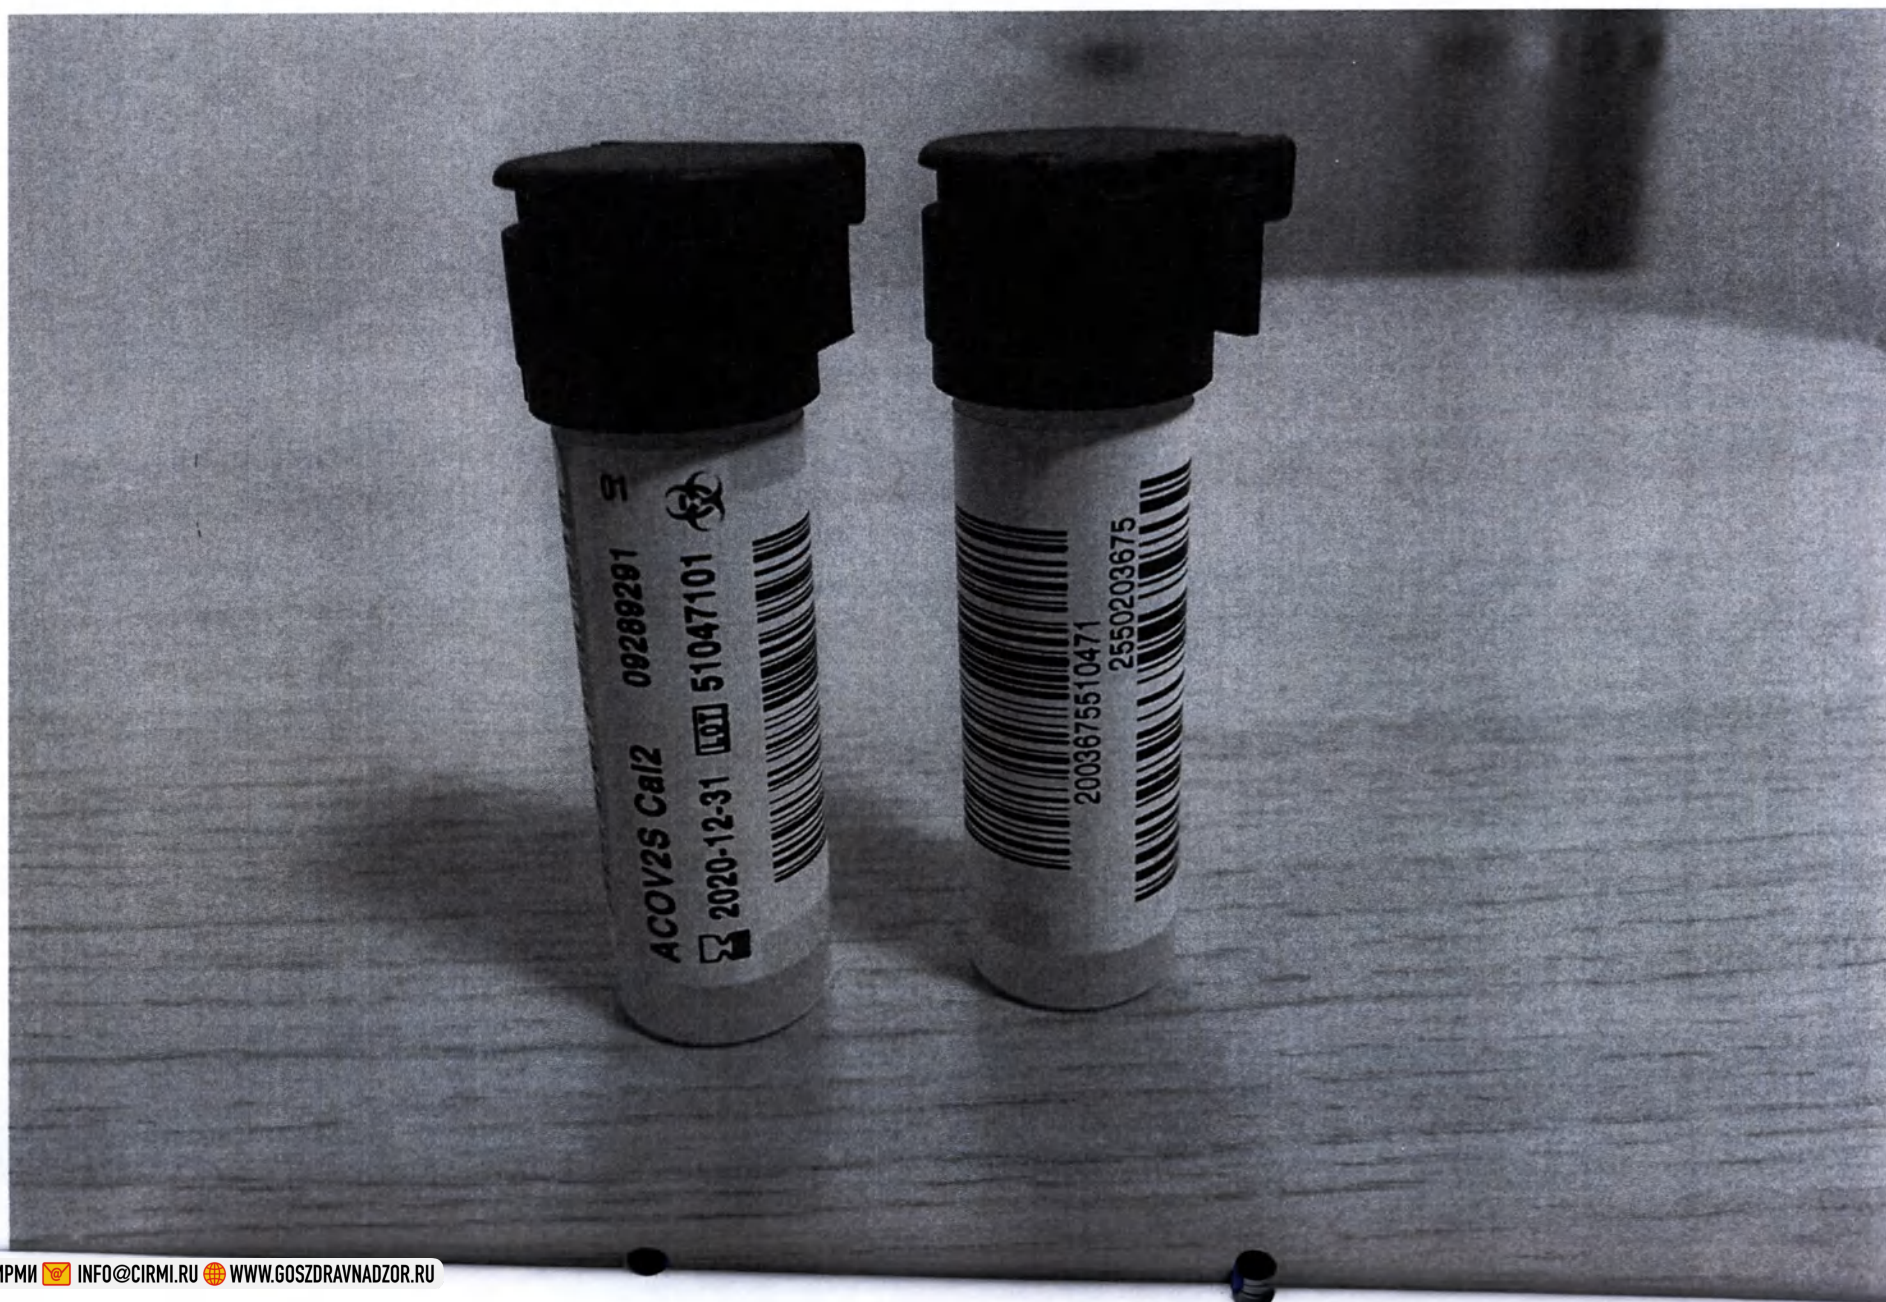


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

3. Флакон пустой – 4 шт.;

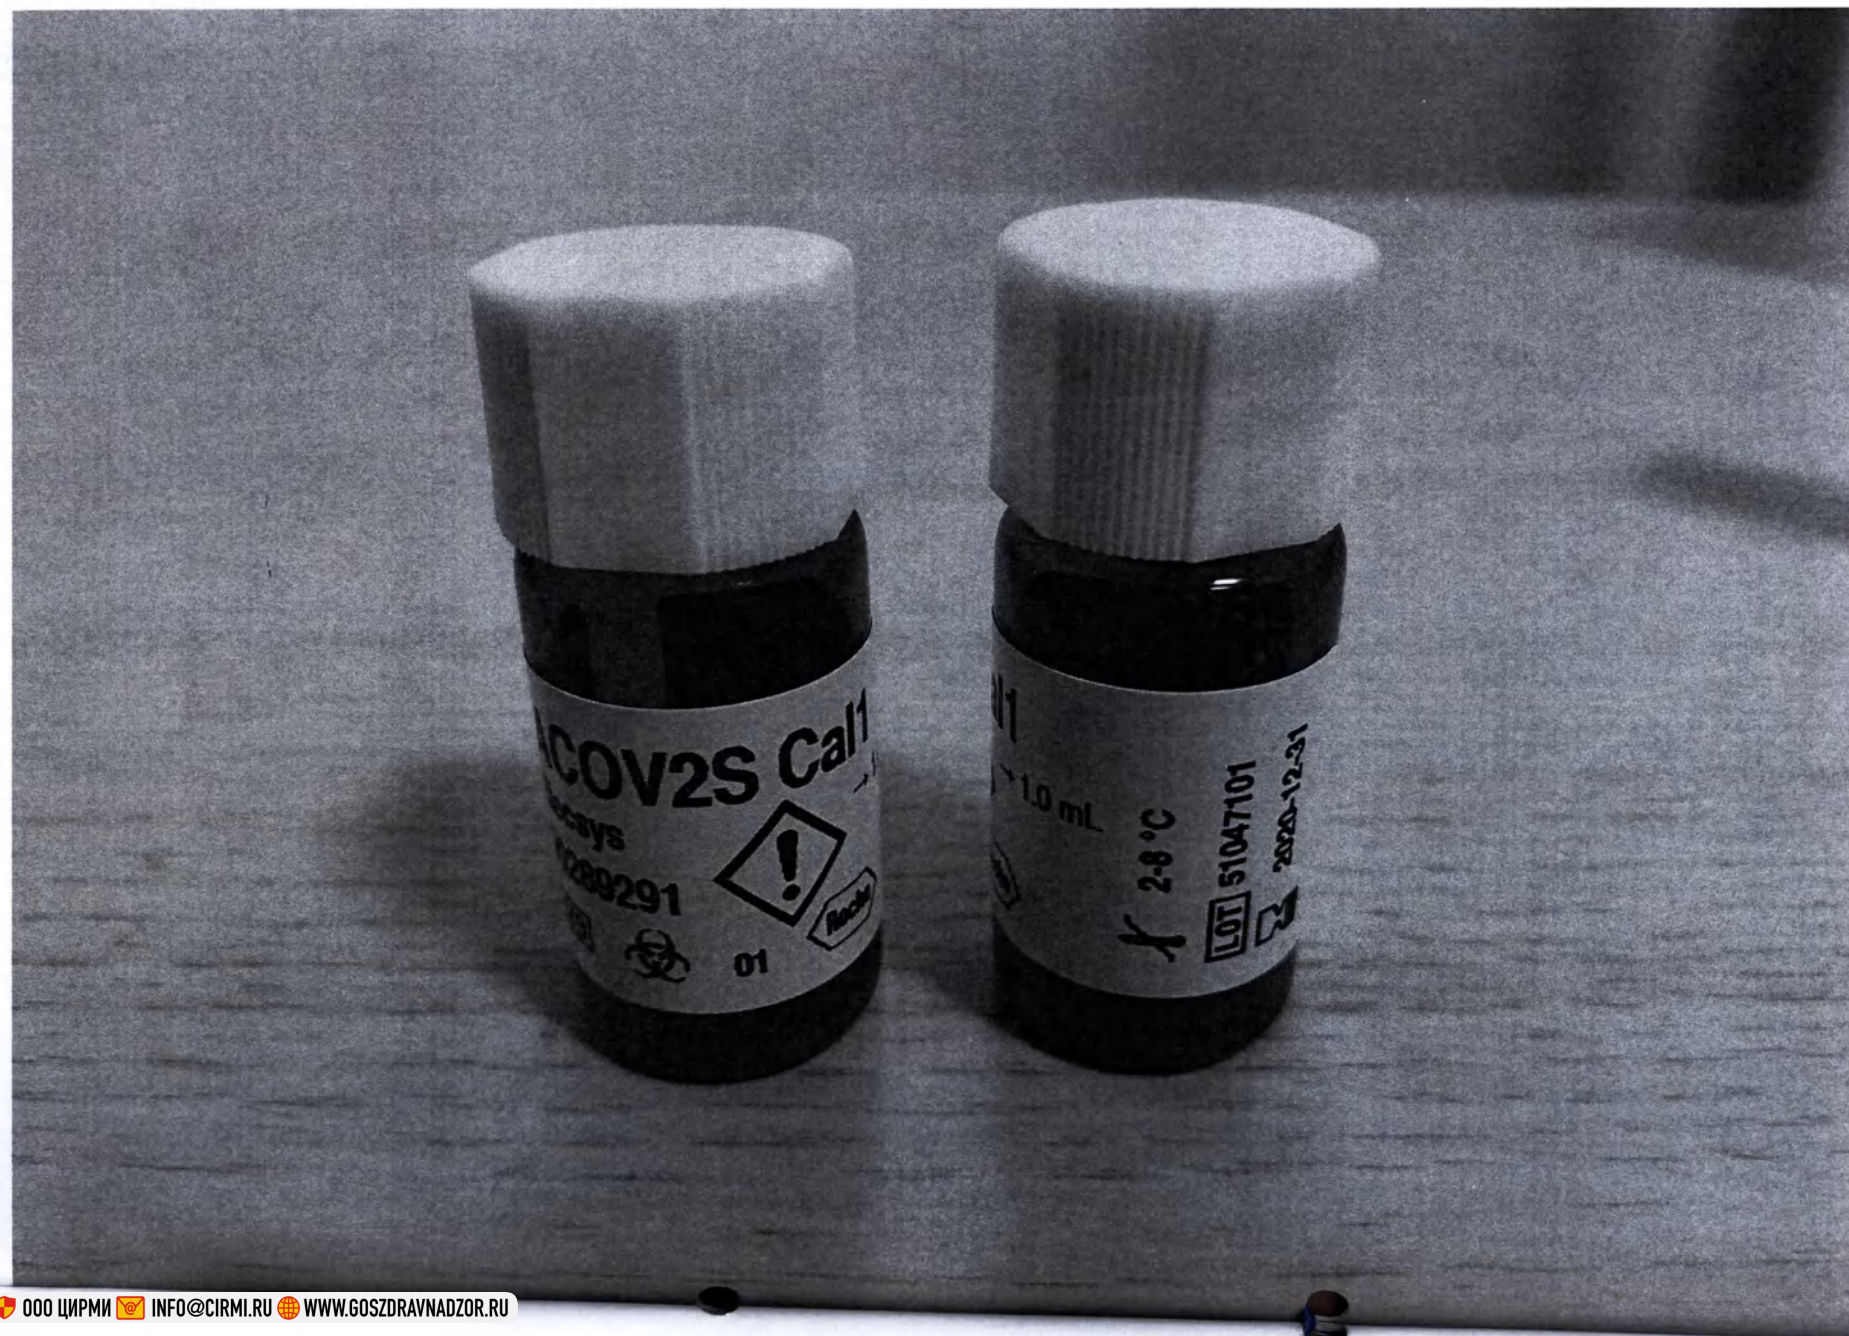

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

3. Флакон пустой – 4 шт.;

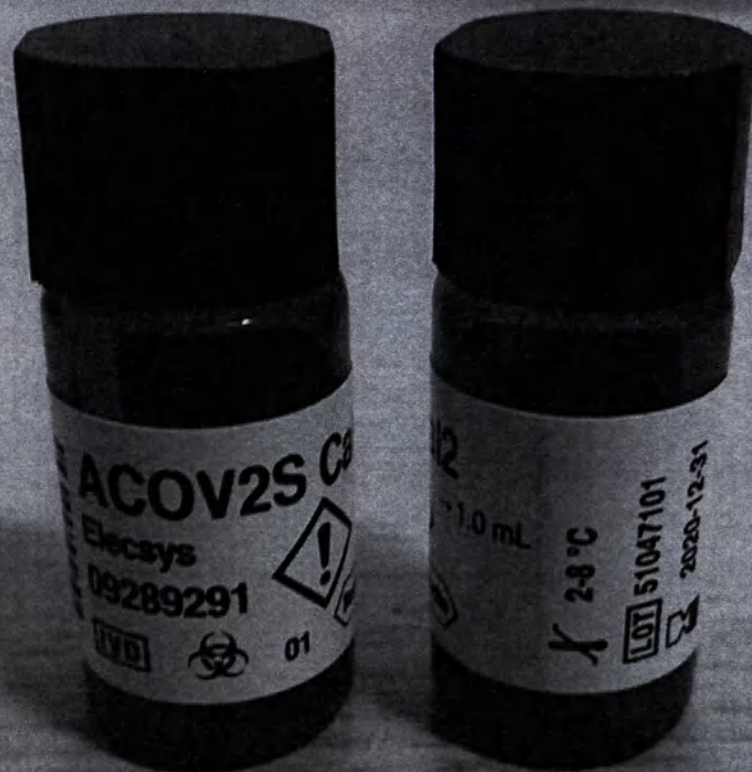

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

4. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;




серия e analyzers
09280291
25.10
LOT 510471

01

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Серия: LOT 51047101

5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;

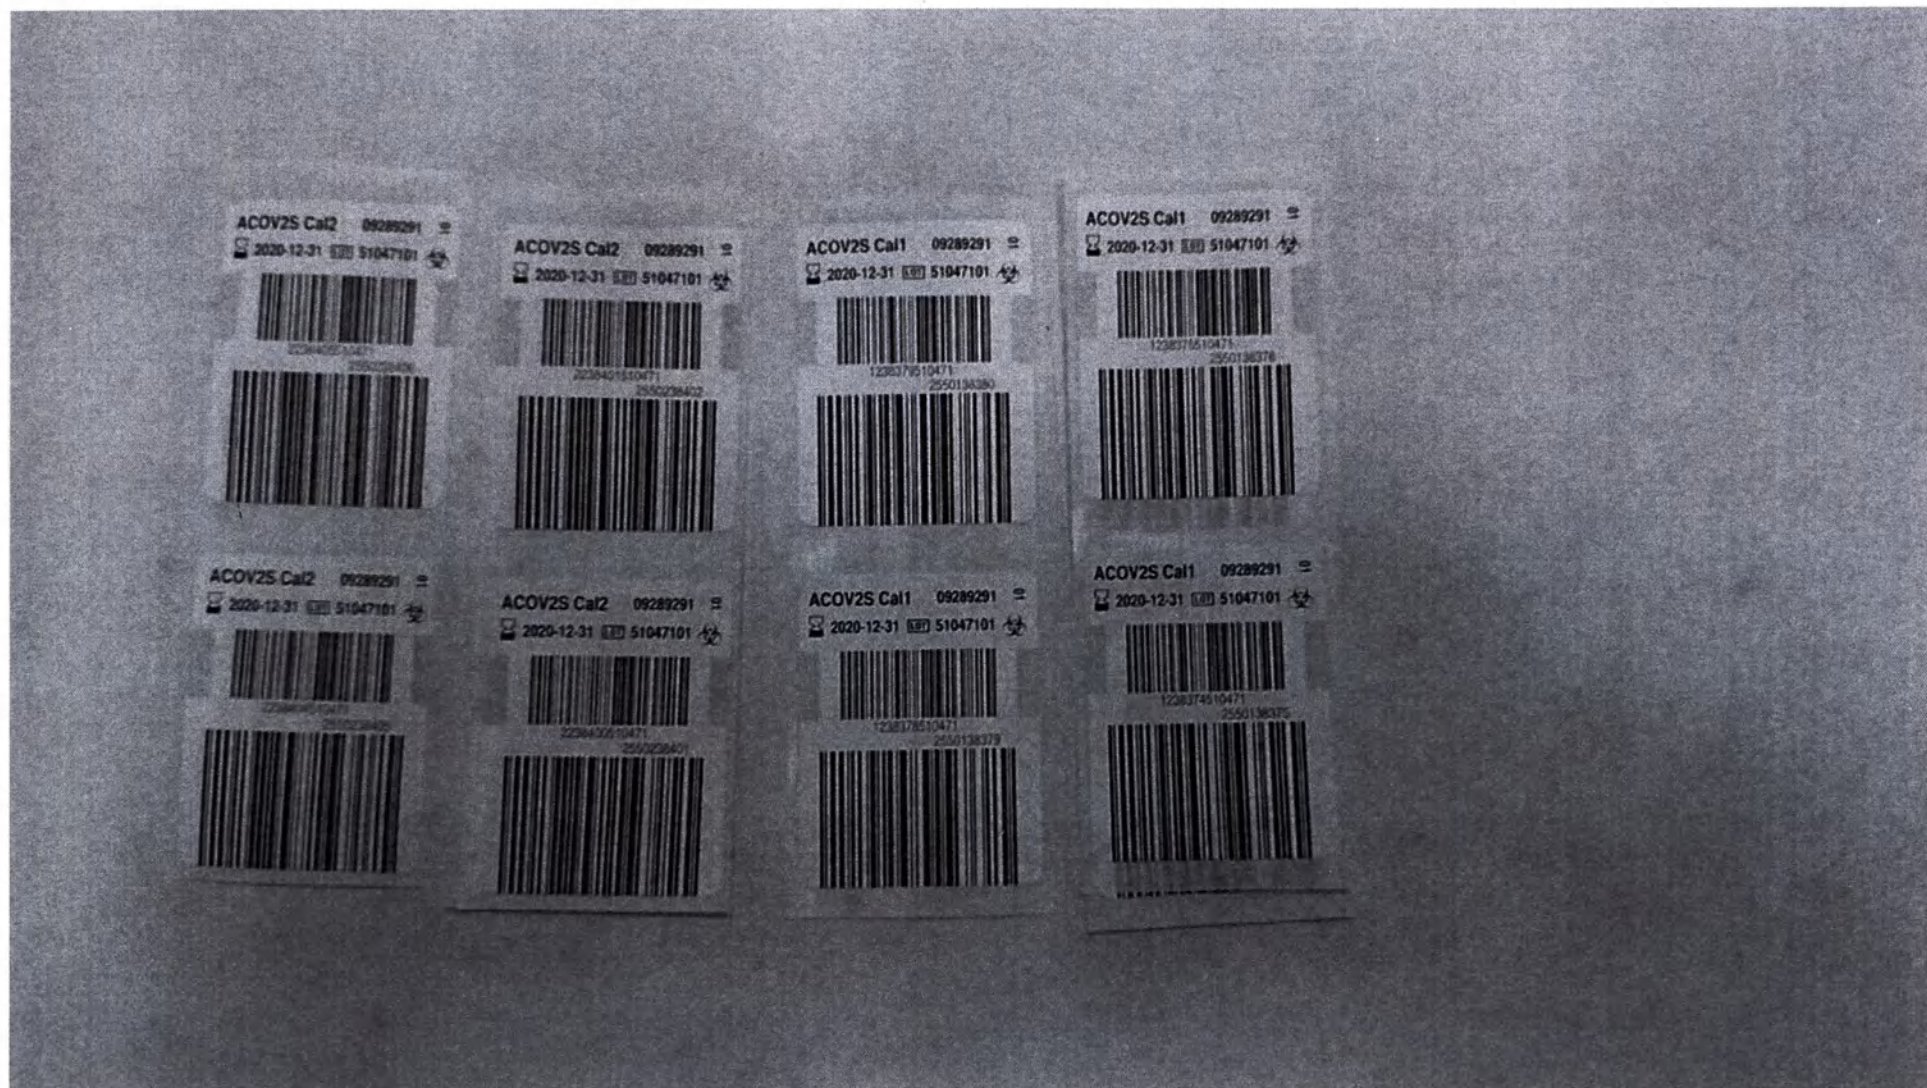

6. Инструкция по применению.

cobas

4710 m

[illegible]

Journal of Management Education

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

100

There is a lot of information in this book, and it is well organized. The book is written in a clear, concise, and easy-to-read style. The book is a good resource for anyone interested in the history of the United States.

...the ...

1. **THE COMPANY** shall be a corporation organized under the laws of the State of New York, and shall have the right to do business in any and all states and territories of the United States.

biochemical and molecular genetic studies. The results of these studies are discussed in the context of the current understanding of the pathogenesis of the disease.

Call us today for a free estimate of your home's energy needs. We'll be glad to help you find the best energy solution for your home.

EG 50714, *Peromyscus* sp. (Carniv.)

participation is required to meet the 5% threshold.

moderate intensity activities, such as walking, swimming, and gardening, and to avoid strenuous activities, such as heavy lifting, pushing, and pulling. Patients should be encouraged to maintain a healthy weight, as obesity can increase the risk of complications. Smoking cessation is also recommended, as smoking can impair wound healing and increase the risk of infection. Patients should be encouraged to follow up with their healthcare provider for ongoing monitoring and support.

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Решающими факторами успеха

Решающие факторы успеха проекта, определяющие возможность выполнения работ в заданные сроки, являются:

- 1) наличие финансирования работ;
- 2) наличие квалифицированных специалистов;
- 3) наличие необходимых материалов и оборудования;
- 4) наличие необходимых помещений и оборудования;
- 5) наличие необходимых документов.

Вопросы организации и управления

Наименование: *Staphylococcus aureus* (золотистый стафилококк).
Характеристика: Голый, сферический, неподвижный, не образует спор. Температурный оптимум 37°C. Растет на большинстве питательных сред. Устойчив к высоким температурам (до 70°C). Устойчив к дезинфектантам. Значительная патогенность. Вызывает различные заболевания. Устойчив к антибиотикам.

разнообразия.

Анализаторы cobas e 501, cobas e 502 и cobas e 501. Единица

Anatrista topi cobas = 507, cobas = 502 + cobas = 507. Extra 20% transfered via feces. Autochthonic soil transferred from 1986-1987.



Каждый образец исследовали только на одной температуре.

кандидат.

Содержание выпуска в рубрике «Экономика» — 601; Как сэкономить деньги. Так и почувствовать себя богатым — 601.

достигает содержания 2 разности углекислот. Поверхность флакона на 180° в противоположные стороны разведена по

unpublished manuscript, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 267

Хранение и стабильность

Хранить при $2-8^{\circ}\text{C}$.

Политические институты относятся к основным
сферам родства.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

CPM-2000's particle count rate was approximately	
1000-2000 CPM (4.5°C)	6 months

112

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 ИЮЛ 2019