

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»




Чэнь Син


2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


«Система ультразвуковая диагностическая DC с принадлежностями, варианты исполнения: DC-55, DC-60, DC-60 Pro, DC-60
Exp»

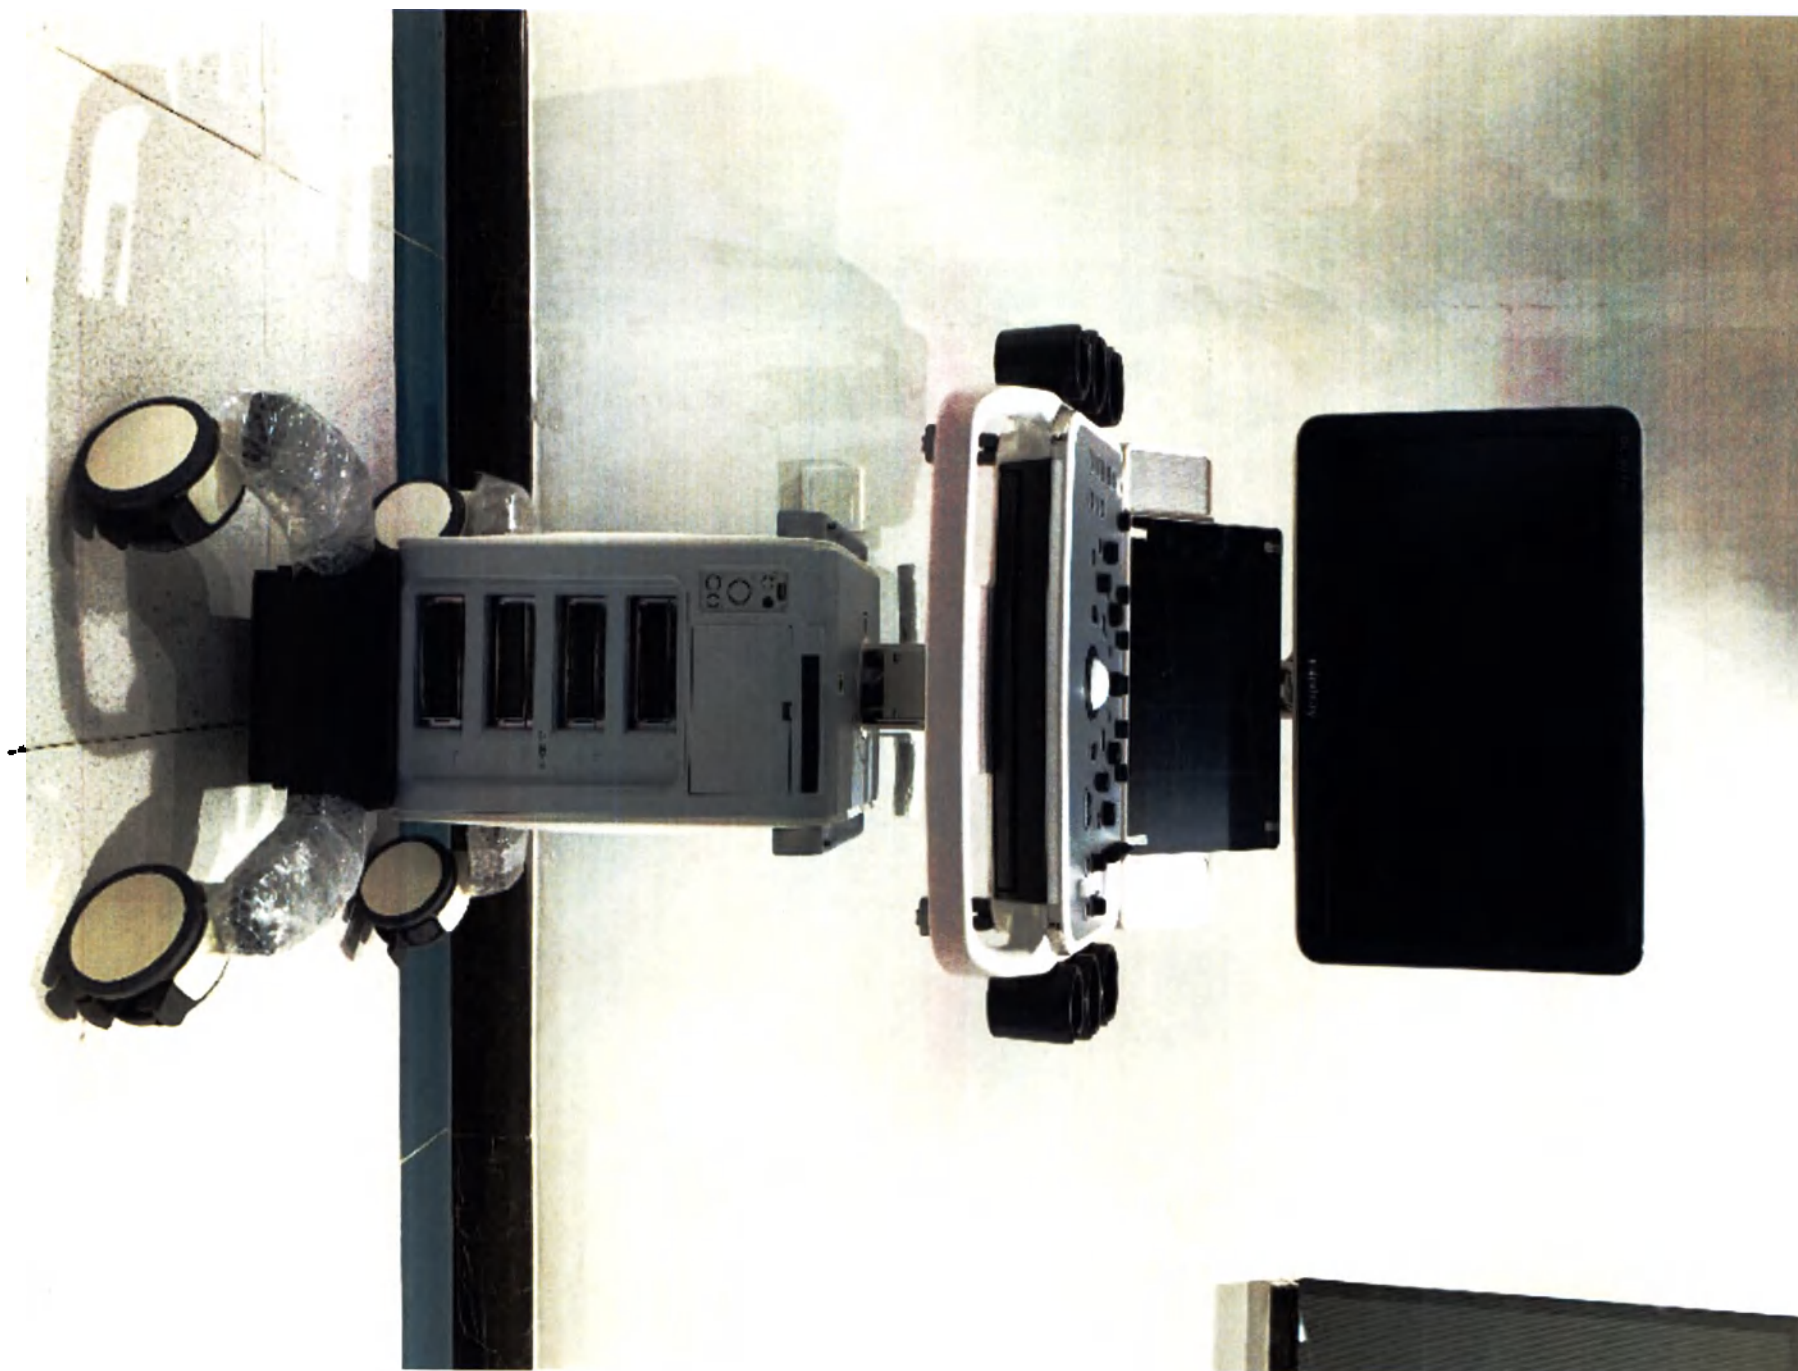

Система ультразвуковая диагностическая DC, варианты исполнения: DC-55, DC-60, DC-60 Pro, DC-60 Exp.: основной блок (Main unit). Вид спереди

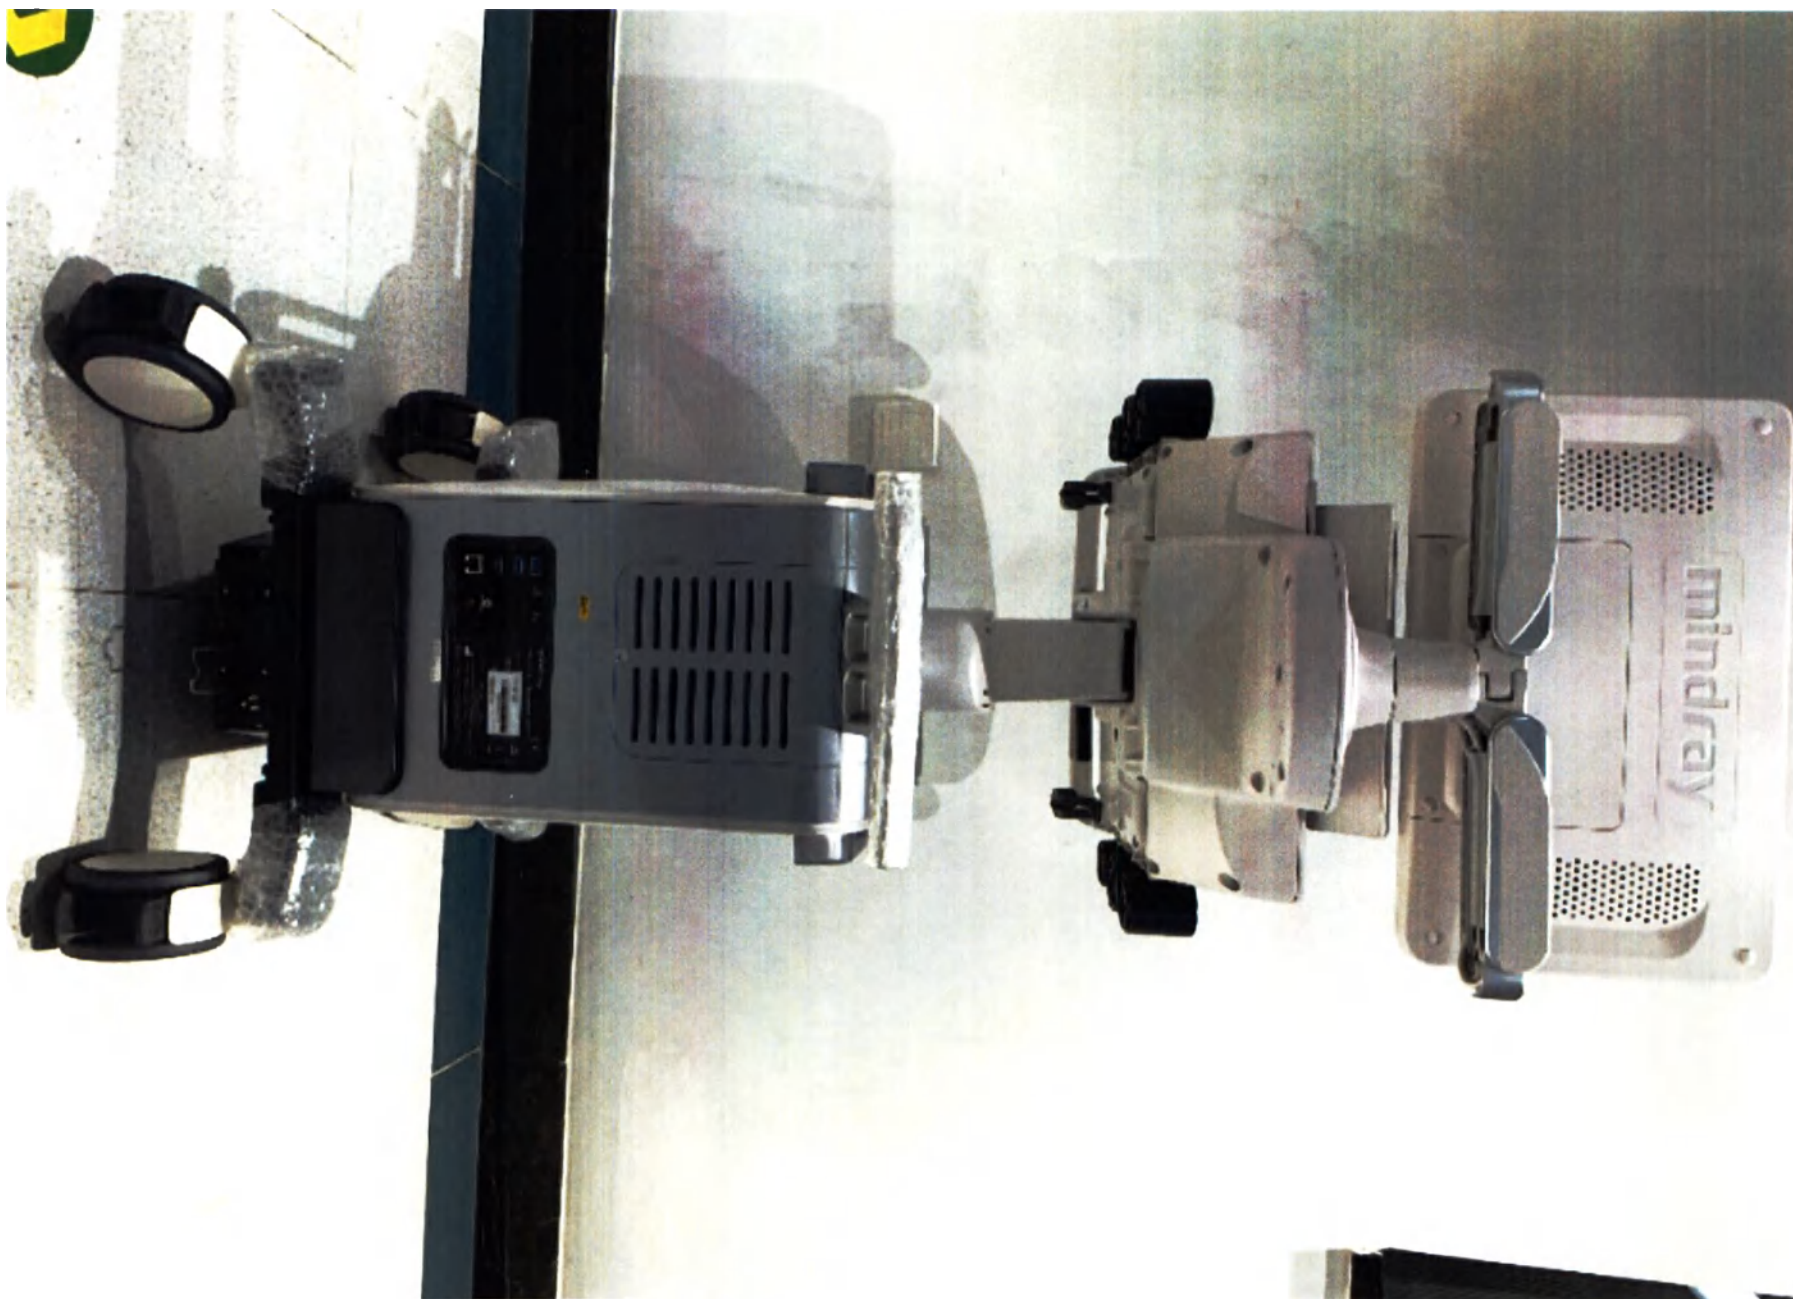

Система ультразвуковая диагностическая DC, варианты исполнения: DC-55, DC-60, DC-60 Pro, DC-60 Exp.: основной блок (Main unit). Вид сзади

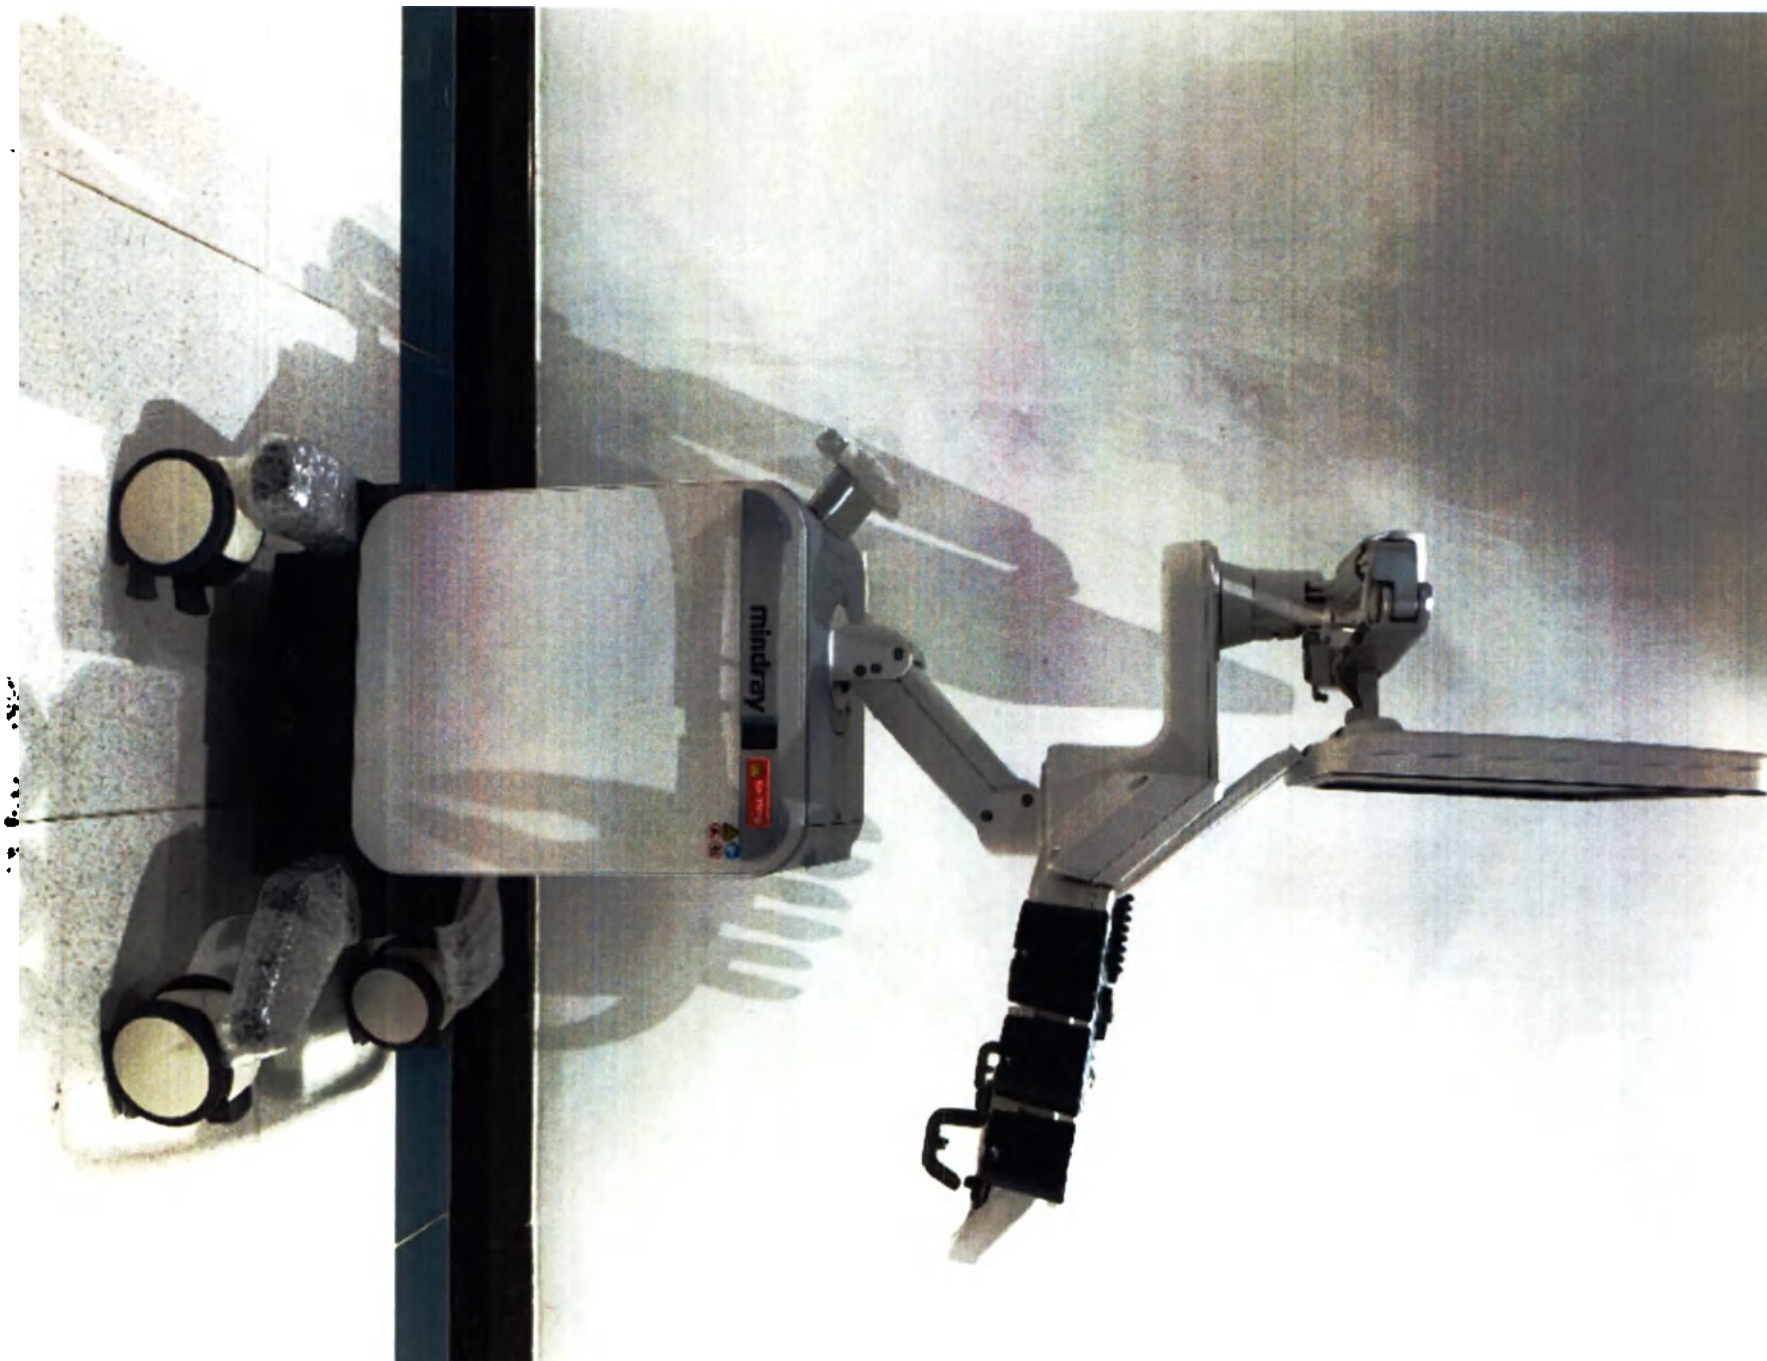

Система ультразвуковая диагностическая DC, варианты исполнения: DC-55, DC-60, DC-60 Pro, DC-60 Exp.: основной блок (Main unit). Вид сбоку



Предупреждающие этикетки





Маркировка основного блока и панель ввода/вывода







Кабель питания (Power cord)

DC-60/DC-60 Pro/DC-60 Exp/DC-60S/DC-65/
DC-65 Pro/DC-65 Exp/DC-65S/DC-65T/DC-61/
DC-62/DC-63

Диагностическая ультразвуковая
система

Руководство оператора

[Стандартные процедуры]

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

Пн - Пт., 9:00-18:00


mail.ruservice@mindray.com

mindray


Руководство оператора печатное (Operator's Manual print)



Датчик ультразвуковой конвексный 3C5A (Convex array transducer, 3C5A)

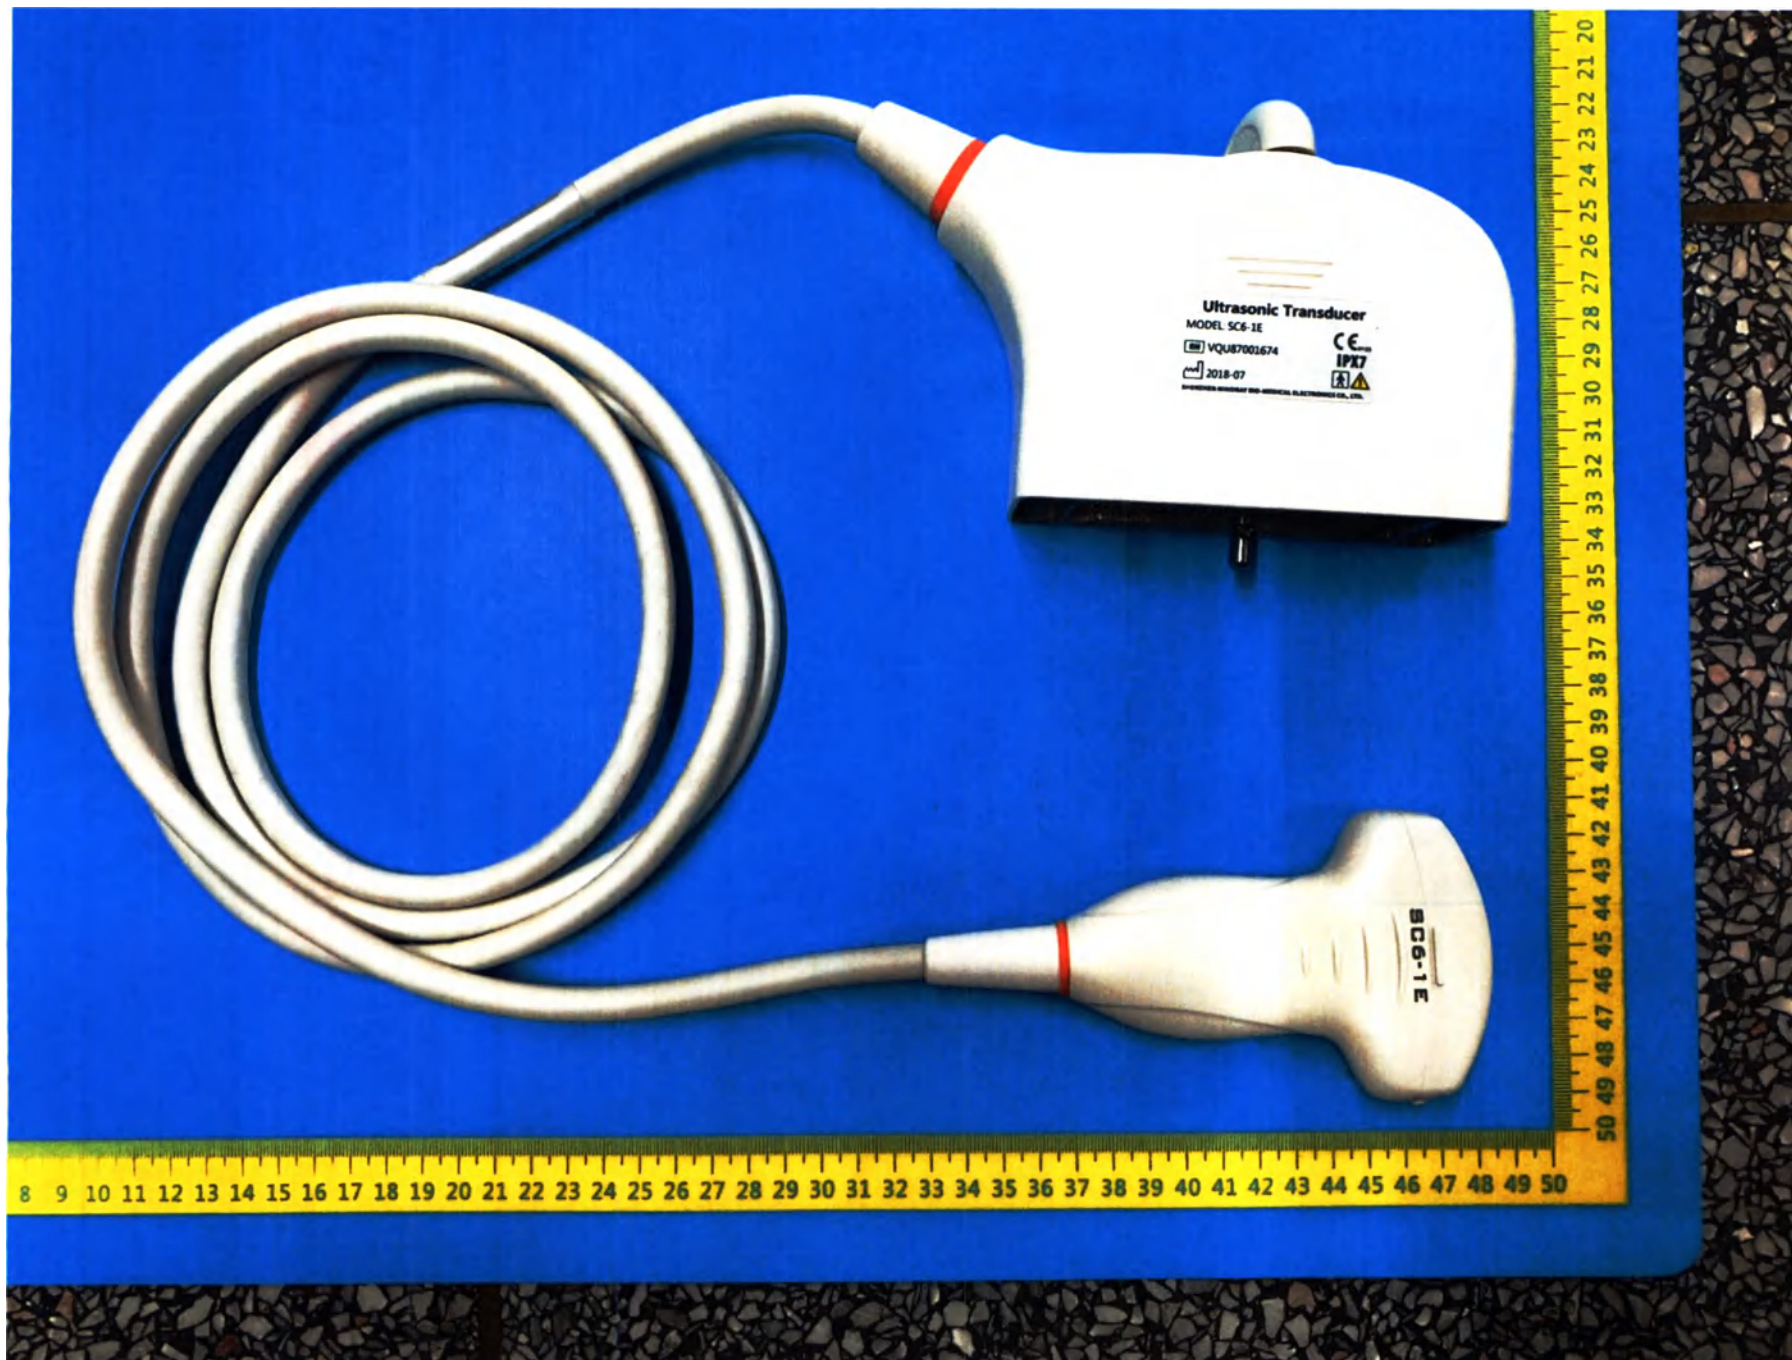


Датчик ультразвуковой конвексный SC6-1E (Convex array transducer, SC6-1E)

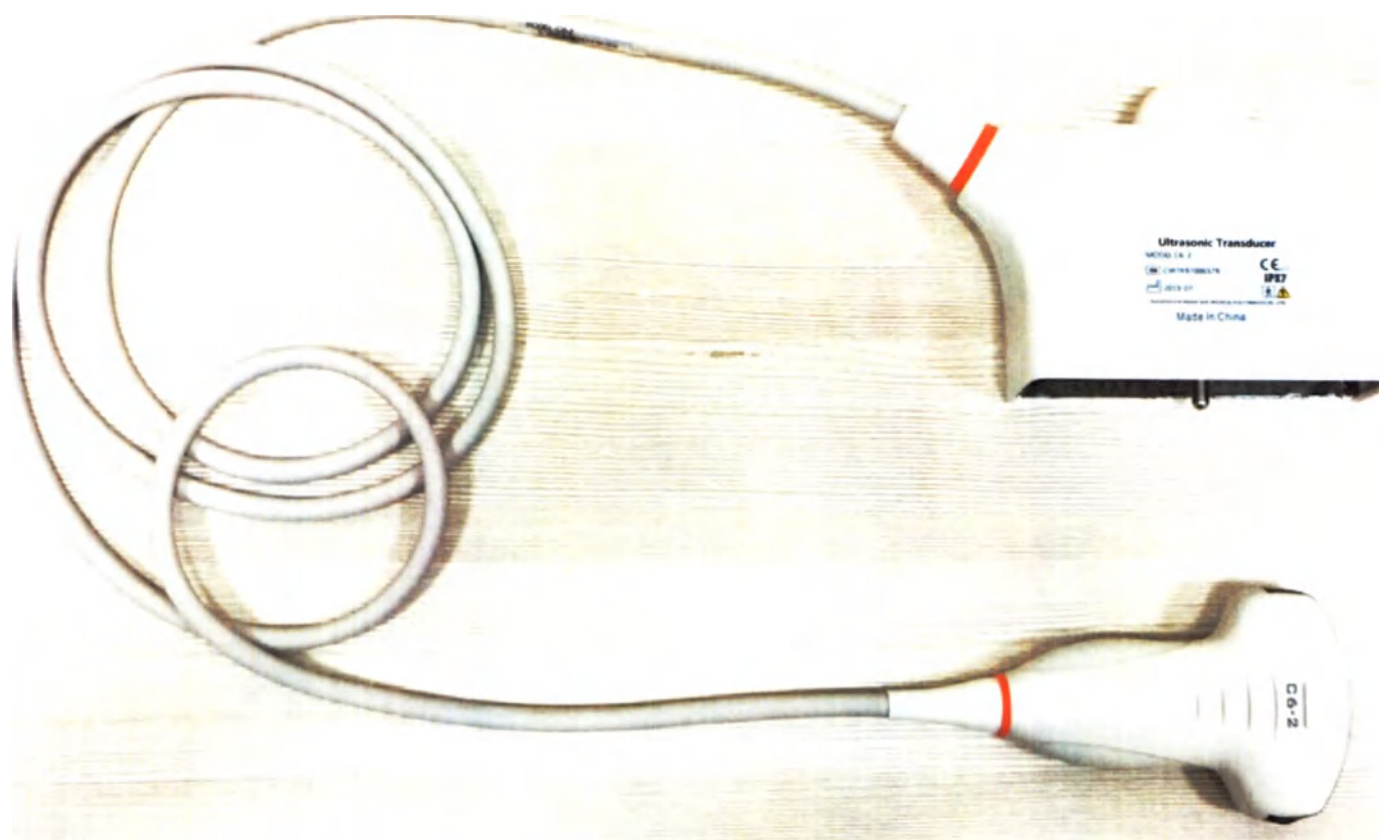

Датчик ультразвуковой конвексный С6-2 (Convex array transducer, C6-2)




Датчик ультразвуковой конвексный C5-2 (Convex array transducer, C5-2)

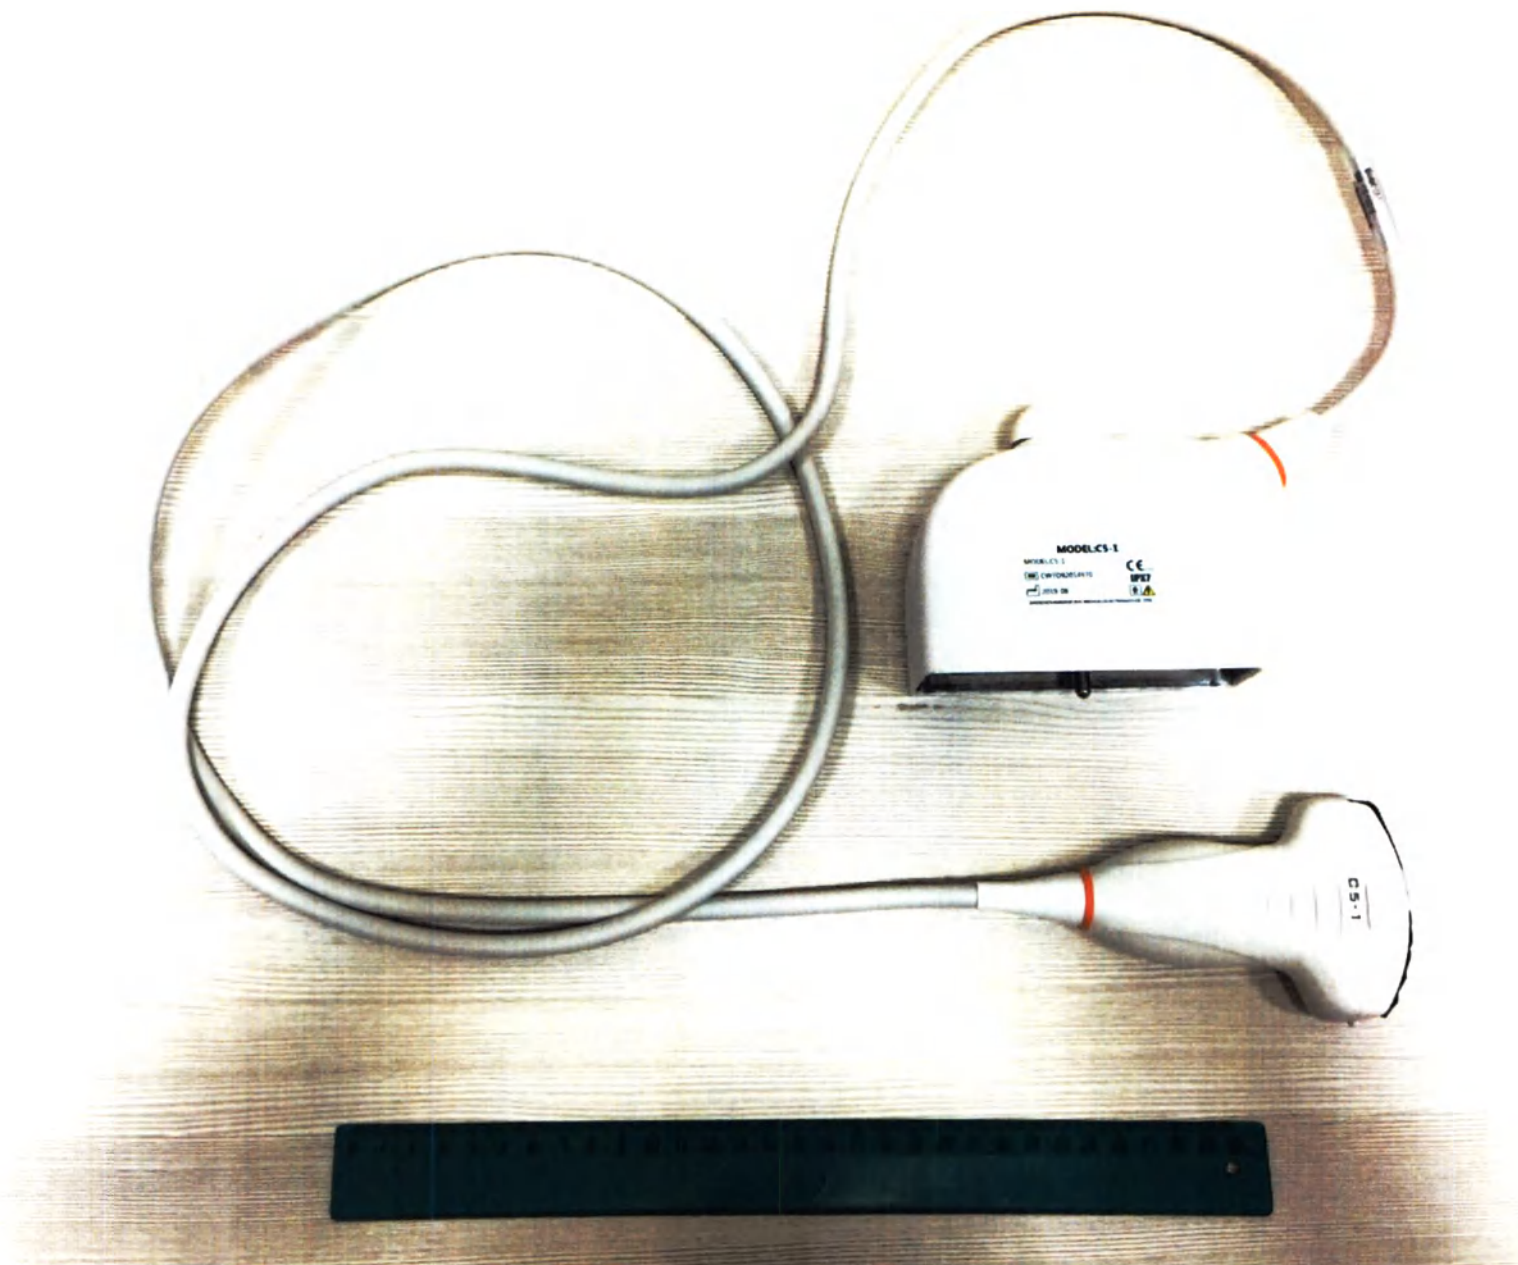


Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 (Convex array transducer, C5-1)


Датчик ультразвуковой микроконвексный 6С2 (Micro-convex array transducer, 6C2)




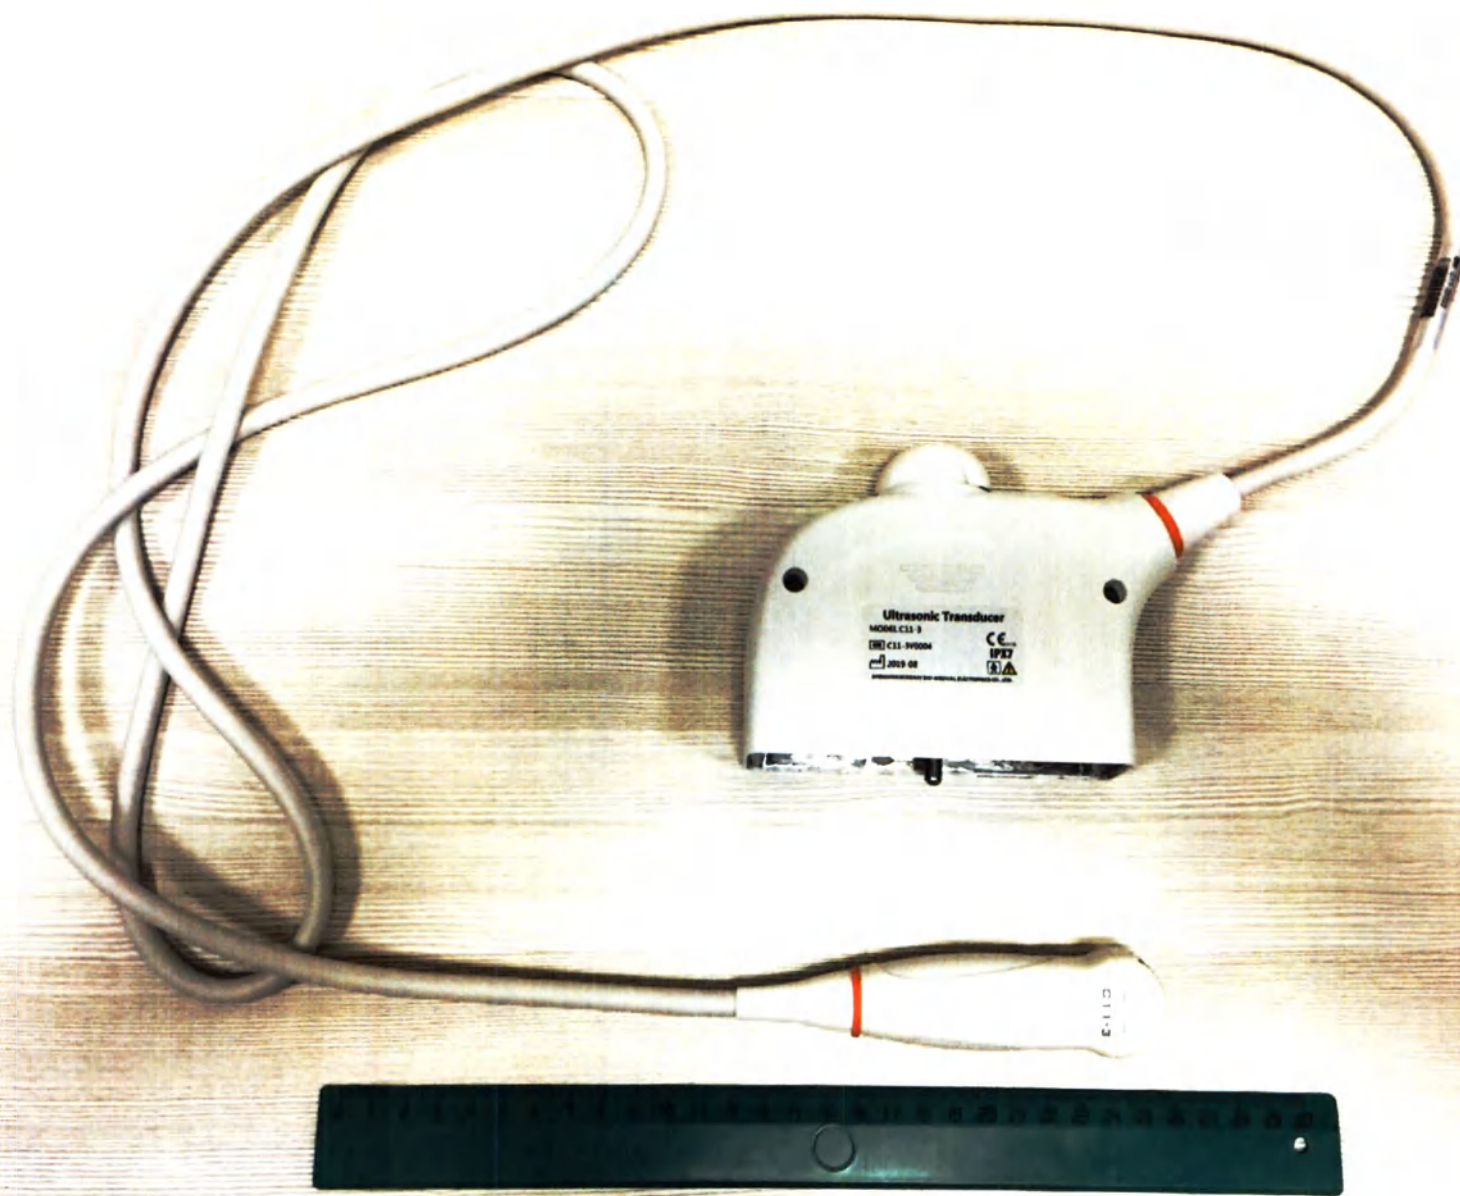





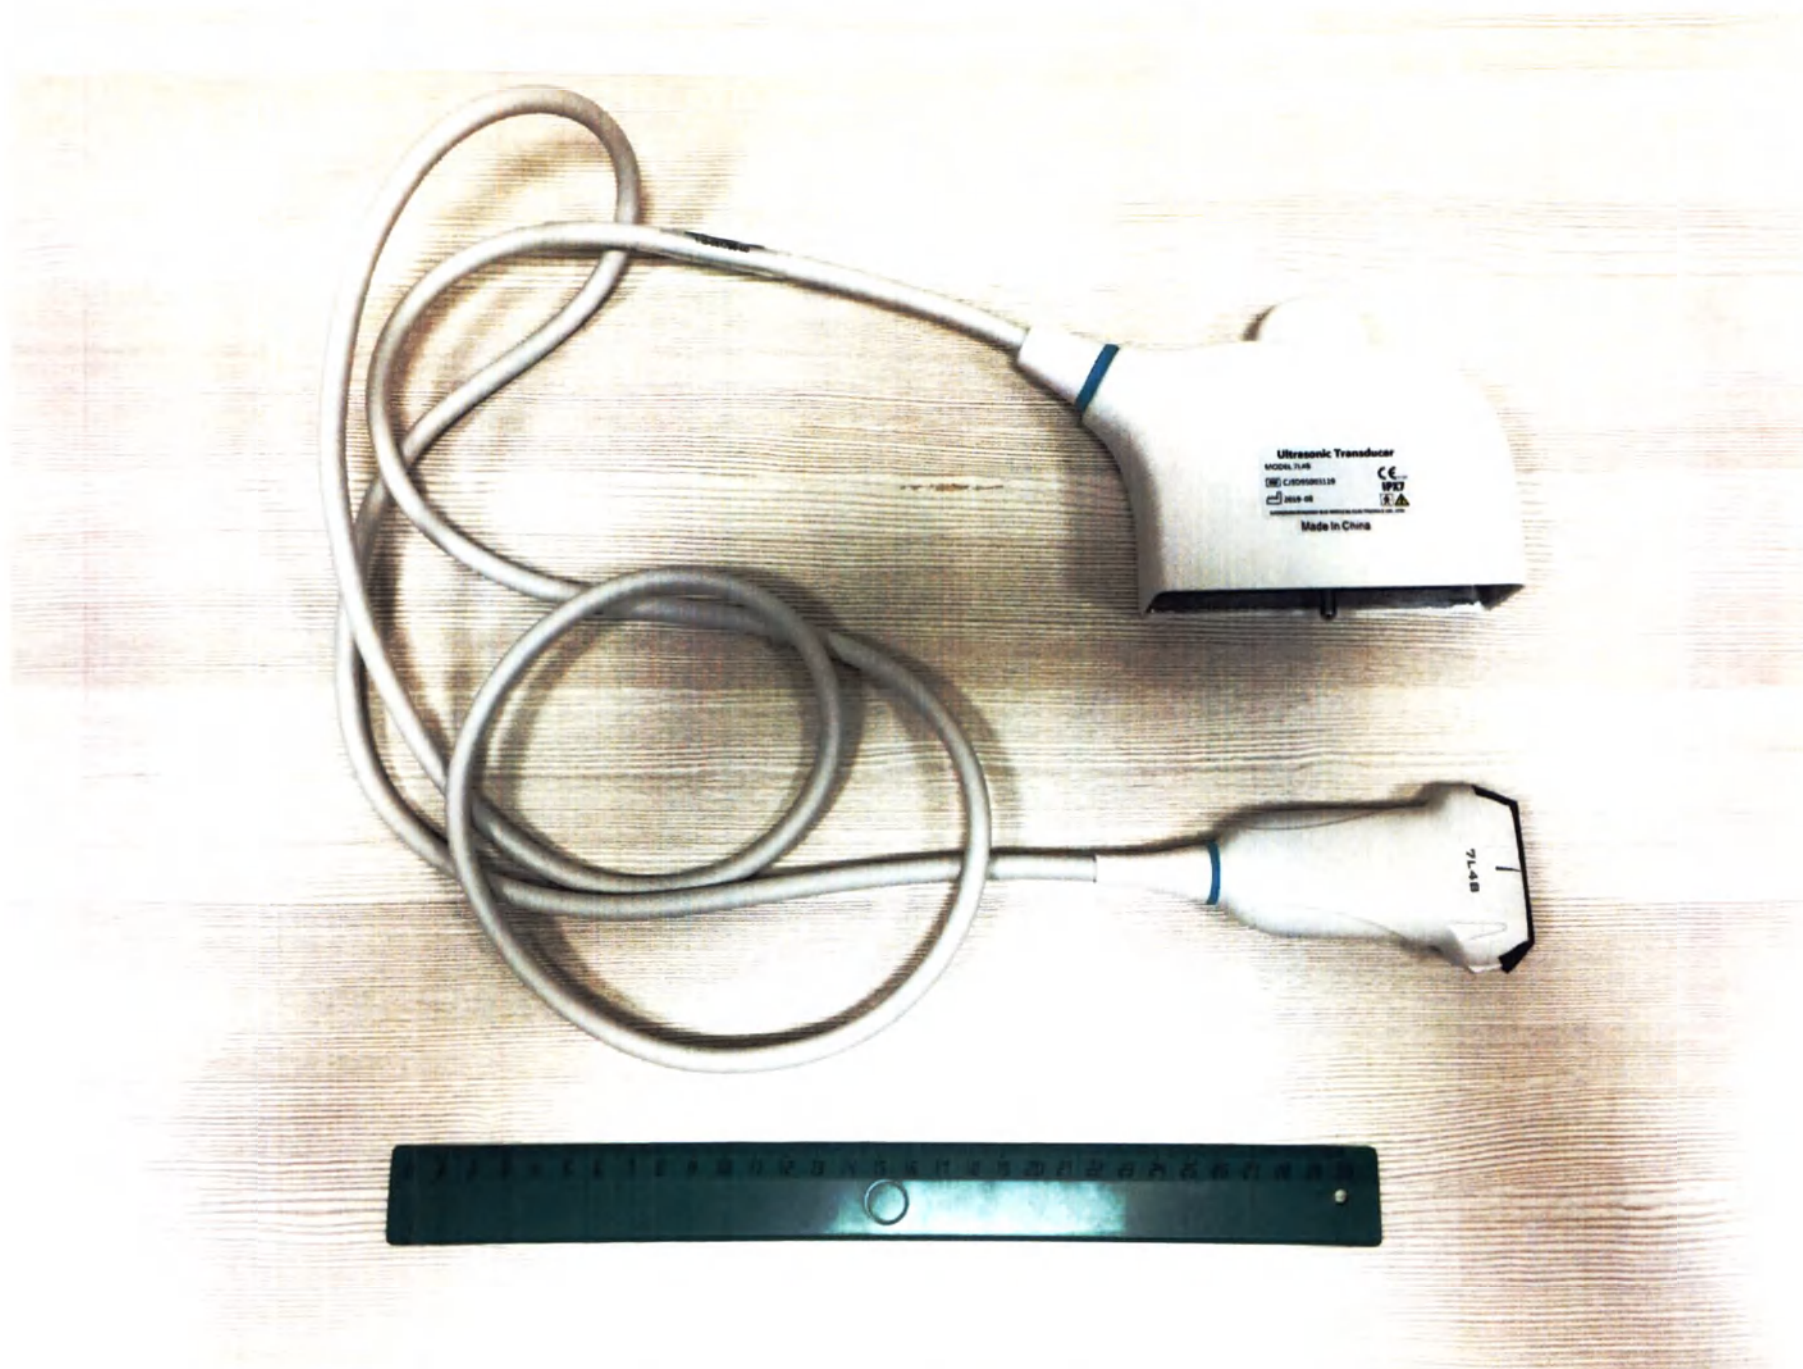

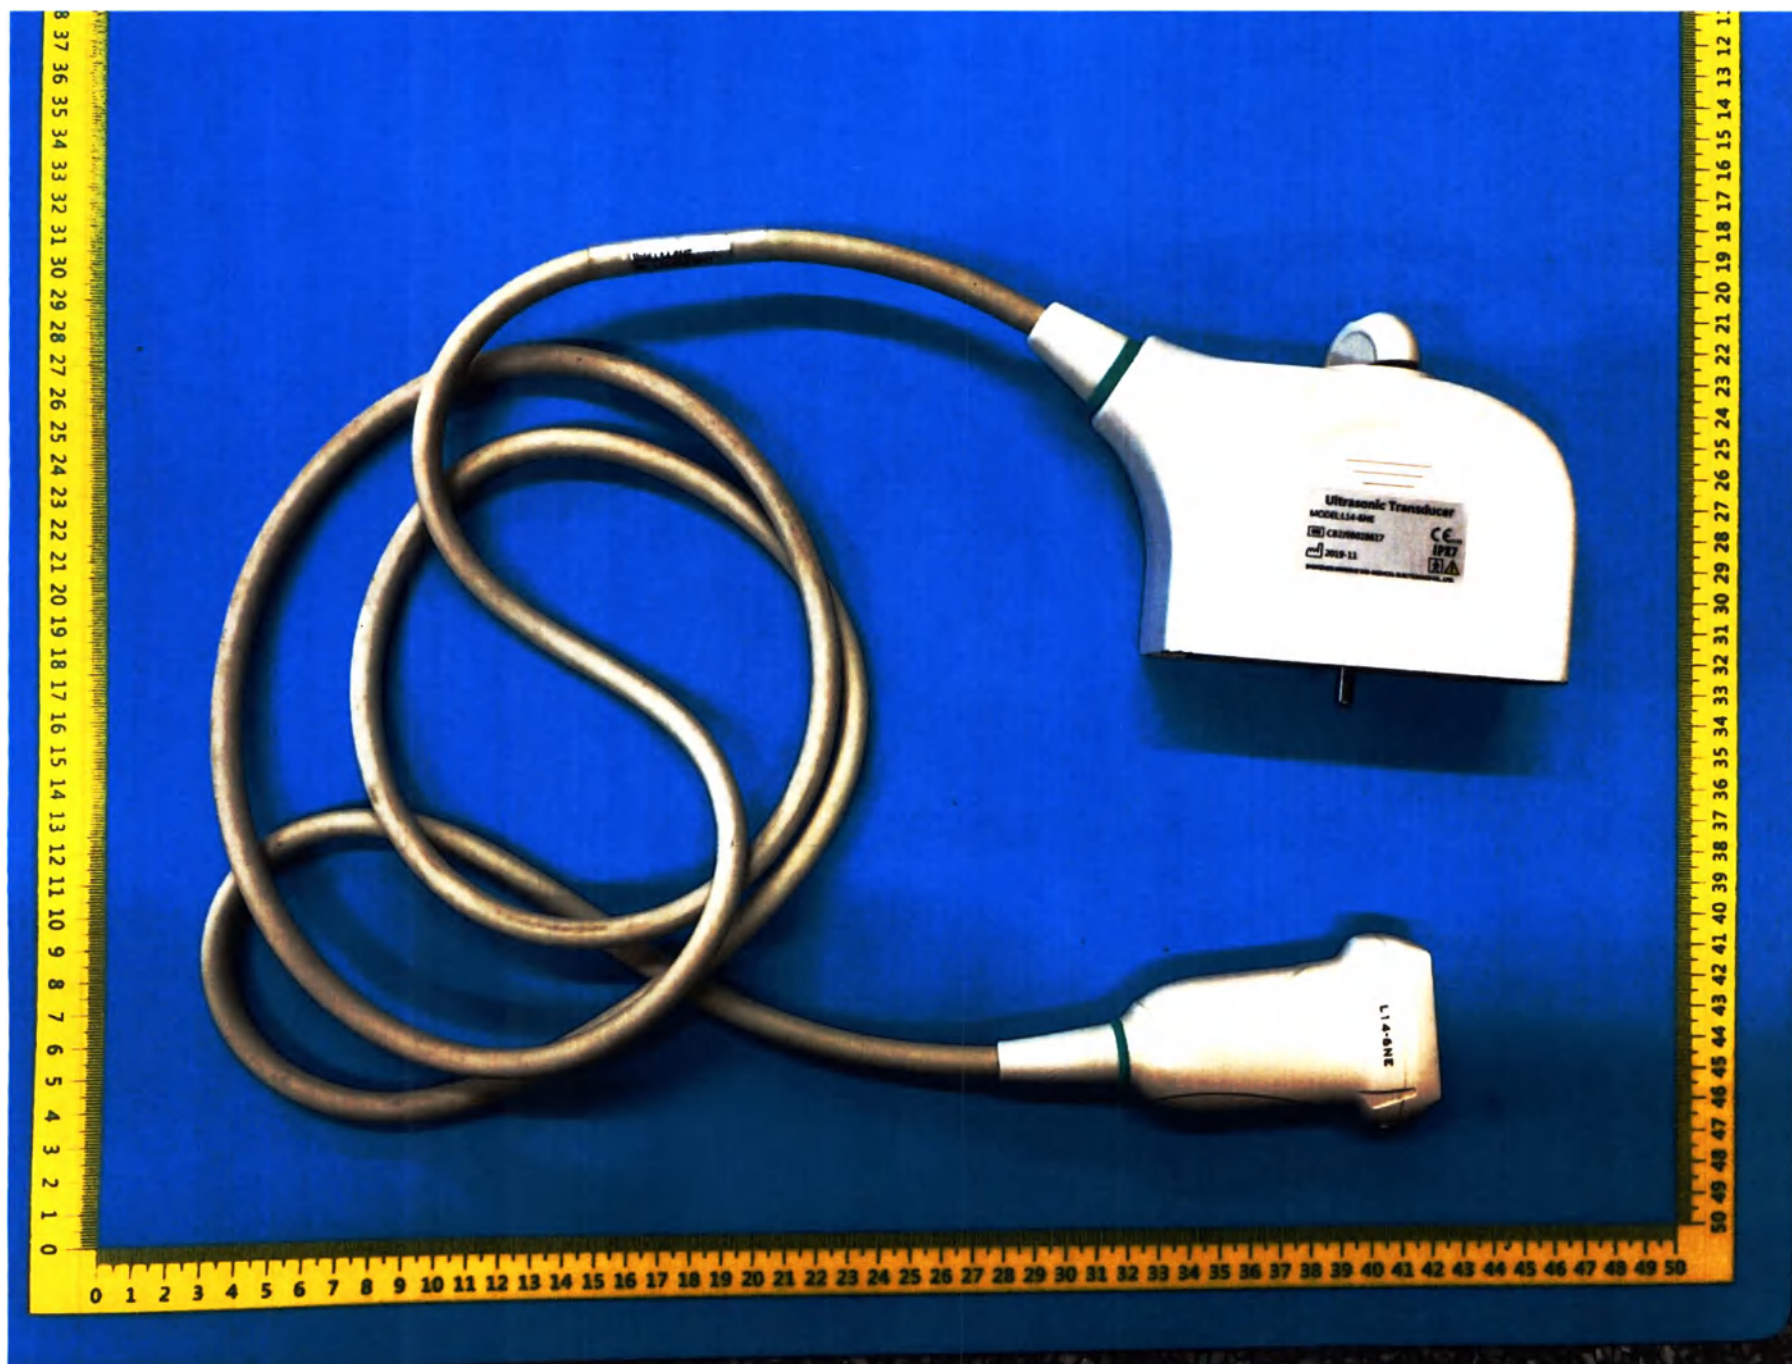

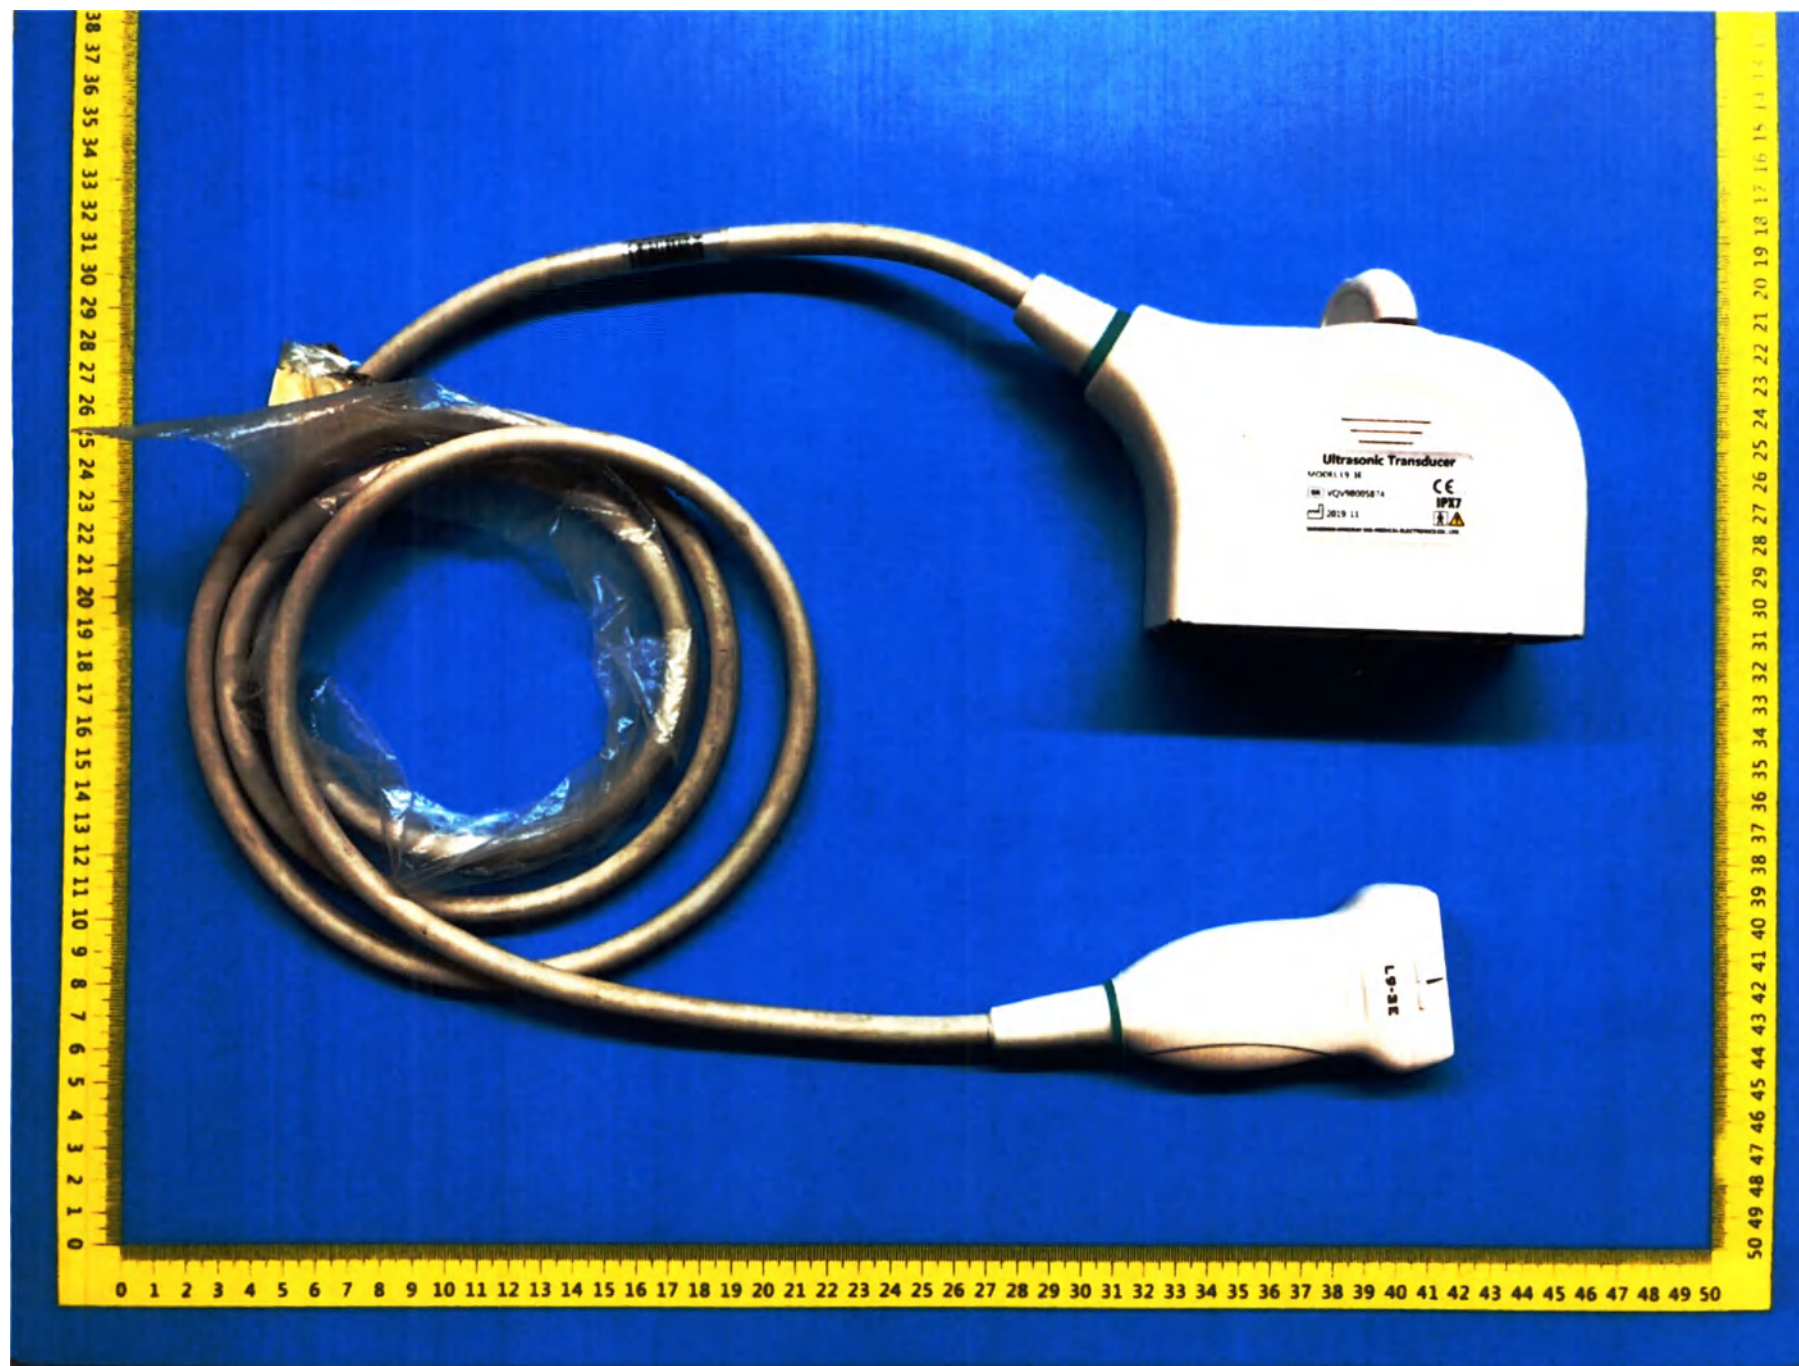


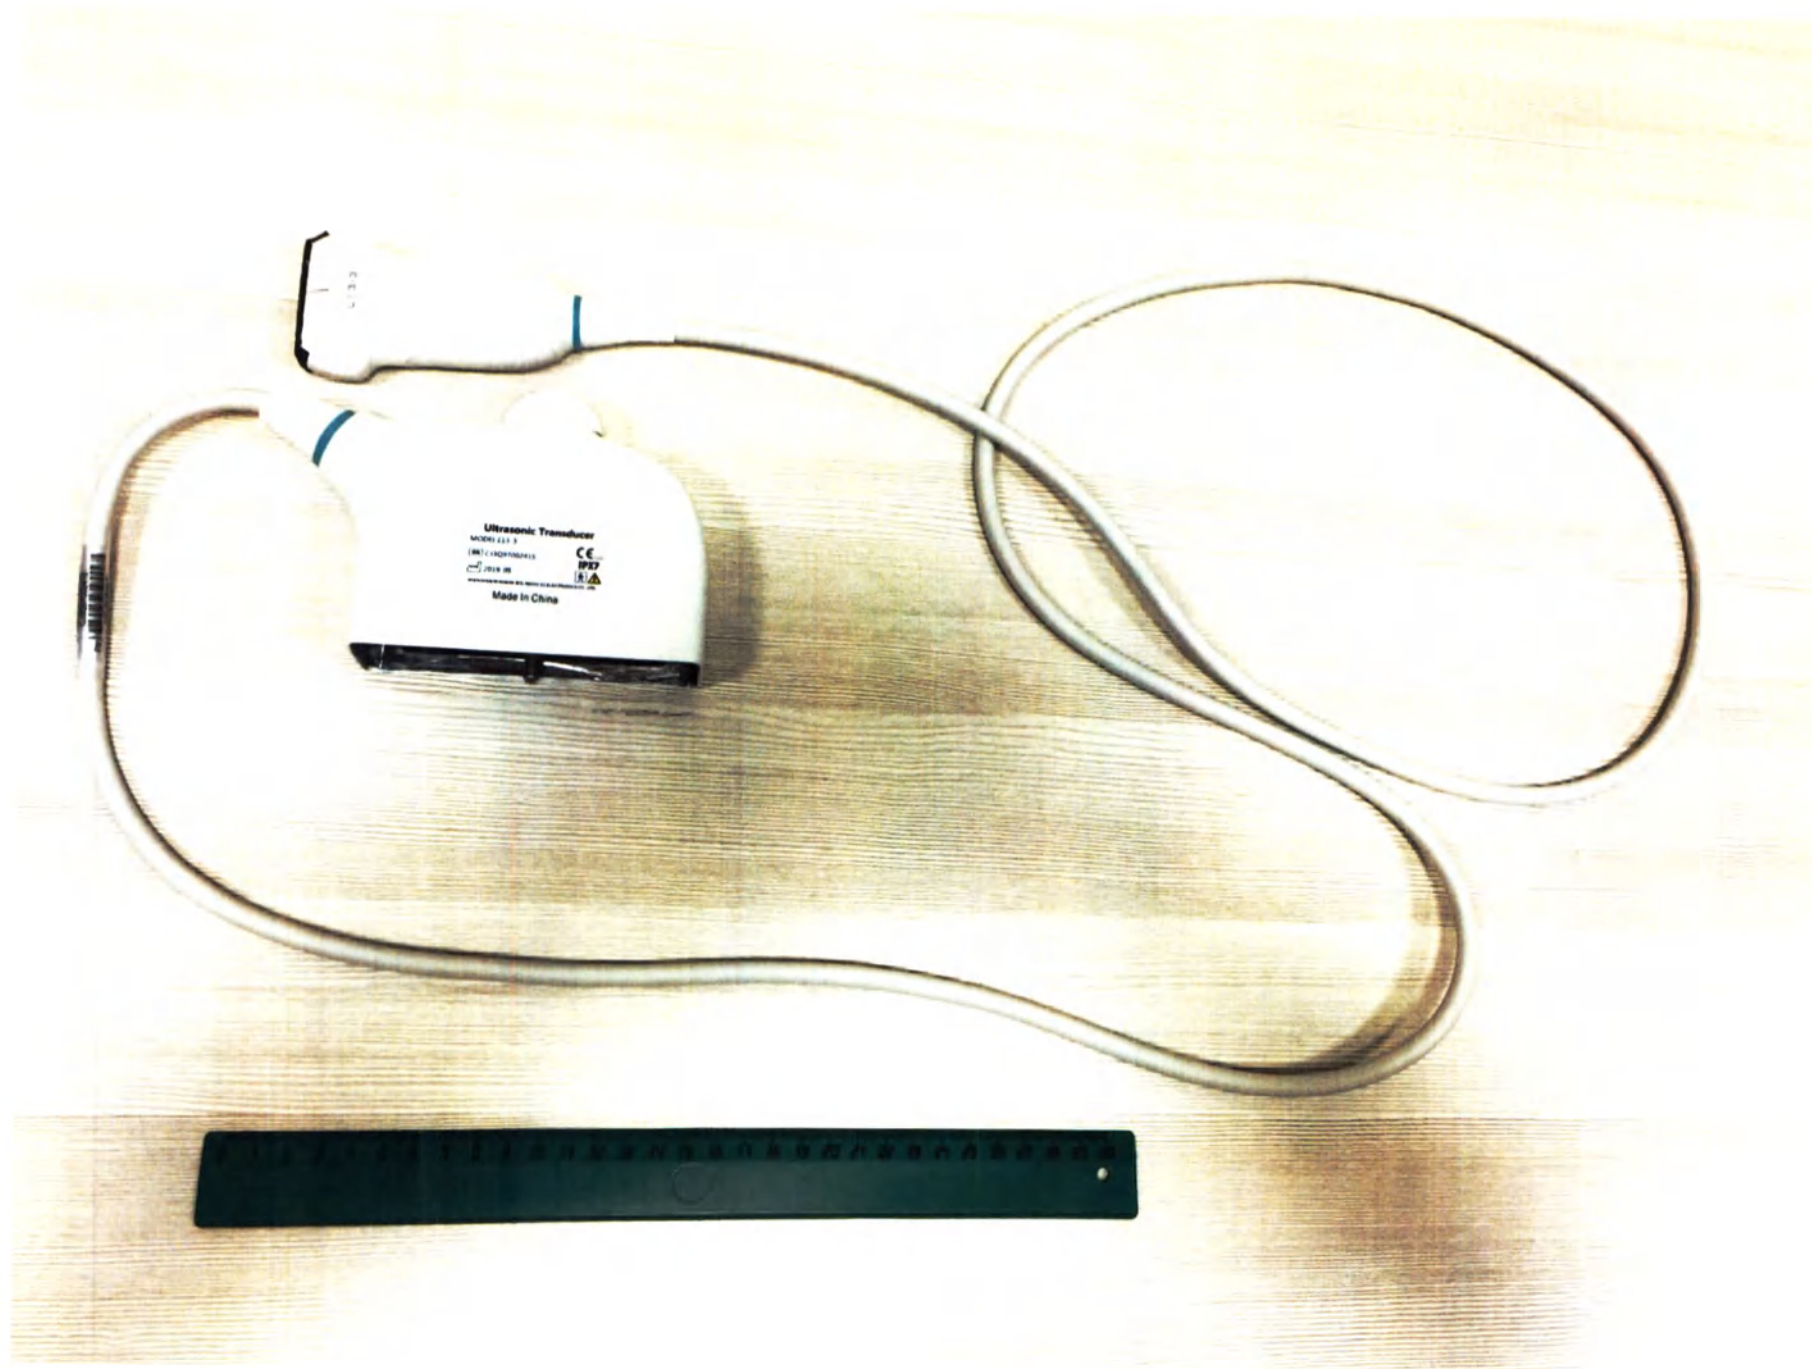


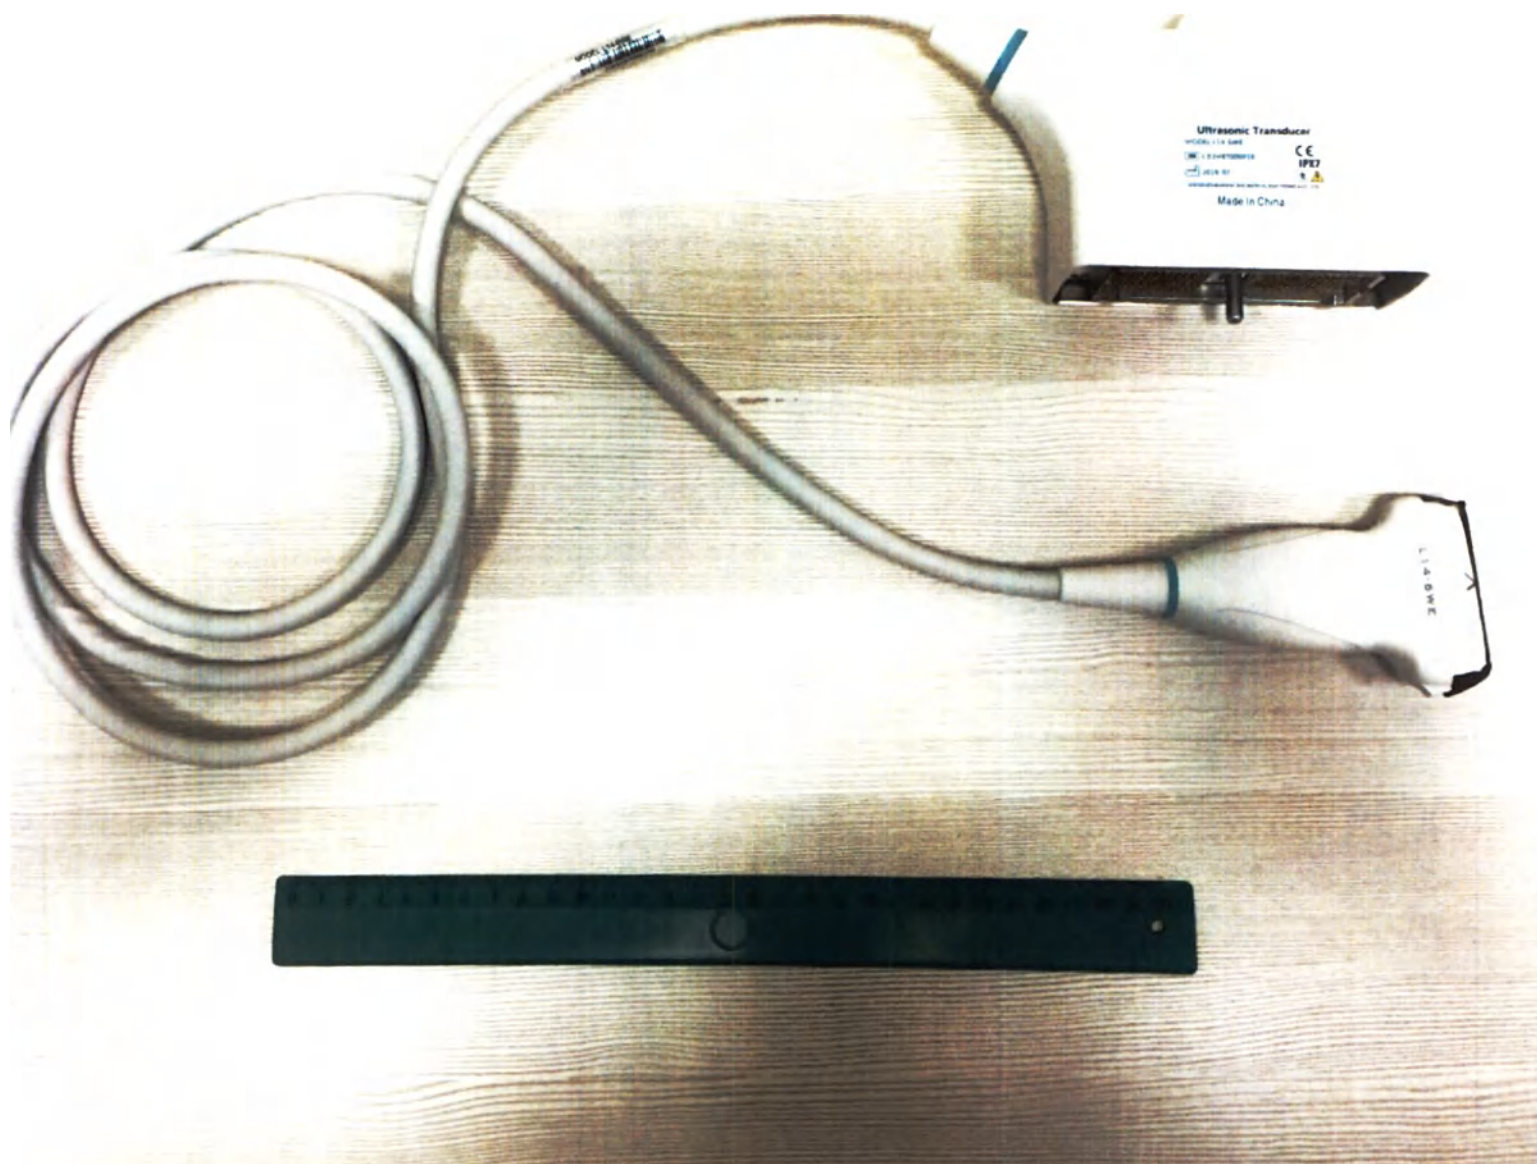

Датчик ультразвуковой линейный LI4-6WE (Linear array transducer, LI4-6WE)



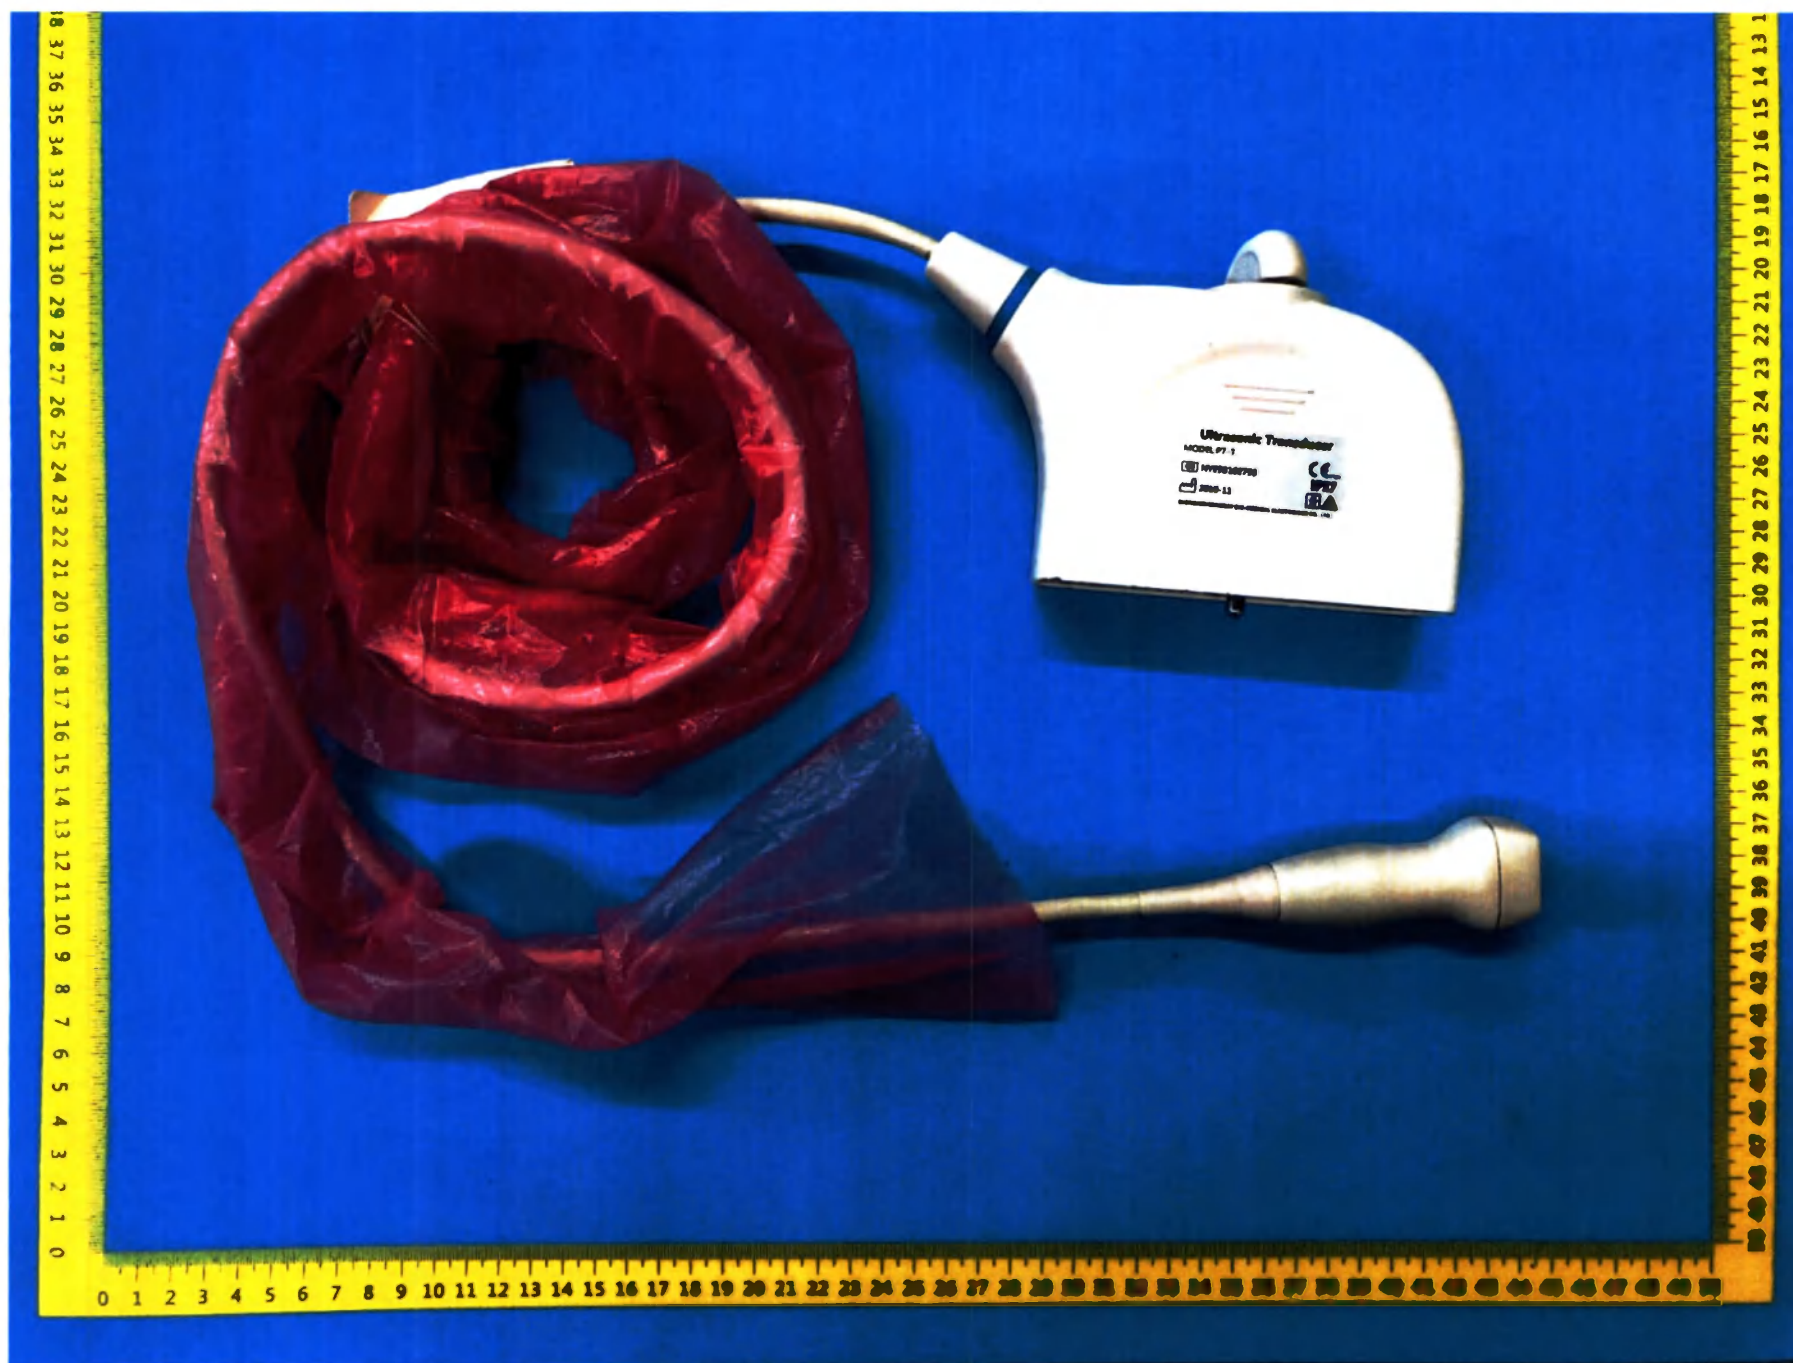

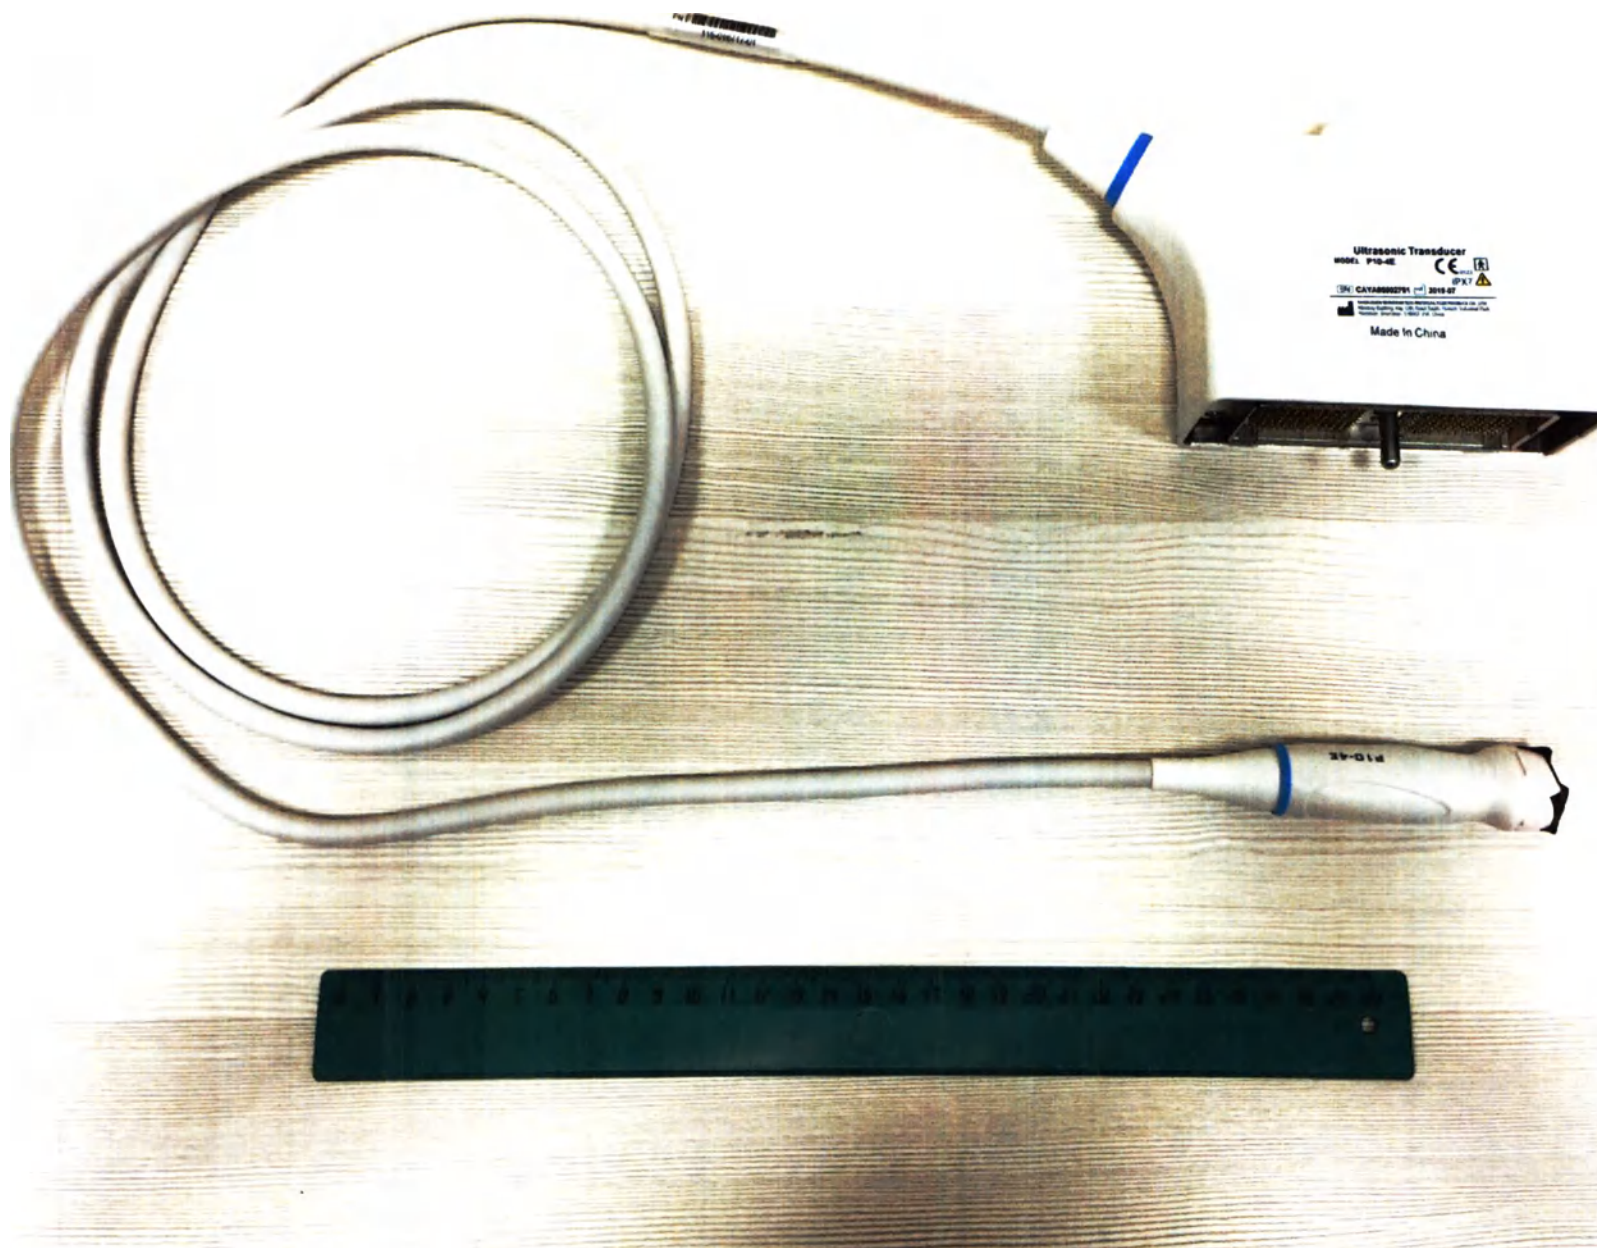





Датчик ультразвуковой фазированный SP5-1E (Phased array transducer, SP5-1E)




Датчик ультразвуковой фазированный P12-4 (Phased array transducer, P12-4)

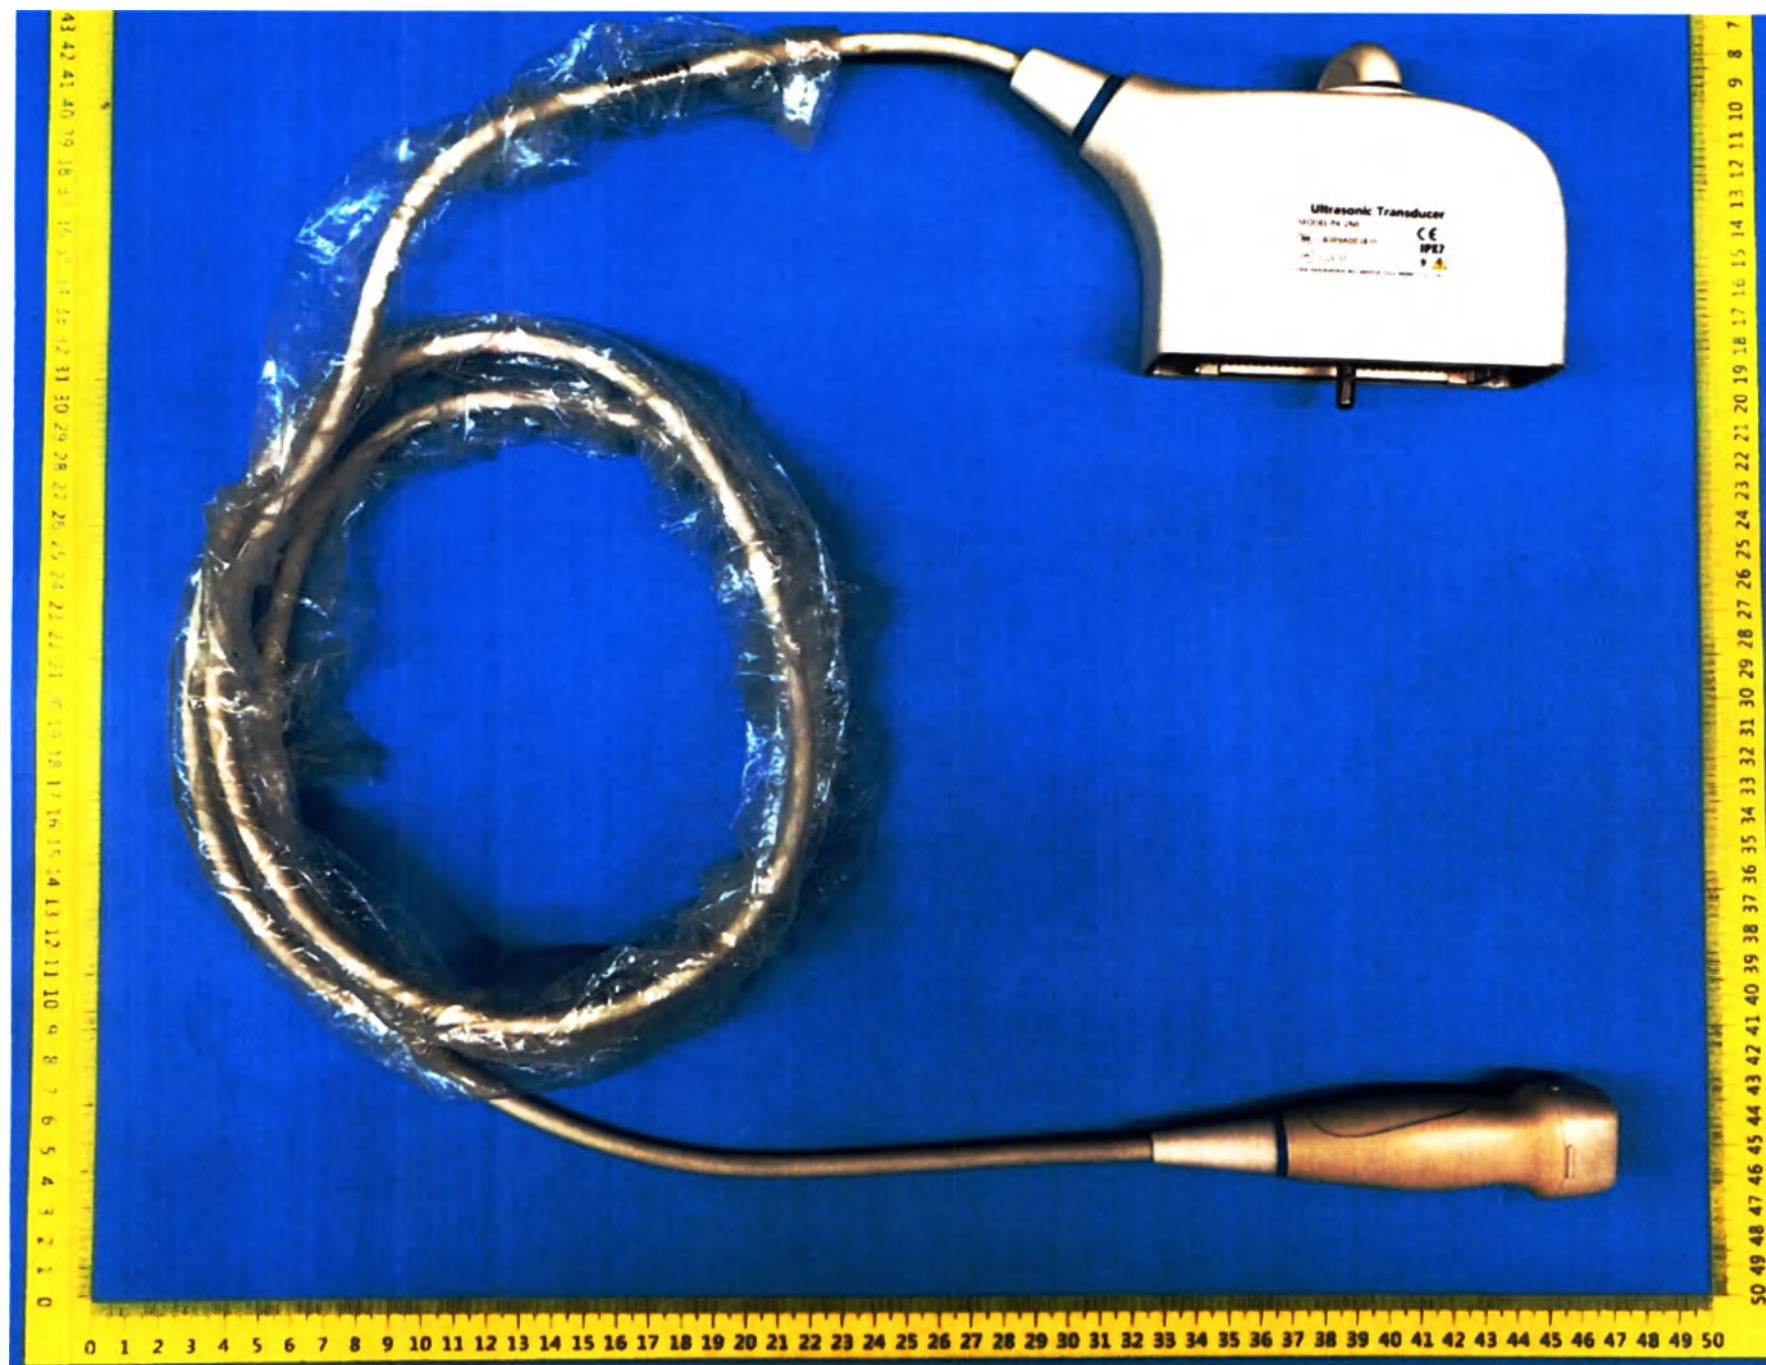


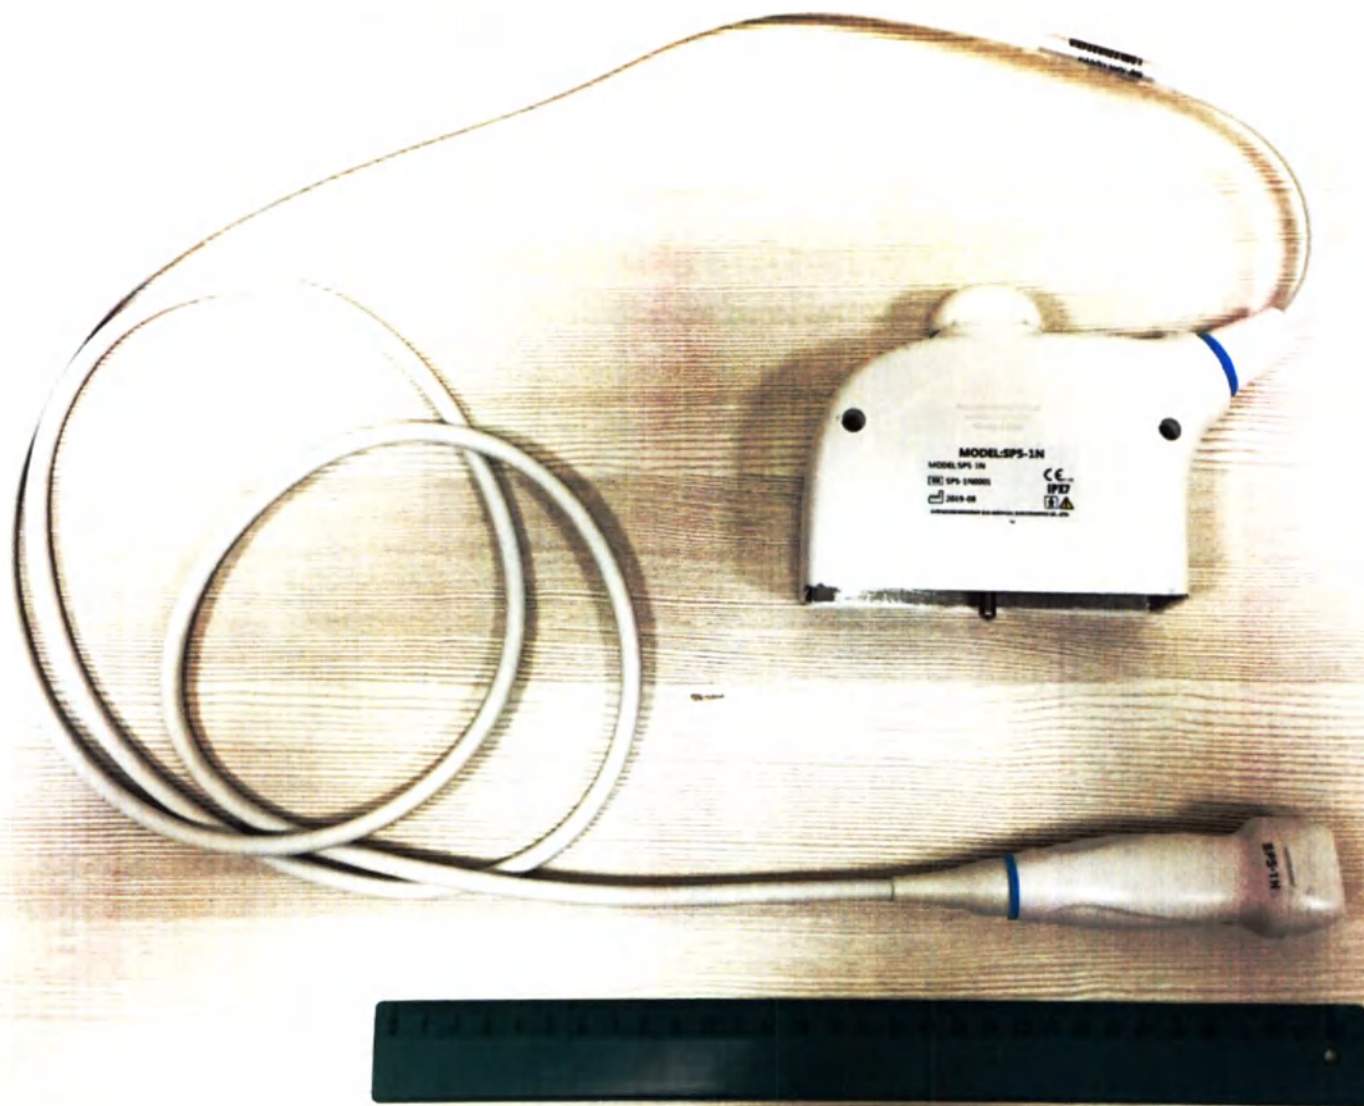


Датчик ультразвуковой фазированный SP5-1N (Phased array transducer, SP5-1N)

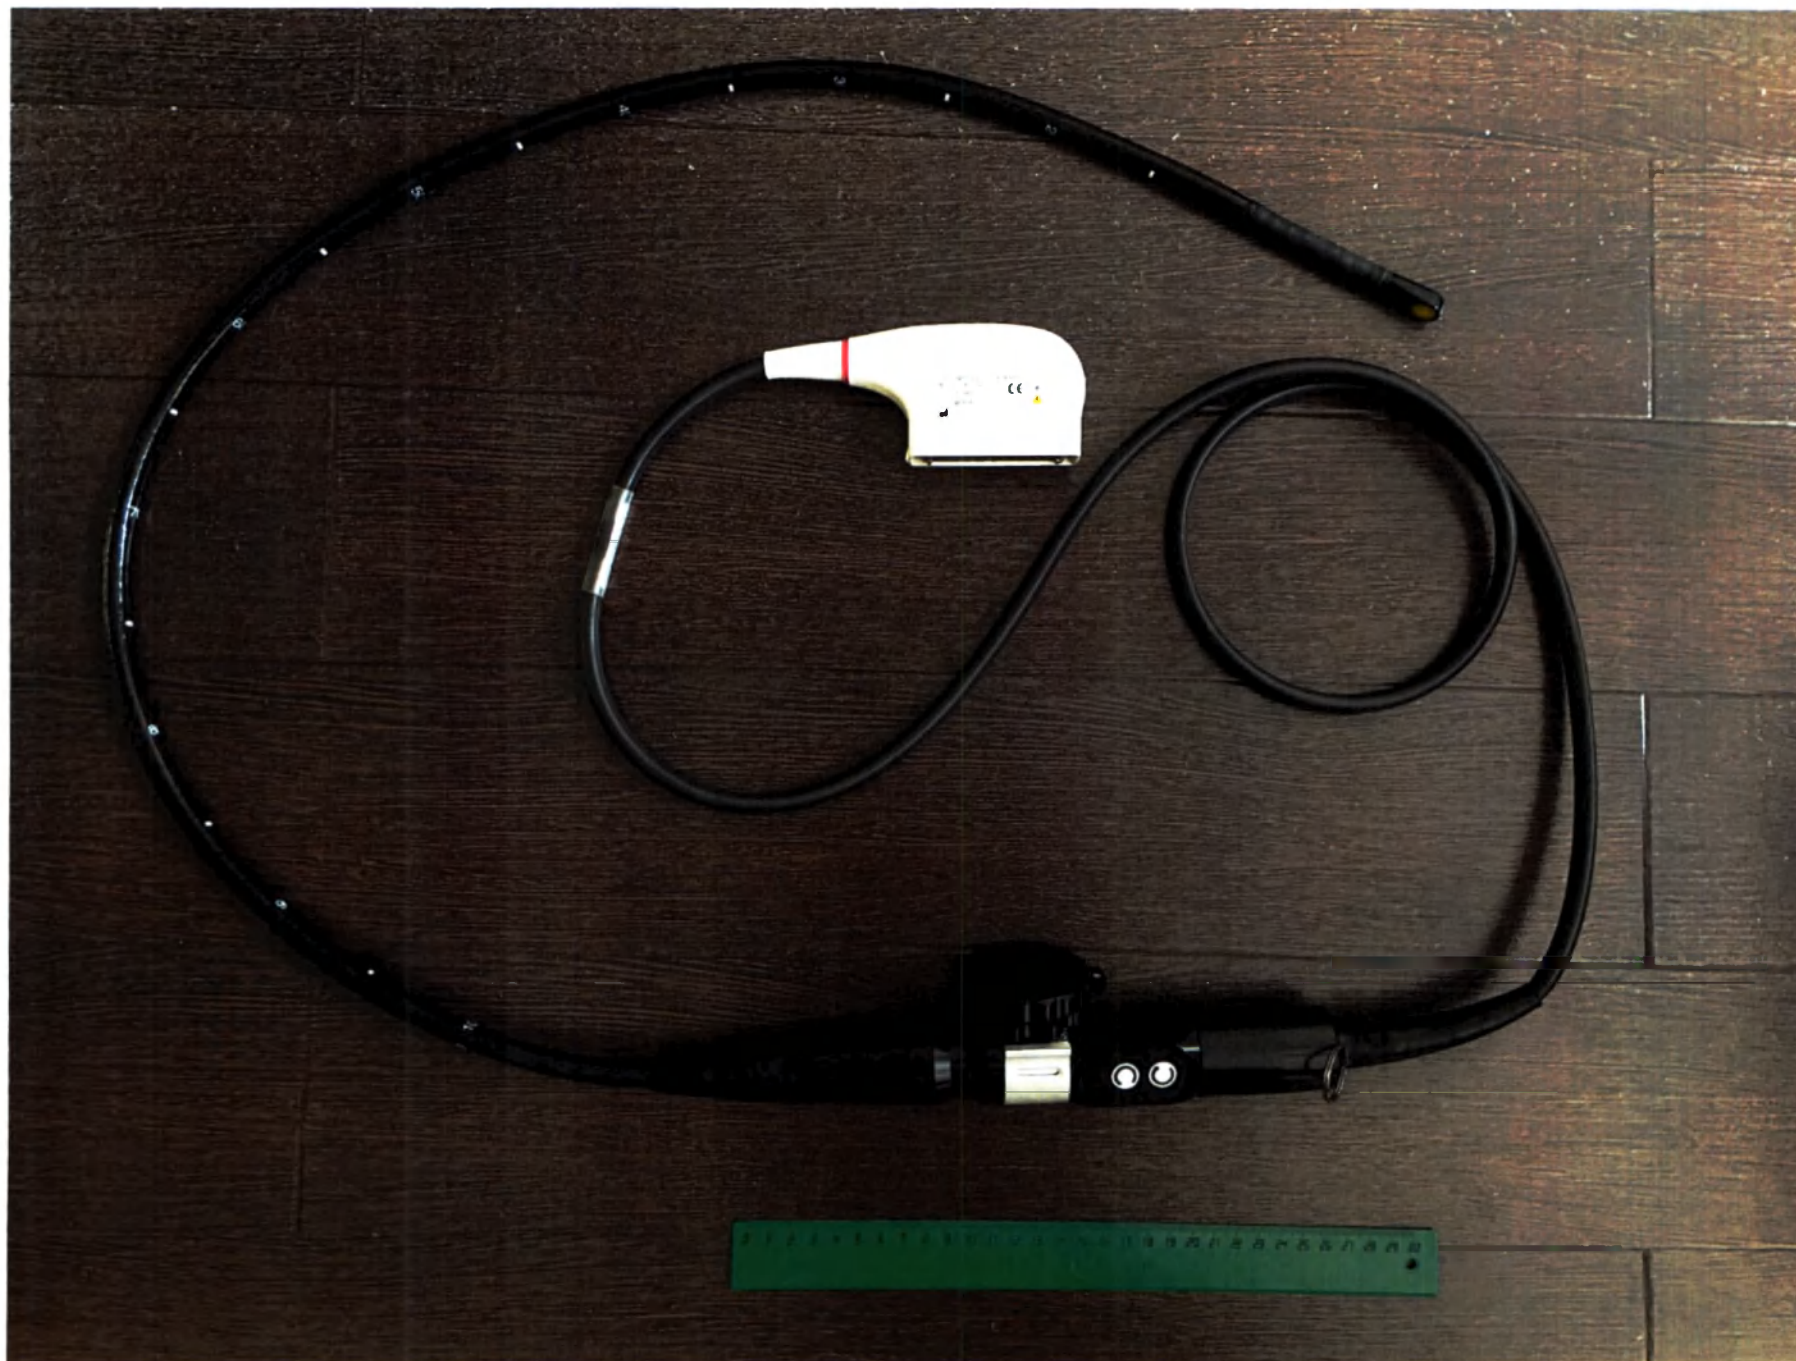


Датчик ультразвуковой чреспищеводный P7-3Ts (Phased array transducer, P7-3Ts)

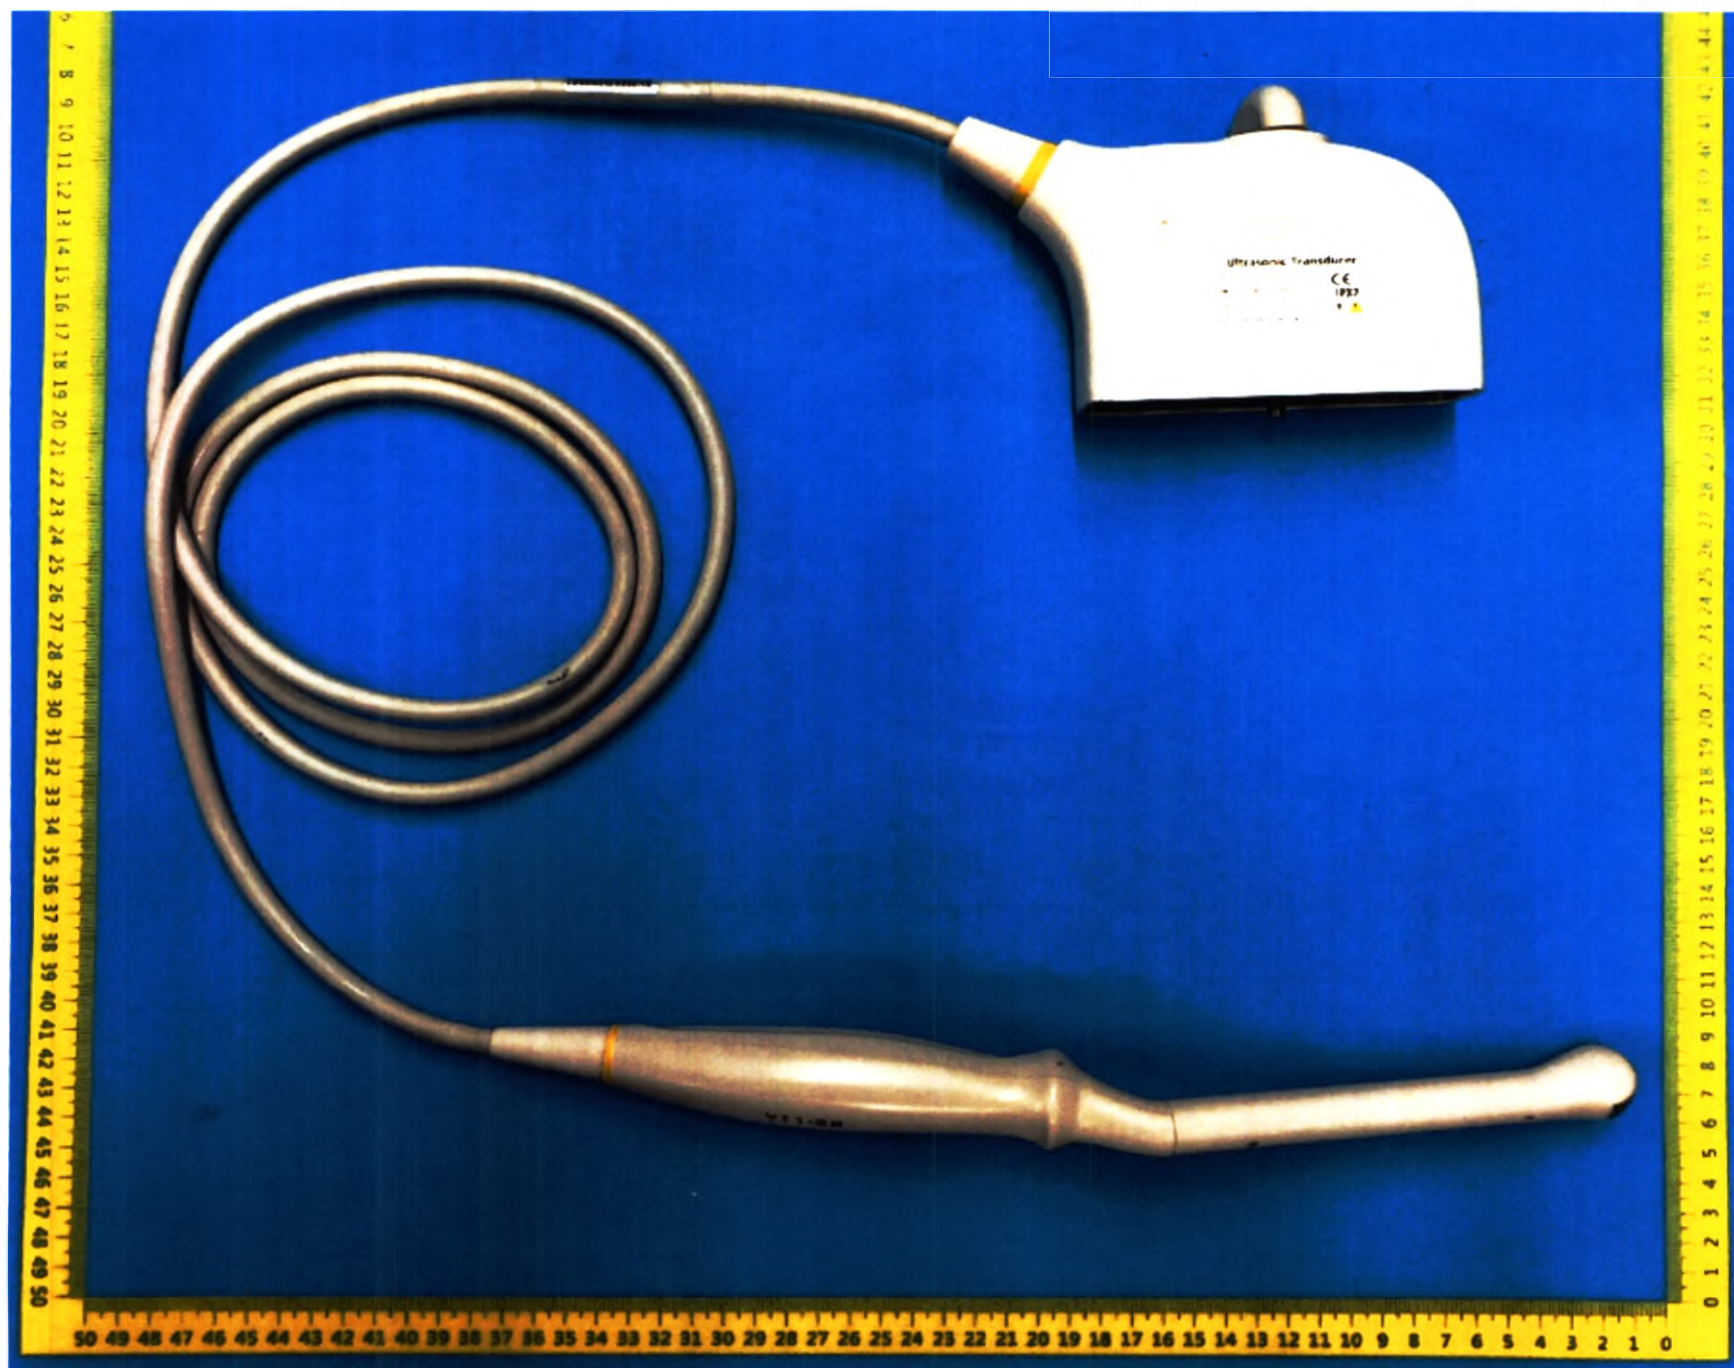


Датчик ультразвуковой внутрисполостной V11-3B (Endocavity convex array transducer, V11-3B)

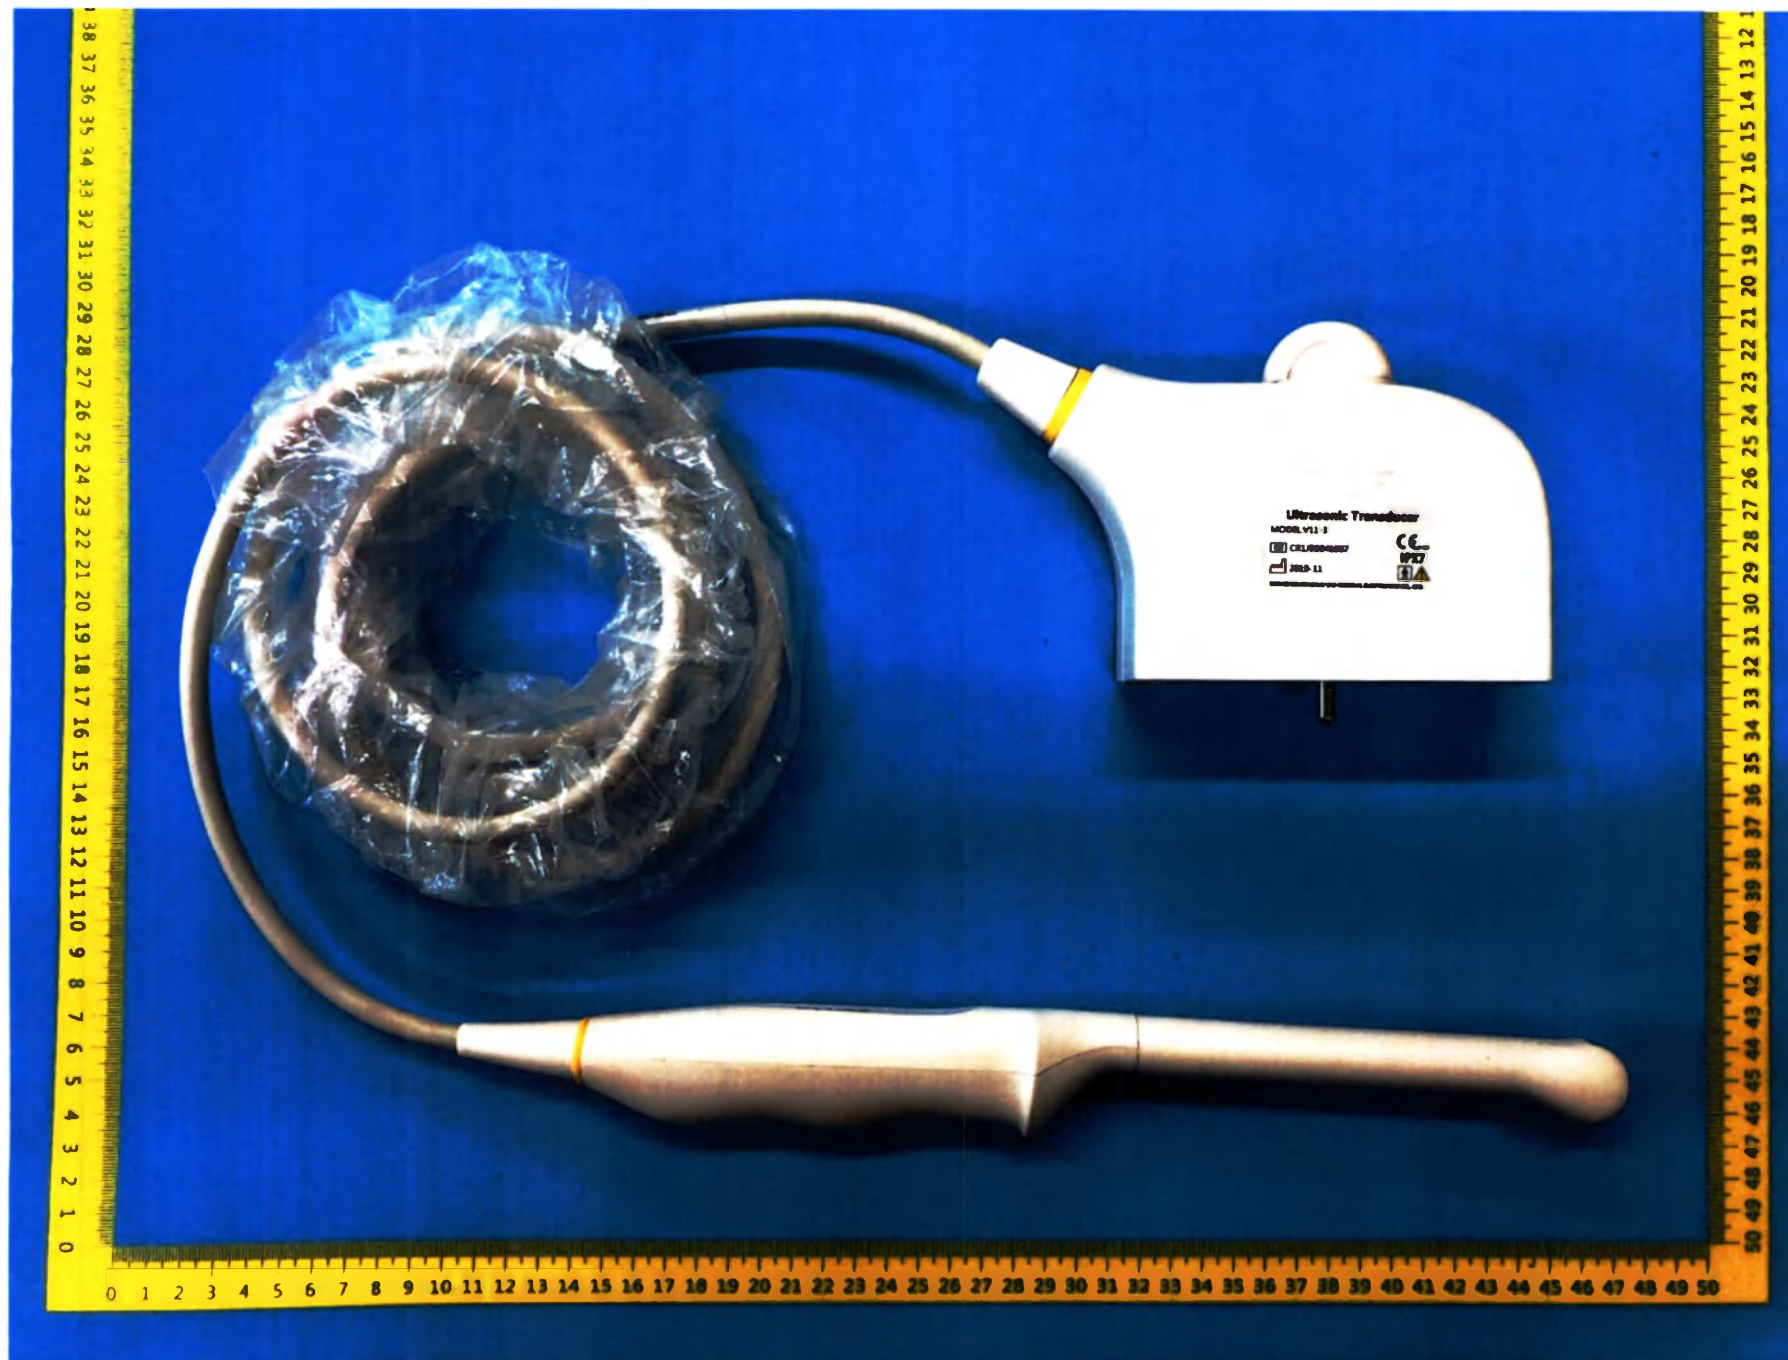

Датчик ультразвуковой внутриматочной V11-3 (Endocavity convex array transducer, V11-3)

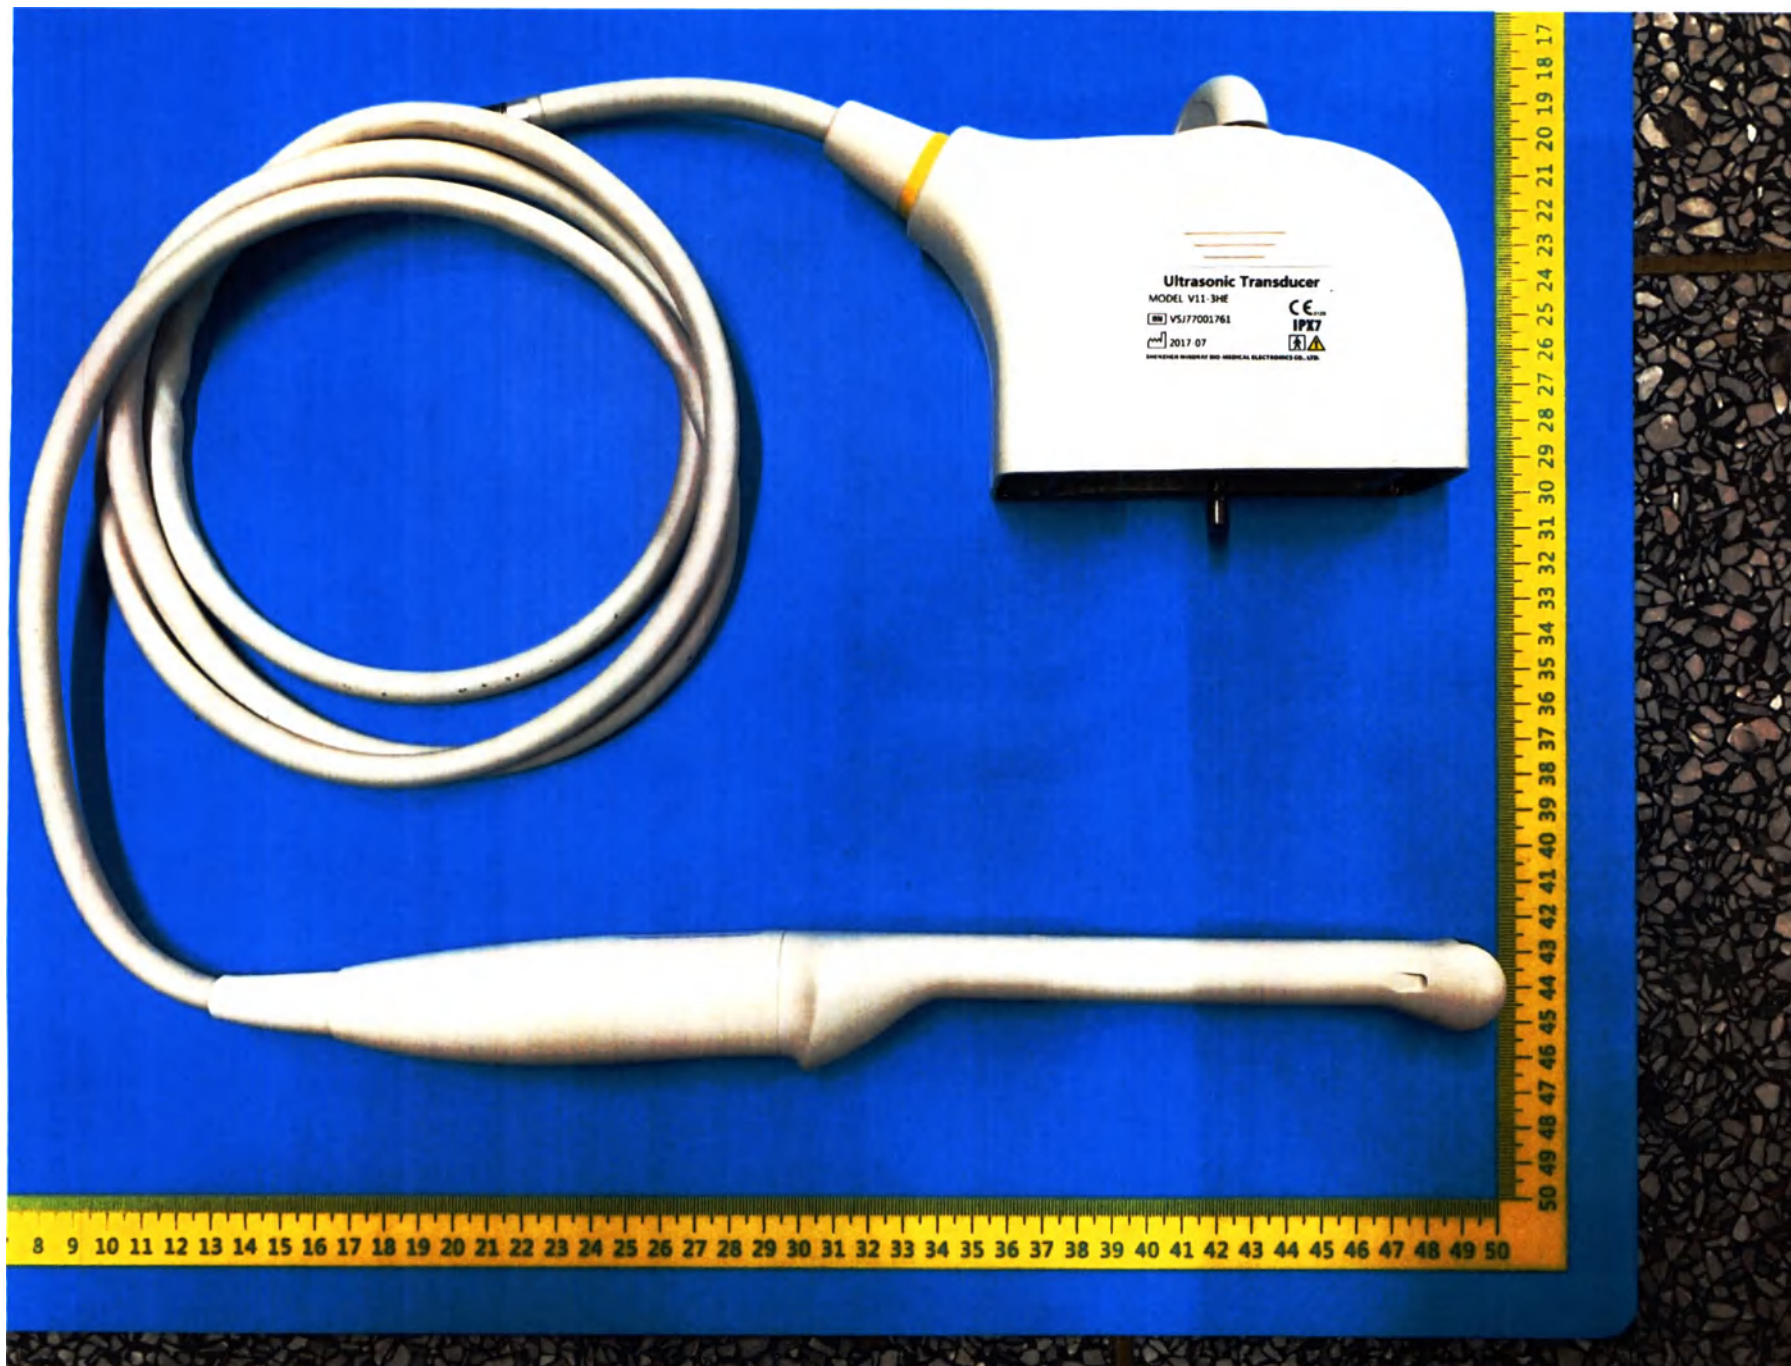


Датчик ультразвуковой внутриполостной V11-3HE (Endocavity convex array transducer, V11-3HE)

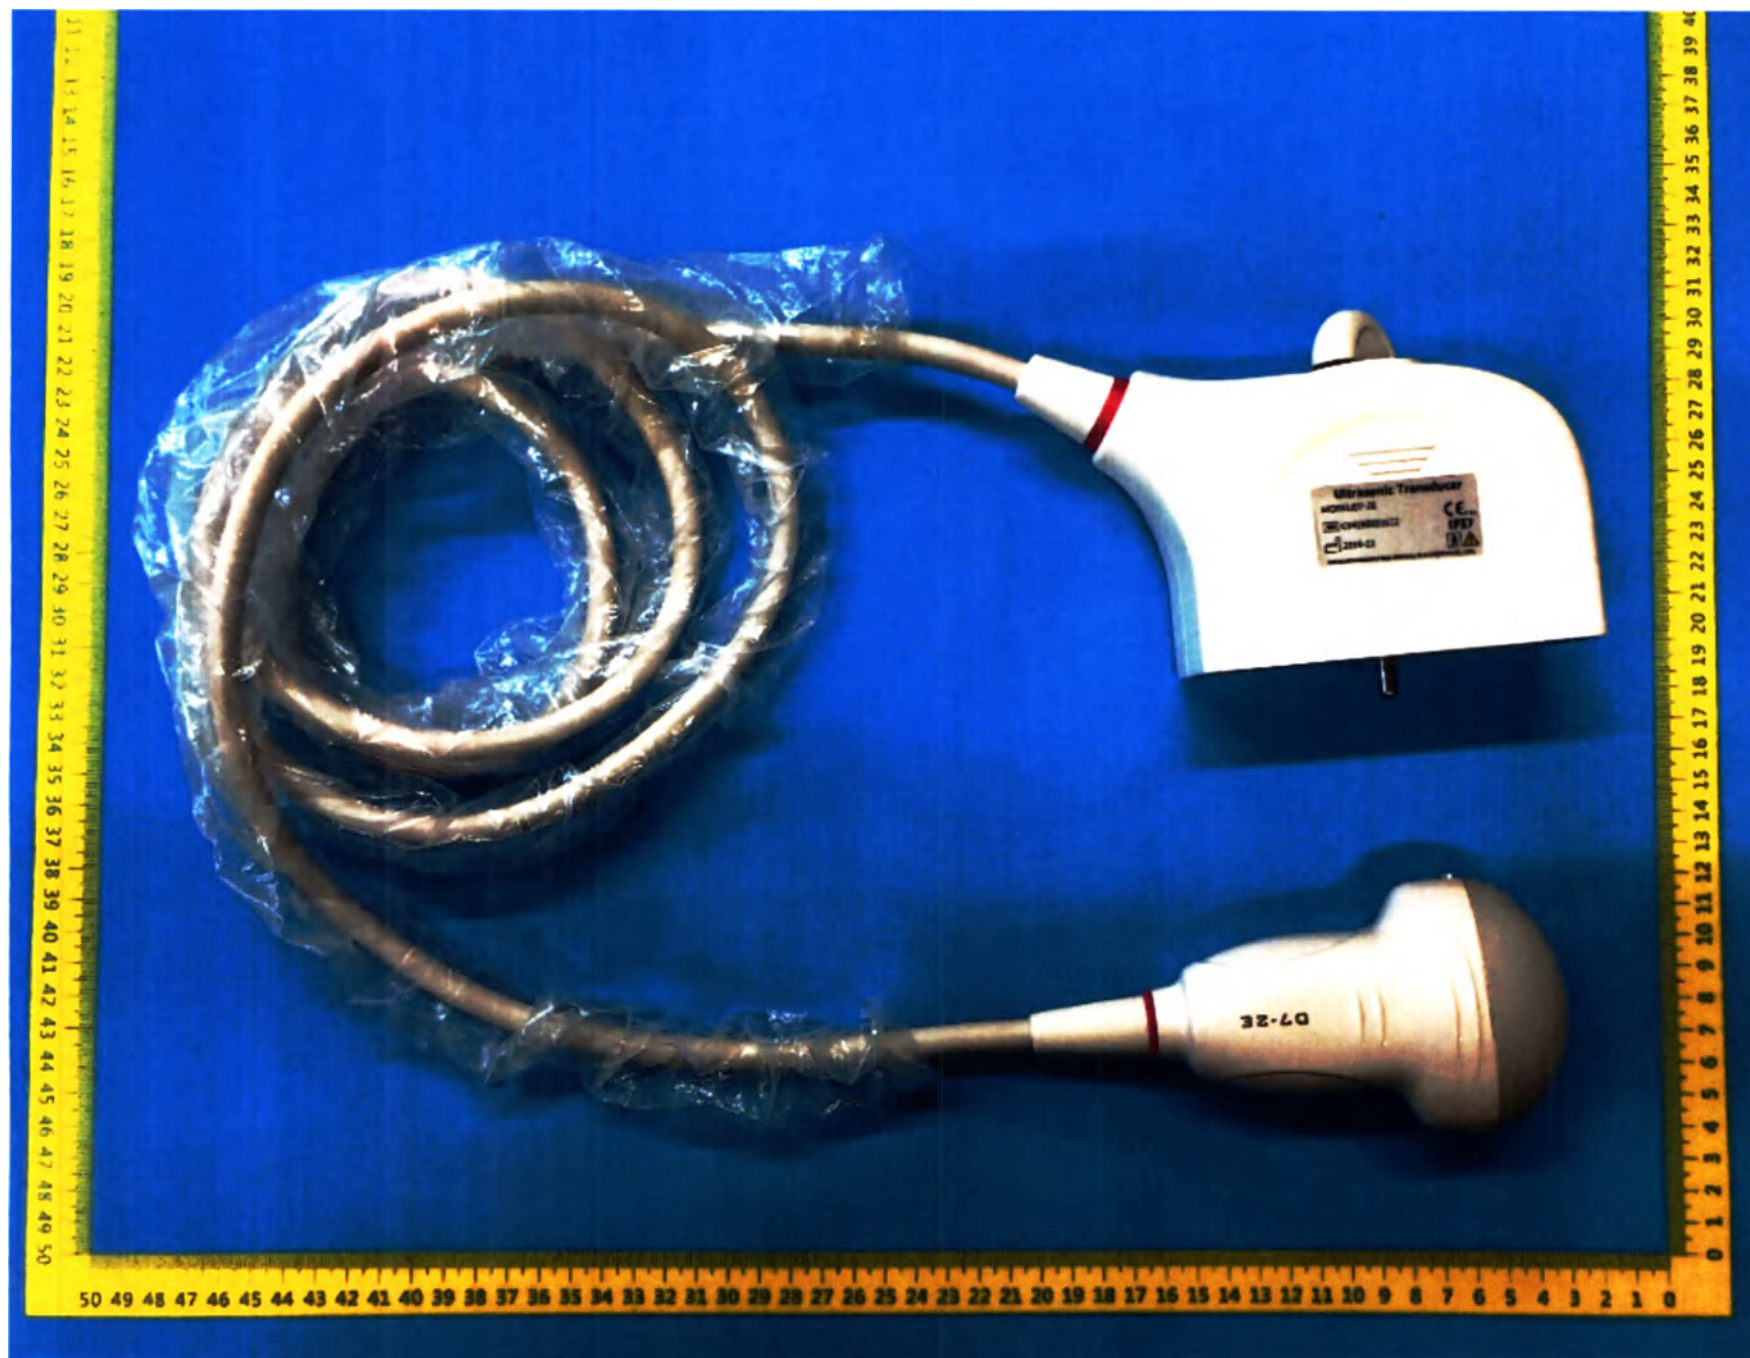


Датчик ультразвуковой объемный D7-2E (Volume convex array transducer, D7-2E)




Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE10-3E (Endocavity volume convex array transducer, DE10-3E)

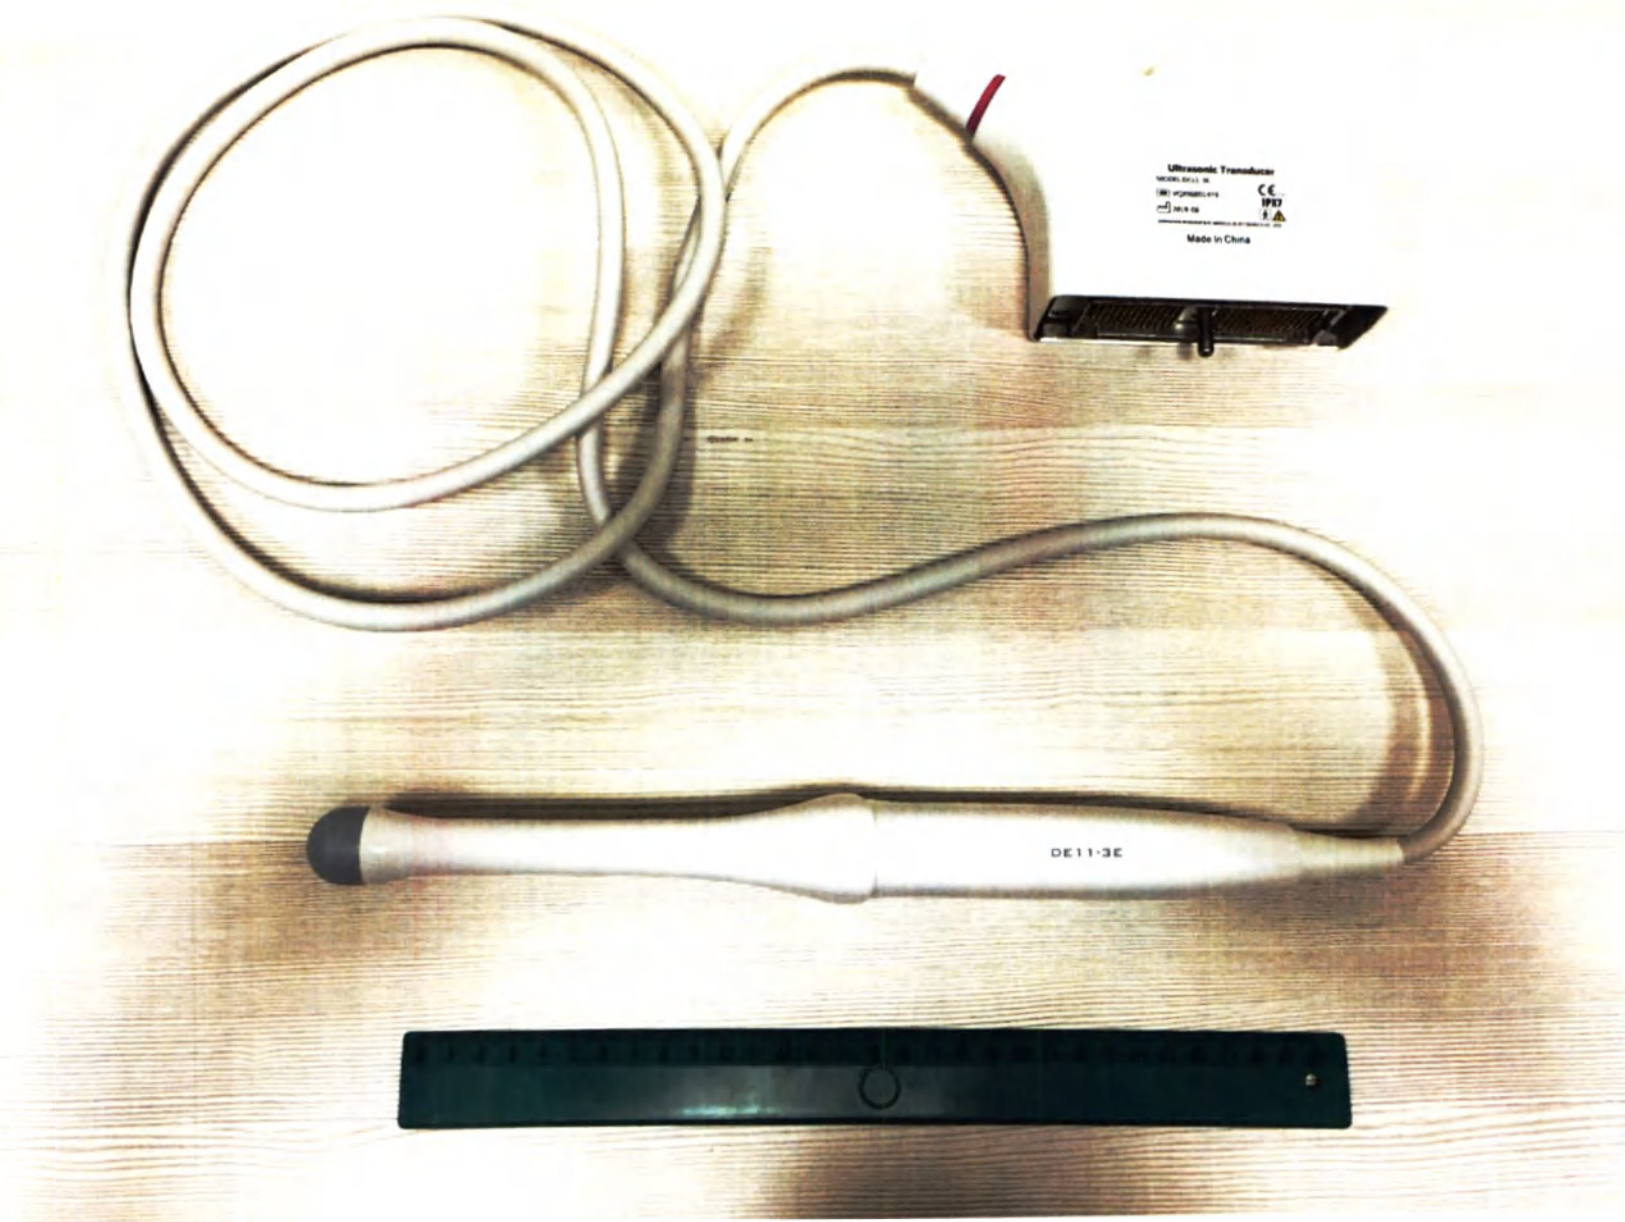


Датчик ультразвуковой объемный внутриполостной DE11-3E (Endocavity volume convex array transducer, DE11-3E)

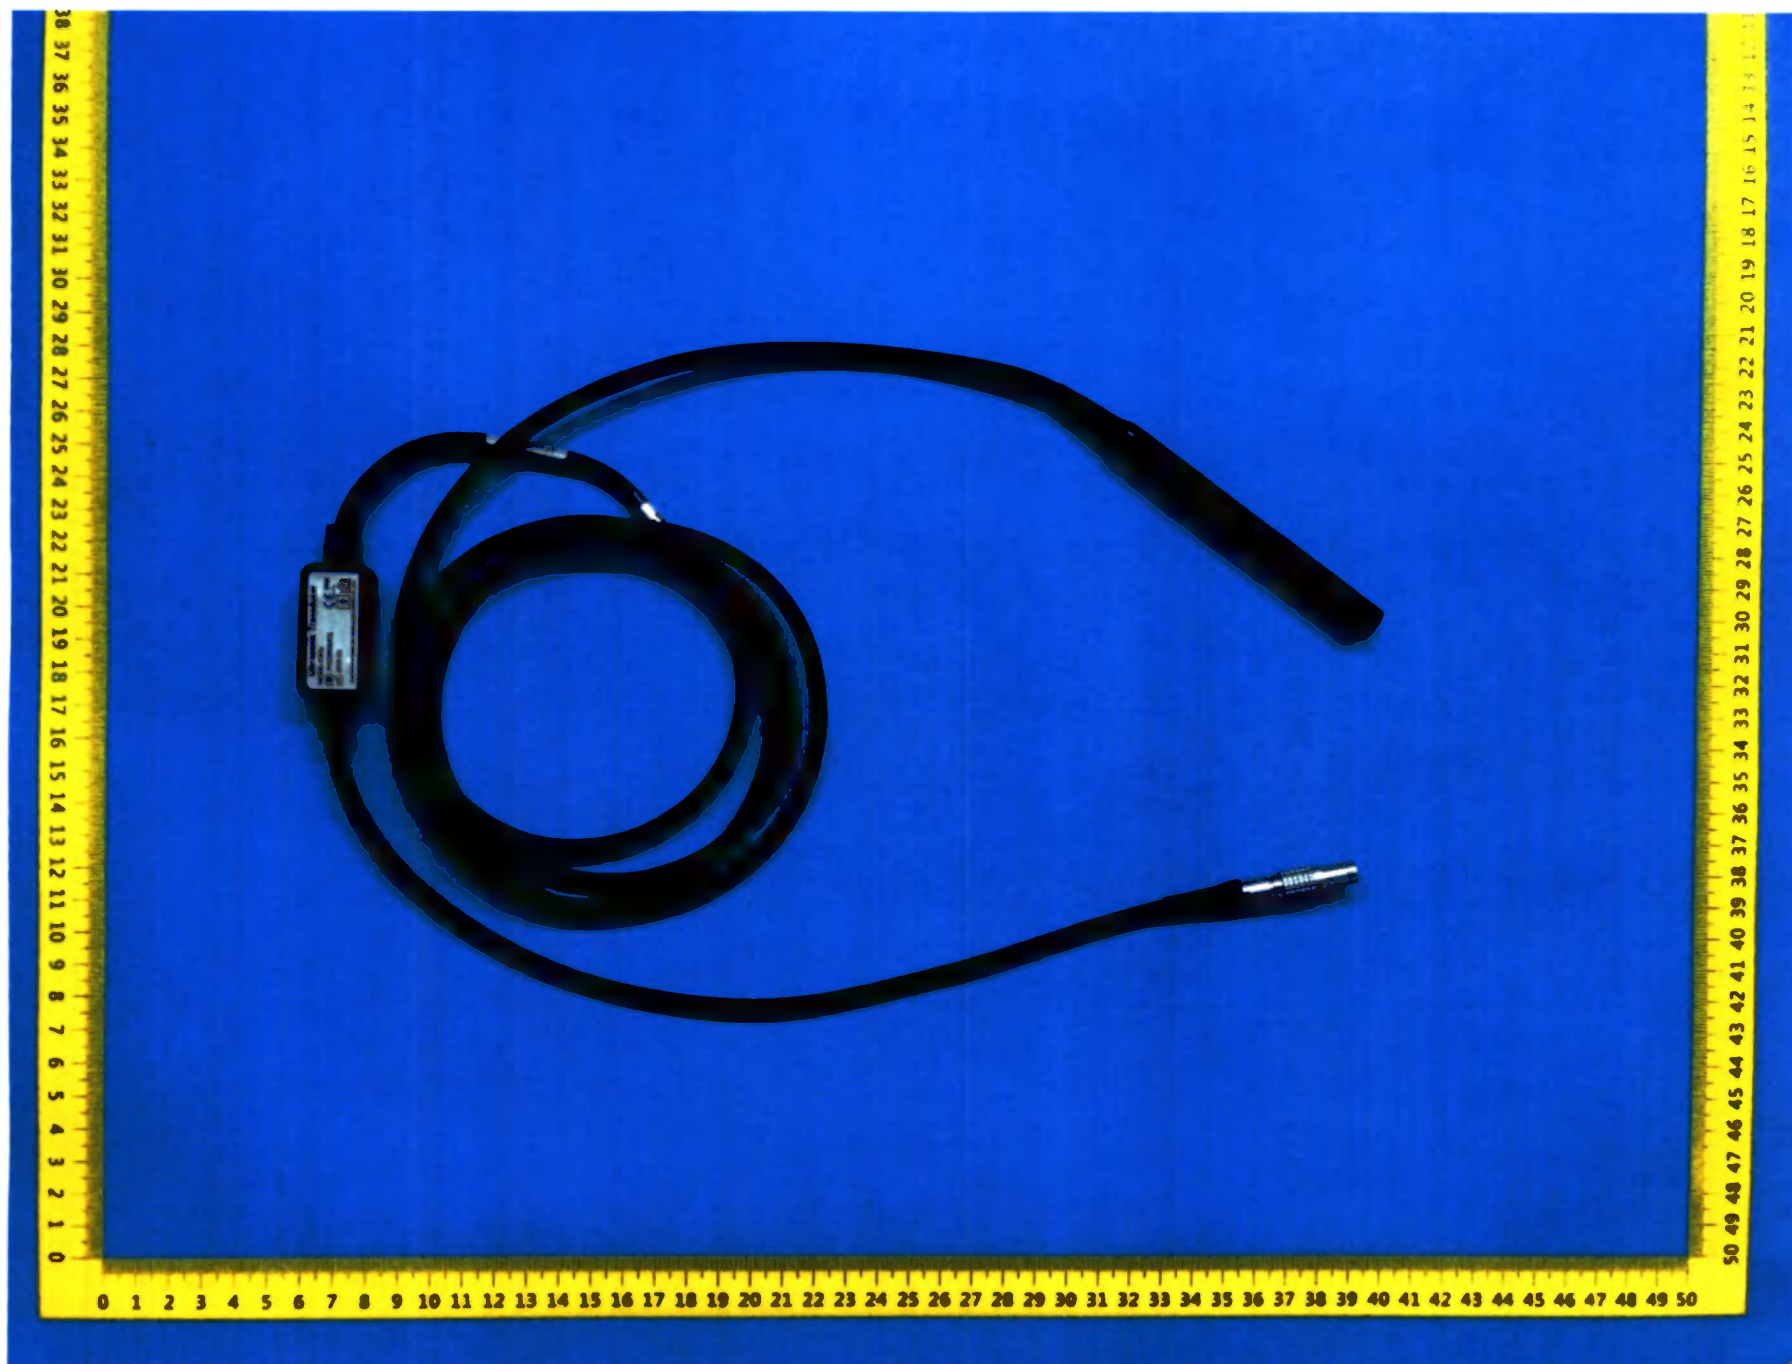


Датчик ультразвуковой фазированный карандашный для «слепых» кардиоваскулярных исследований CW5s (Pedoff transducer, CW5s)

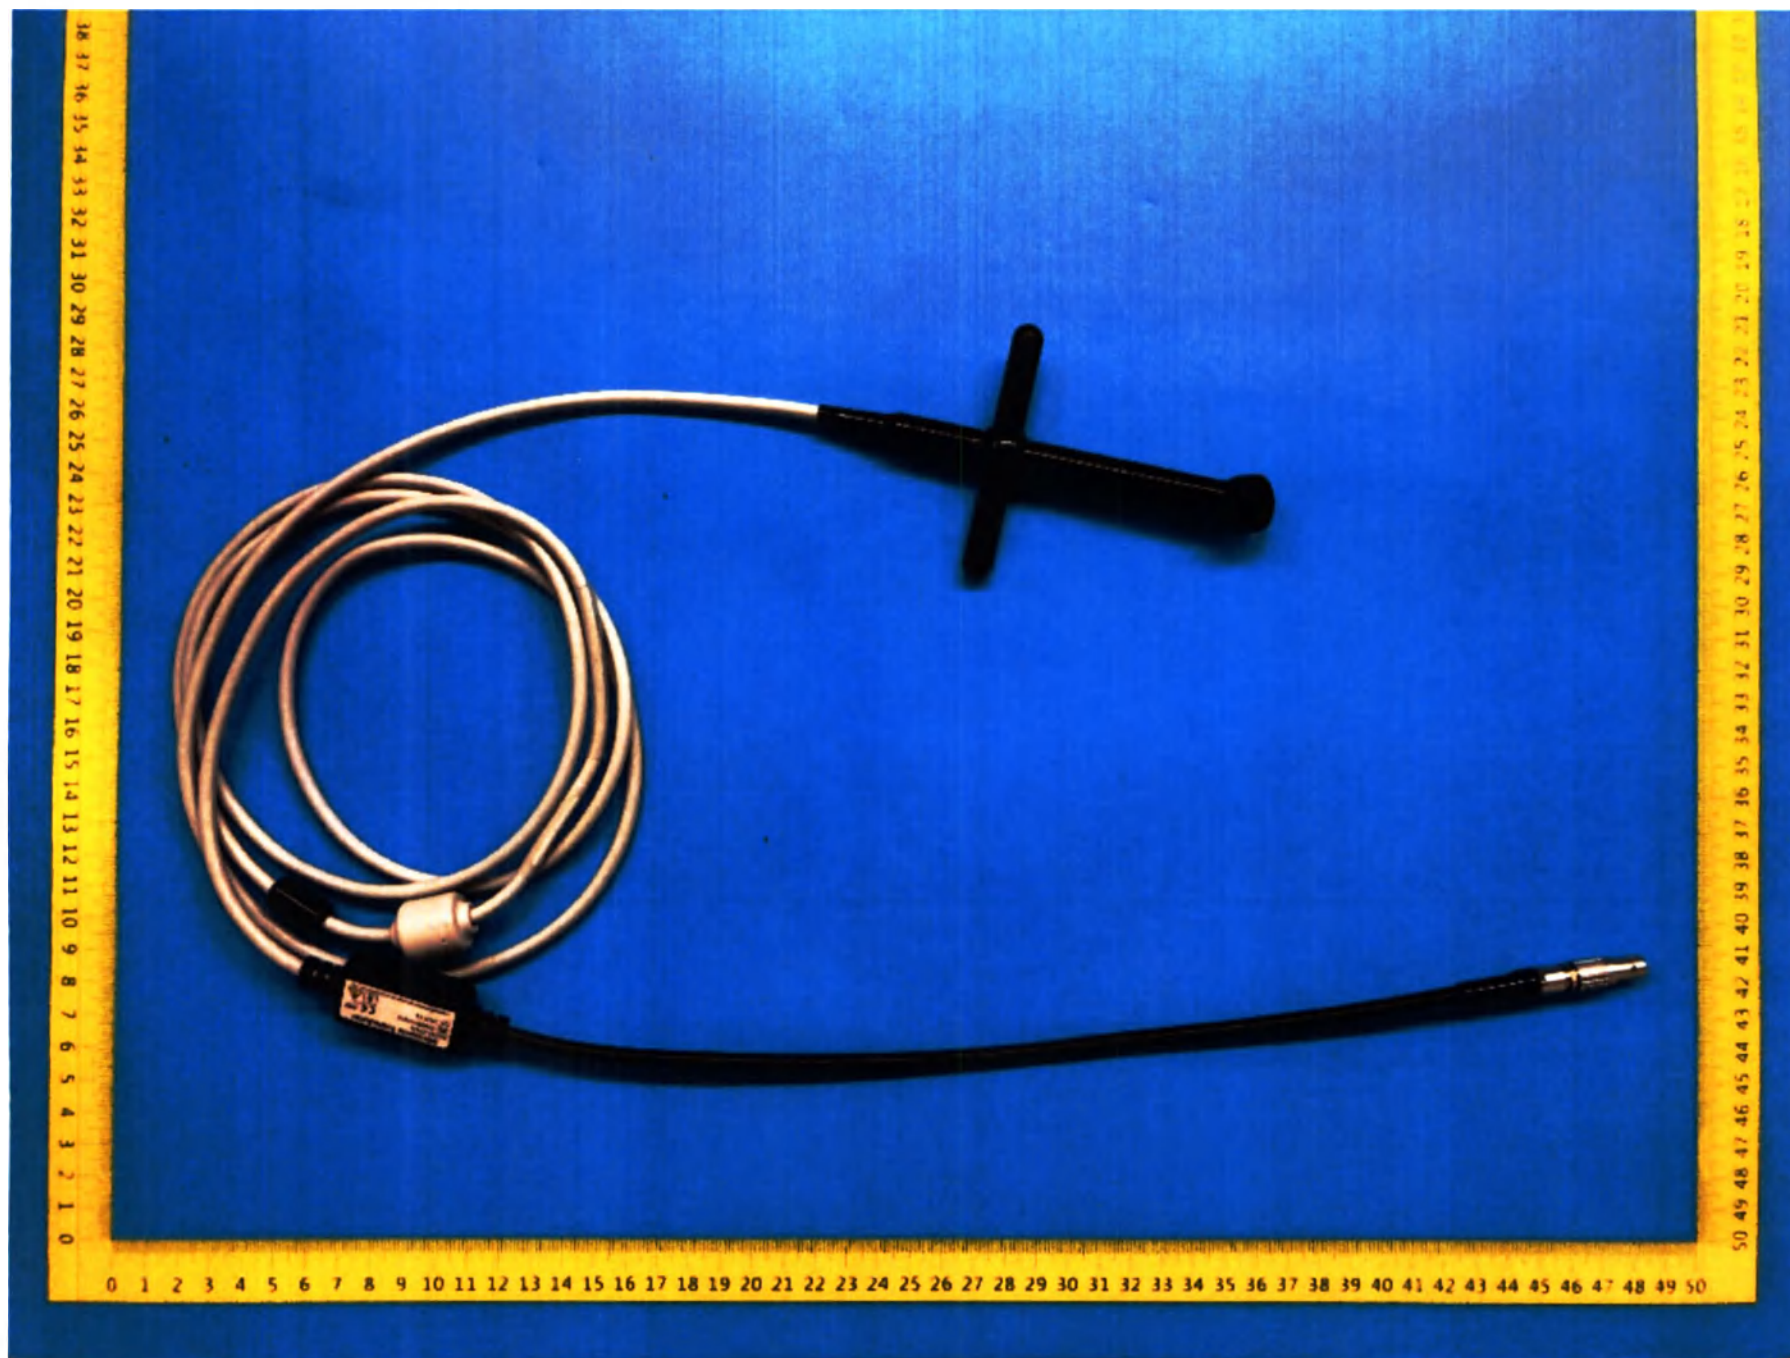


Датчик ультразвуковой фазированный карандашный для «слепых» кардиоваскулярных исследований CW2s (Pedoff transducer, CW2s)

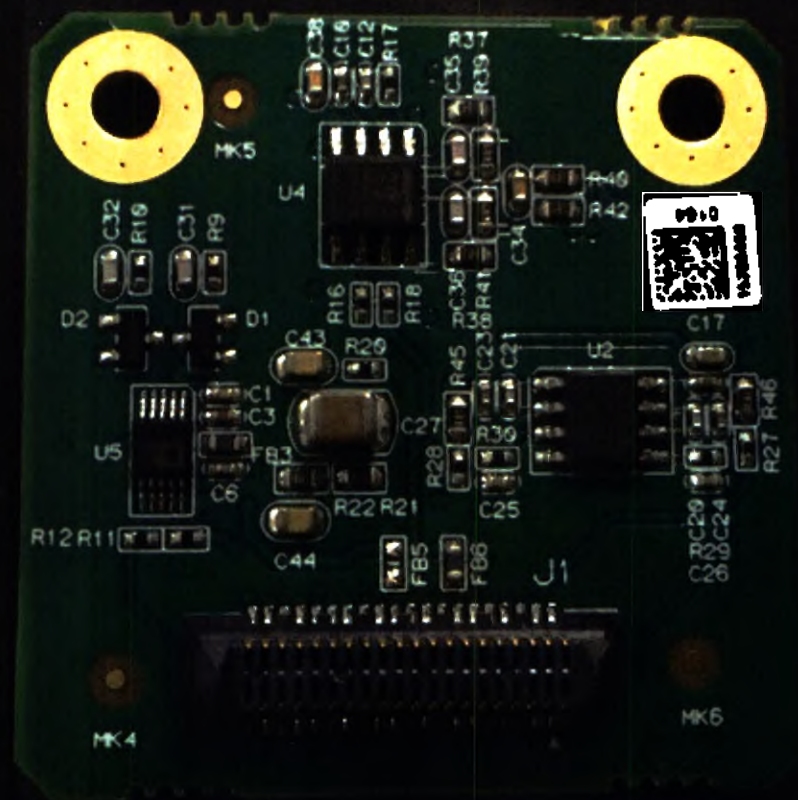

Модуль постоянно-волнового доплера (CW module)

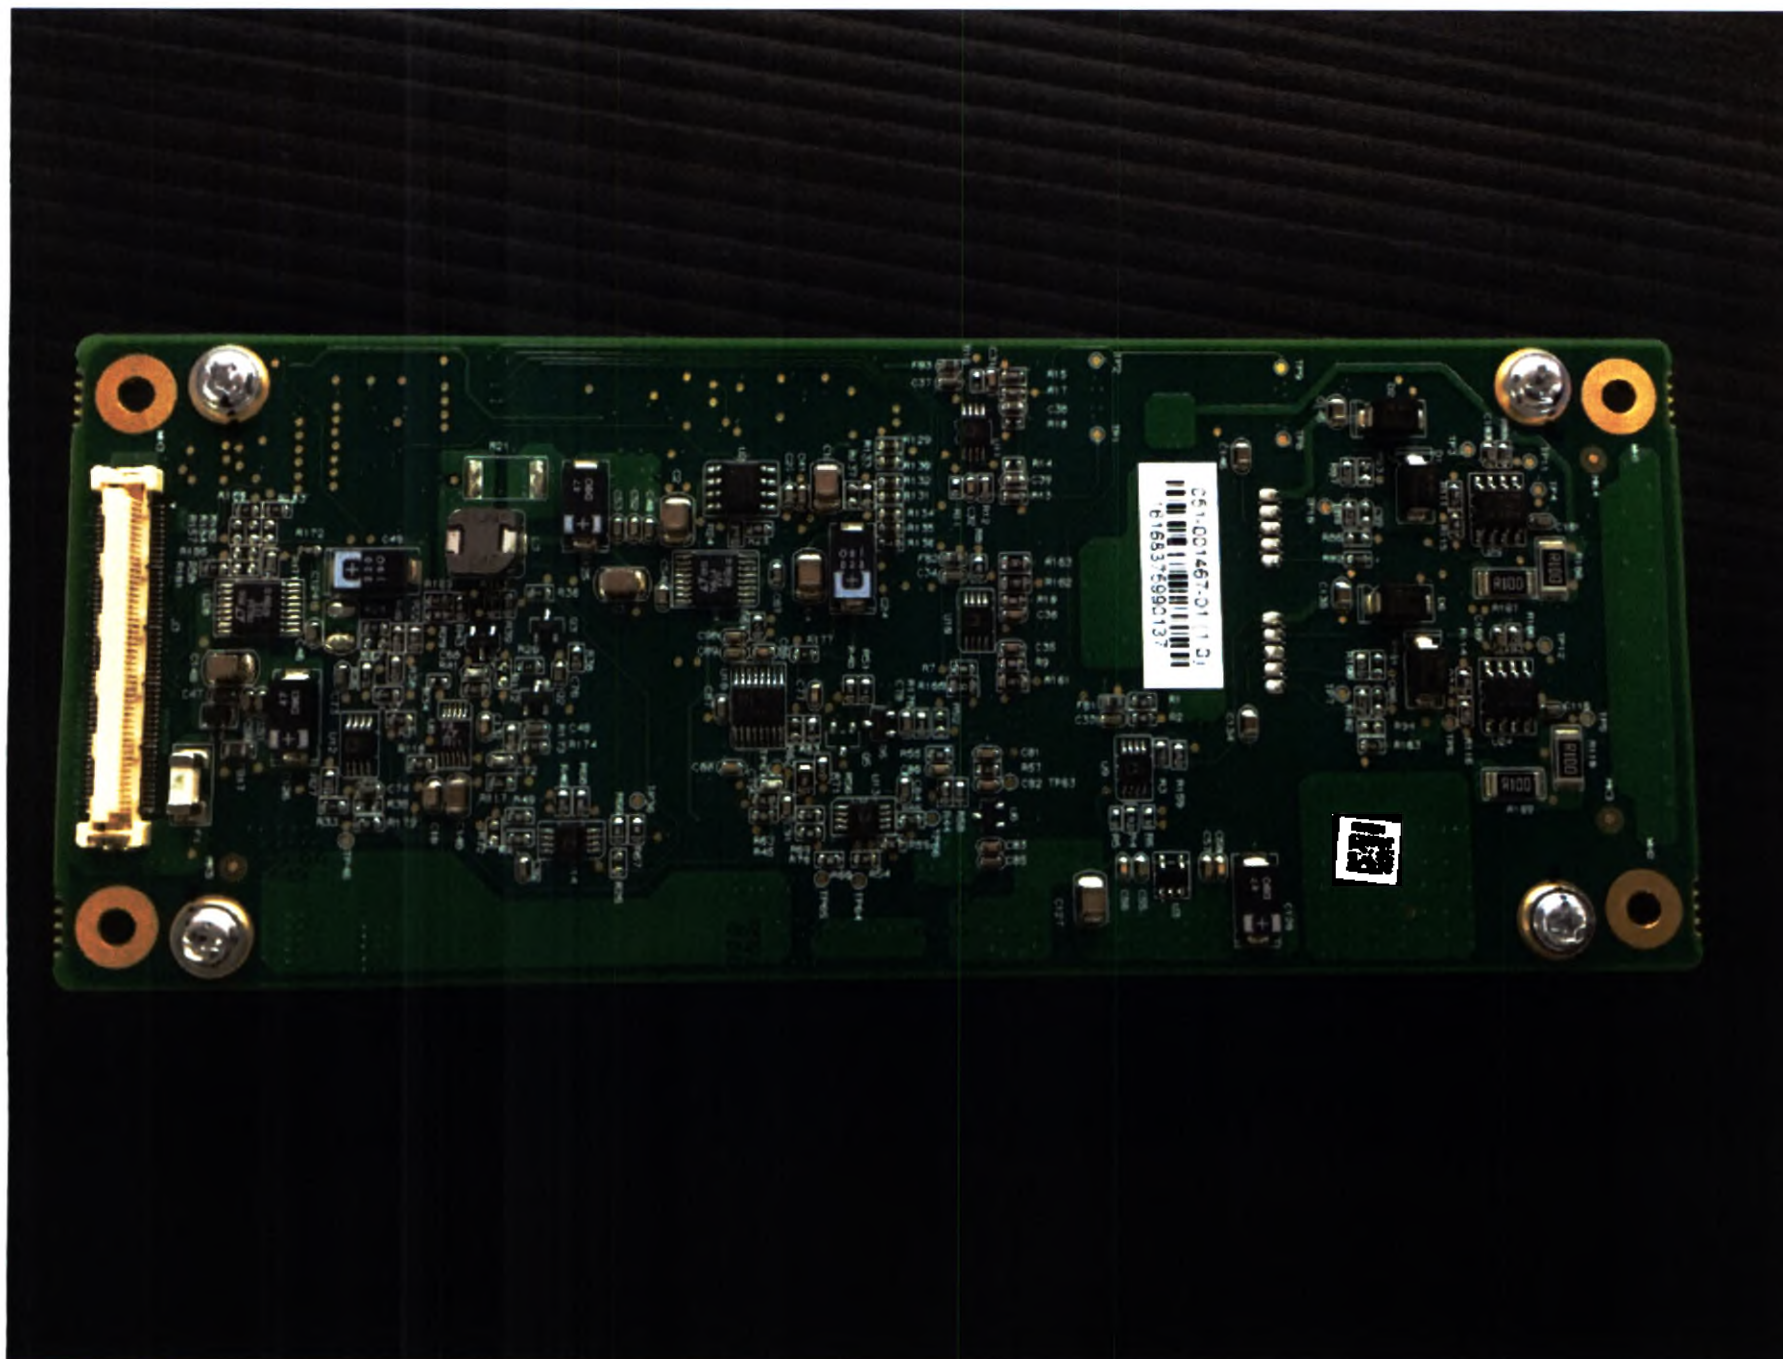


Модуль объемного сканирования в реальном времени (4D-module)

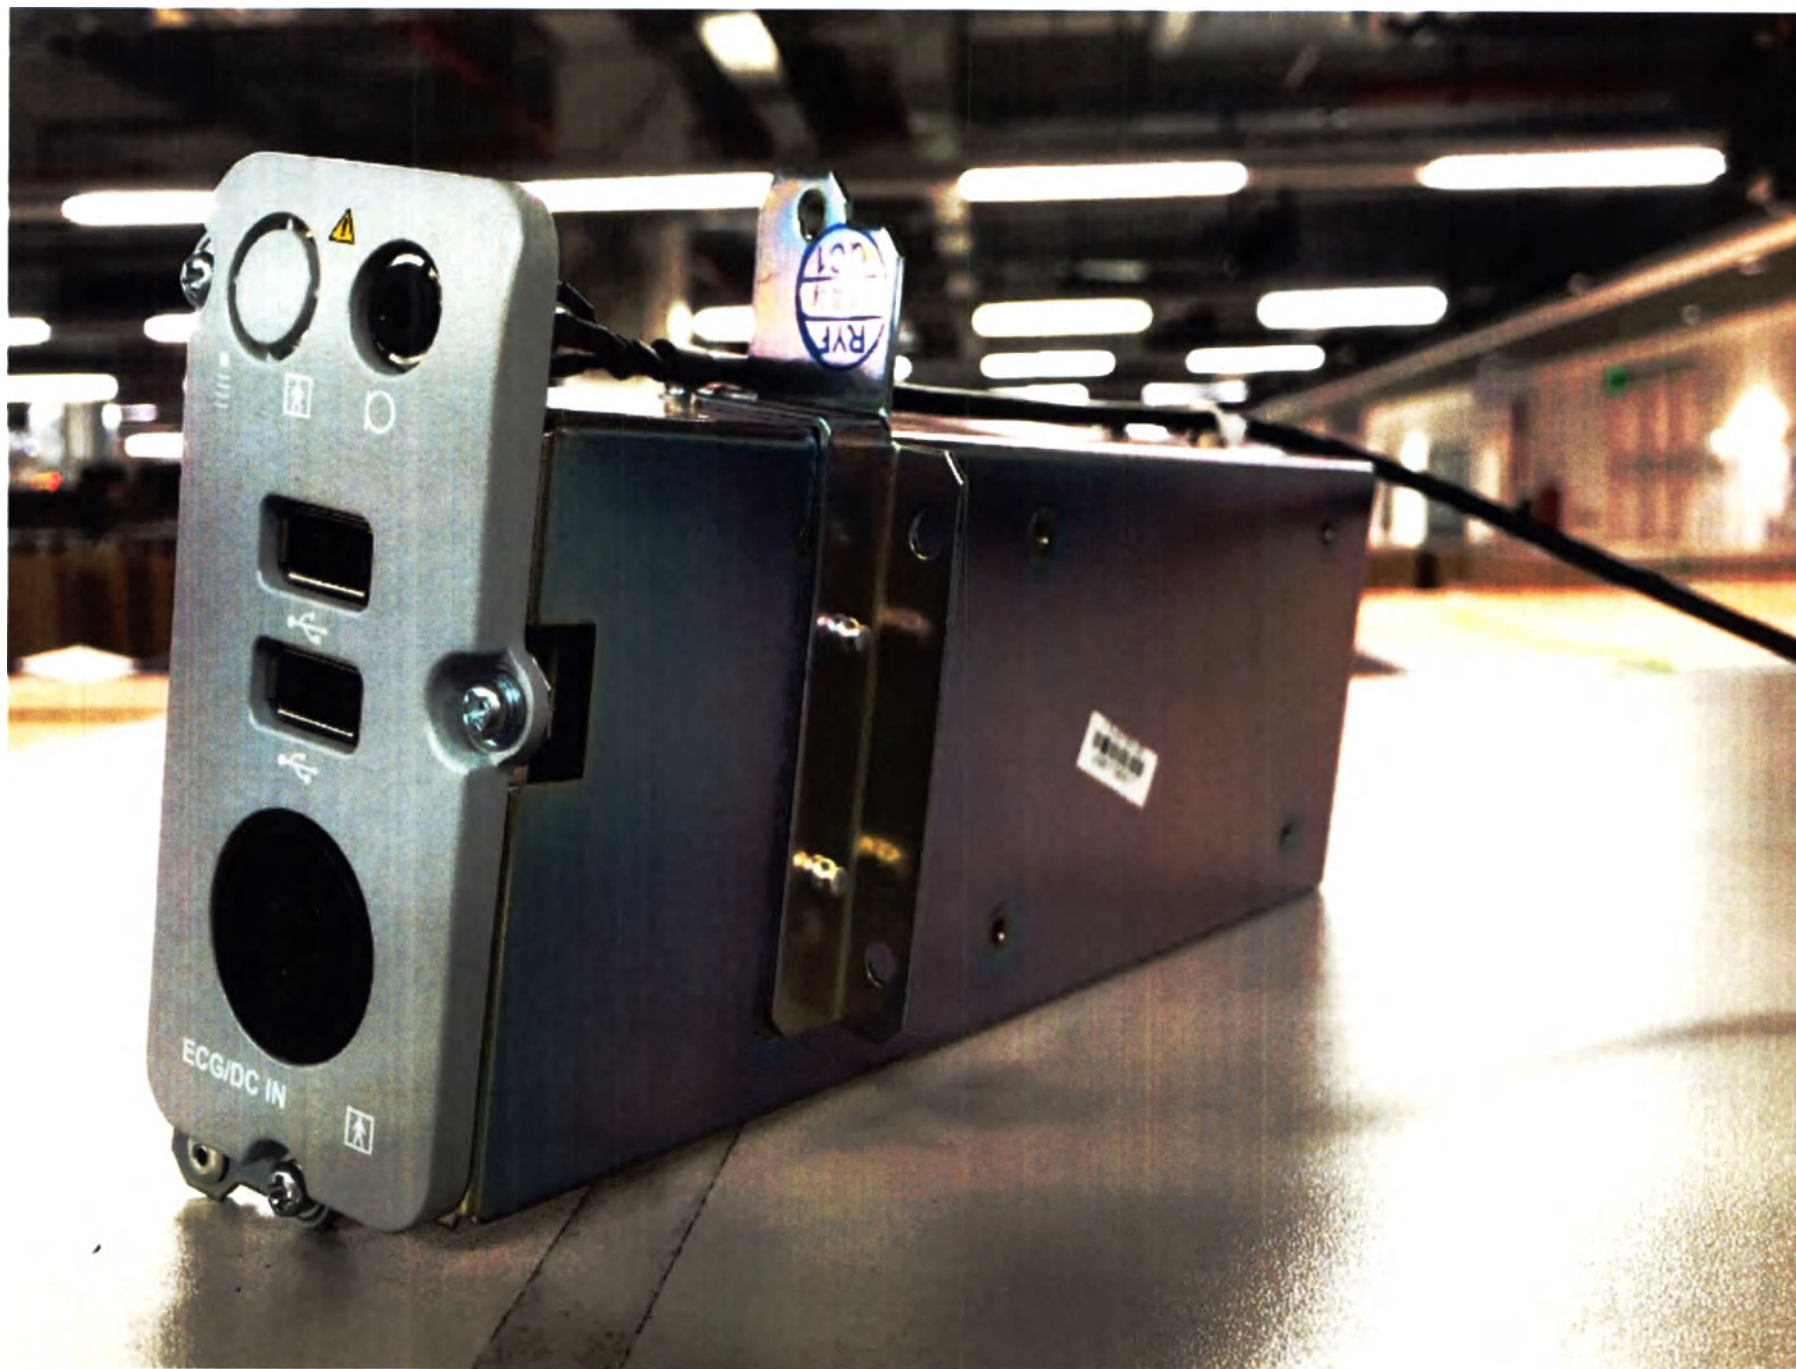


Модуль приема ЭКГ сигналов с кабелем ЭКГ (Physio Module (includes ECG with cords))



Программное обеспечение для эластографии (Elastography)

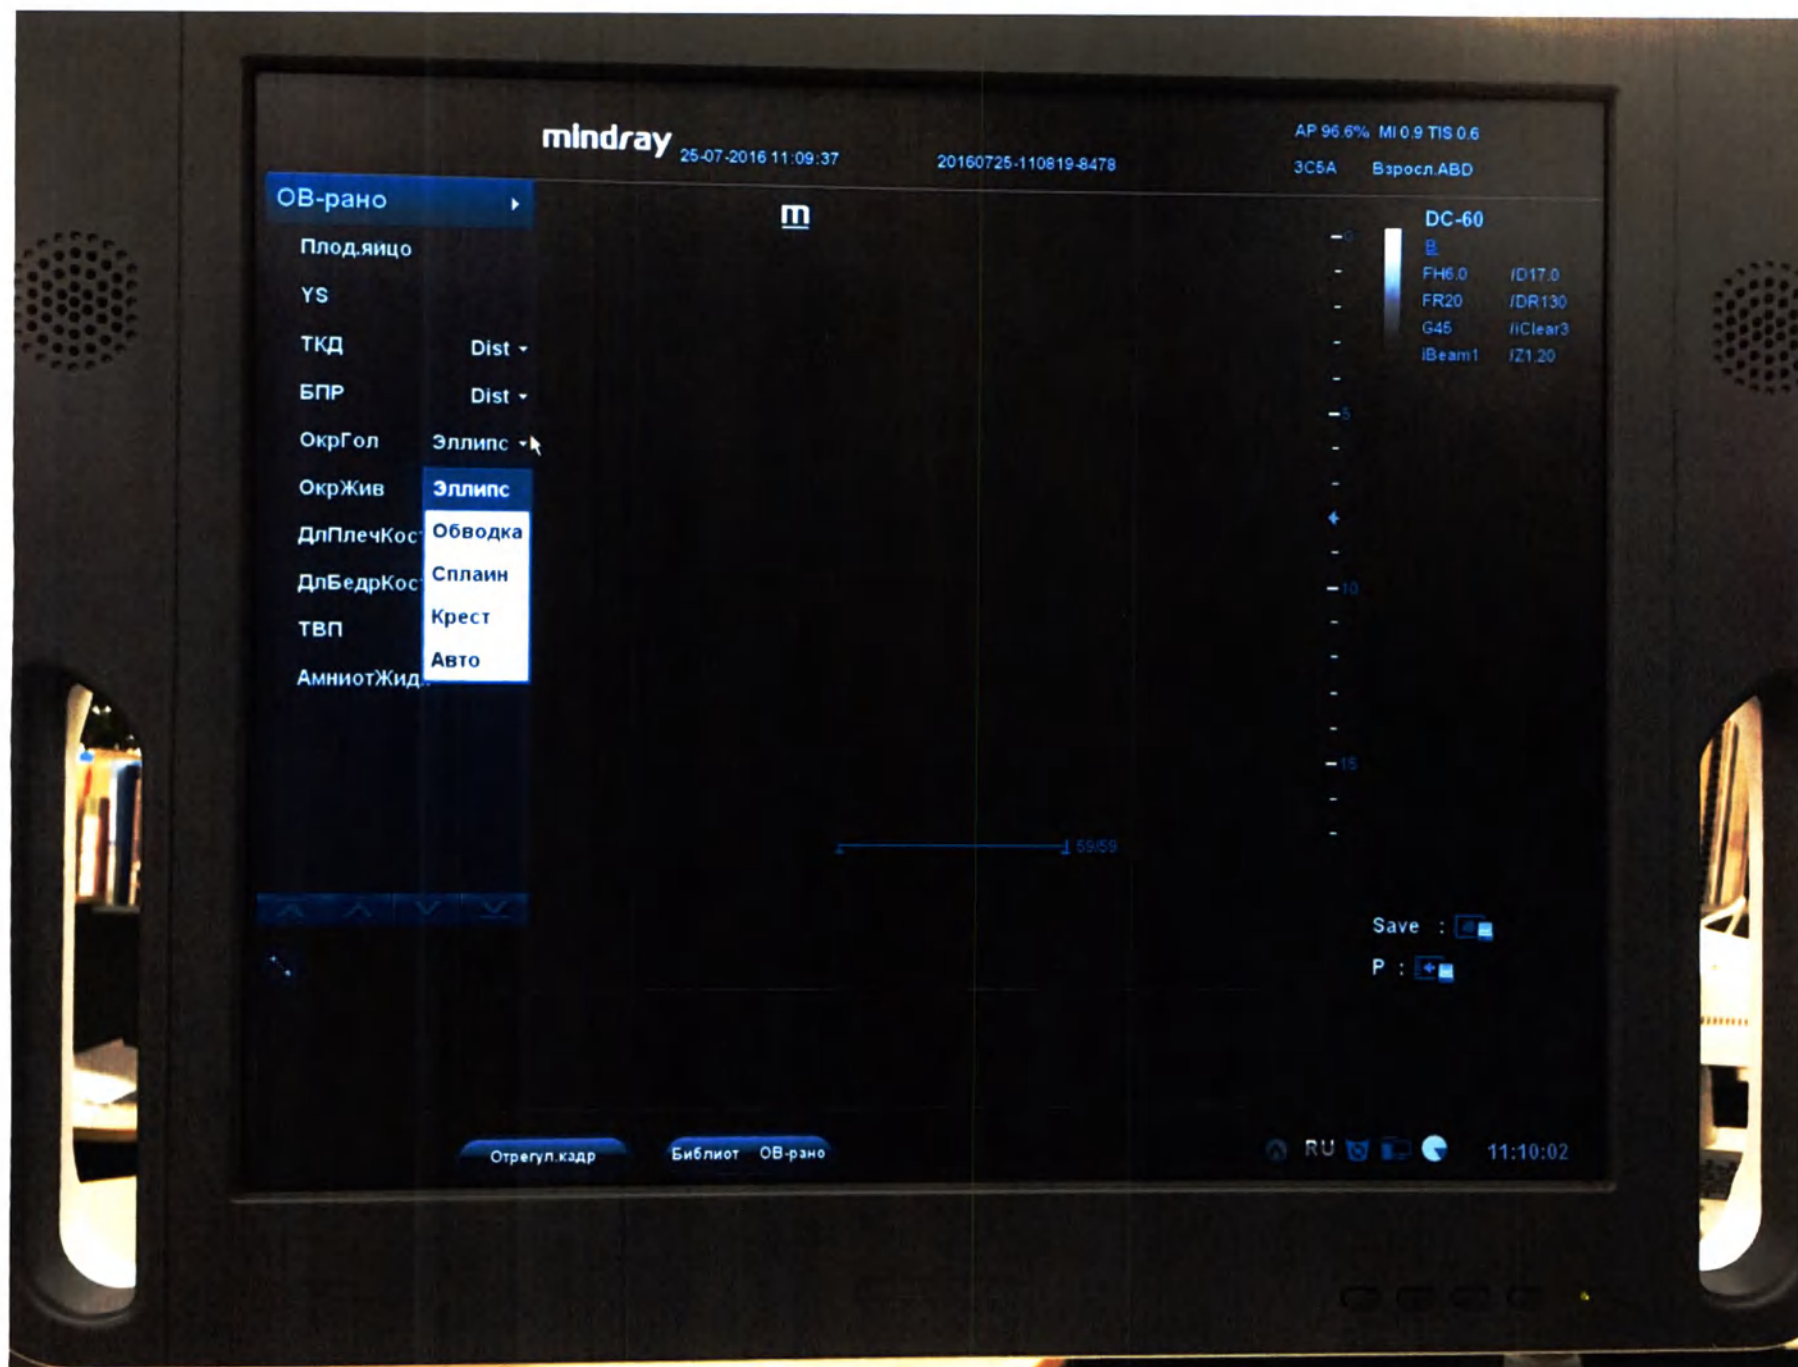

Программное обеспечение для автоматического измерения акушерско-гинекологических параметров Smart OB (Automatic obstetrical measurements)

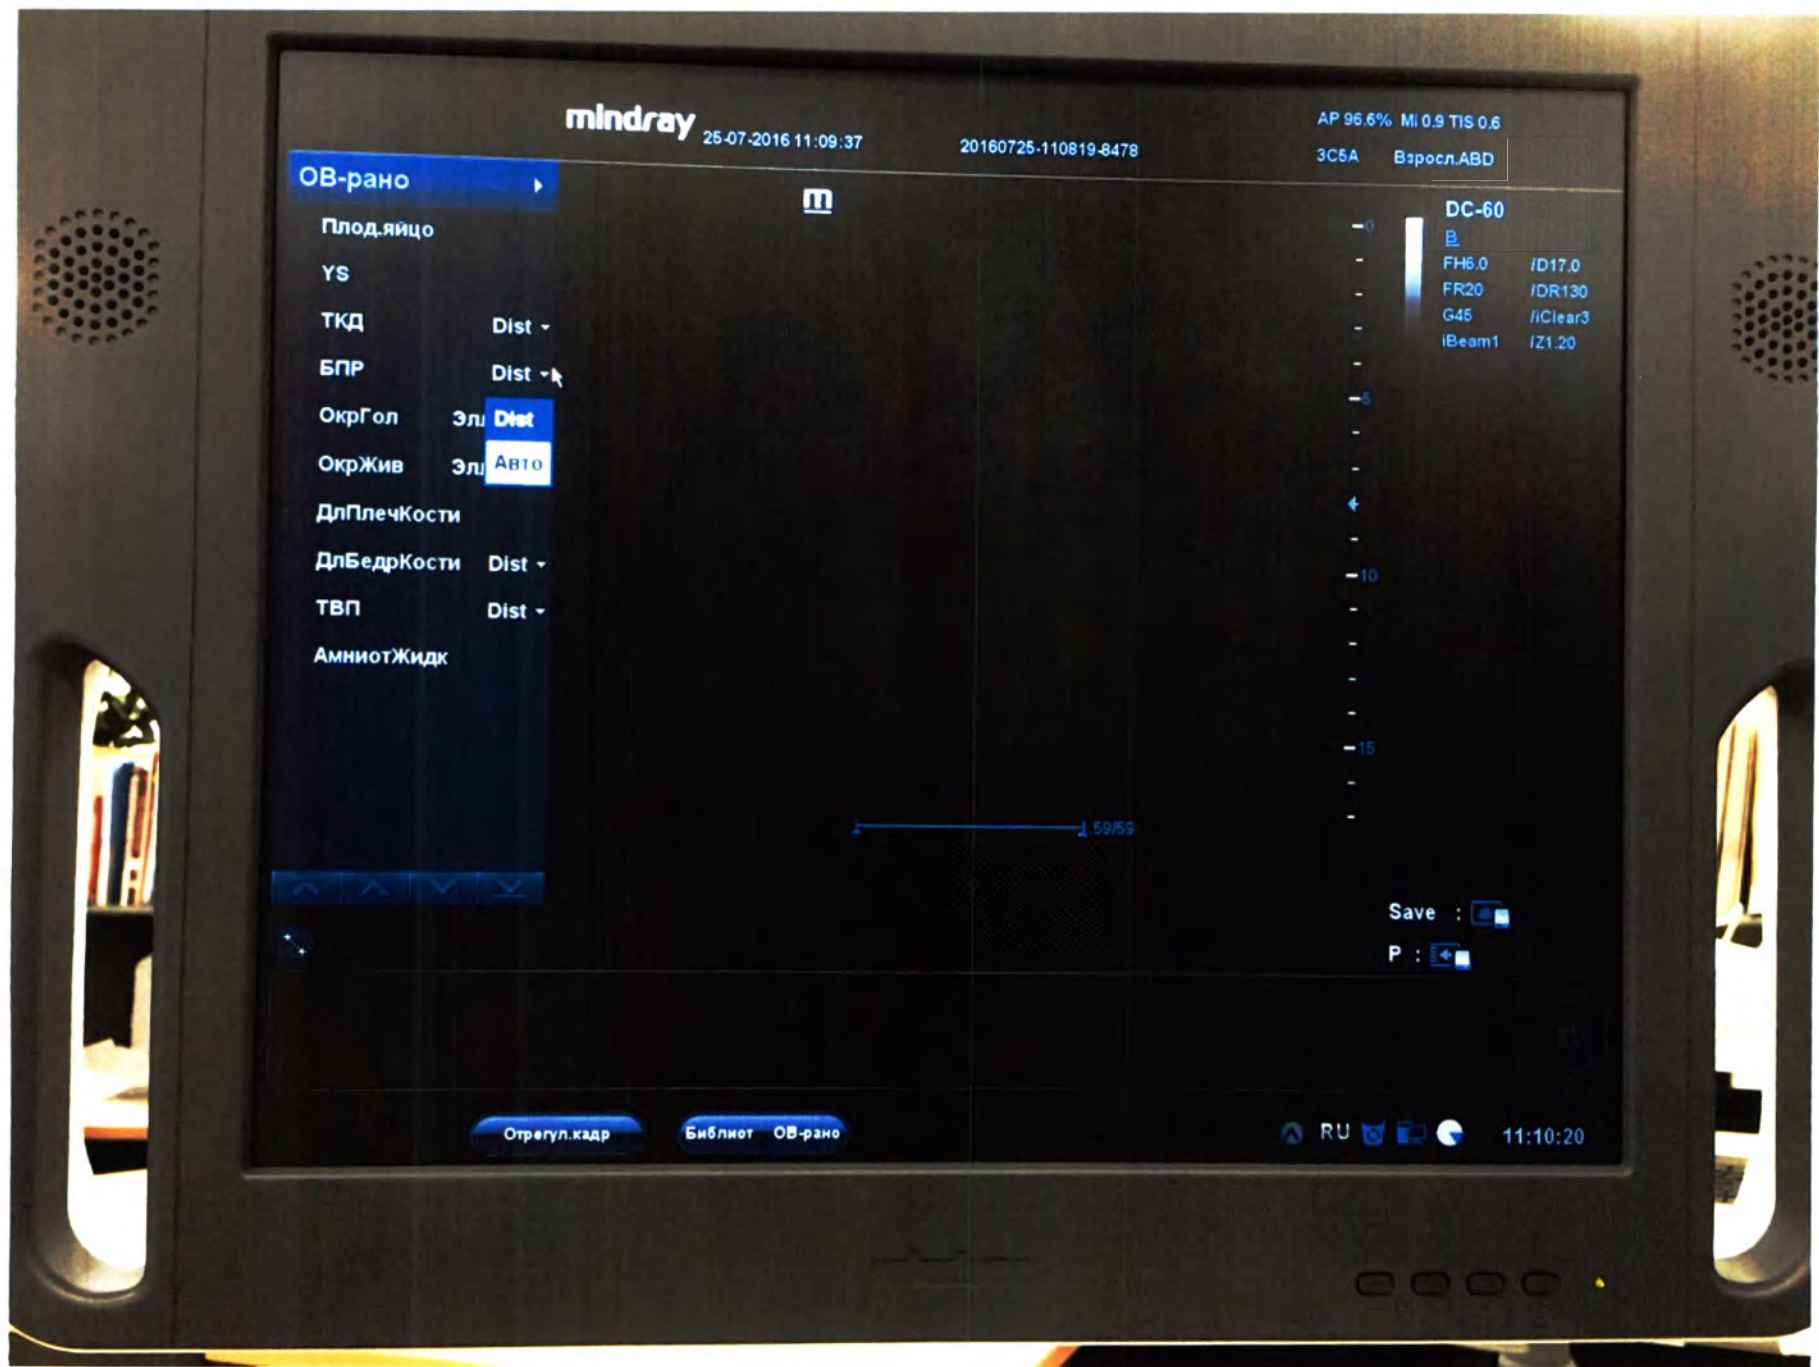

Программное обеспечение для автоматического измерения воротникового пространства у плода Smart NT (Automatic calculation of Nuchal Translucency)



Программное обеспечение для построения 3D изображений при помощи 2D датчиков Smart 3D (Freehand 3D)

DC-60

3D/4D

Приобретение методы

С качением

Линейн

Режимах рендеринга

Поверхность

Мах

Мин


Рентген

Отрезок
150mm


Качество
Низ2

Угол
60°

Программное обеспечение для построения объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки плода iLive (Rendering mode for realistic volume imaging display)

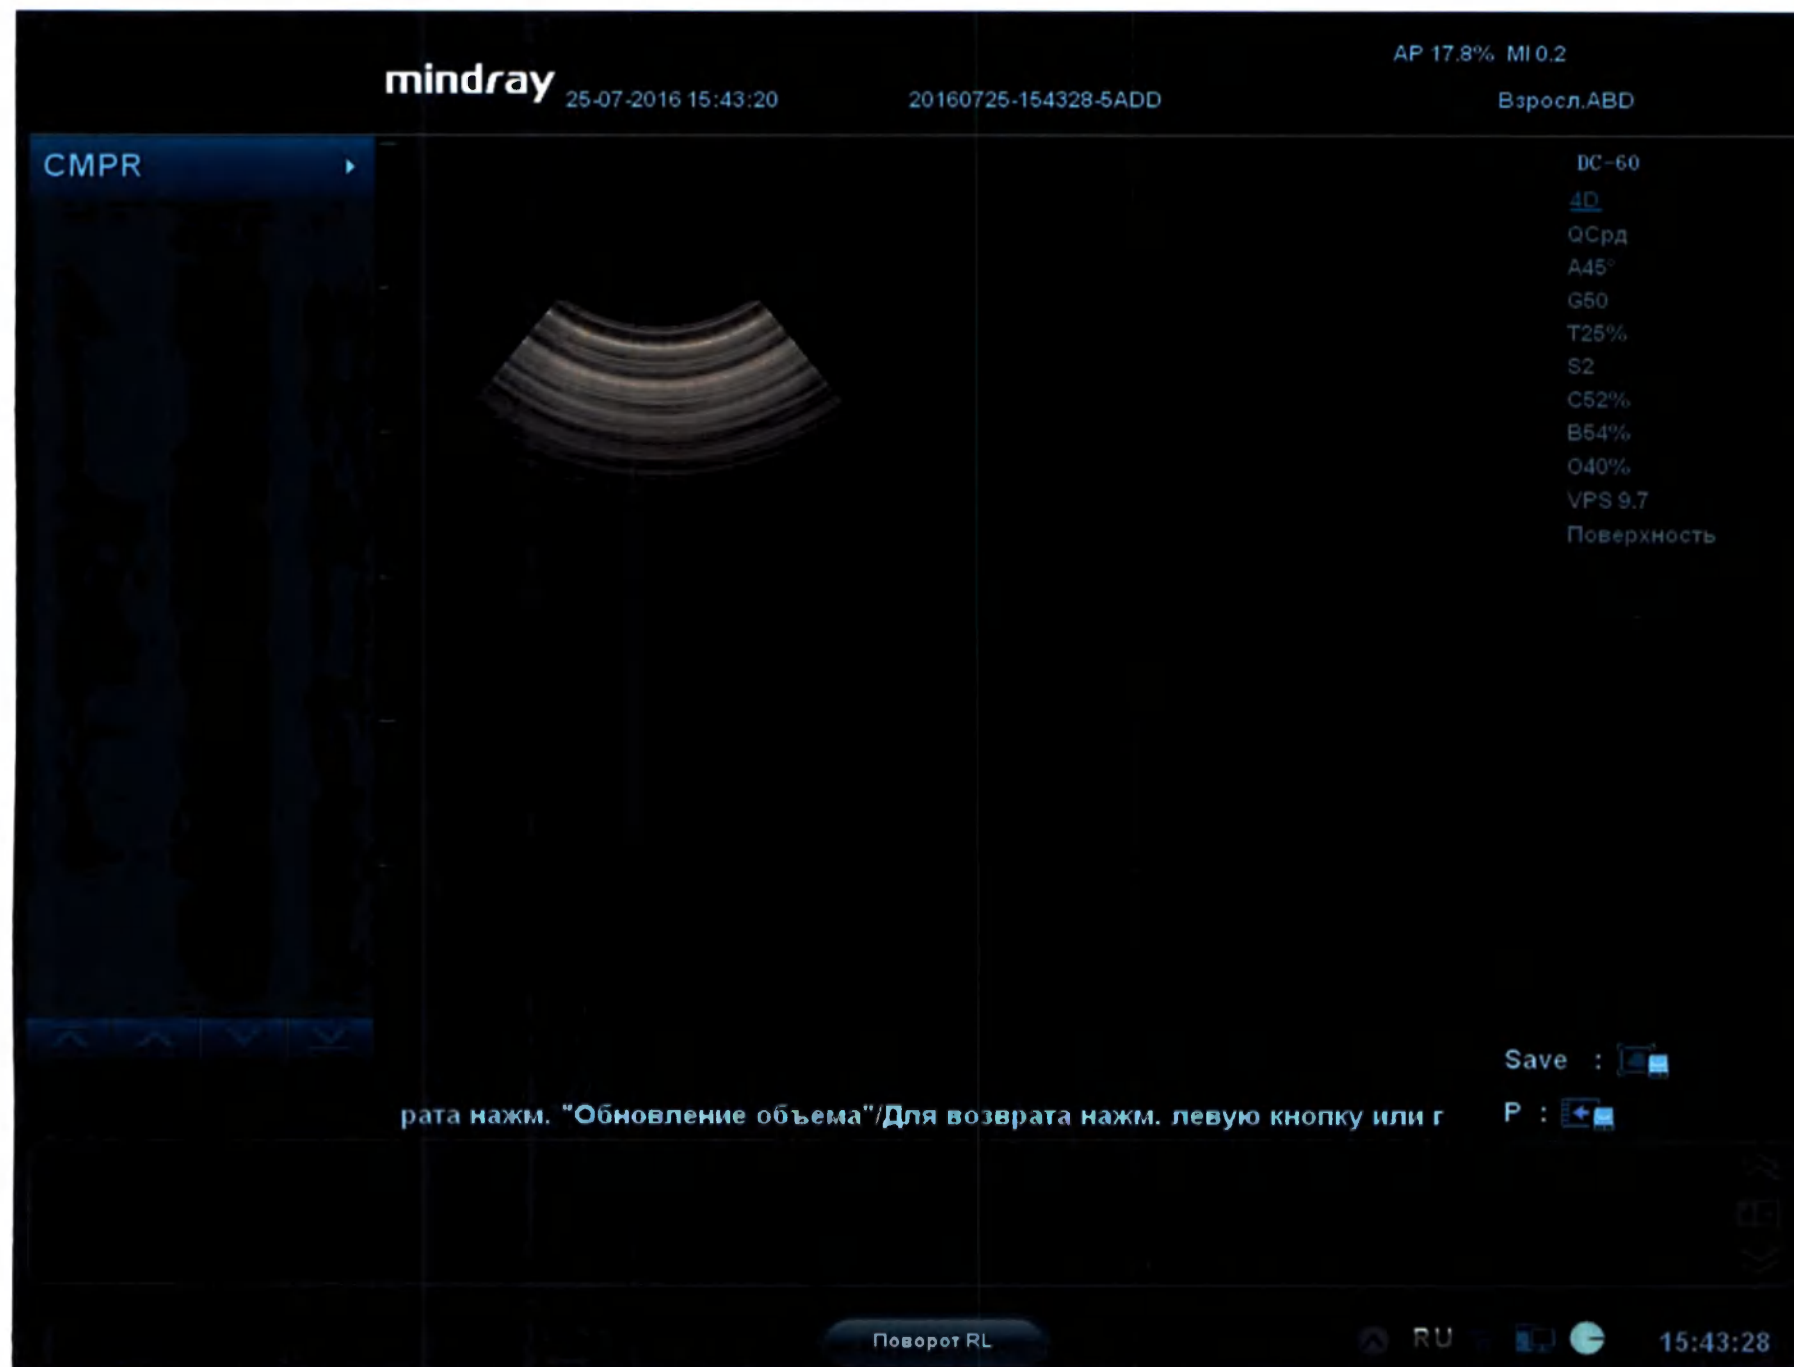

Программное обеспечение для получения срезов сложной геометрической формы в объемном изображении CMPR (Curved Multi-Planar Reconstruction)

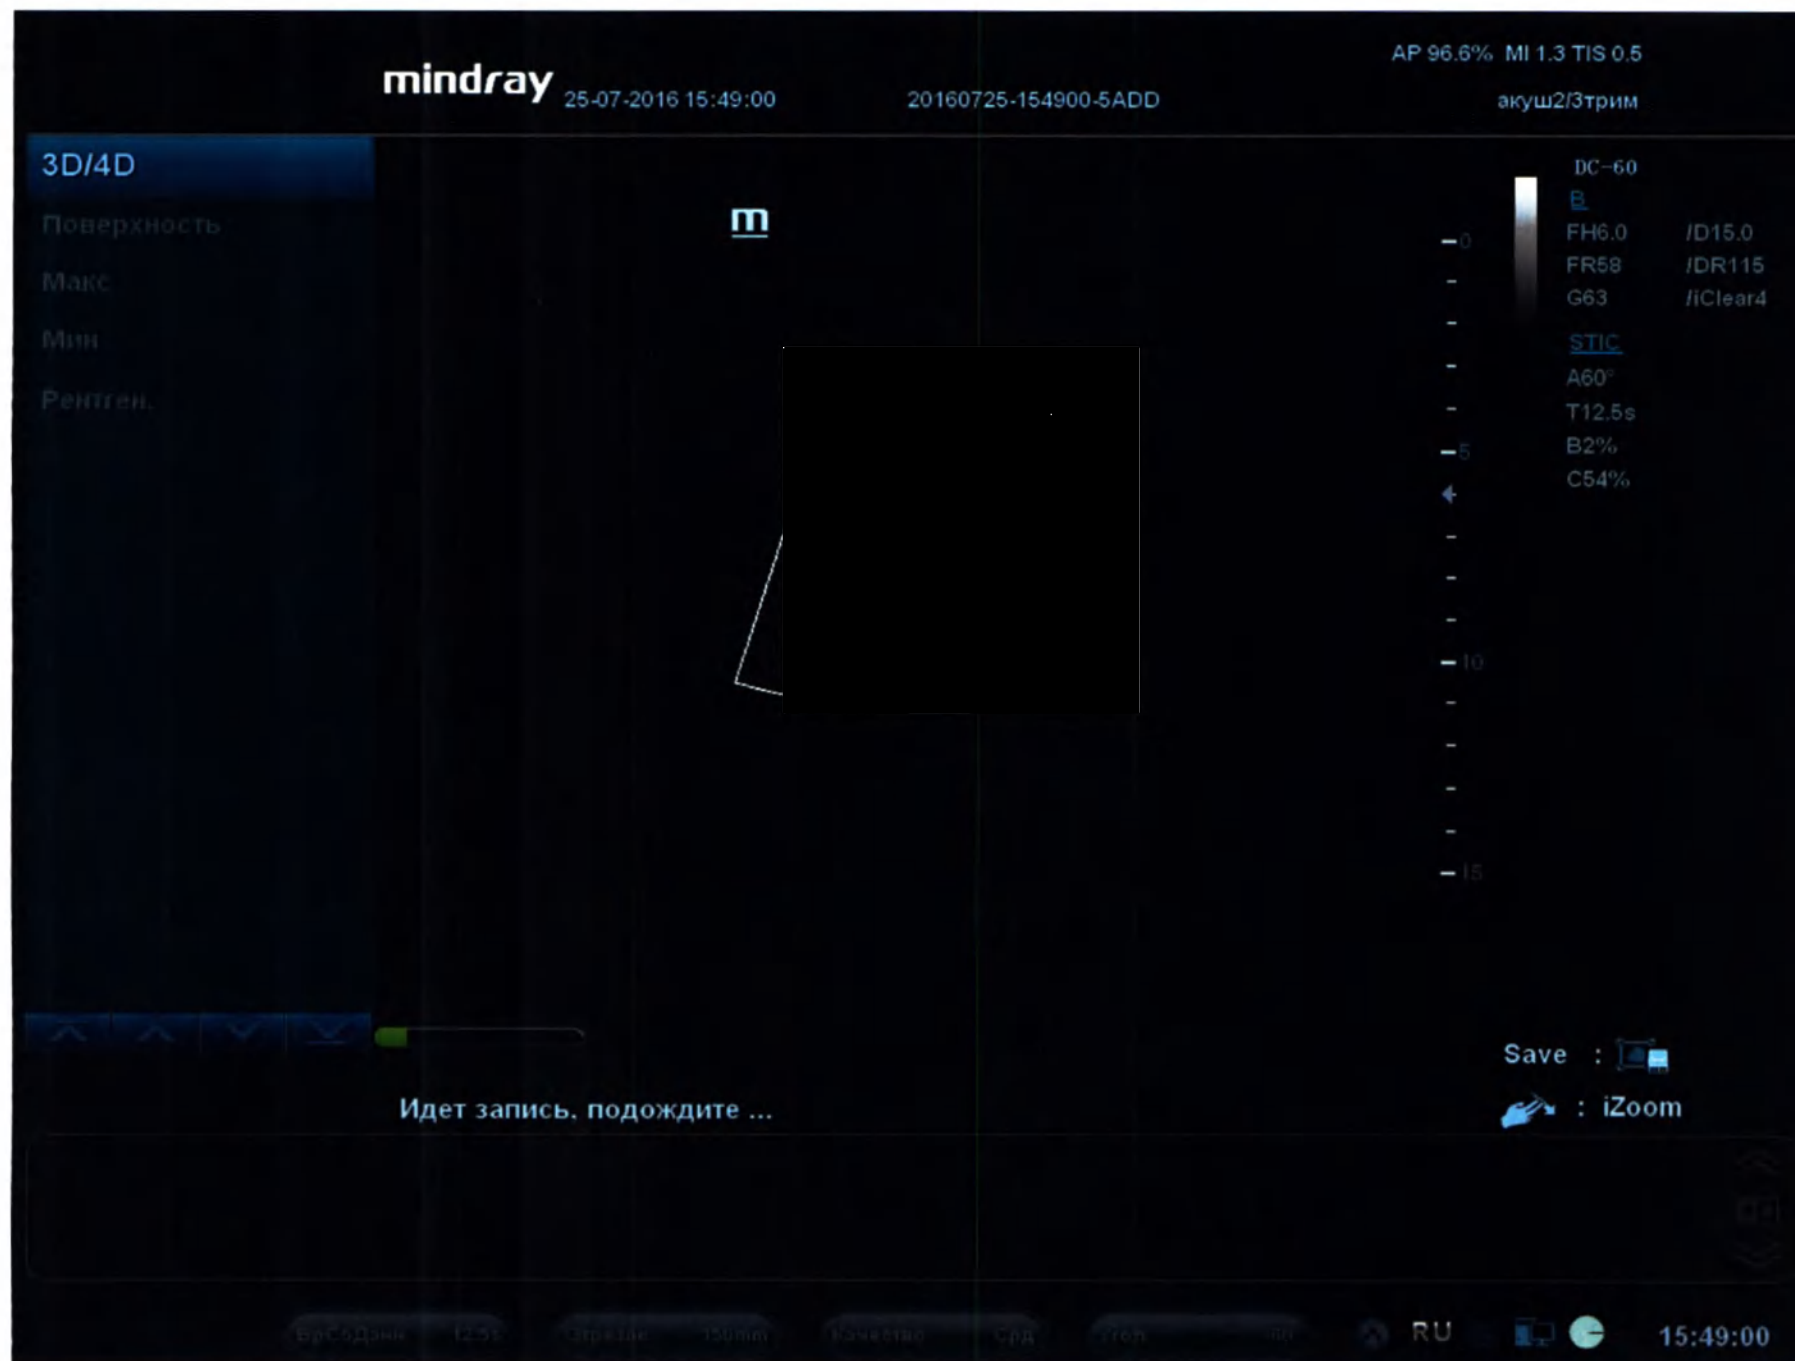

Программное обеспечение для исследования объемного изображения сердца плода STIC (Spatio-Temporal Imaging Correlation)




Программное обеспечение для трехмерного изображения в режиме цветового/энергетического доплеровского картирования Color 3D (3D supports color and power mode)




Программное обеспечение для произвольного выбора среза в объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей Niche/3Slice




Программное обеспечение для автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов Smart FLC (Smart Follicle)

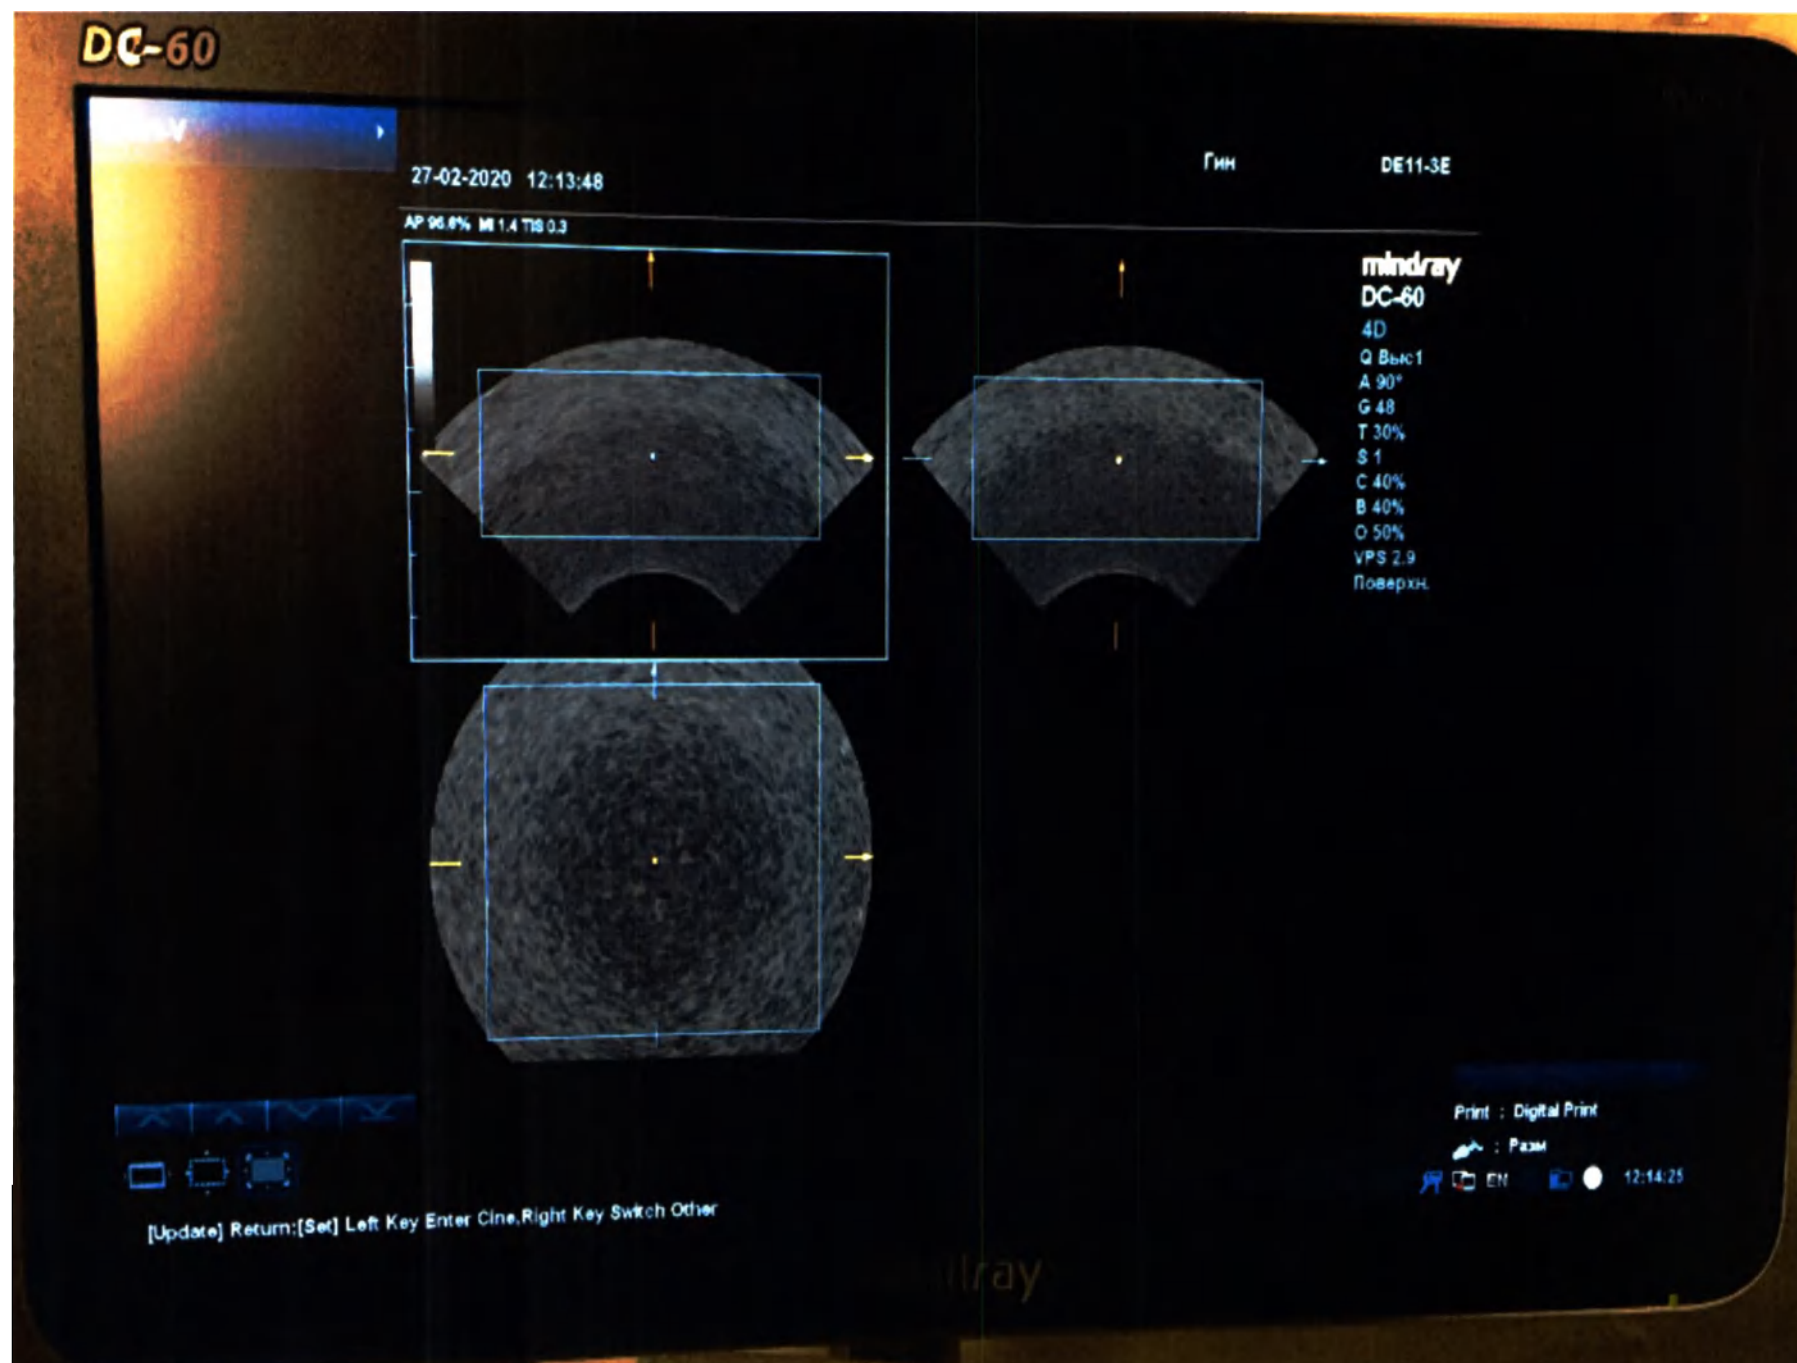

Программное обеспечение для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении Smart Volume

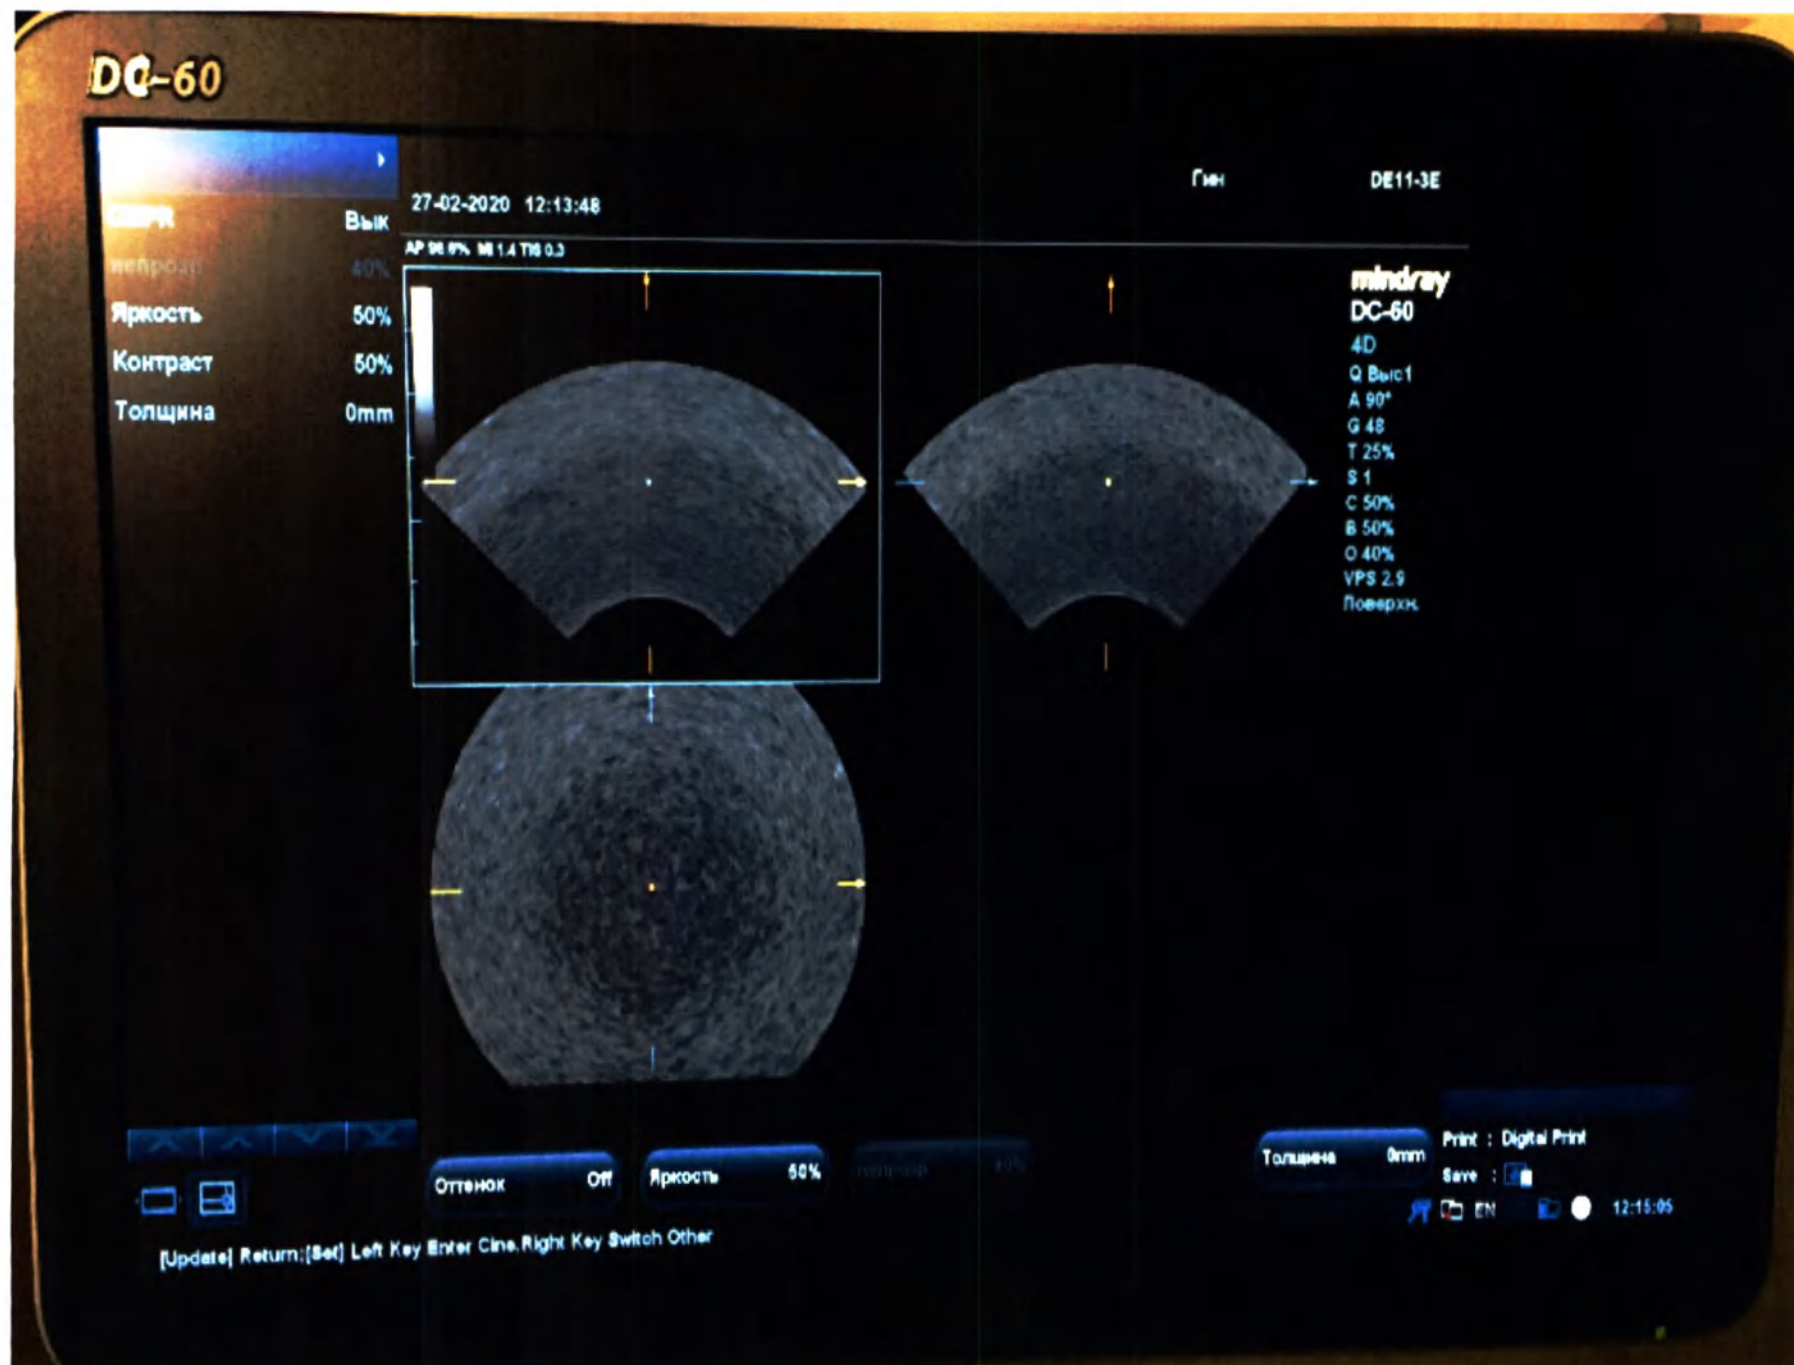

Программное обеспечение для получения произвольного среза заданной толщины в объемном изображении с одновременным улучшением контрастности SCV+ (Slice Contrast View)

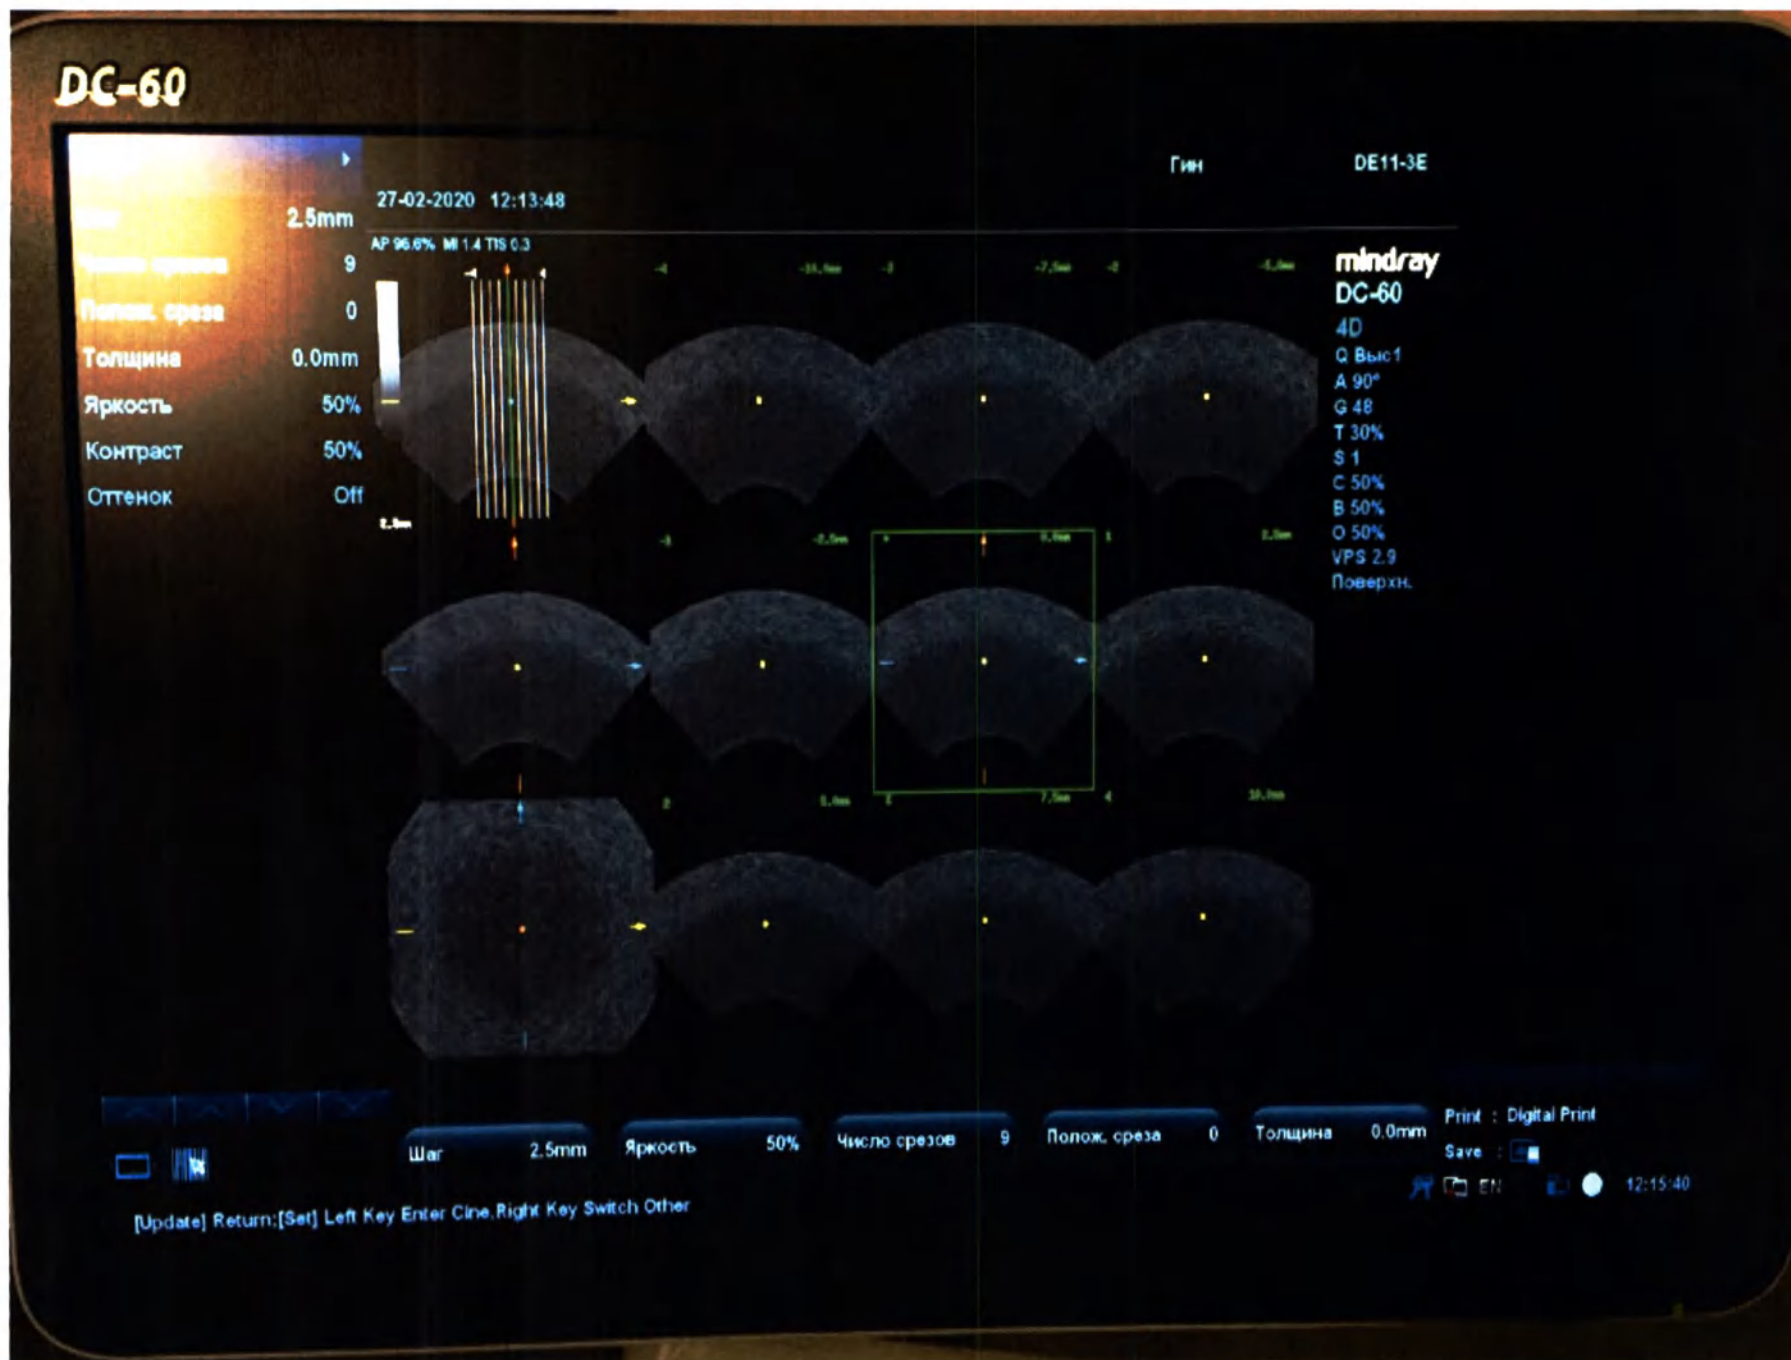

Программное обеспечение для мультисрезового томографического отображения с регулировкой толщины среза (iPage+)




Программное обеспечение для автоматического получения набора срезов головы плода (Smart Planes CNS)




Программное обеспечение для автоматизированного расчета фракции выброса левого желудочка Auto EF (automatic Ejection Fraction Measurement)




Программное обеспечение для ЭКО (IVF package)

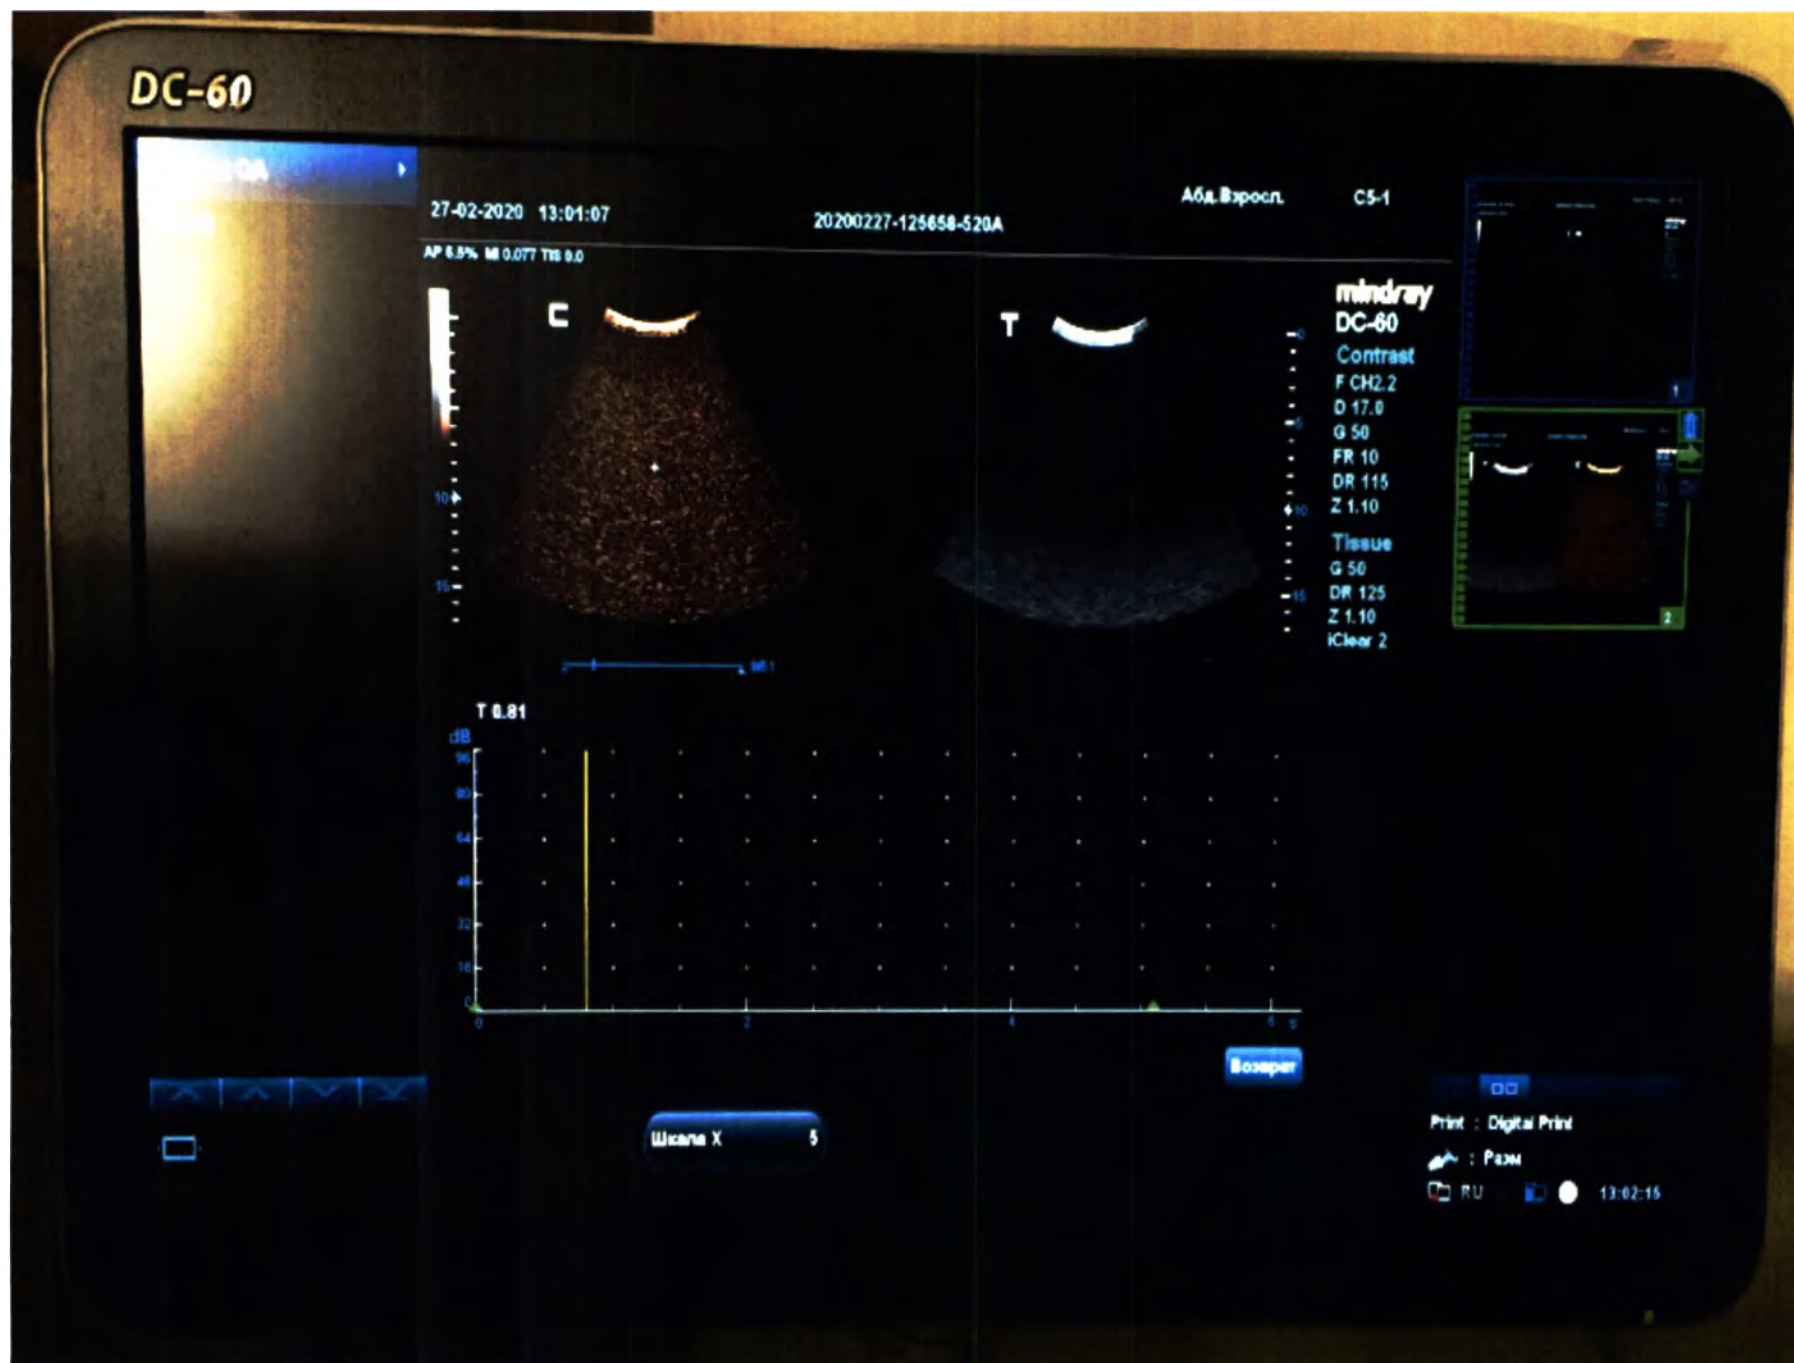

Программное обеспечение для количественной оценки с контрастированием (UWN+ Contrast QA)

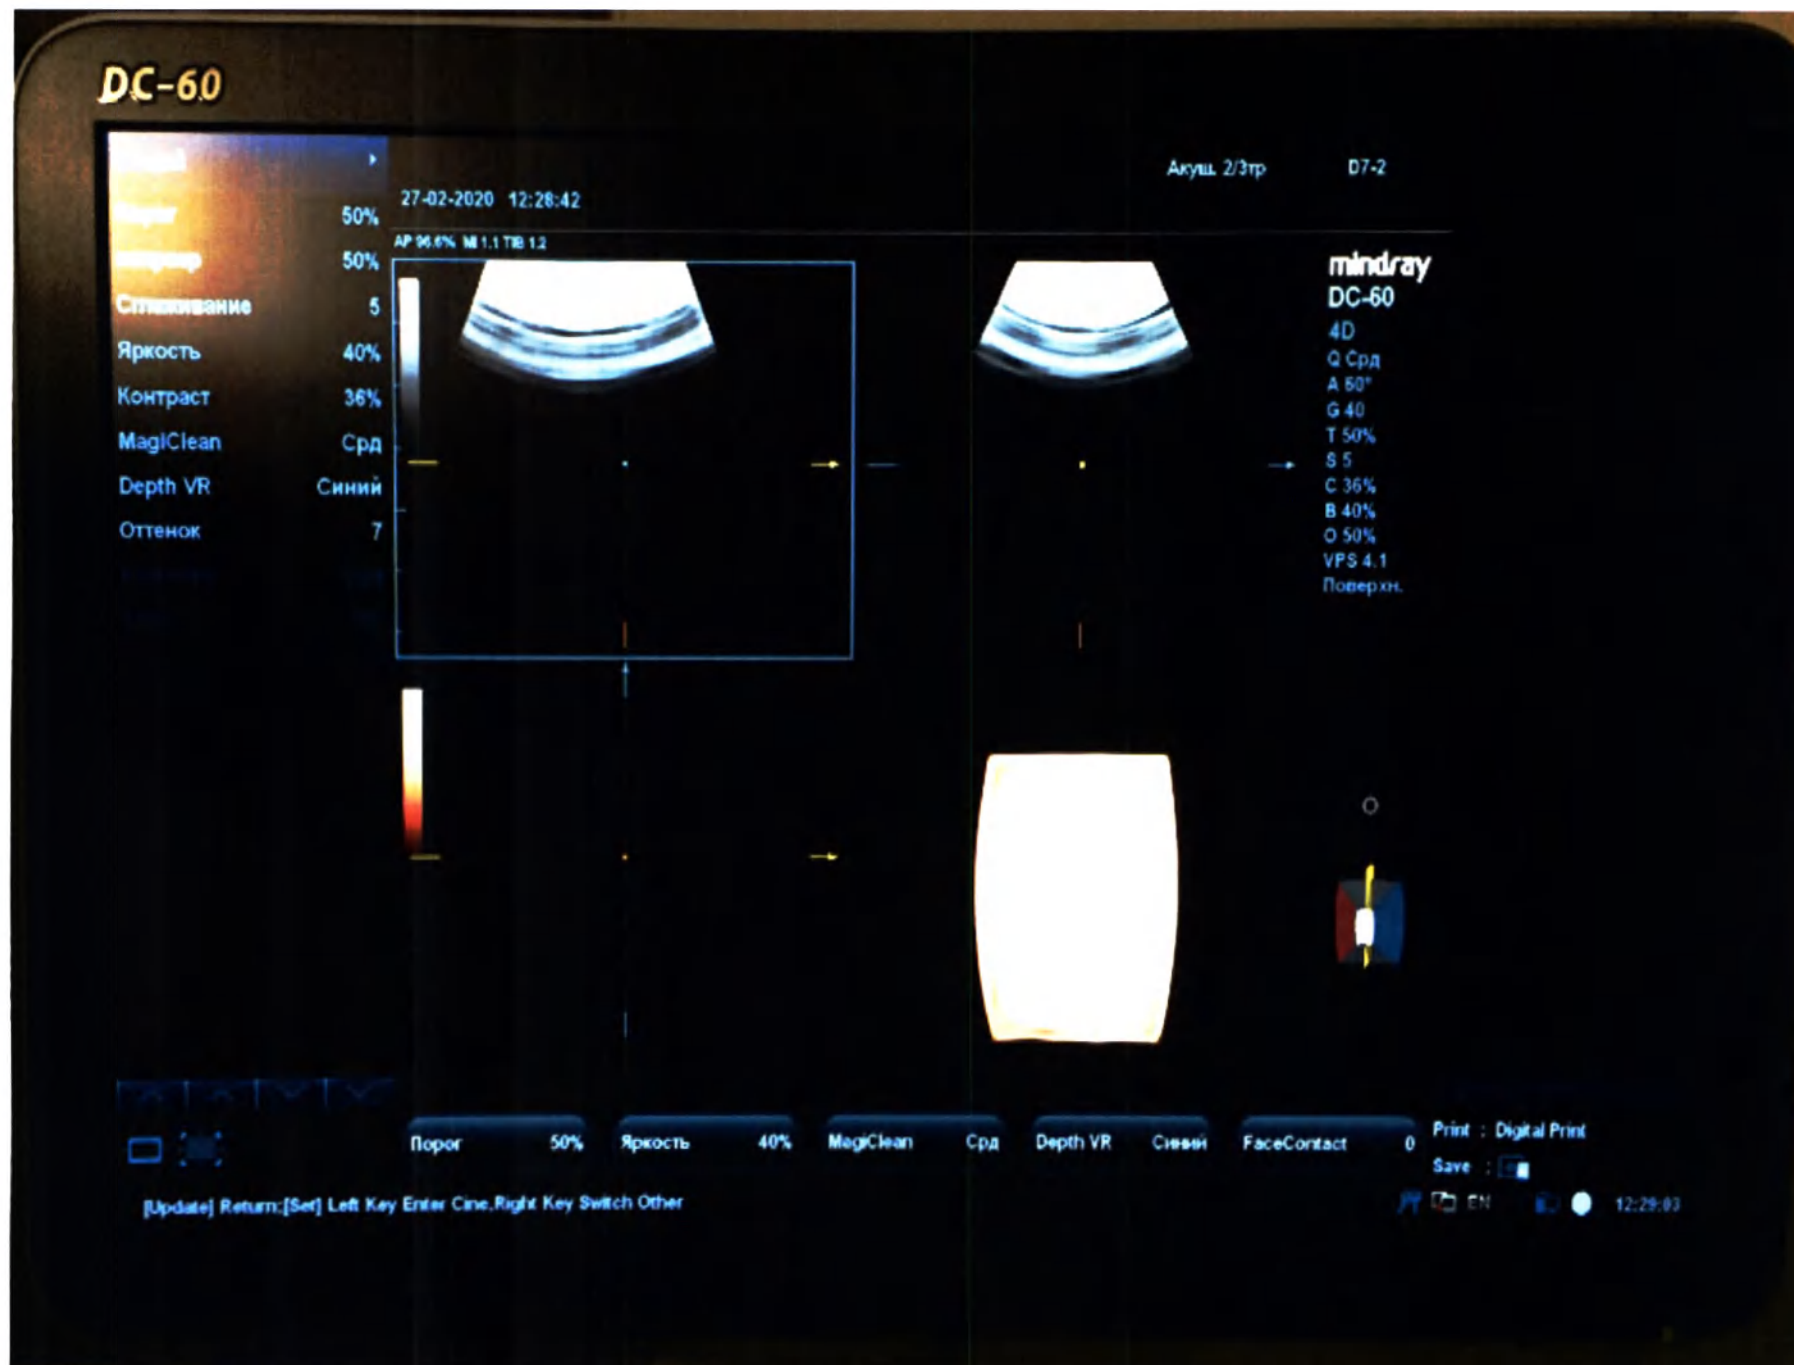

Программное обеспечение для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода (Smart Face)

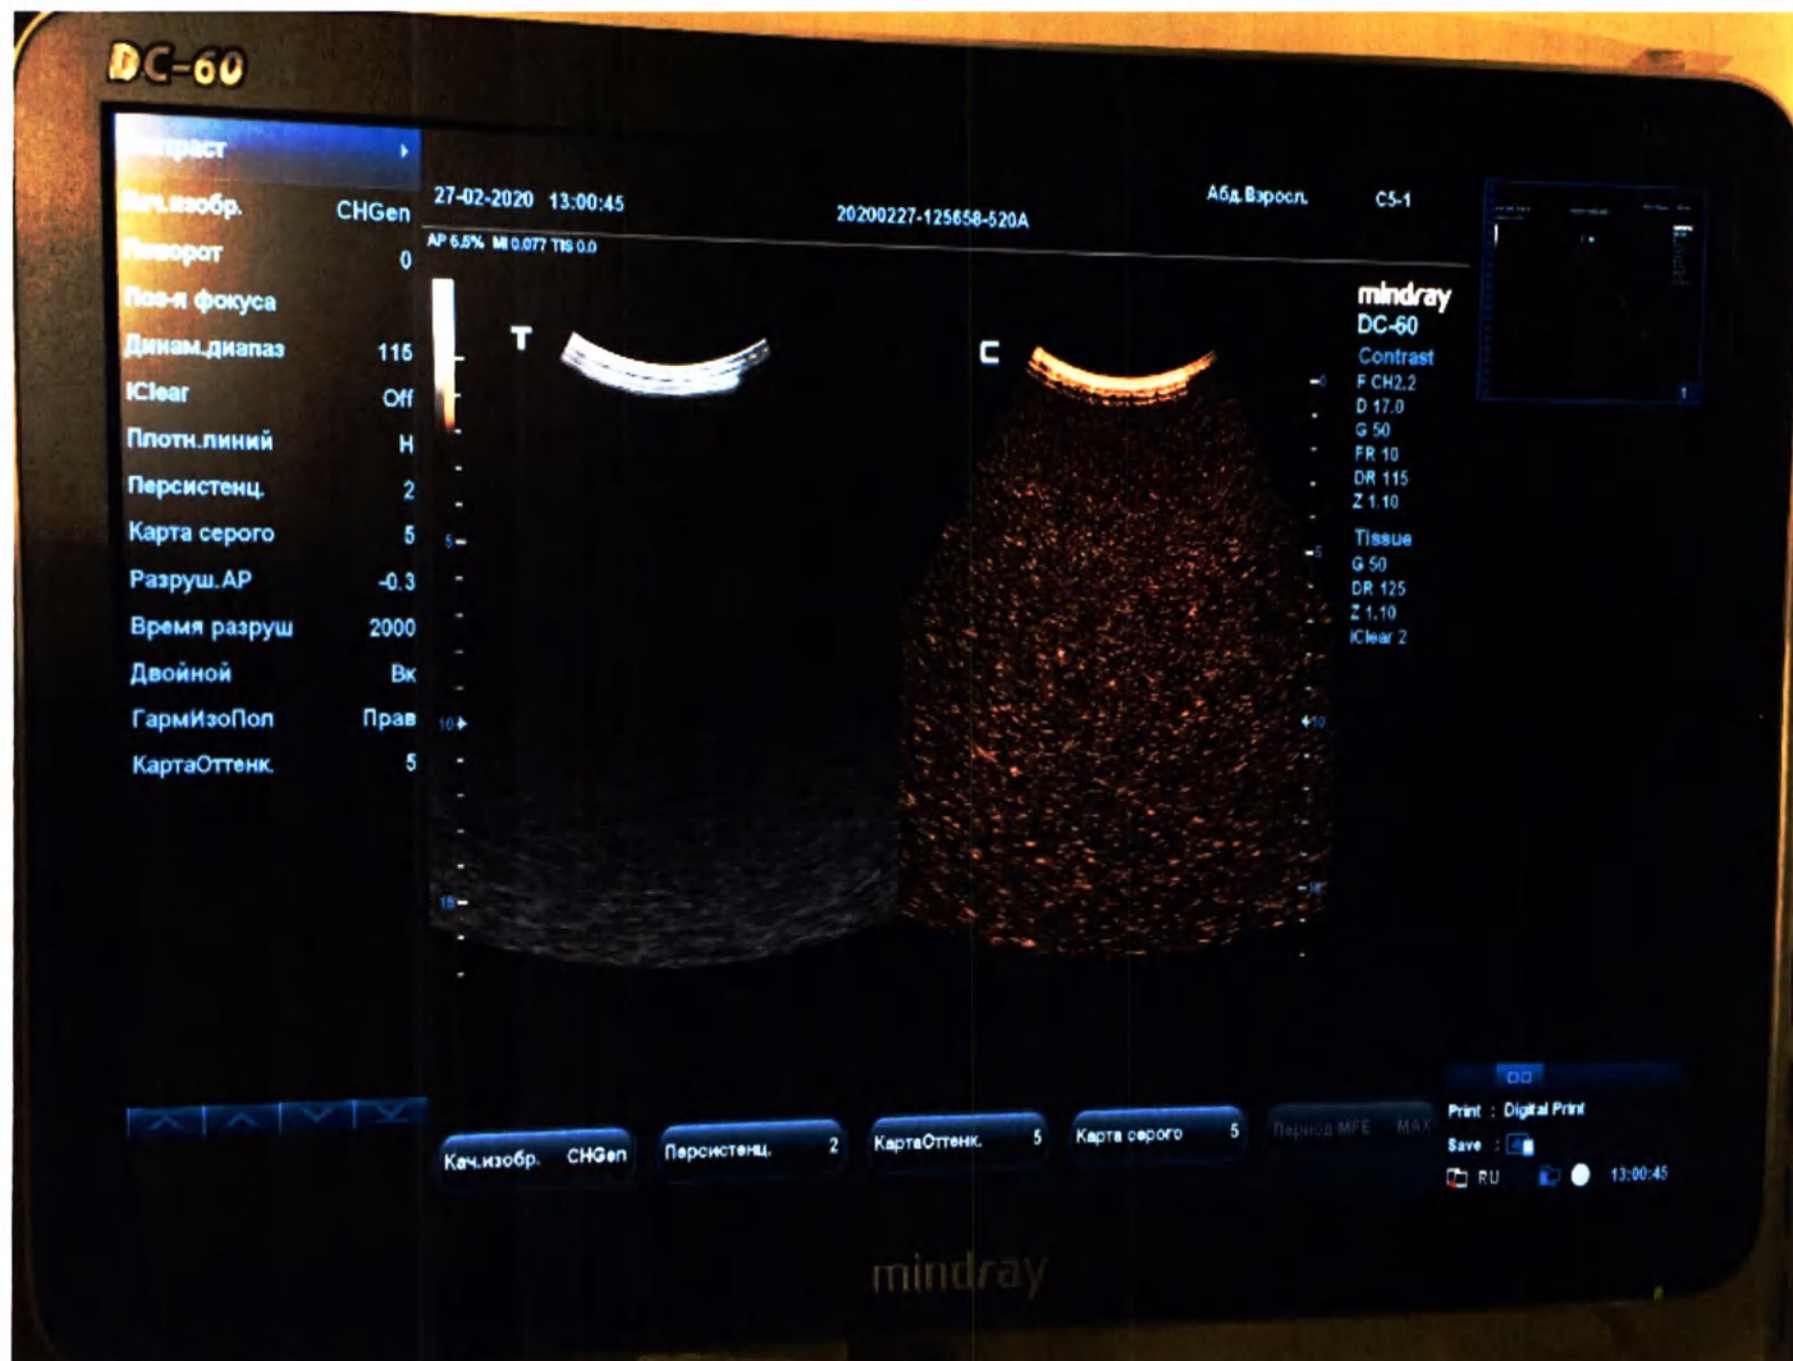


Программное обеспечение для исследований с контрастированием (UWN+ Contrast)



Программное обеспечение для получения изображения в режиме тканевого доплера TDI (Tissue Doppler Imaging)



Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы iNeedle (Needle Visualization Enhancement)

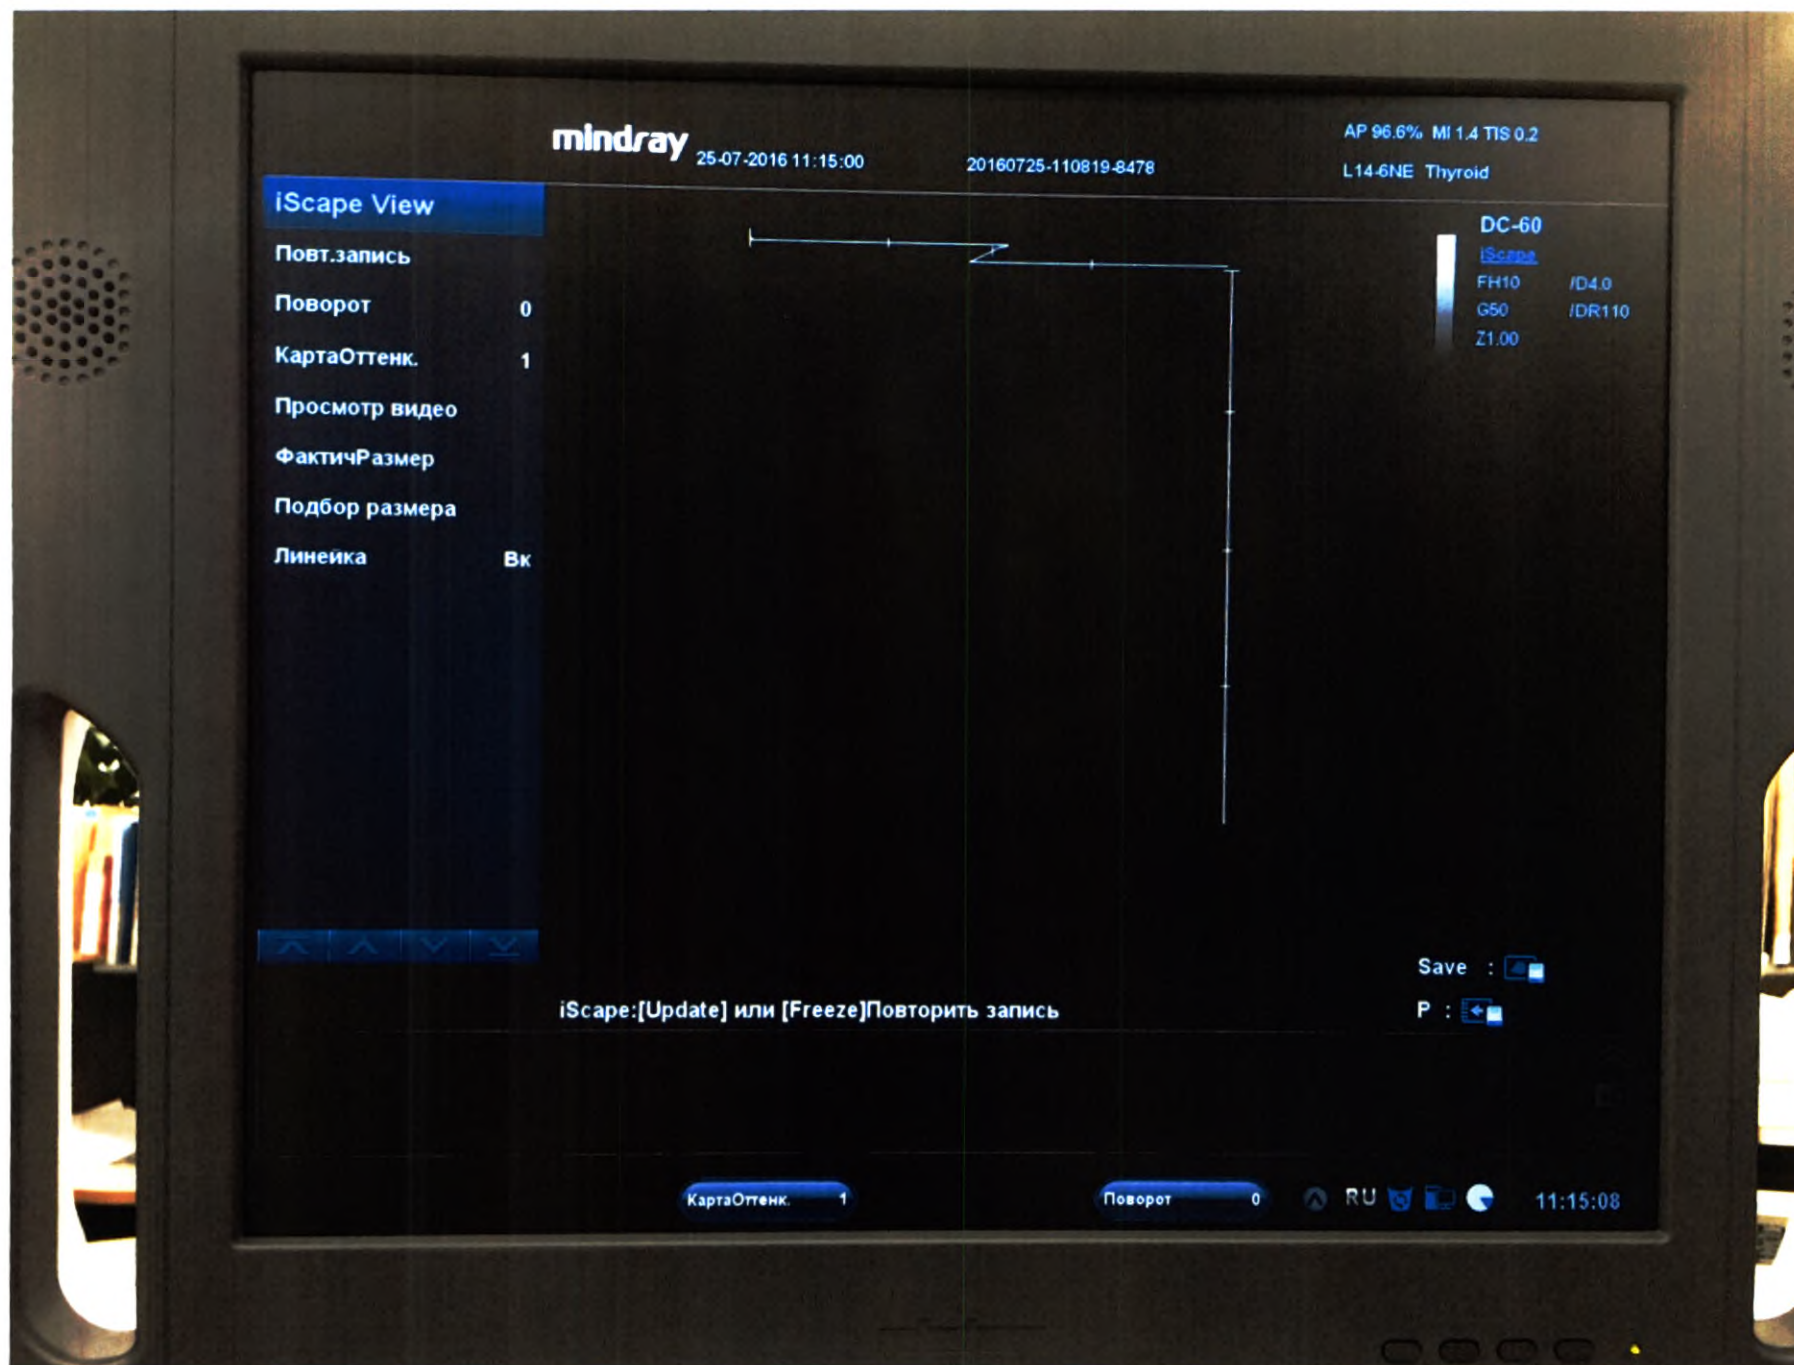

Программное обеспечение для панорамного сканирования iScape View (Realtime Panoramic Imaging)



Программное обеспечение для автоматизированных рабочих протоколов (iWorks) (Automatic Workflow Protocol)



Программное обеспечение для автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа Auto IMT (Automatic measurement for Intima-Media Thickness)



Программное обеспечение для анатомического М-режима Free Xros M (Anatomical M-mode)



Программное обеспечение для количественного анализа в режиме тканевого доплера (TDI Quantification Analysis)



Программное обеспечение для криволинейного анатомического М-режима Free Xros CM (Curved Anatomical M-Mode)




Программное обеспечение для усиления контрастности серошкального изображения (Echo Boost)




Программное обеспечение для оценки результатов стресс-эхокардиографии (Stress Echo)



Программное обеспечение для интеграции в больничную сеть DICOM

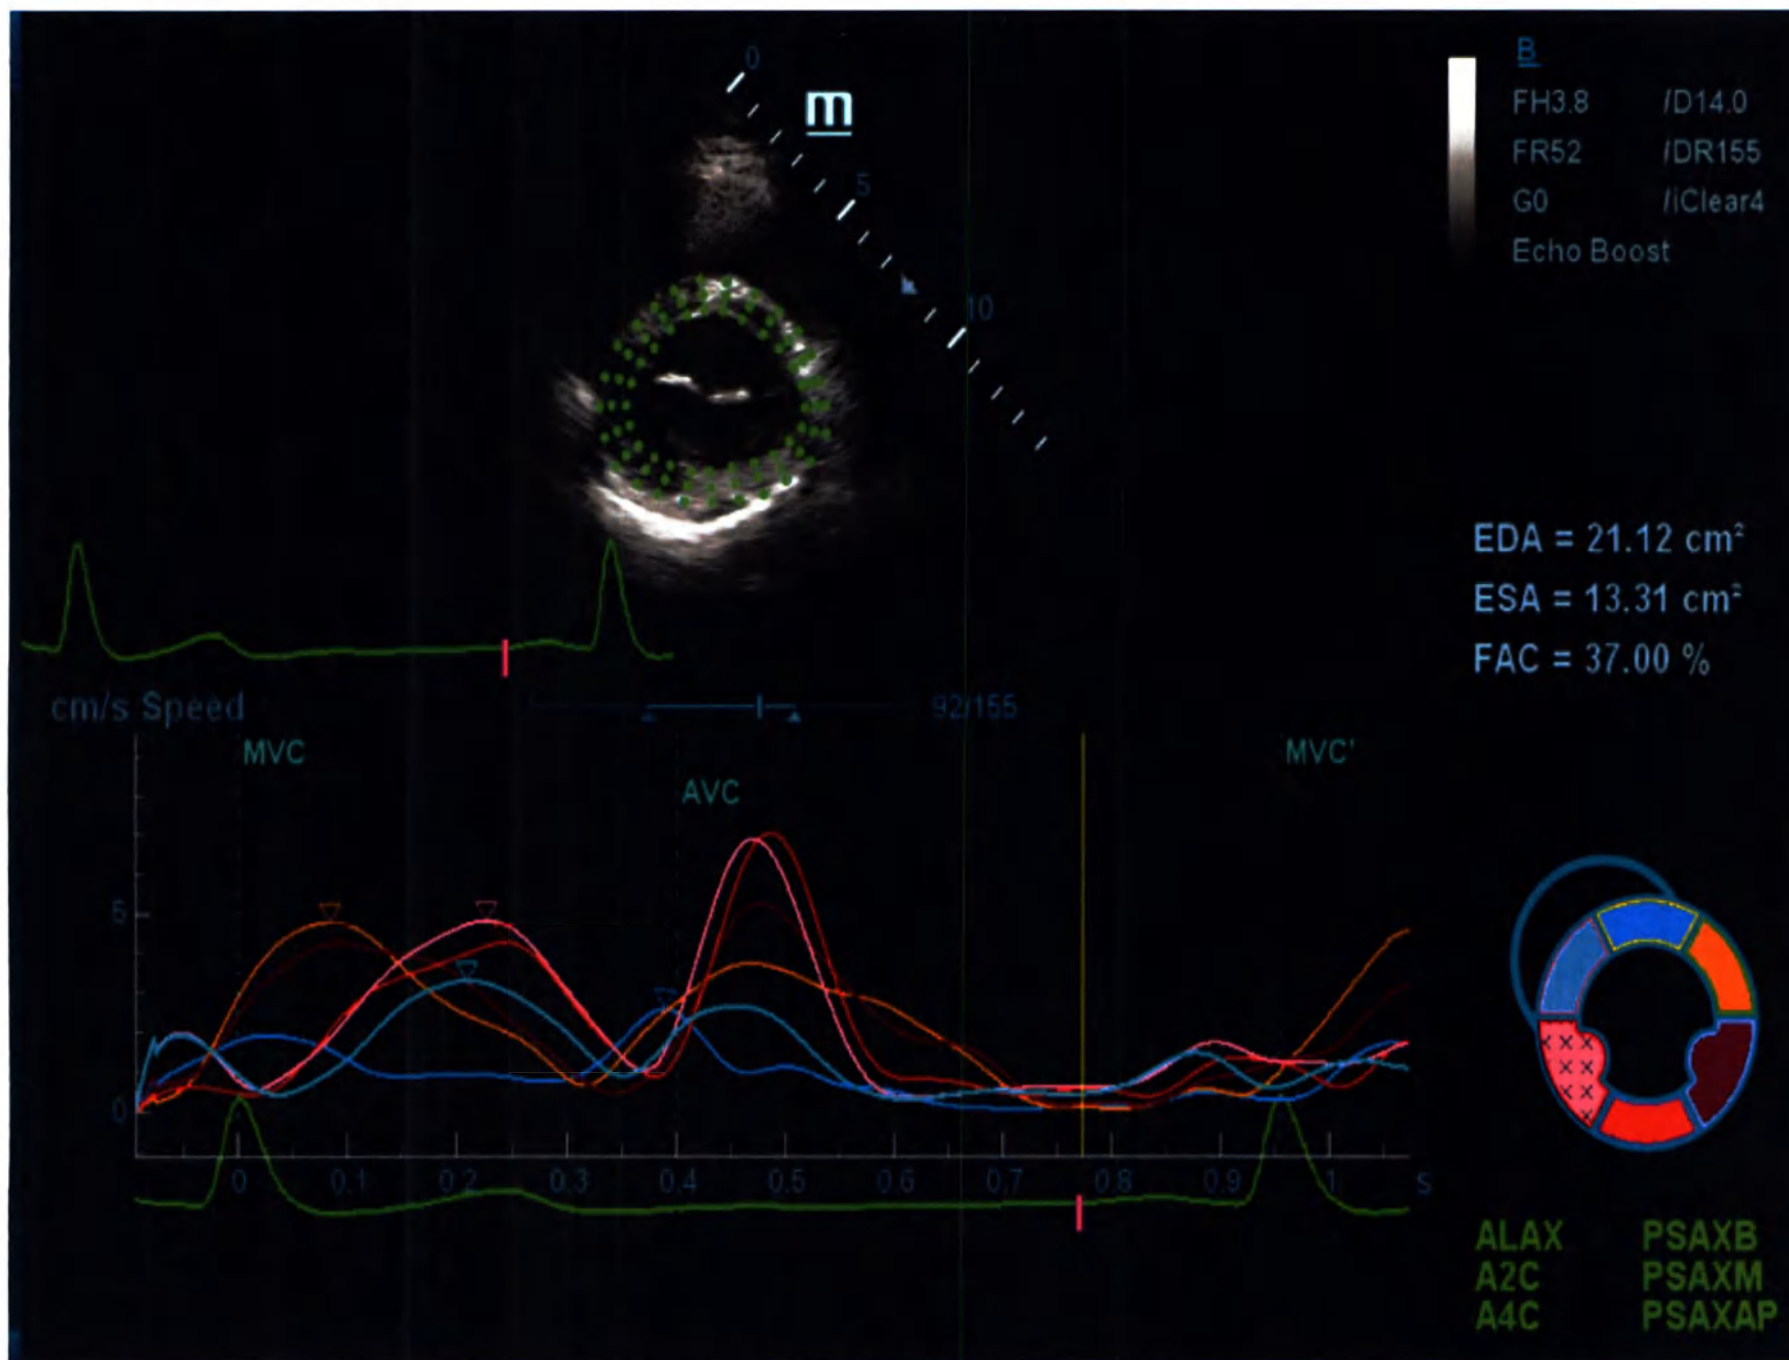

Программное обеспечение для неоплериовской количественной оценки движения и деформации миокарда (Tissue Tracking with Quantitative Analysis)

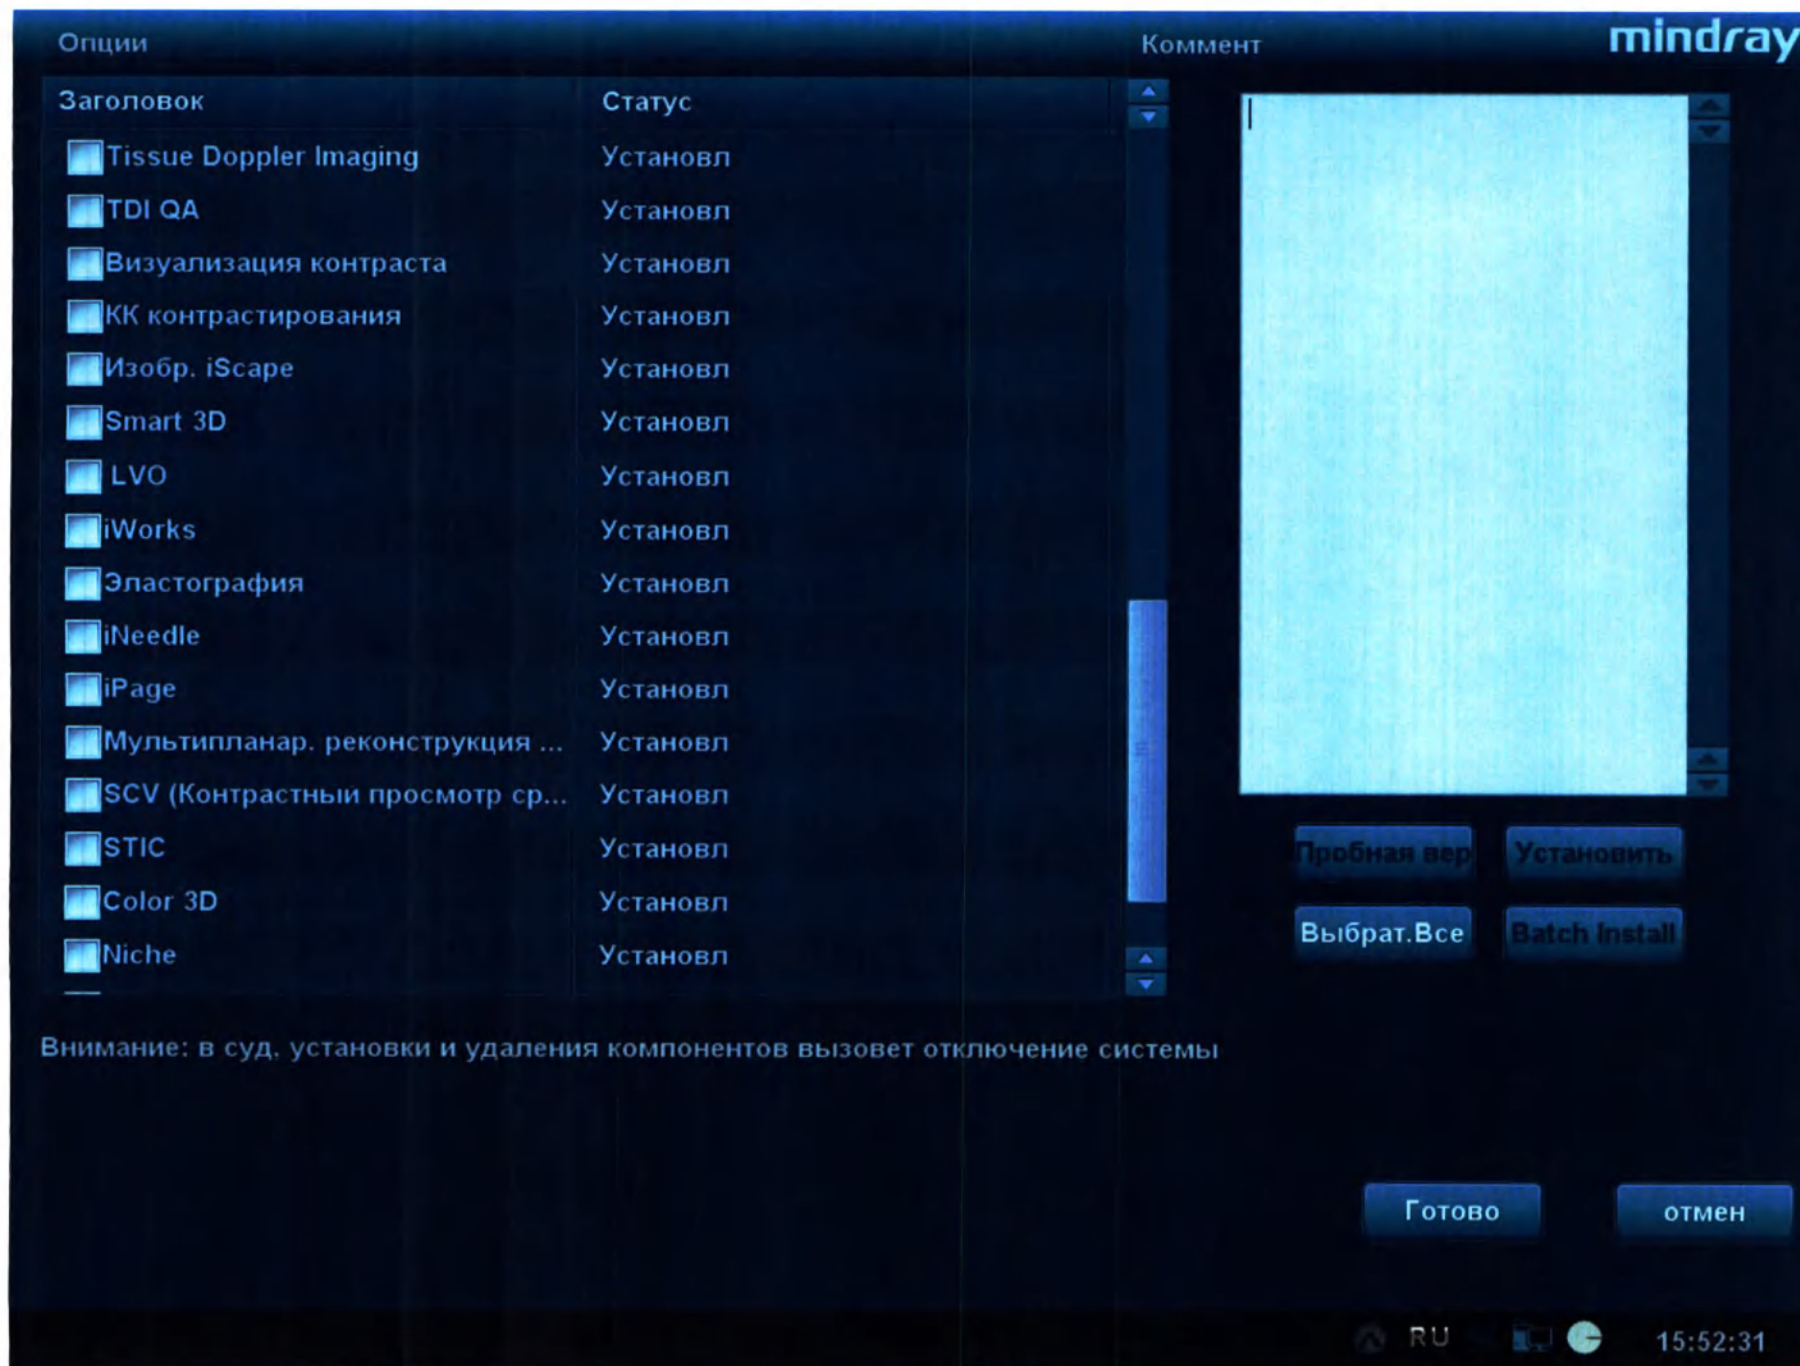

Программное обеспечение для исследований ЛЖ с контрастированием (LVO Contrast)

Информация о пациенте mindray

Общие сведения

Фамилия: ID пацие... **20160725-110819-8478** Другие ID: iStation

Имя: Пол: **Неизв** Дата рожд-я: **DD/MM/YYYY**

M.I.: Возраст: ☒ Лет ☐ Месяц ☐ Дней Быстр.регистр Р.список

Диагностика информации

Абдо Акуш Гин Кард Сосуд Урол МалО Пед-я ГРУДИ

Описание иссл-я: ЛечащийВрач:

Первичные показ-я: Диагностич:

Вторичные показ-я: Оператор:

Код СРТ4: Пополнение #:

Описание СРТ4: Комментарий:

Рост: cm Weight: kg

ППТ: лг

Нов.пациент Новое иссл-е ПриостИссл-е Отм иссл-е Готово Отмен

RU 11:19:52

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для абдоминальных исследований (Abdomen/General package)

mindray

Информация о пациенте

Общие сведения

Фамилия:
ID пацие...
20160725-110819-8478
Другие ID:
iStation

Имя:
Пол:
Неизв
Дата рожд-я:
DD/MM/YYYY

M.L.:
Возраст:
Пол:
Месяц
Дни
Быстр.регистр
Р.список

Диагностика информации

Абдом
Акуш
Гин
Кард
Сосуд
Урол
МалО
Пед-я
ГРУДИ

Описание иссл-я:
Первичные показ-я:
Вторичные показ-я:
Код CPT4:
Описание CPT4:
Рост:
cm
Weight:
kg
LMP
DD/MM/YYYY
ГестВозрас...
ДатаРодов(LMP):
Кол-воЗарод...
1
ЧислоБеремен...
Эктопич:
Кол-воРодов:
Кол-воАбортов:

ЛечащийВрач:
Диагностич:
Оператор:
Пополнение #:
Коммент:

Нов.пациент
Новое иссл-е
ПриостИссл-е
отм иссл-е
Готово
отмен
RU
11:19:58

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для акушерства (Obstetrics package)

Информация о пациенте
mindray

Общие сведения

Фамилия: ID пацие... **20160725-110819-8478**
Другие ID:
iStation

Имя: Пол: **Неизв**
Дата рожд-я: **DD/MM/YYYY**

M.L.: Возраст:

☒ Лет
 ☐ Месяц
 ☐ Дней

 Быстр.регистр

Диагностика информации

Абдо́м Акуш **Гин** Кард Сосуд Урол Мало Пед-я ГРУДИ

Описание иссл-я:

Первичные показ-я:

Вторичные показ-я:

Код СРТ4:

Описание СРТ4:

Рост: cm Weight: kg

ДПМ: **DD/MM/YYYY**

ЧислоБере... Кол-воРодов:

Эктопич: Кол-воАборт...

ЛечащийВрач:

Диагностич:

Оператор:

Пополнение #:

Коммент:

RU 11:20:05

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для гинекологии (Gynecology package)

Информация о пациенте

mindray

Общие сведения

Фамилия: ID пацие... **20160725-110819-8478**
 Имя: Пол: **Неизв**
 M.I.: Возраст:

Другие ID: iStation
 Дата рожд-я: **DD/MM/YYYY**
☒ Лет ☐ Месяц ☐ Дней Быстр.регистр Р.список

Диагностика информации

Абдом Акуш Гин Кард Сосуд **Урол** МалО Пед-я ГРУДИ

Описание исп-я:
 Первичные показ-я:
 Вторичные показ-я:
 Код CPT4:
 Описание CPT4:
 Рост: cm Weight: kg
 СыворотPSA: ng/ml
 КозффPPSA: **0.12** ng/ml²

ЛечащийВрач:
 Диагностич:
 Оператор:
 Пополнение #:
 Комментарий:

Нов.пациент

Новое иссле-е

ПриостИssl-е

отм иссле-е

Готово

отмен

RU 11:20/24

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для урологии (Urology package)

Информация о пациенте

Общие сведения

Фамилия: ID пацие... **20160725-110819-8478**

Имя: Пол: **Неизв**

M.I.: Возраст:

☒ Лет ☐ Месяц ☐ Дней

iStation

Диагностика информации

Описание иссл-я:

Первичные показ-я:

Вторичные показ-я:

Код СРТ4:

Описание СРТ4:

Рост: cm

Weight: kg

ЛечащийВрач:

Диагностич:

Оператор:

Пополнение #:

Коммент:

11.20.16

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для педиатрии (Pediatric package)

Информация о пациенте

mlndray

Общие сведения

Фамилия:

ID пацие...

20160725-110819-8478

Другие ID:

iStation

Имя:

Пол:

Неизв

Дата рожд-я:

DD/MM/YYYY

M.I.:

Возраст:

☒ Лет

☐ Месяц

☐ Дни

Быстр.регистр

Р.список

Диагностика информации

Абдом

Акуш

Гин

Кард

Сосуд

Урол

МалО

Пед-я

ГРУДИ

Описание иссл-я:

ЛечащийВрач:

Первичные показ-я:

Диагностич:

Вторичные показ-я:

Оператор:

Код CPT4:

Пополнение #:

Описание CPT4:

Коммент:

Рост:

cm

Weight:

kg

ппт:

mmHg

ЧСС:

ВртДавлПрПр...

mmHg

АД:

mmHg

Нов.пациент

Новое иссл-е

ПриостИссл-е

отм иссл-е

Готово

отмен

RU

11:20:12

mindray

Информация о пациенте

Общие сведения

Фамилия:
ID пацие...
20160725-110819-8478
Другие ID:
iStation

Имя:
Пол:
Неизв
Дата рожд-я:
DD/MM/YYYY

M.L.:
Возраст:
Лет
Месяц
Дней
Быстр.регистр
Р.список

Диагностика информации

Абдом
Акуш
Гин
Кард
Сосуд
Урол
МалО
Пед-я
ГРУДИ

Описание иссл-я:

Первичные показ-я:

Вторичные показ-я:

Код CPT4:

Описание CPT4:

Рост: cm

Weight: kg

Давление(П): mmHg

Давление(Л): mmHg

ПечатацияВрач:

Диагностич:

Оператор:

Пополнение #:

Коммент:

Нов.пациент

Новое иссл-е

ПриостИссл-е

отм иссл-е

Готово

отмен

11.20.17

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для ангиологии (Vascular package)

mindray

Информация о пациенте

Общие сведения

Фамилия: ID пацие... **20160725-110819-8478** Другие ID: iStation

Имя: Пол: **Неизв** Дата рожд-я: **DD/MM/YYYY**

M.I.: Возраст: ☒ Лет ☐ Месяц ☐ Дней Быстр.регистр Р.список

Диагностика информации

Абдом Акуш Гин Кард Сосуд Урол **МалО** Пед-я ГРУДИ

Описание иссл-я: ЛечащийВрач:

Первичные показ-я: Диагностич:

Вторичные показ-я: Оператор:

Код CPT4: Пополнение #:

Описание CPT4: Комментарий:

Рост: cm

Weight: kg

Нов.пациент Новое иссл-е ПриостИссл-е отм иссл-е Готово отмен

11:28:30

Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для исследования малых органов (Small Parts package)



Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для ургентной медицины (Emergency/Critical package)



Пакет диагностических программ, измерений и вычислений для регионарной анестезии (Nerve package)




Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-004




Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-005



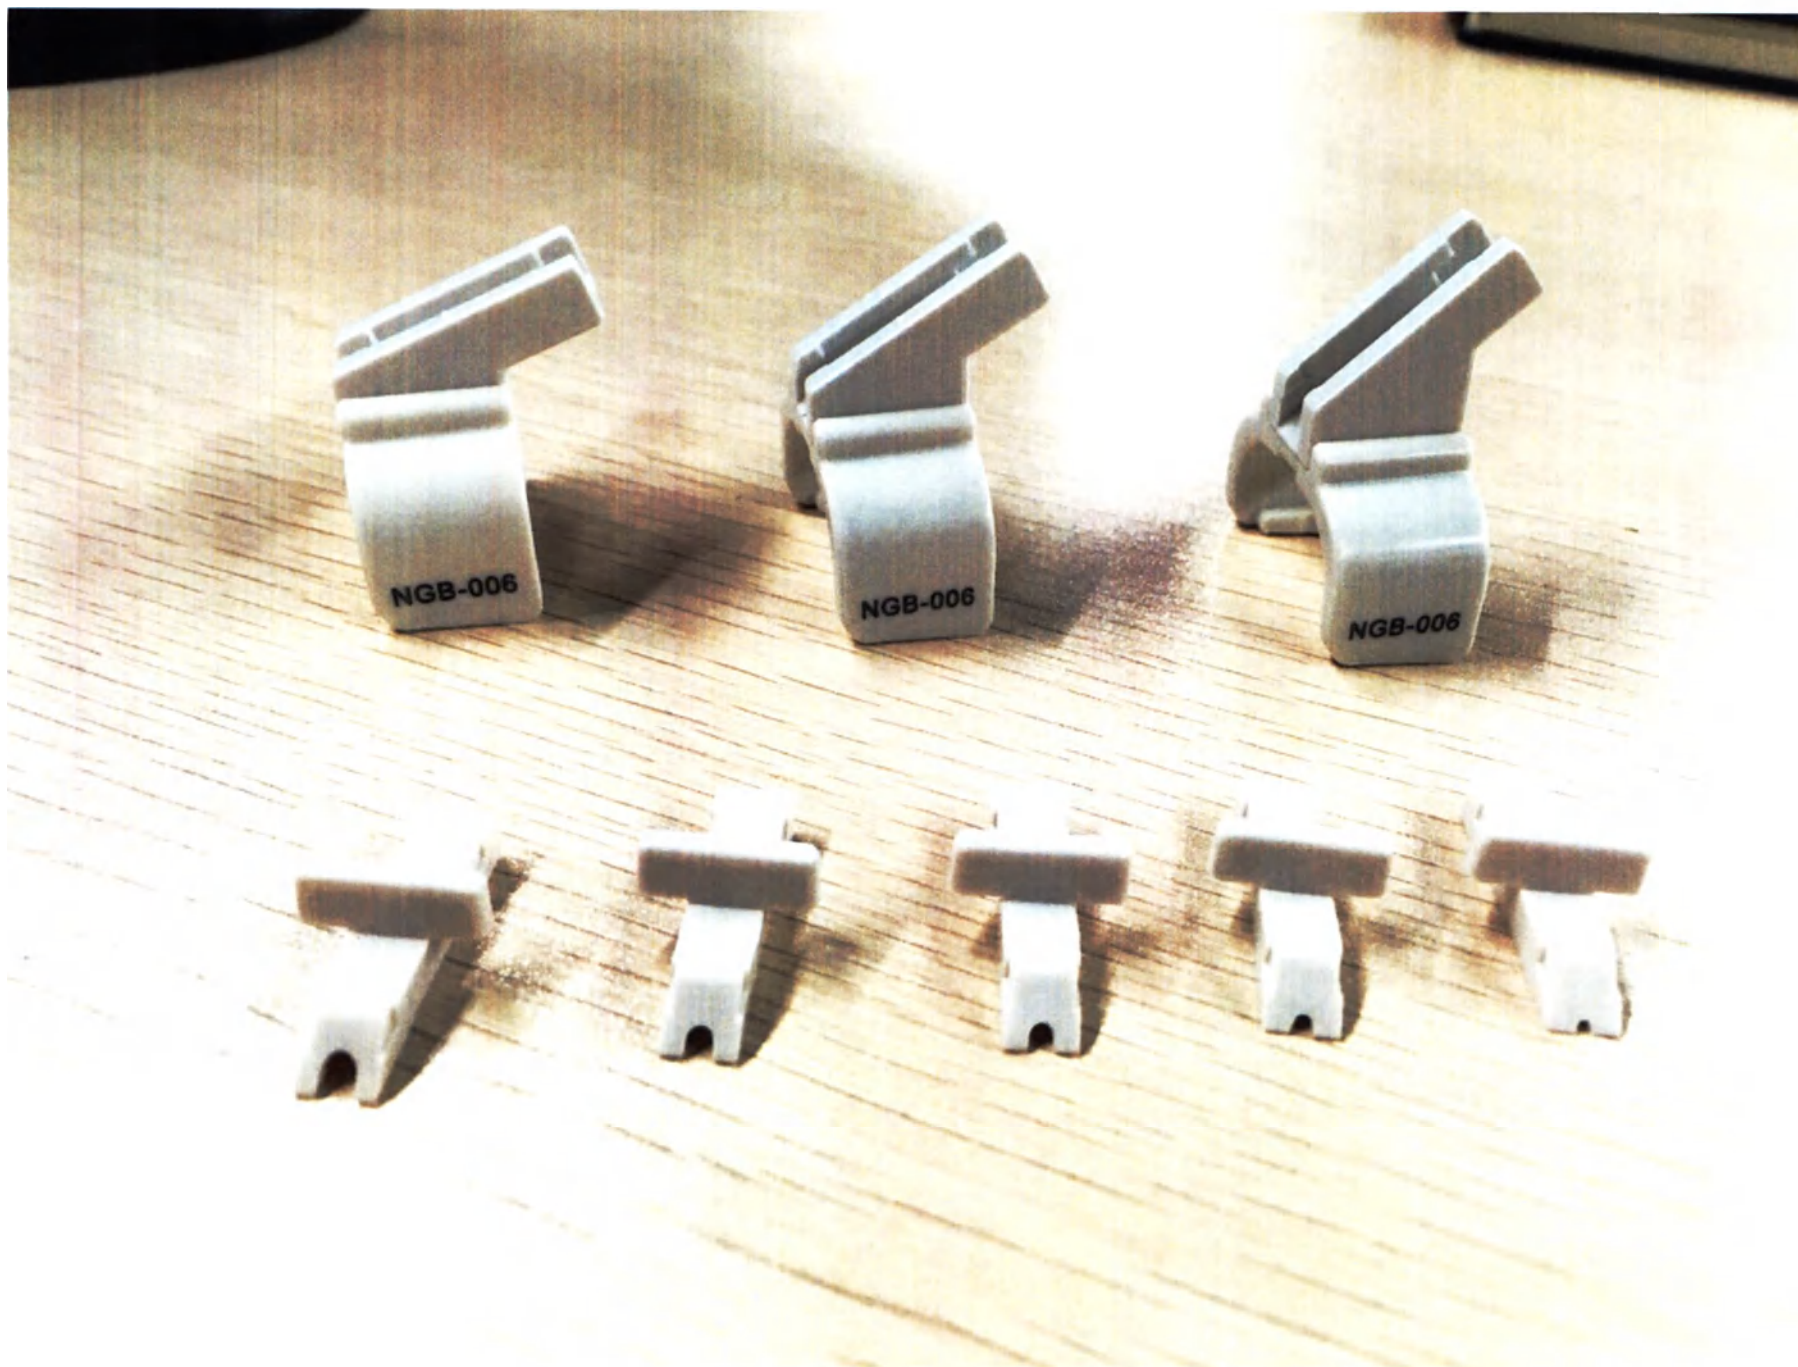



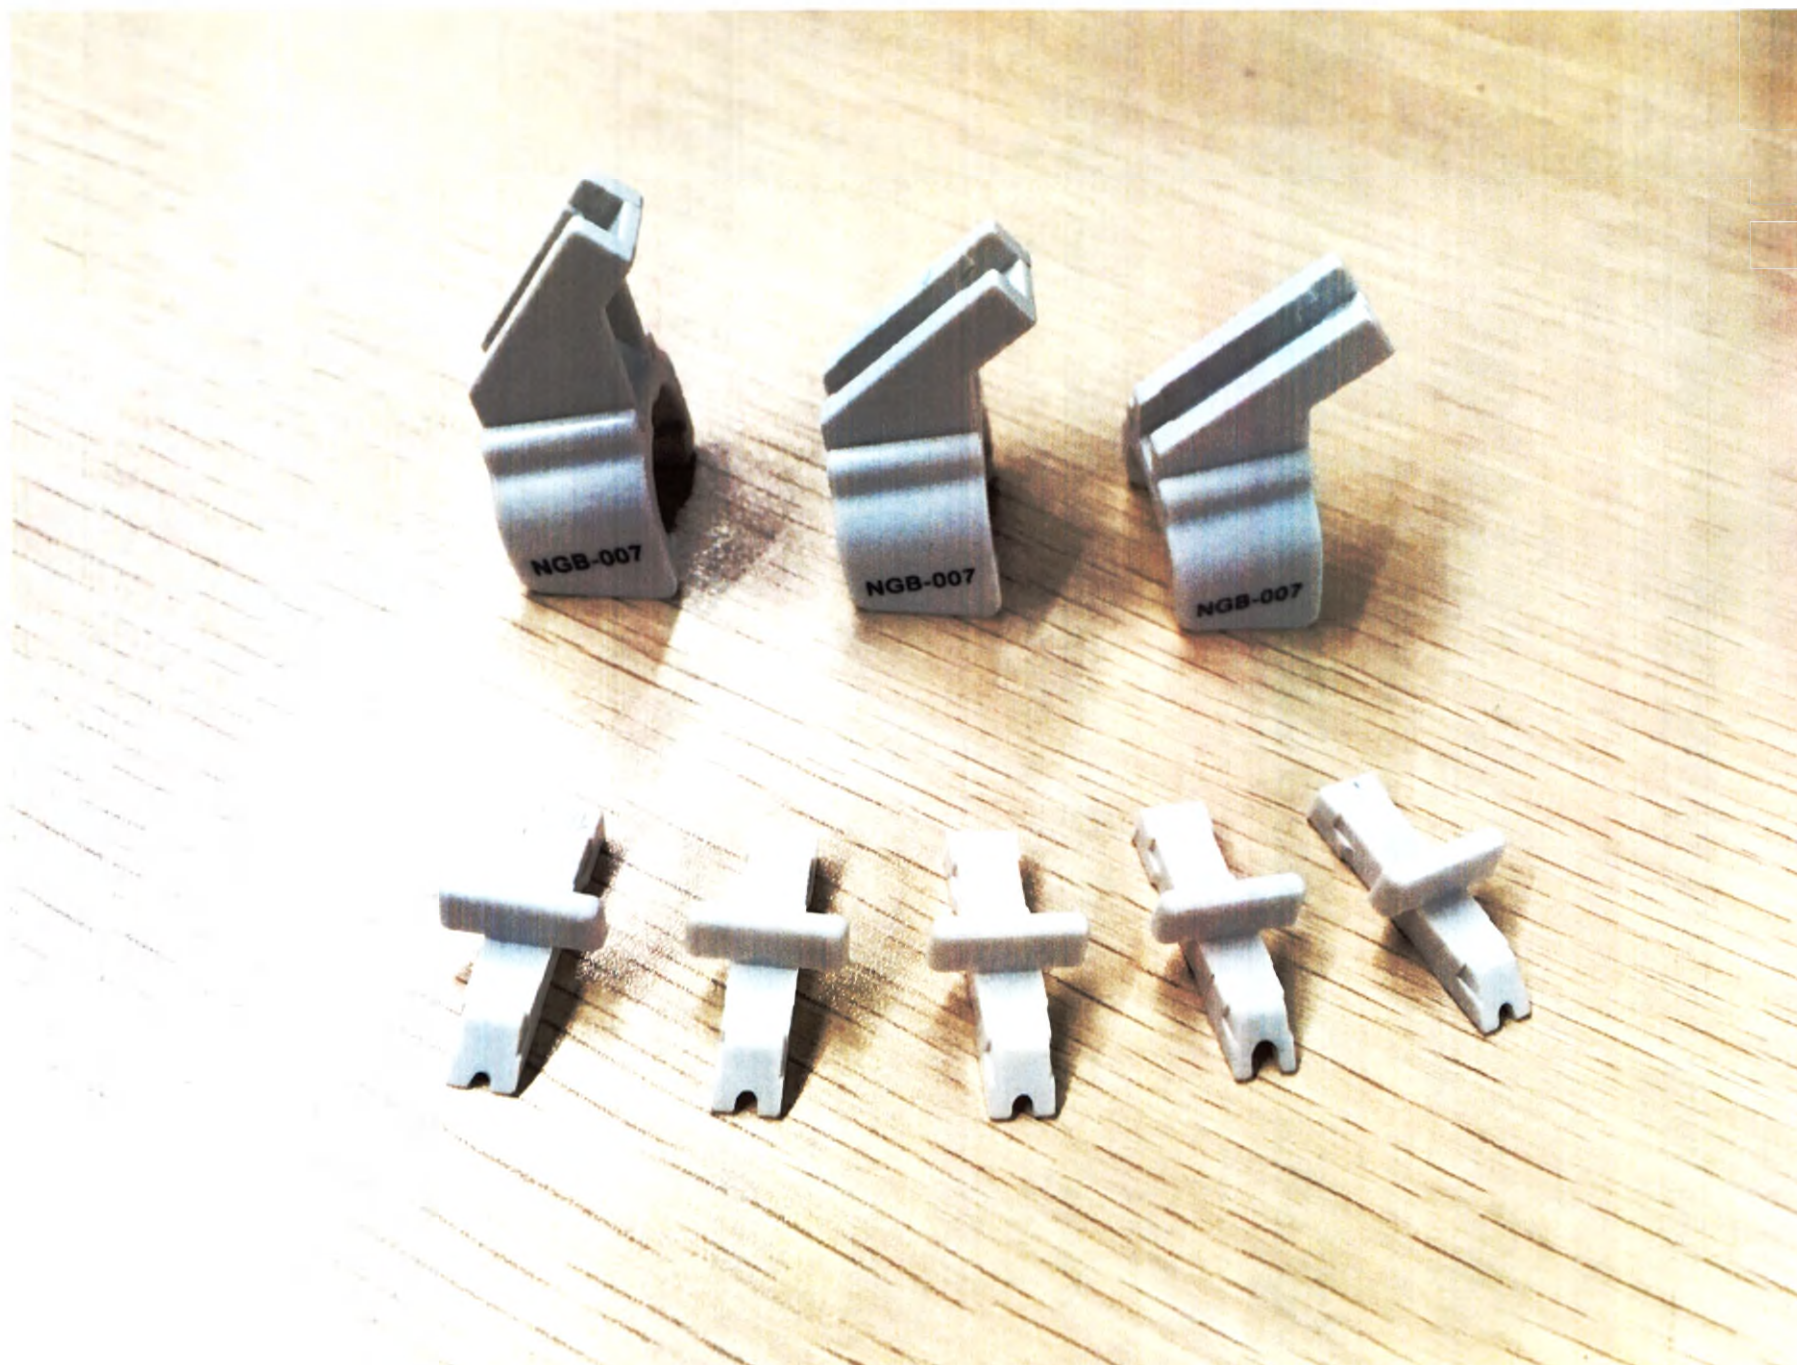



Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-011




Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-027



Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-021




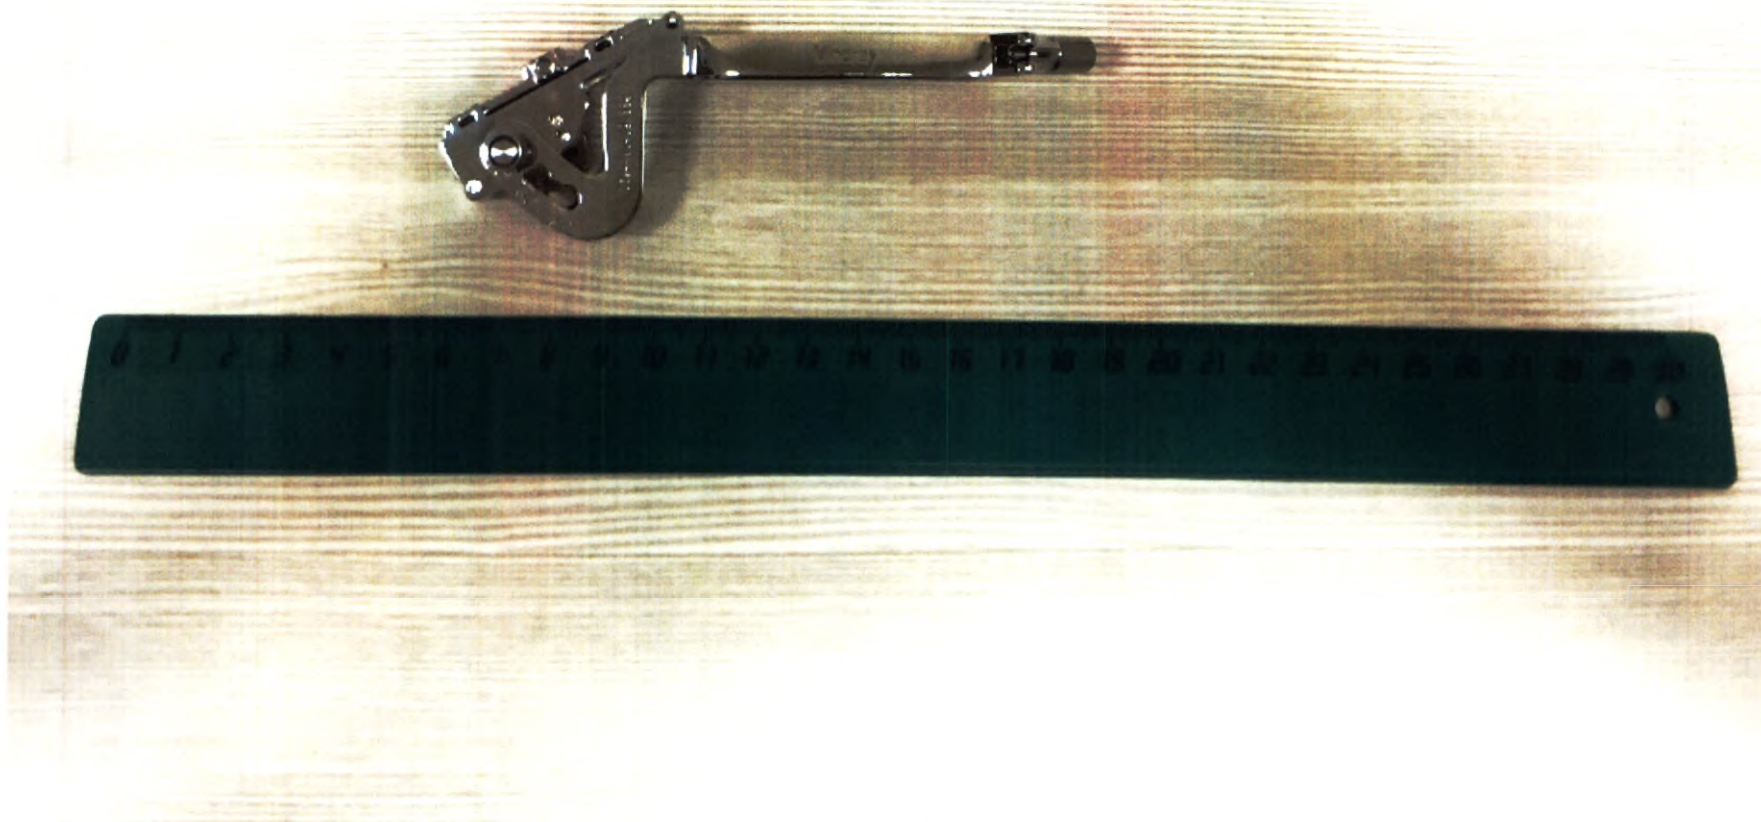

Биопсийная насадка (Needle guided bracket), тип: NGB-034





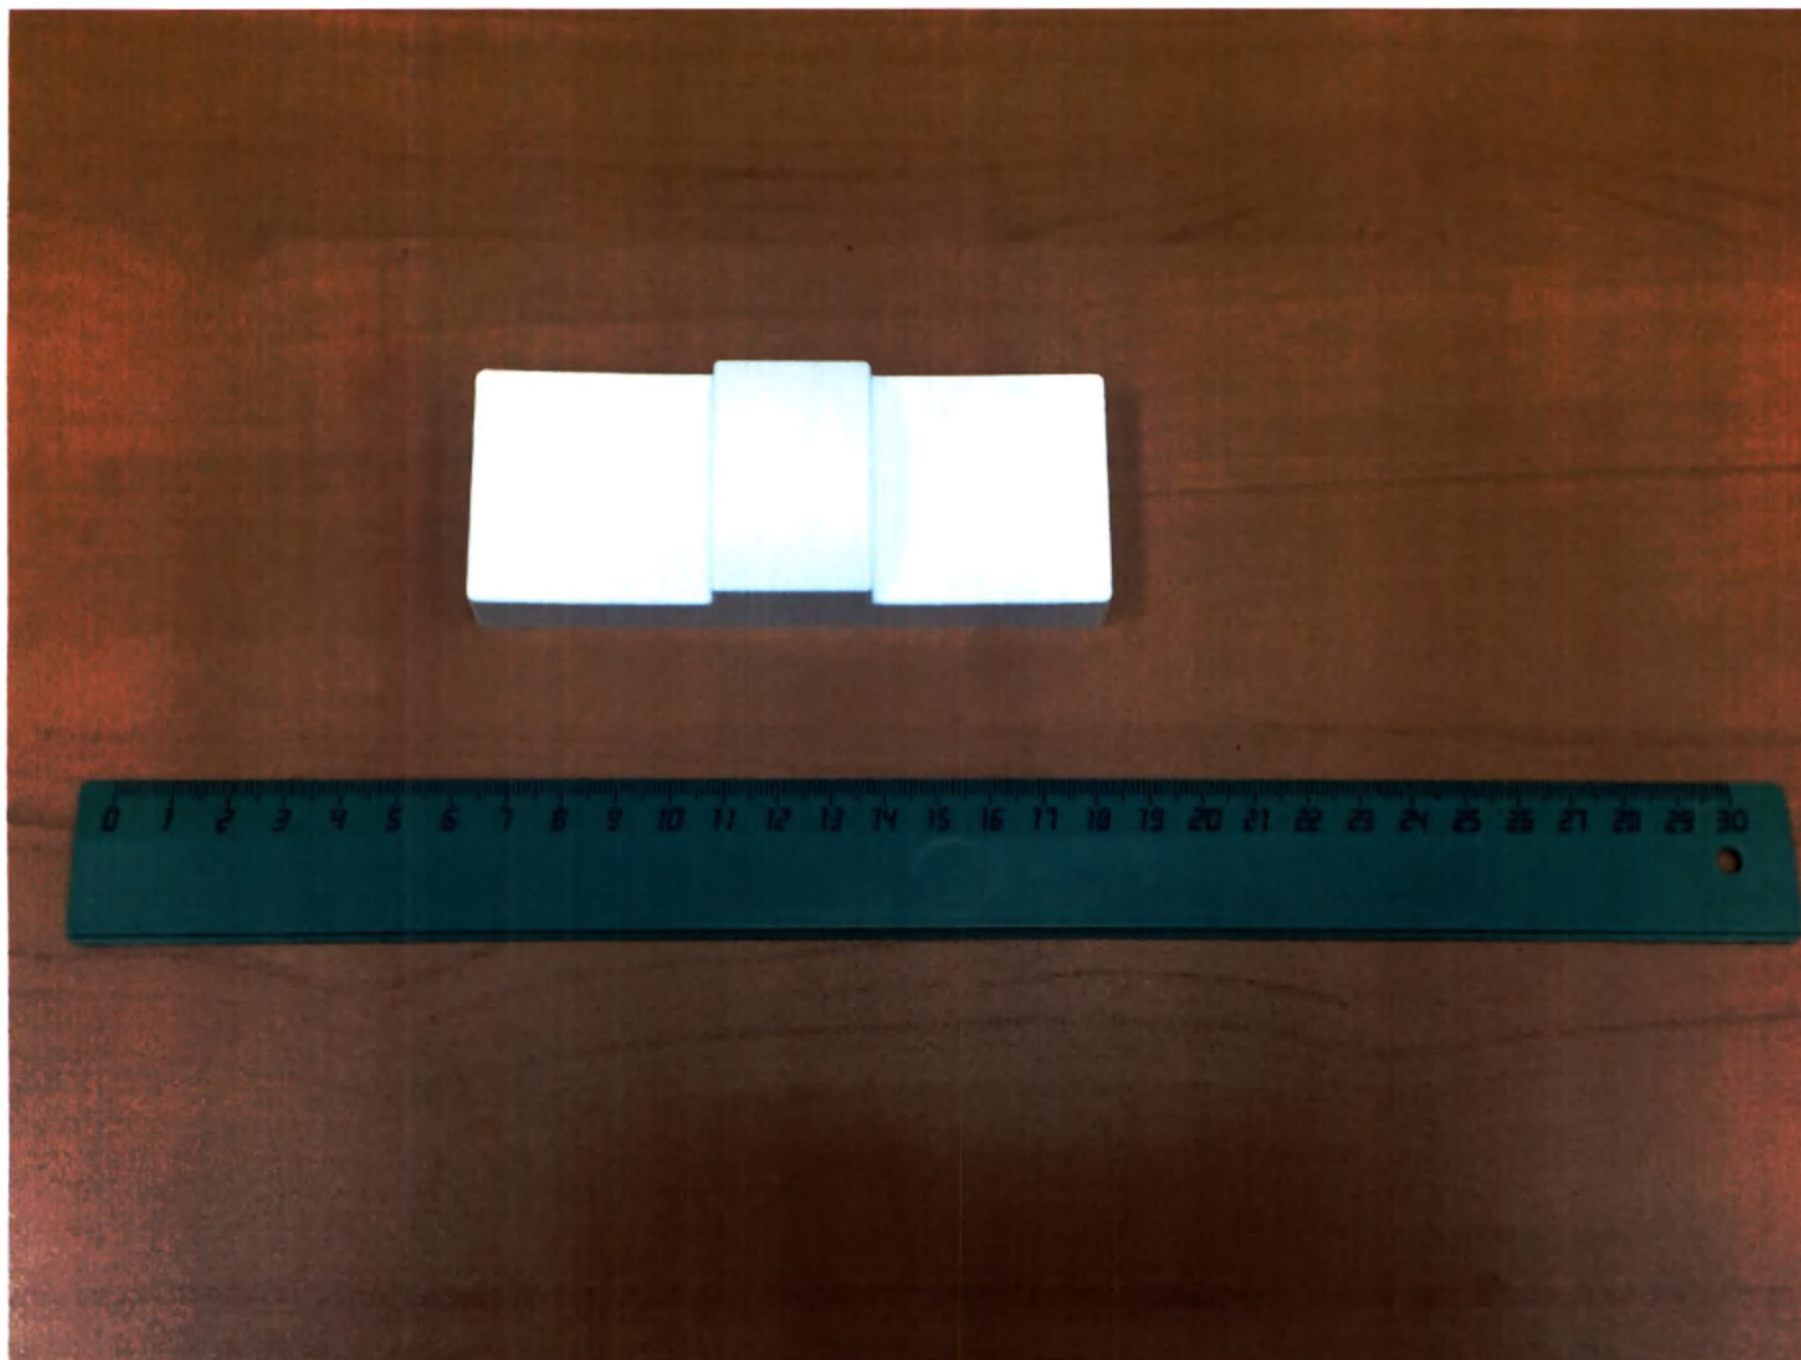


Крышка выходного отверстия датчика 2120 (2120 probe outlet cover)



Левый держатель датчика (Left probe holder)




Правый держатель датчика (Right probe holder)

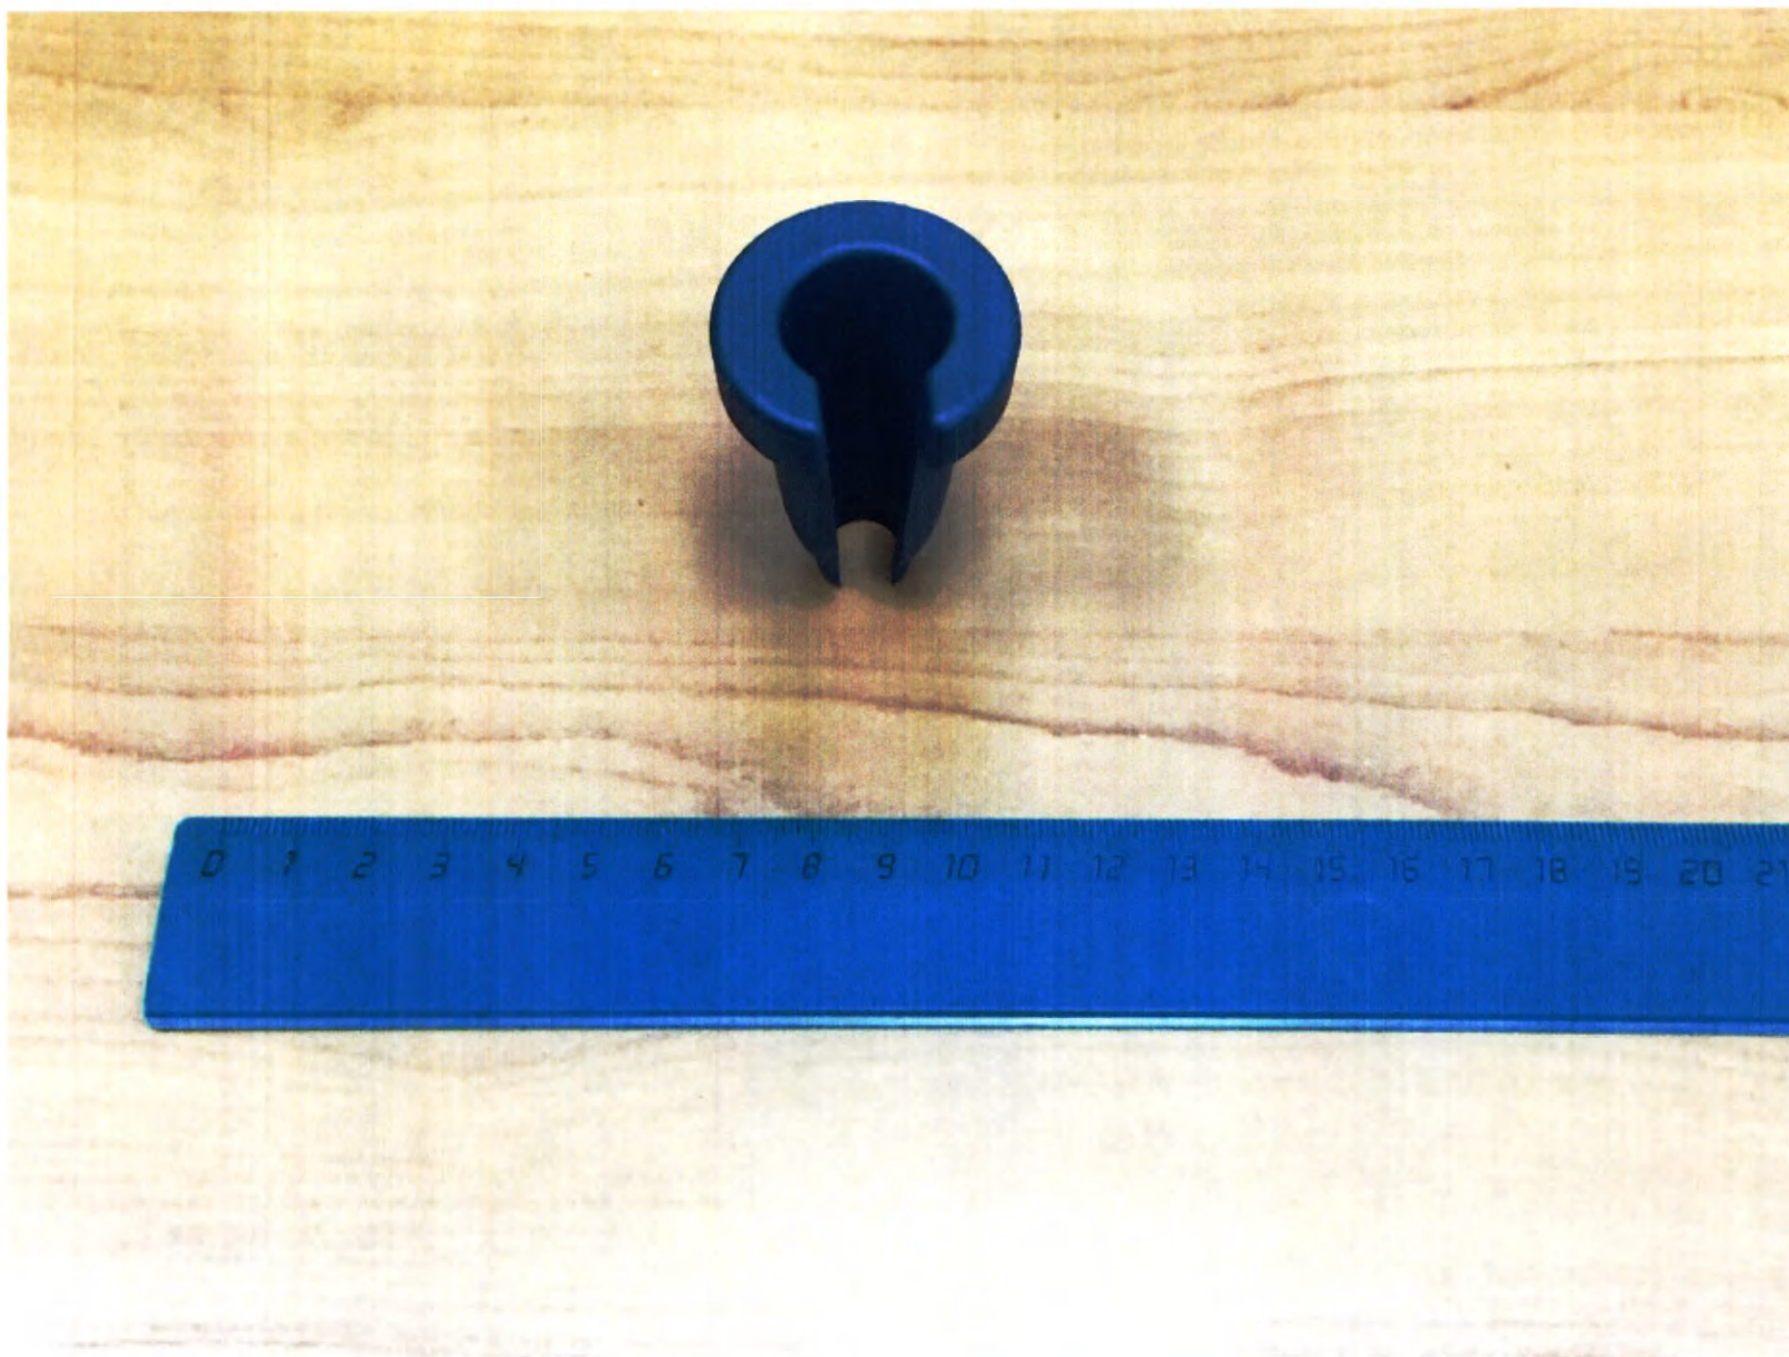


Держатель карандашного датчика (Pencil probe holder)




Большой держатель датчика (Big transducer holder)

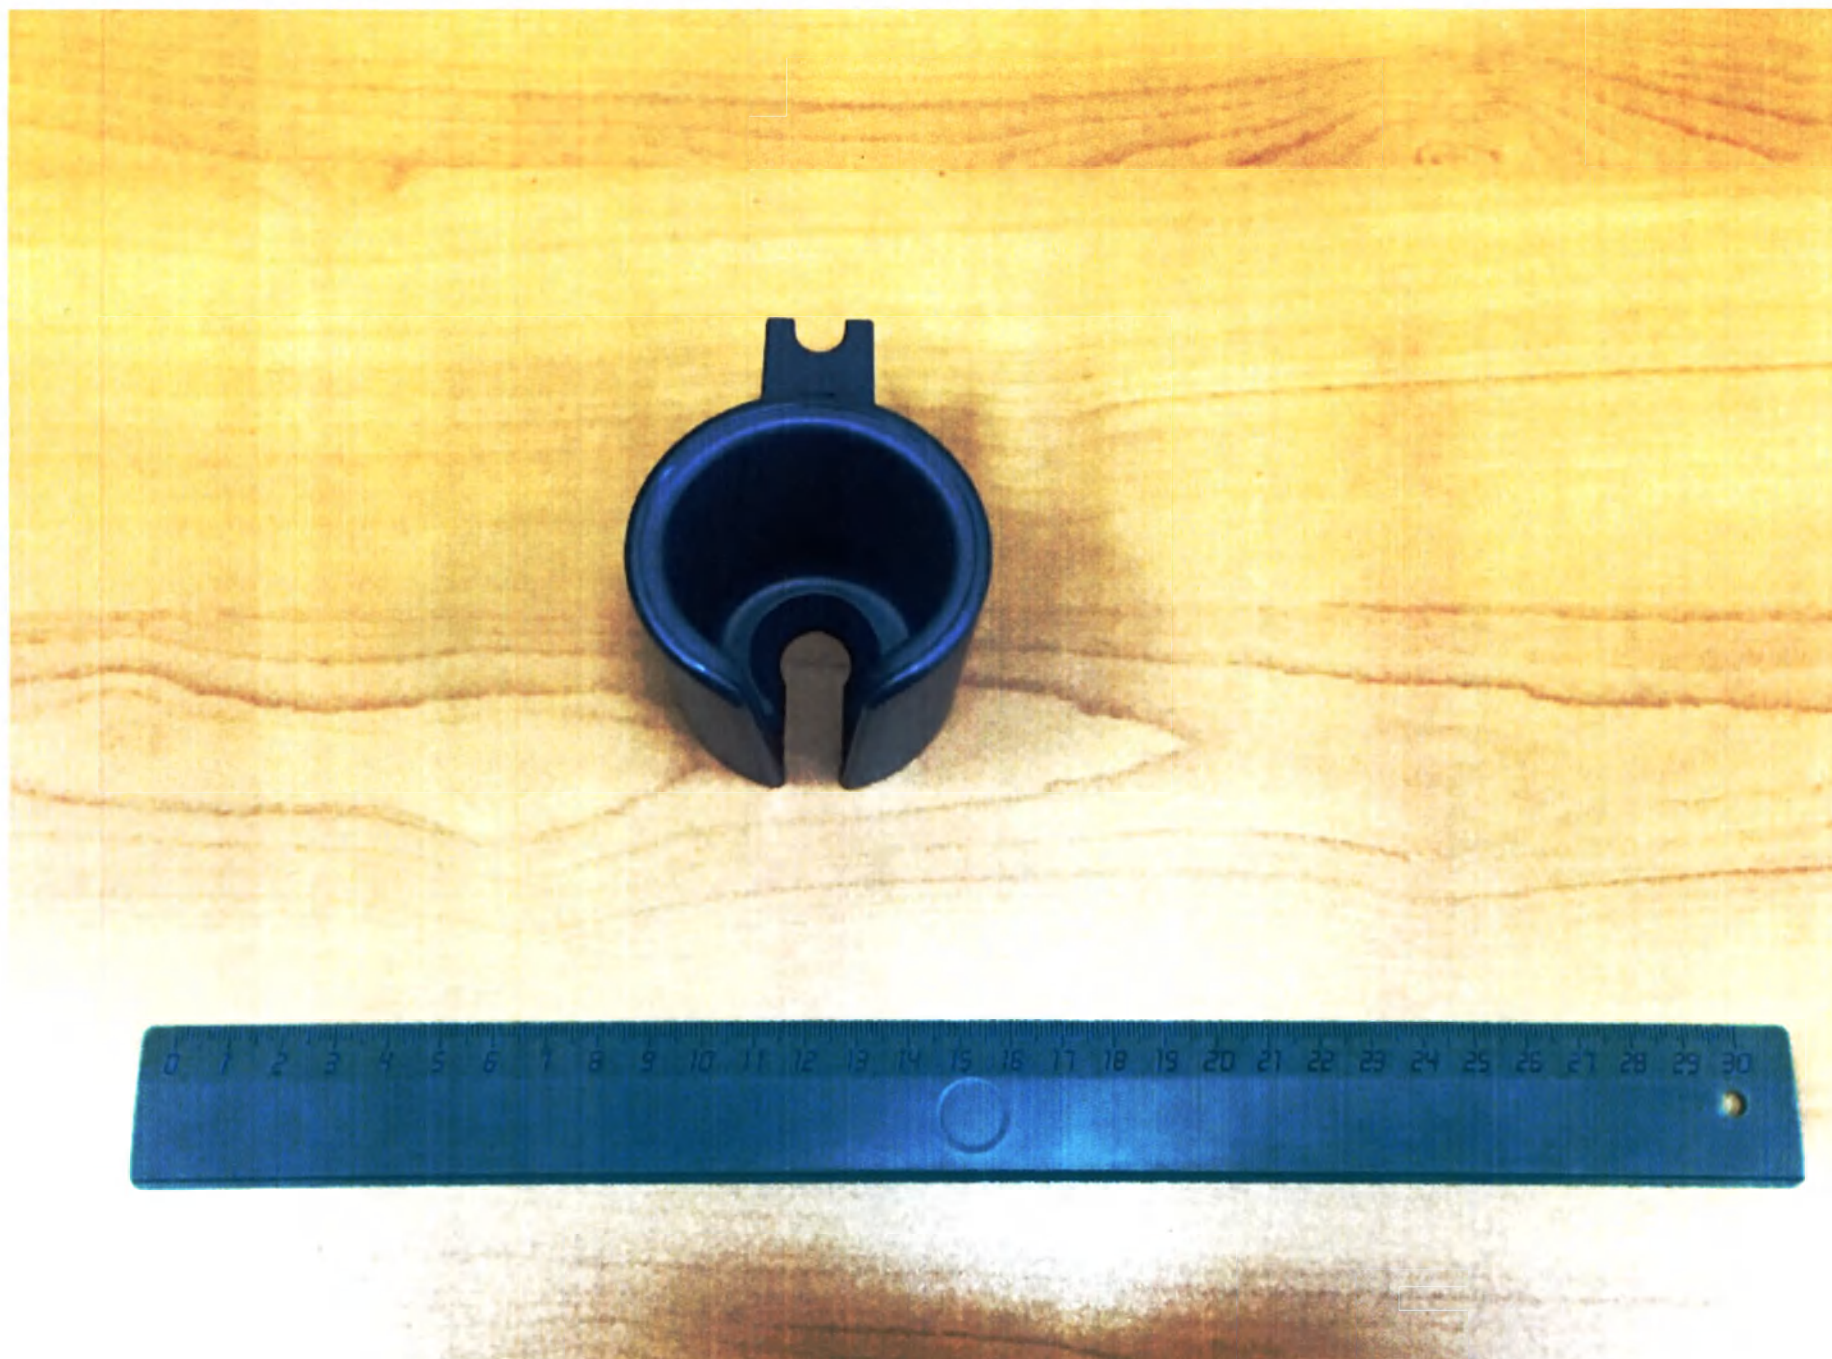

Малый держатель датчика (Small transducer holder)

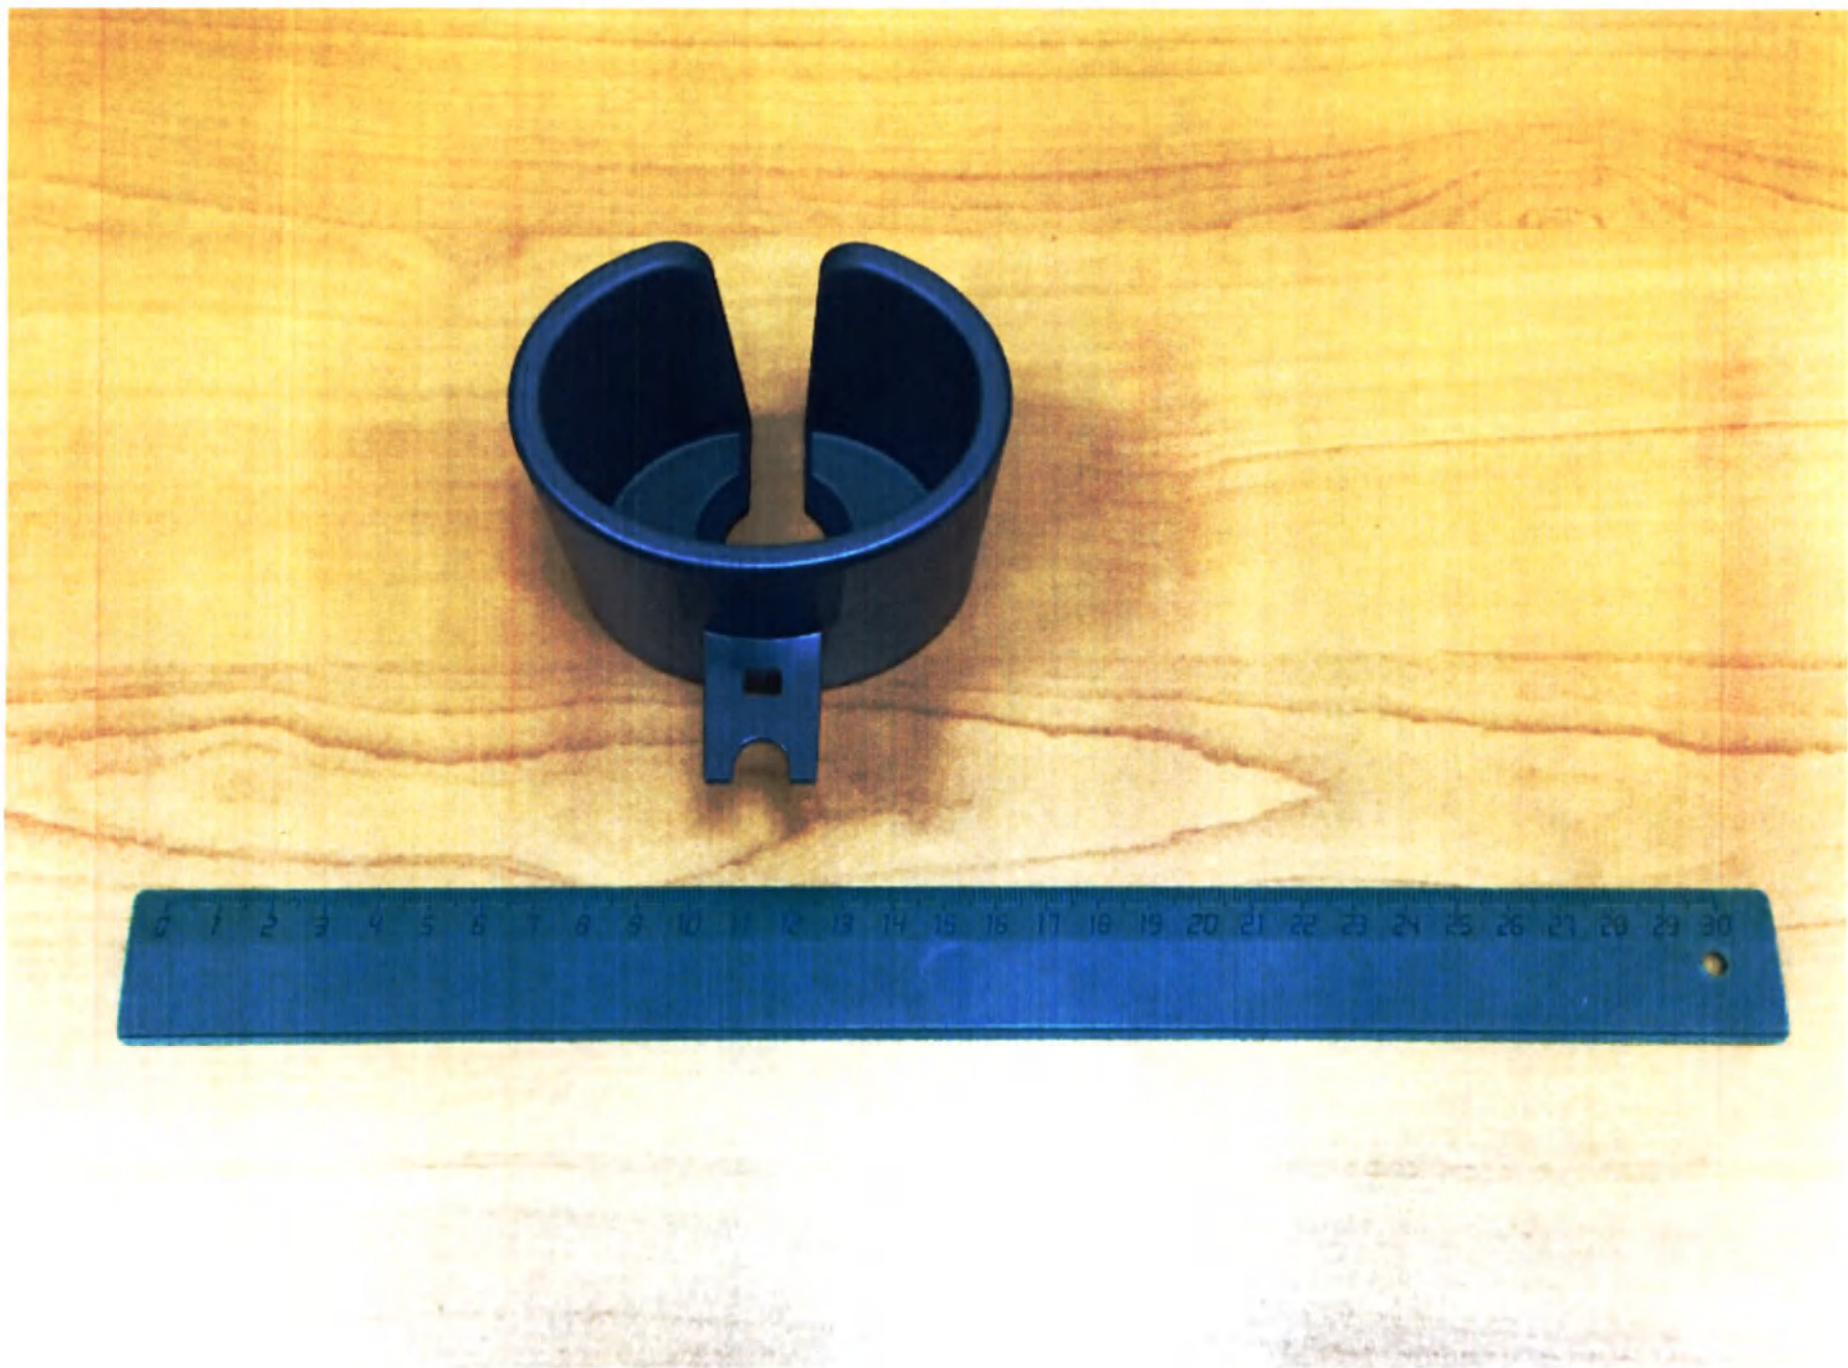


Держатель объемного датчика (4D transducer holder)

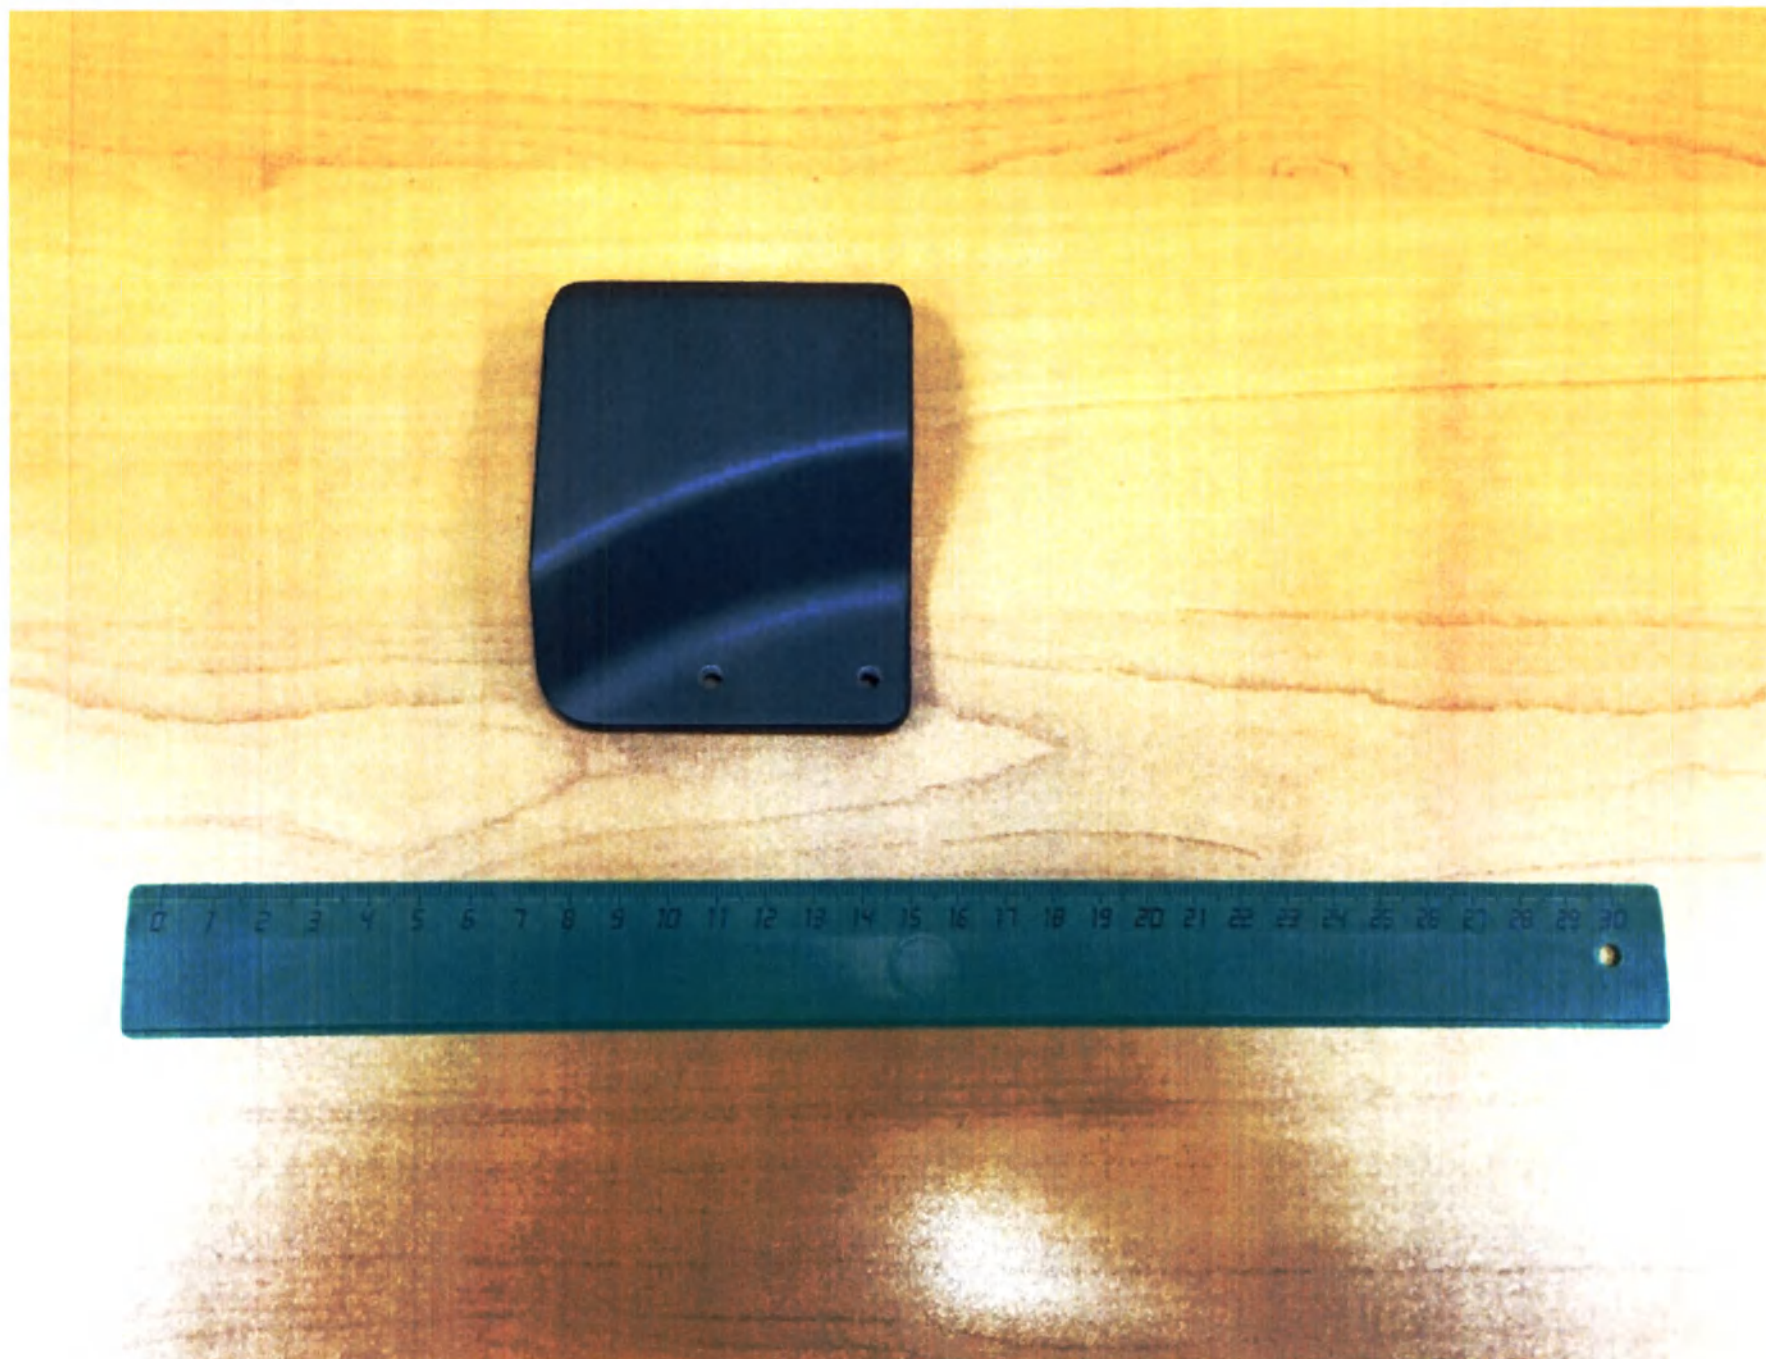

Соединение для левого держателя датчика (Left conneting for probe holder)



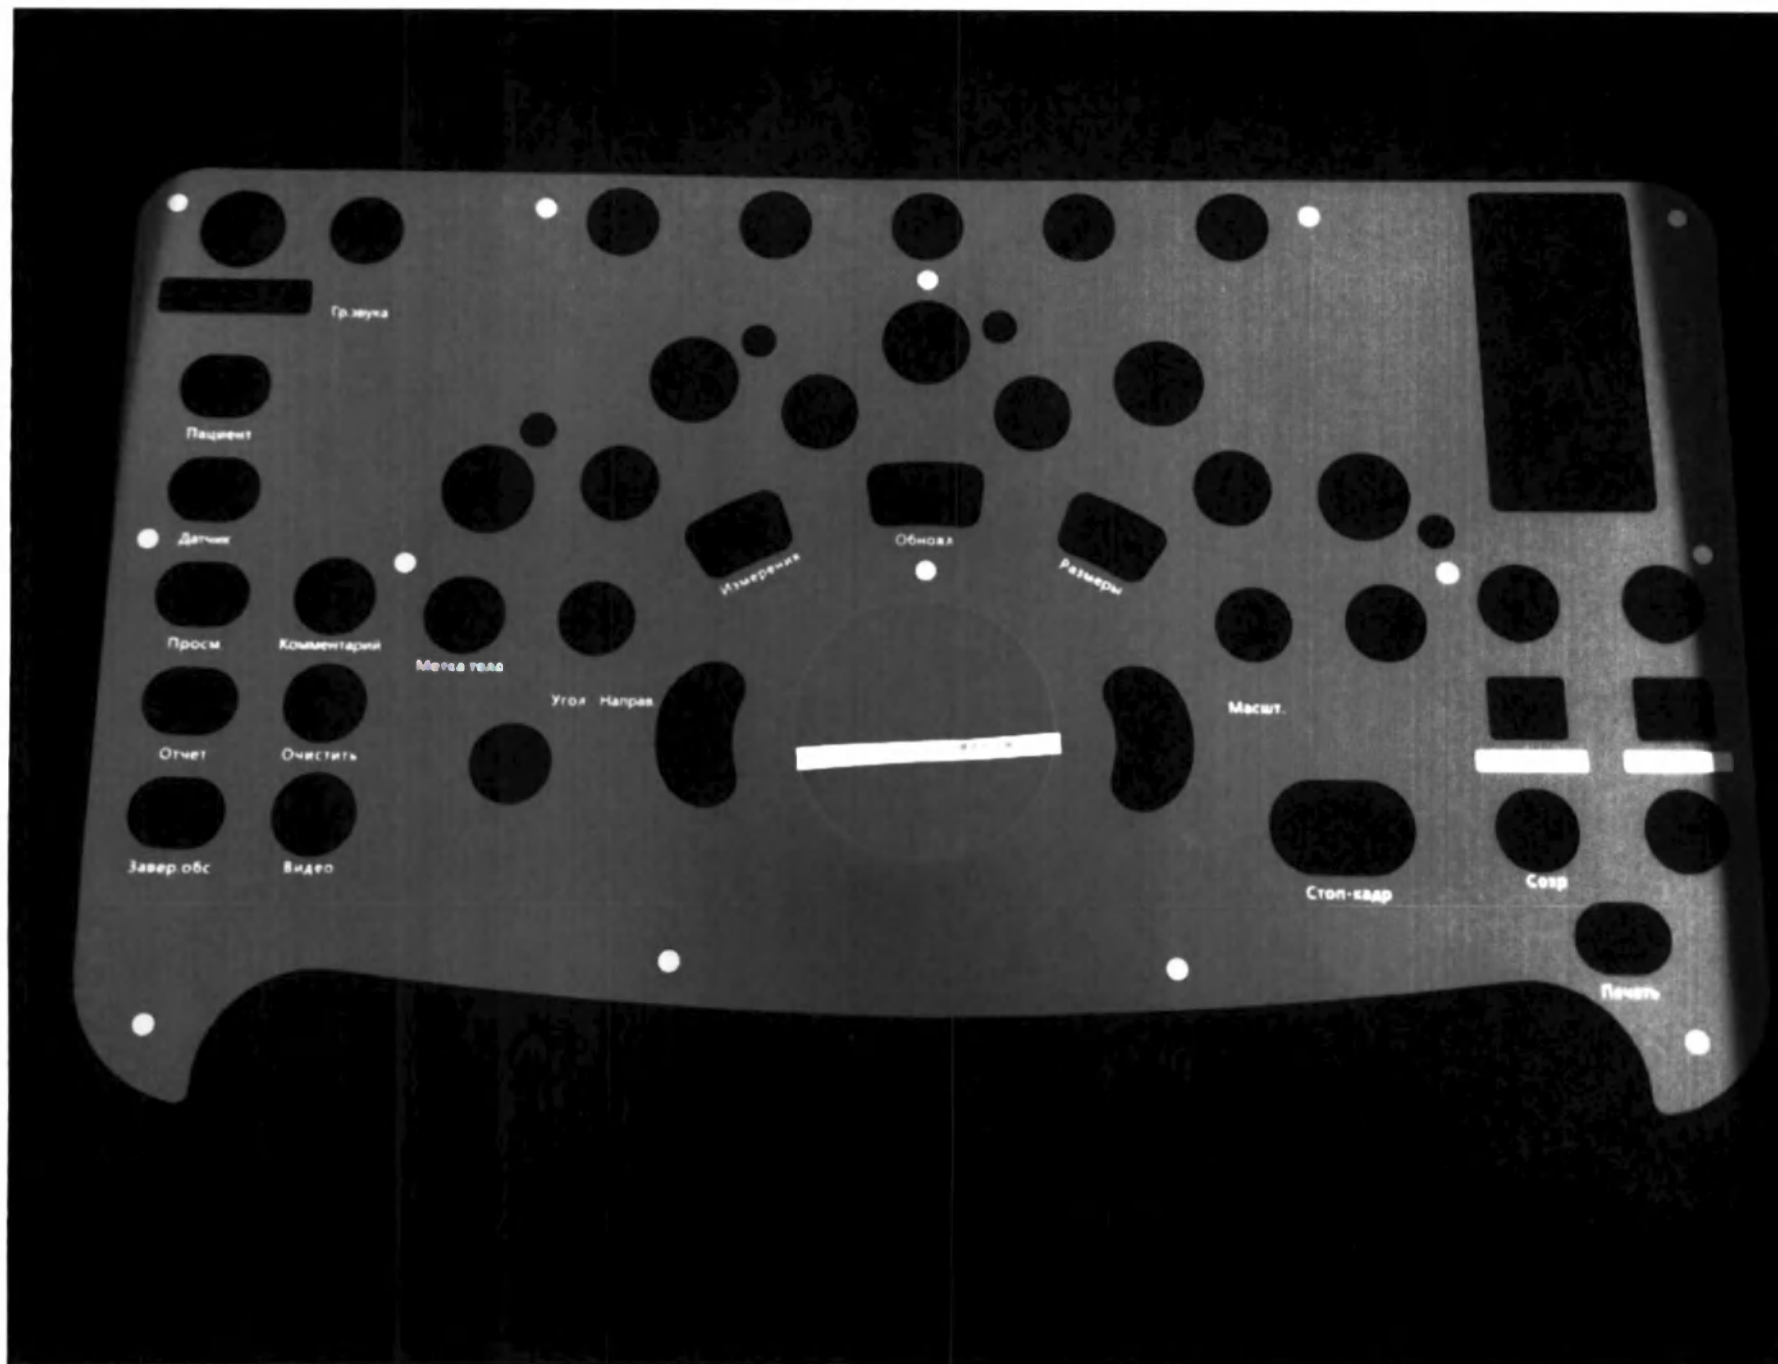

Наклейка на панель русскоязычная (Russian overlay)



Кабель заземления (Grounding cable)




Пылезащитный чехол для основного блока (Dustproof Cover for Main Unit)



Встроенный подогреватель геля (Gel Warmer)



Встроенная батарея iPower (Built-in battery)

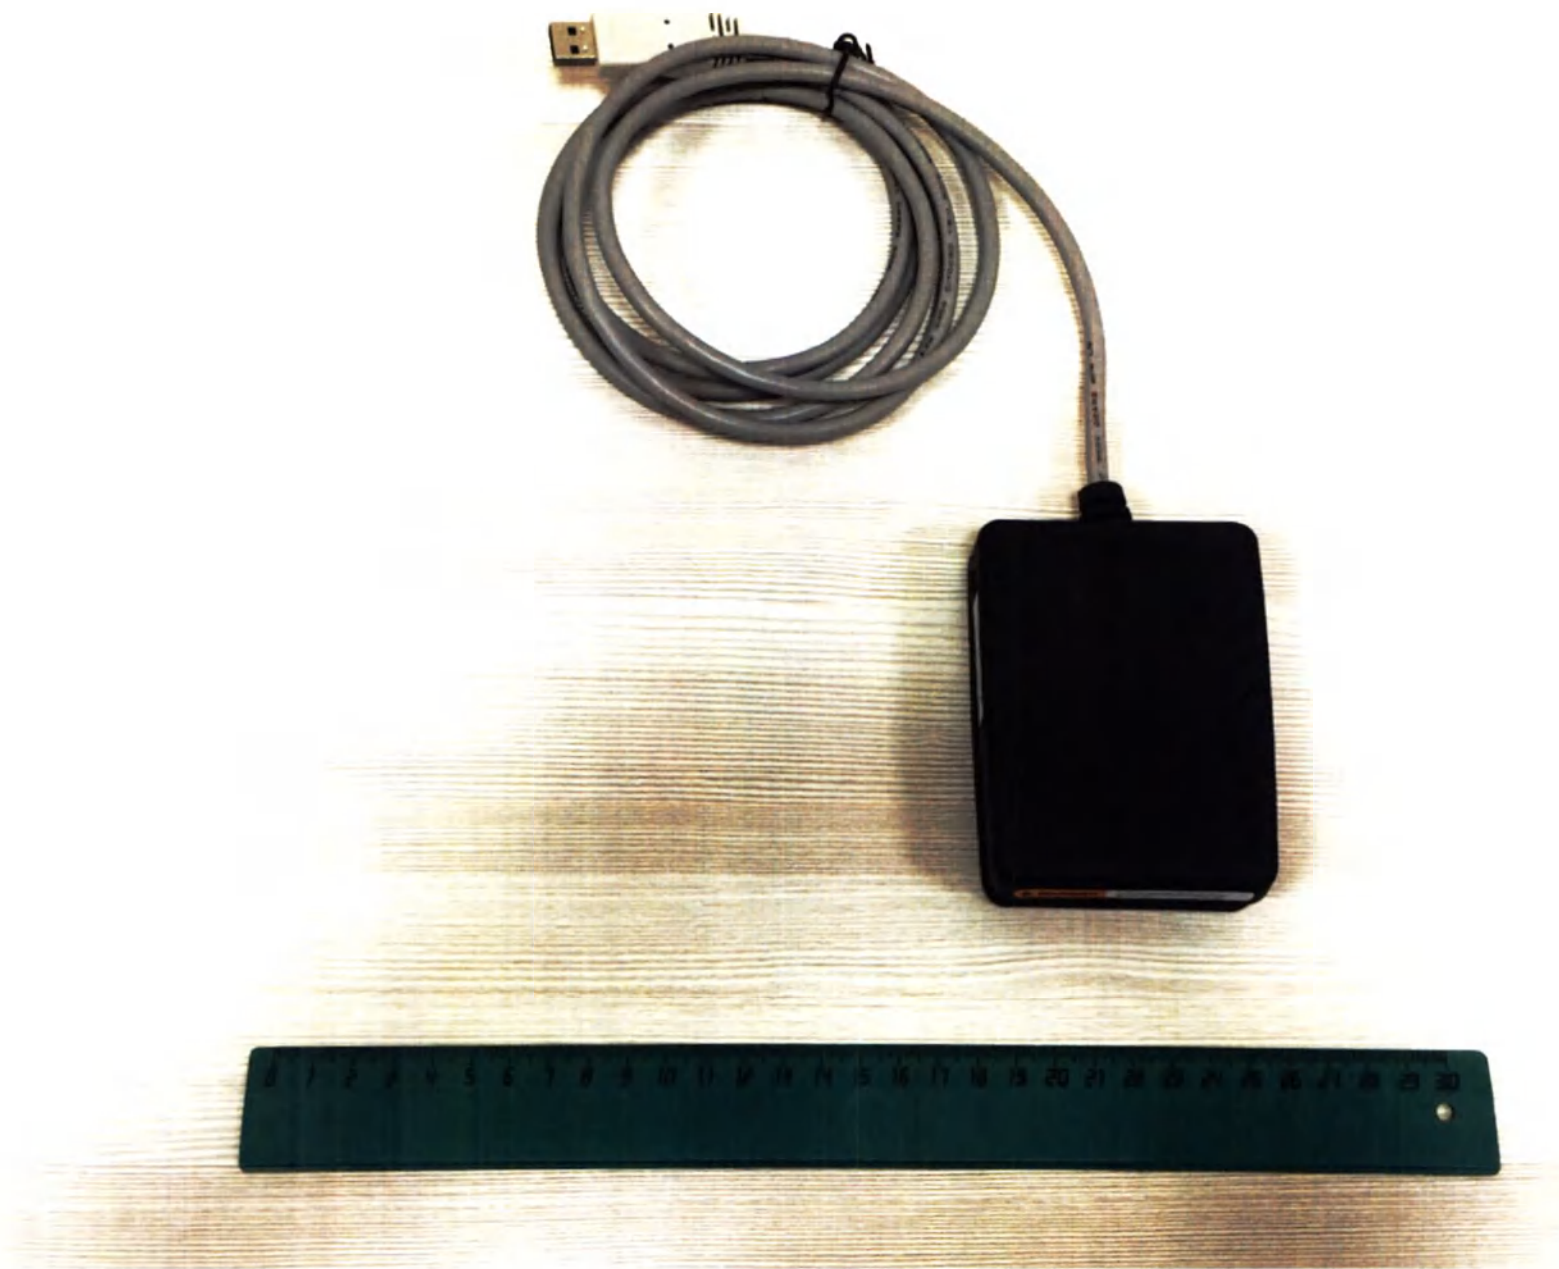

Ножной переключатель, 1 педаль (Water-resistant foot switch with one hot key)







Ножной переключатель (971-SWNOM), 3 педали (Foot switch Module (971-SWNOM), 3-pedal)



Встроенный адаптер для беспроводного подключения к сети (Built-in Wireless Adapter)

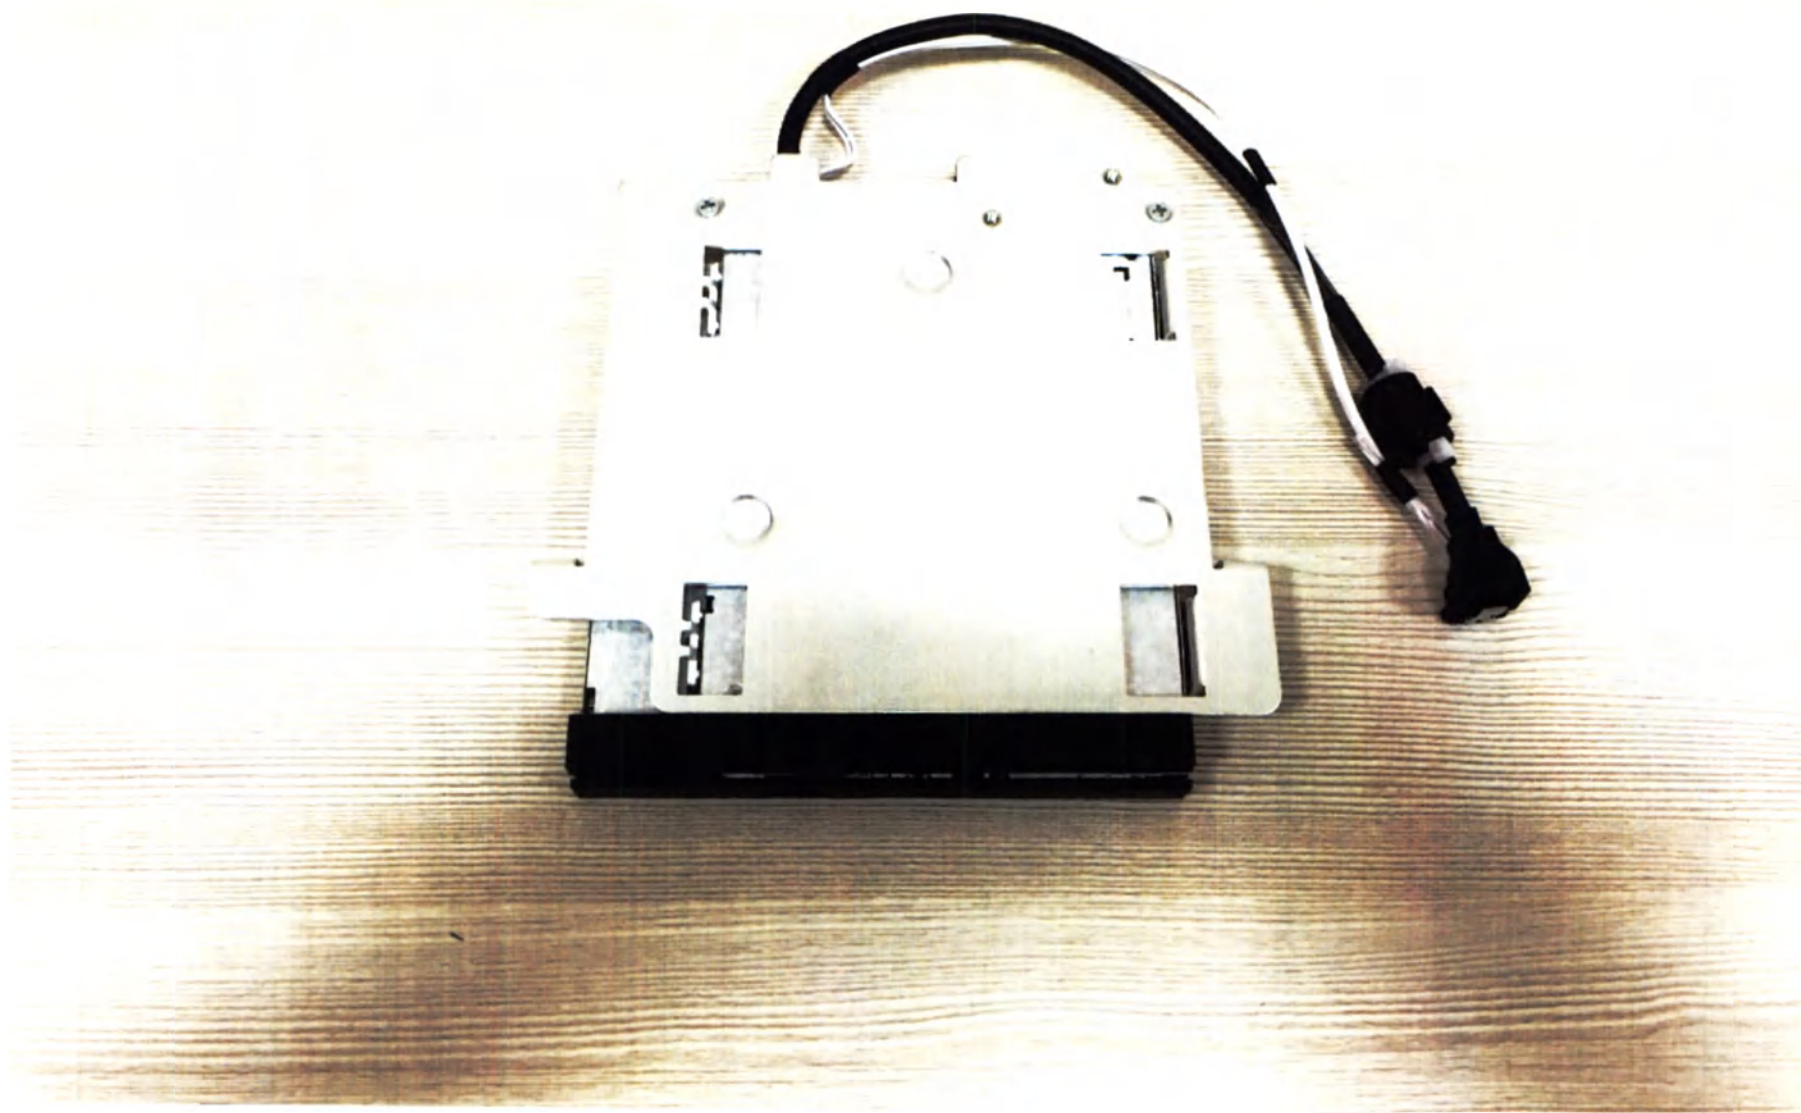

Блок DVD (DVD assembly)

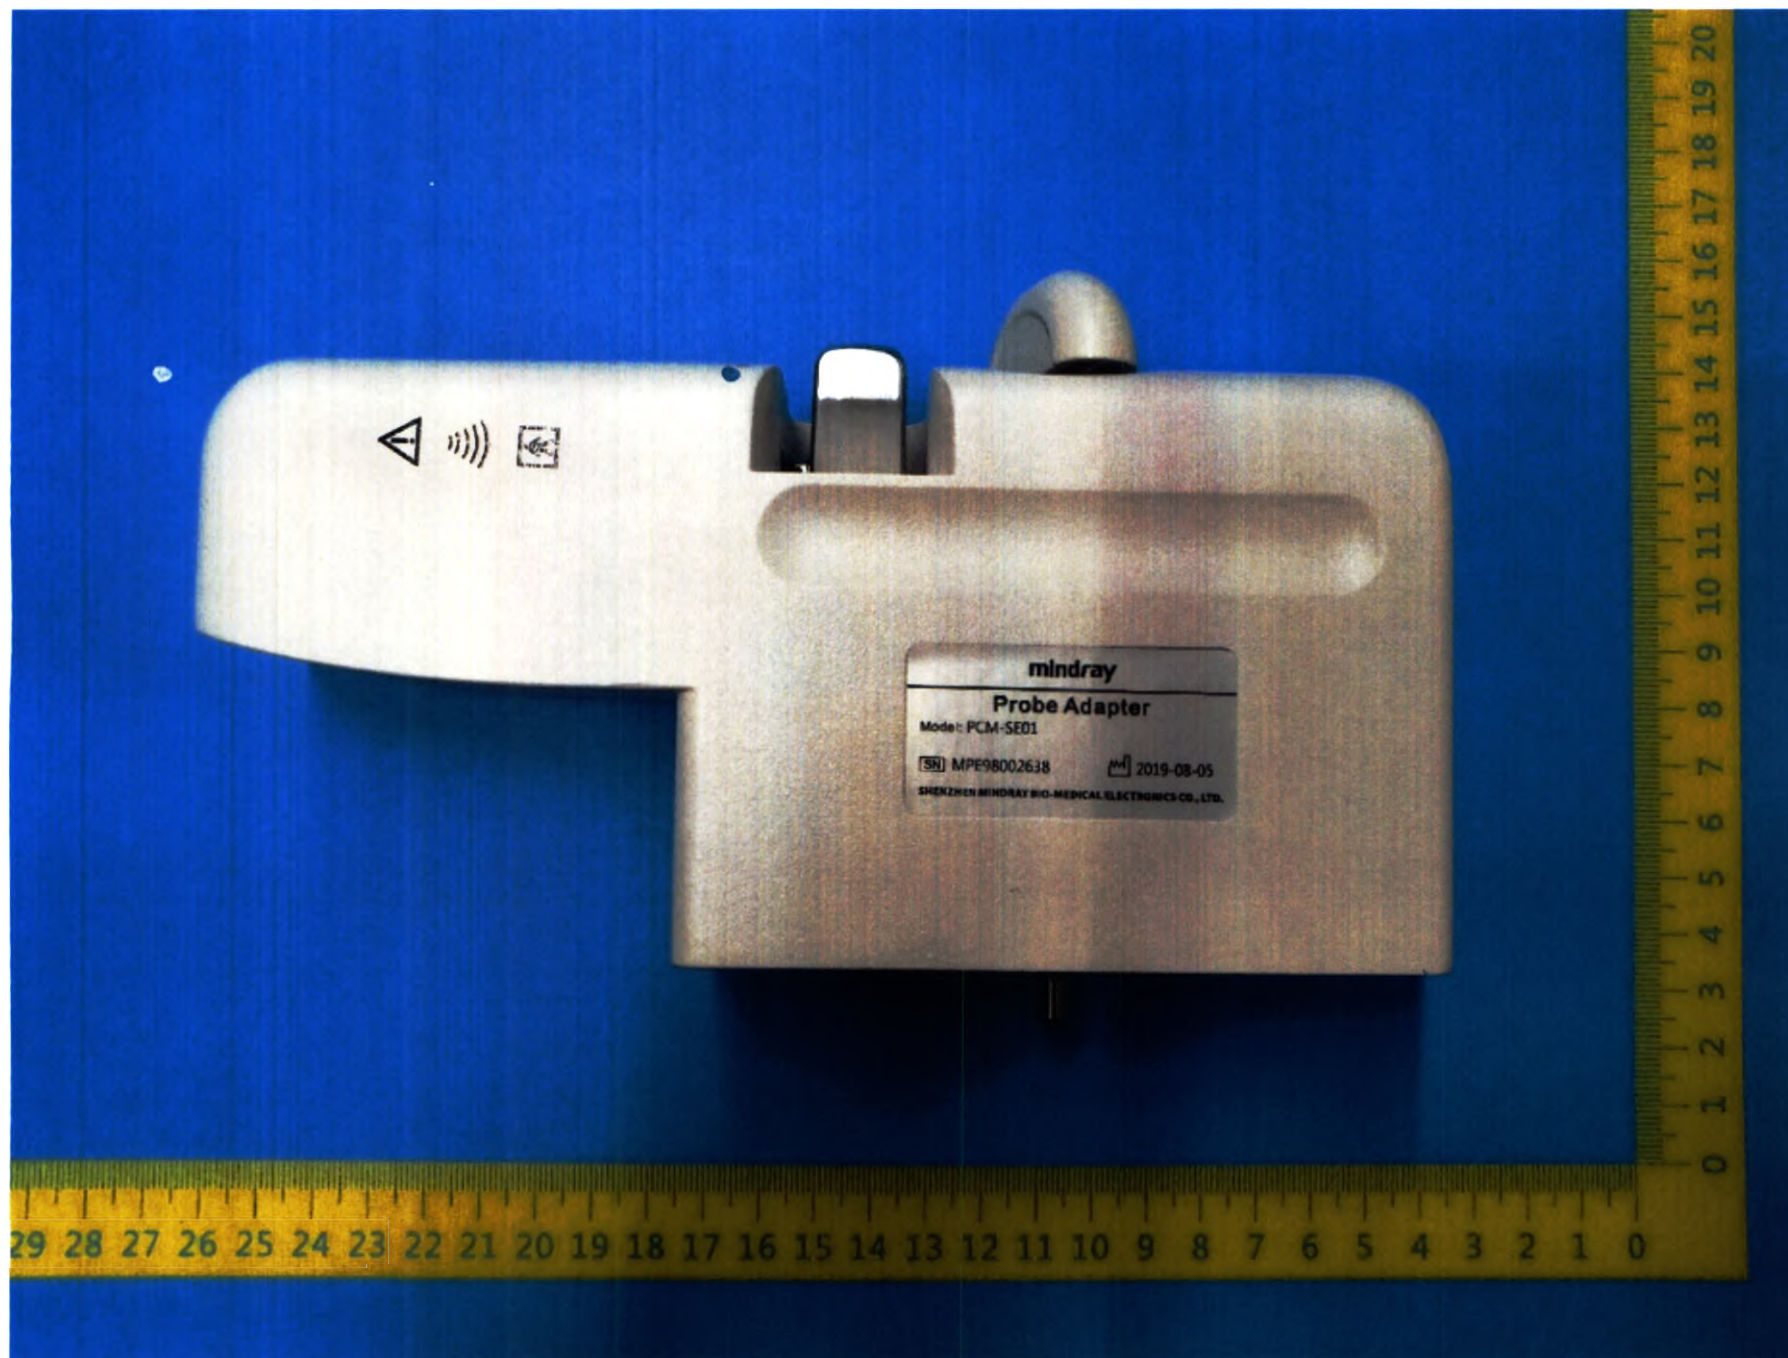

Принадлежности: Адаптер датчика ультразвукового чреспищеводного P7-3Ts (Apadter of Phased array transducer P7-3Ts)

Настройки

mindra

System

ExamMode

Measure

Comment

iWorks

Стресс-эхо

DICOM/HL7

Network

Print

Обслуживание

Информация

Свойство службы Localhost DICOM (включая SCU и SCP)

AE TitleDC-60Port2345PDU32768

Наст.сервера

Устройство

Устройство

IP-адрес

Ping

Добавить

Список устройств

Устройство

IP-адрес

Уст. службу DICOM

Удалить

хранения

Печ

Раб.Спис

MPPS

Подтвержд.сохранения

Query/Retrieve

ЗапросHL7

Настр.те нов. службу

Устройство

Имя службы

AE Title

Port

104

Макс.к-во попыт

Времен.интерв.(с)

Тайм-аут(с)

Реж.увел-я

Режим сжатия

Козфф. сжатия

Цвет.режим

☐ Разр.неск.кадр.мак част.кадров

3D/4D

Опция сохр-я SR

☐ Encapsulated PDF

Режим сохр.

Добавить

отмен

Обн.

Спис.служб

Устройство

Имя службы

AE Title

Port

Умолч

Удалить

Умолч

Провер

Подтв.отмену!

Выход

хранения **Печ** Раб.Спис MPPS Подтвержд.сохранения Query/Retrieve ЗапросHL7

Настр.те нов.службу

Устройство Имя службы AE Title Port
Макс.к-во попыт Времен.интерв.(с) Тайм-аут(с)

Св-ва печати

Копии Настройки Ориент.пленки Приор
РазмПленки ФормОтобр Тип носителя Регул.
Мин.плотн макс Плотность Инфо о конфигурации
Назнач-е Вид увеличения

Спис.служб

Устройство	Имя службы	AE Title	Port	Умолч
------------	------------	----------	------	-------

Отпр

Предупр.: в УЗ-системе невозможно восстан. отосланные данные исслед.!

Носитель

-  **DICOM**
-  **Принтер**
-  **iStorage**
-  **MedTouch/MedSight**
-  **DICOMDIR**

Свойство

Сервер хранения

Сервер принтера

Готово

отмен

Отпр

Предупр.: в УЗ-системе невозможно восстан. отосланные данные исслед.!

Носитель

-  **DICOM**
-  **Принтер**
-  **iStorage**
-  **MedTouch/MedSight**
-  **DICOMDIR**

Свойство

Сервер хранения

Сервер принтера

Готово

отмен

Пациента(Место назн)							
0 записи перечис-ны.							
ID пациента	Имя	Пополнени ..	Описание иссл-я	Дата/ВрОбсл	Содерж	Пол	Дата ро...
<button>Выход</button>							

Отпр

Warning: Measurement labels that do not meet the DICOM SR standard may not be saved!

Носитель

-  F:
-  DICOM
-  Принтер
-  iStorage
-  MedTouch/MedSight
-  **DICOMDIR**

Свойство

Назнач-е **USB(F:)**

Реж.увел-я **Исходный**

Режим сжатия **Несжатый**

Козфф. сжатия **Б/потерь**

☐ Удалить с диска после копиров-я

☒ Удал.иссл-ия

☐ Удал.изобр-ия

Готово

отмен

Локальные Общий Изоб Приложение Акуш Конф.Клавиш Админ Скан.код

Сведения о больнице

Имя

Адрес

Вебсайт

Location

Telephone Факс

Главный врач Объединить

Язык и время

Язык **Russian** ▼

Часовой пояс **(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London** ▼

Системная дата **28/01/2012** 

Формат даты ☐ YYYY/MM/DD ☒ MM/DD/YYYY ☐ DD/MM/YYYY

Систем.время **14:51:23** ▲▼

Time Format ☒ 12часов ☐ 24 часа

Синхр.вр.

Save **отмен**

Локальные

Общий

Изоб

Приложение

Акуш

Конф.Клавиш

Админ

Скан.код

Информация о пациенте

Отображ данные пац-та на дисплее

☒ Имя

☒ Пол

☒ Возраст

☒ Дата рожд-я

☒ ID

☒ Оператор

☒ Больница

Единицы измерения

☒ метрич

☐ Англ-изм

Формула поверх-ти

☐ Восточн

☒ Западный

Наст.исс.

По завершению иссл-я

☐ Скан

☒ НовПац

☐ Раб.Спис

☒ Отпр/печать по оконч иссл-я

Показ

LCD

Сенс.панель

хранения

Размер изобр.

☐ РазмИзоб

☒ Stand Area

Реж.аналог.вых

☒ PAL

☐ NTSC

Режим цифр. выхода

☒ ПолнЭкр

☐ Stand Area

Проспективная кинопетля

Время (с)

180

(1-480s)

ЧСС

120

(1-390 циклов)

Кодир. AVI

Совместимость ОС:

☒ Windows OS

☐ Mac OS

Качество код...

☐ Высо...

☒ Стандарт

☐ Low

Скринсеивер

☒ Вкл. заставку.

жди

15

min

☒ Вкл.реж.ожид.

жди

30


min

Выбер.картинку

Обзор

См.

Настройки	
System	Локальные Общий Изоб Приложение Акуш Конф.Клавиш Админ Скан.код
ExamMode	Настройки
Measure	Датч. P4-2 ▼
Comment	
iWorks	
Стресс-эхо	Настройки Freeze После нажатия Freeze
DICOM/HL7	☒ Вид ☐ измер ☐ Разм ☐ Комментар ☐ Метка
Network	
Print	
Обслуживание	Изоб Направл ☒ C&PW ☐ C/PW
Информация	☐ Автоинверсия ☐ Отображать шкалу iScale ☐ Обновл. режима В+ЦДК при смещении КО в PW/CW

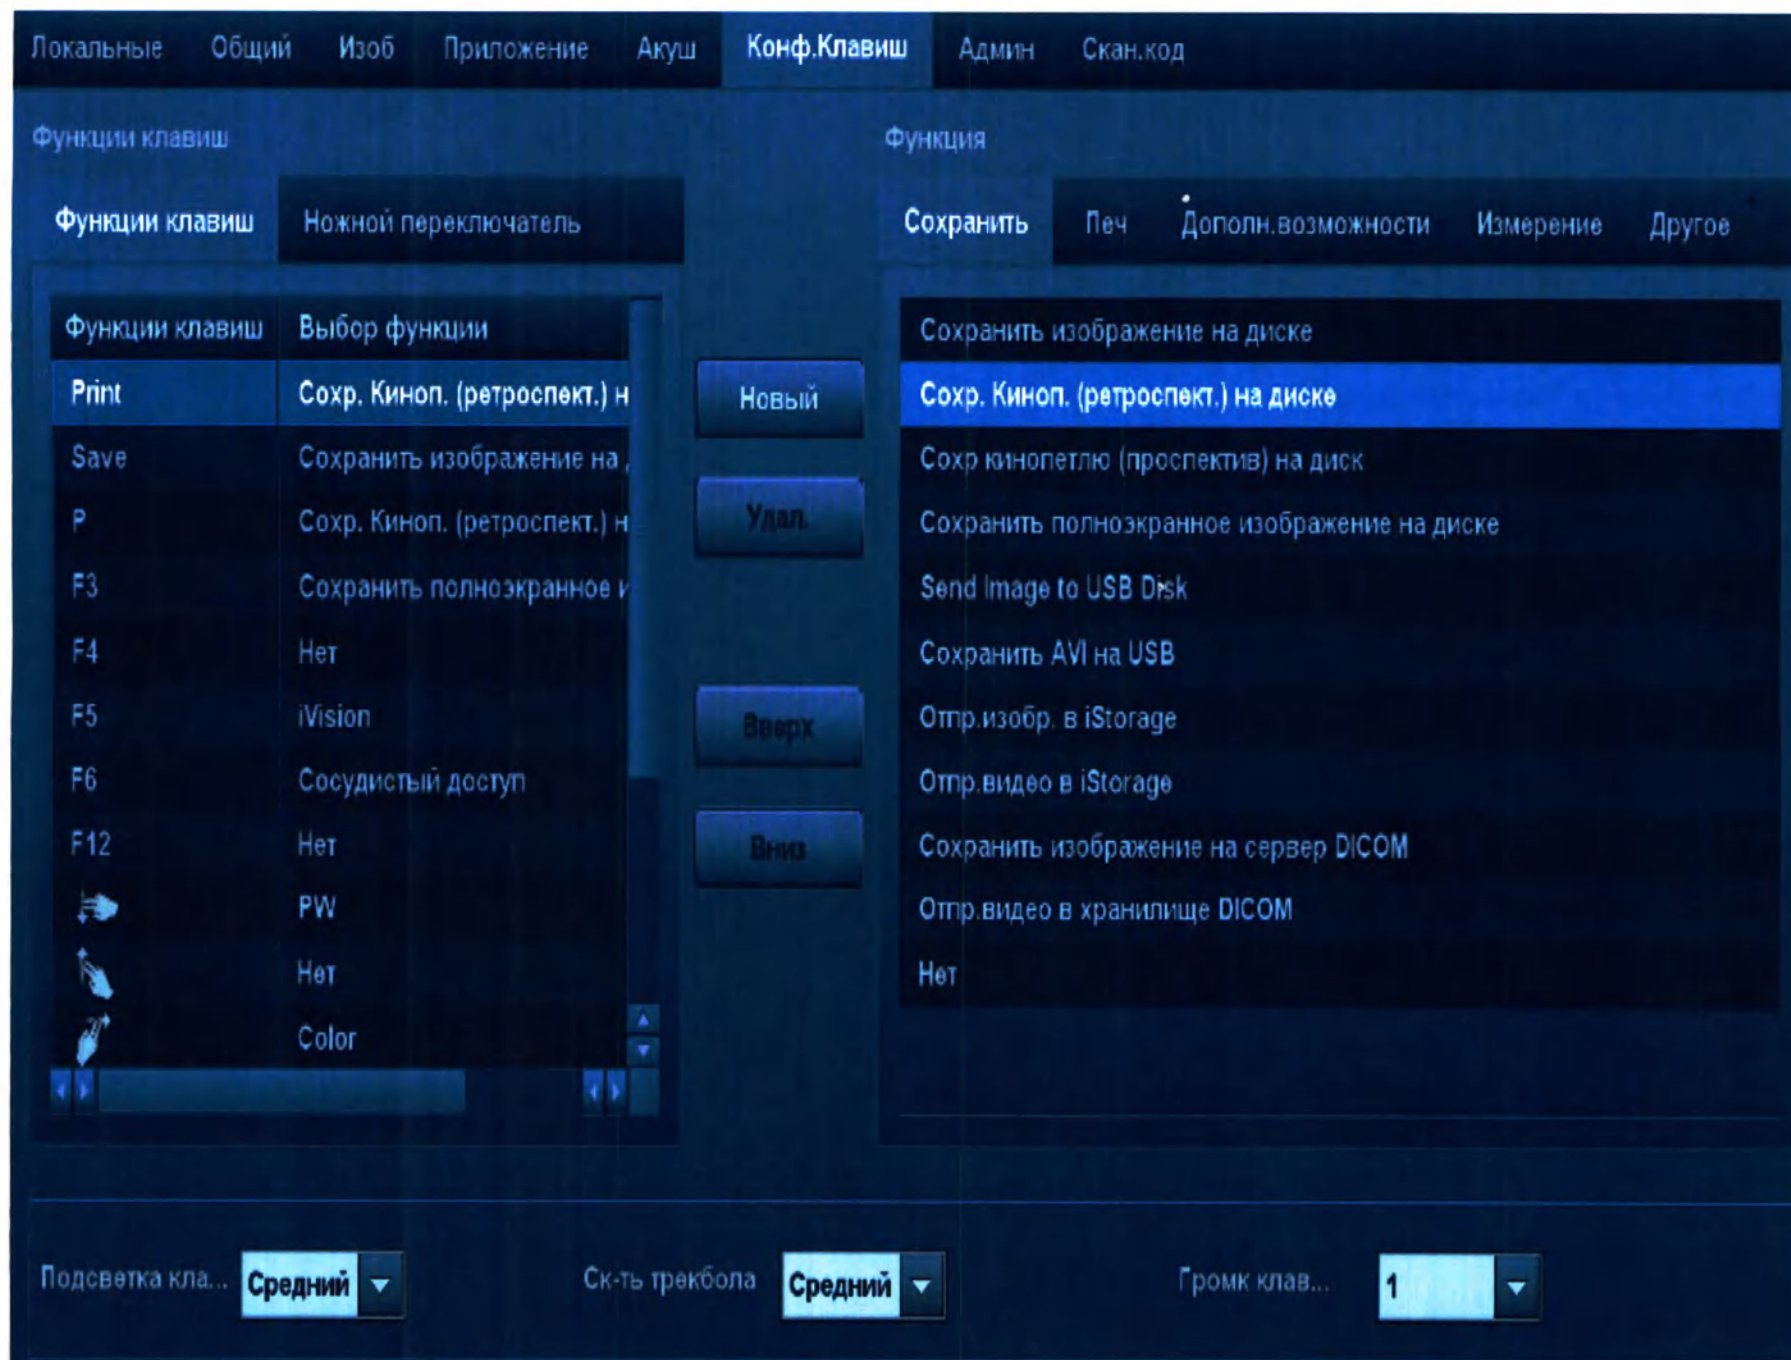

Руководство оператора п.п. 12.1.6 Конфигурация клавиш



Руководство оператора п.п. 12.2 Предварительные установки режимов исследования

Библиот: Абдом

Доступные метк **Кард** ▼

Выбранн. метки

Пред.стр. След.стр.

2-створч		RT 	Доля	ОБЖПроток	GB	Аорта
3-створч.		Саг 	Печень	ЖелчПрот	На спине	Желудок
A2CH	>	Пркс 	Лежа/боку	Подж.жел	ПанкрПрот	12-п.киш
A4CH	>>	Артерия 	ОбПечПрот	Селезенка	Почка	Кишка
ASD	<					
AV	<<					
IAS						
LA						
LAA						
LCC						
LE						
LT						
LV						
LVOT						
LVPW						
ME						
ME2CH						
ME4CH						
ME5CH						

Вверх Вниз Лев. Вправо

Доб.коммент

Руководство оператора п.п. 12.4 Предварительные установки комментариев

Настройки

System

Служба печати

Настройка изображения

ExamMode

Имя службы

Тип службы

Принтер

Статус

Умолч

Добавить службу

Measure

Report Print

Печат.отчета

СбойОткр

Удалить службу

Comment

Digital Print

Печ.цифр.изобр.

Sony UP-D898MD/X898MD

Автоном.

Переим. службу

iWorks

Analog Print

Печать изображ.

Black and White Printer

Н/П

Доб.принтер

Стресс-эхо

СлужбПеч по умолч

DICOM/HL7

Свойство

Network

Тип службы

Печат.отчета

Имя службы

Report Print

Print

Принтер

Обслуживание

РазмерБумаги

A4

210.0mm * 297.0mm

Информация

iStorage

MedTouch/MedSight

Конфиг. службу

Имя службы:

IP-адрес:

Port:

Подключ

Добавить

Обн.

Спис. служб

Имя службы	IP-адрес	Port	Умолч
------------	----------	------	-------

Удалить

Умолч

ЛокальныеОбщийИзобПриложениеАкушКонф.КлавишАдминСкан.код

Сканер ш/кода: 1D

Режим ввода данн.пациен: ☒ Только ID пац. ☐ Элем.комбинации

Scan Barcode Example:

Scan Item	Separator	Content
Ignore Item		
ID пациента		
Другие ID		
Имя		
Фамилия		
Отчество		
Рожд(день)		
Рожд(месяц)		
Рожд(год)		

Вверх

Вниз

Add Ignore

Удалить

Загруз.по умолч...

Age Unit: Лет

Муж: Жен:

Руководство оператора приложение В.3 Настройки ультразвуковой системы: Сканер одномерных штрихкодов

ЛокальныеОбщийИзобПриложениеАкушКонф.КлавишАдминСкан.код

Сканер ш/кода: 2D

Режим ввода данн.пациен: ☒ Только ID пац. ☐ Элем.комбинации

Scan Barcode Example:

Scan Item	Separator	Content
Ignore Item		
ID пациента		
Другие ID		
Имя		
Фамилия		
Отчество		
Рожд(день)		
Рожд(месяц)		
Рожд(год)		

Вверх

Вниз

Add Ignore


Удалить

Загруз по умолч...

Age Unit: Лет

Муж.: Жен.:

Руководство оператора приложение В.3 Настройки ультразвуковой системы: Сканер двумерных штрихкодов

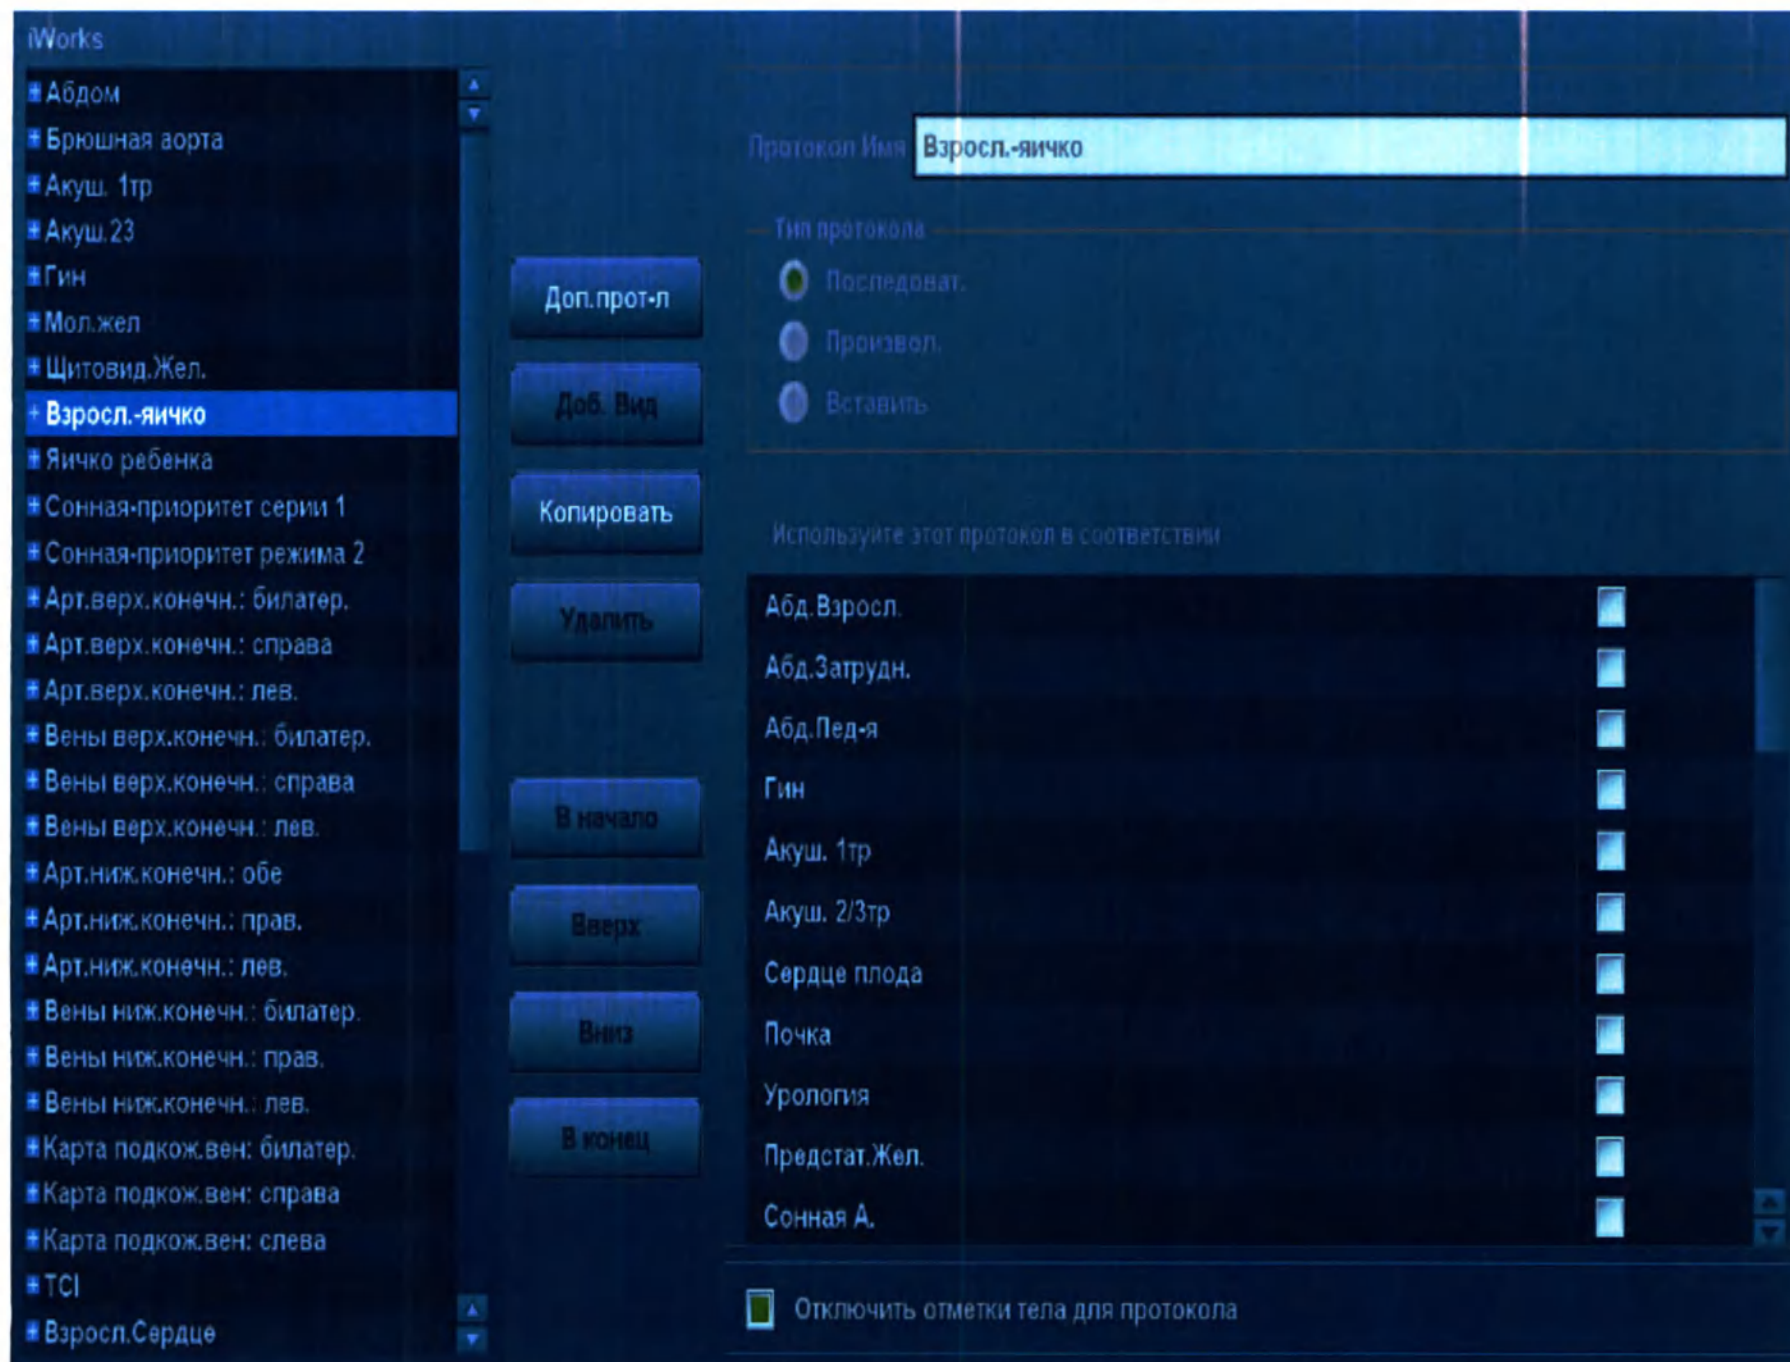

Руководство оператора приложение С.9 Настройка iWorks

Протокол Имя

iWorks

Тип протокола



Последоват.



Произвол.



Вставить

Используйте этот протокол в соответствии

Абд. Взросл.



Абд. Затрудн.



Абд. Пед-я



Гин



Акуш. 1тр



Акуш. 2/3тр



Сердце плода



Почка



Урология



Предстат. Жел.



Сонная А.



Отключить отметки тела для протокола

Изоб		Измерение	Аннотация	Метка
См.Имя		View		
Режим Комбинации		Параметр изобр.		
☒ В-реж.		Авт.Выч		
☐ Двойн.реж		☐ Вк		
☐ Цветной режим В +		☒ Вык		
☐ В + PW режим		iTouch		
☐ В + Цвет + PW режим		☐ Вк		
☐ В + CW режим		☒ Вык		
☐ В + Цвет + CW режим				
☐ В + М режим				
☐ iScape Mode				
Позиция				
☒ Нет		☐ Саг		
		☐ XS		
☐ Отключить отметки тела для протокола				

Изоб

Измерение

Аннотация

Метка

Текст 1

View

Location

☐ Лев.-верх

☐ Лев.-средн

☐ Верх.пр

☐ Центр

☒ Нижн.лев

☐ Нижн.средн

☐ Нижн.прав

Текст 2

Location

☐ Лев.-верх

☐ Лев.-средн

☐ Верх.пр

☐ Центр

☒ Нижн.лев

☐ Нижн.средн

☐ Нижн.прав

Шрифт

☐ Мал

☒ Средний

☐ Большой

☐ Отключить отметки тела для протокола

Изоб
Измерение
Аннотация
Метка

Абдом
2D
Измерение

Название элем

Печень
ДлинаПочки
ТолщПочки
ШирПочки
ТолщКоркСлоя
ДлинаНадпоч
ТолщНадпоч
ШирНадпоч
ОбЖПроток
ДиамВоротВ
ОбПечПрот

>
<
<<
Вверх
Вниз

Выбранн метки

Свойство
Location
Distal
Срд
Пркс

Стор.
Лев.
Прав

Измерение на след. сечении

Отключить отметки тела для протокола



ПРОШТО И
ПРОНУМЕРАНО
141 ЛИСТОВ



20.08.2017