


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто”
 комплект 1 серия 1


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2020 г.

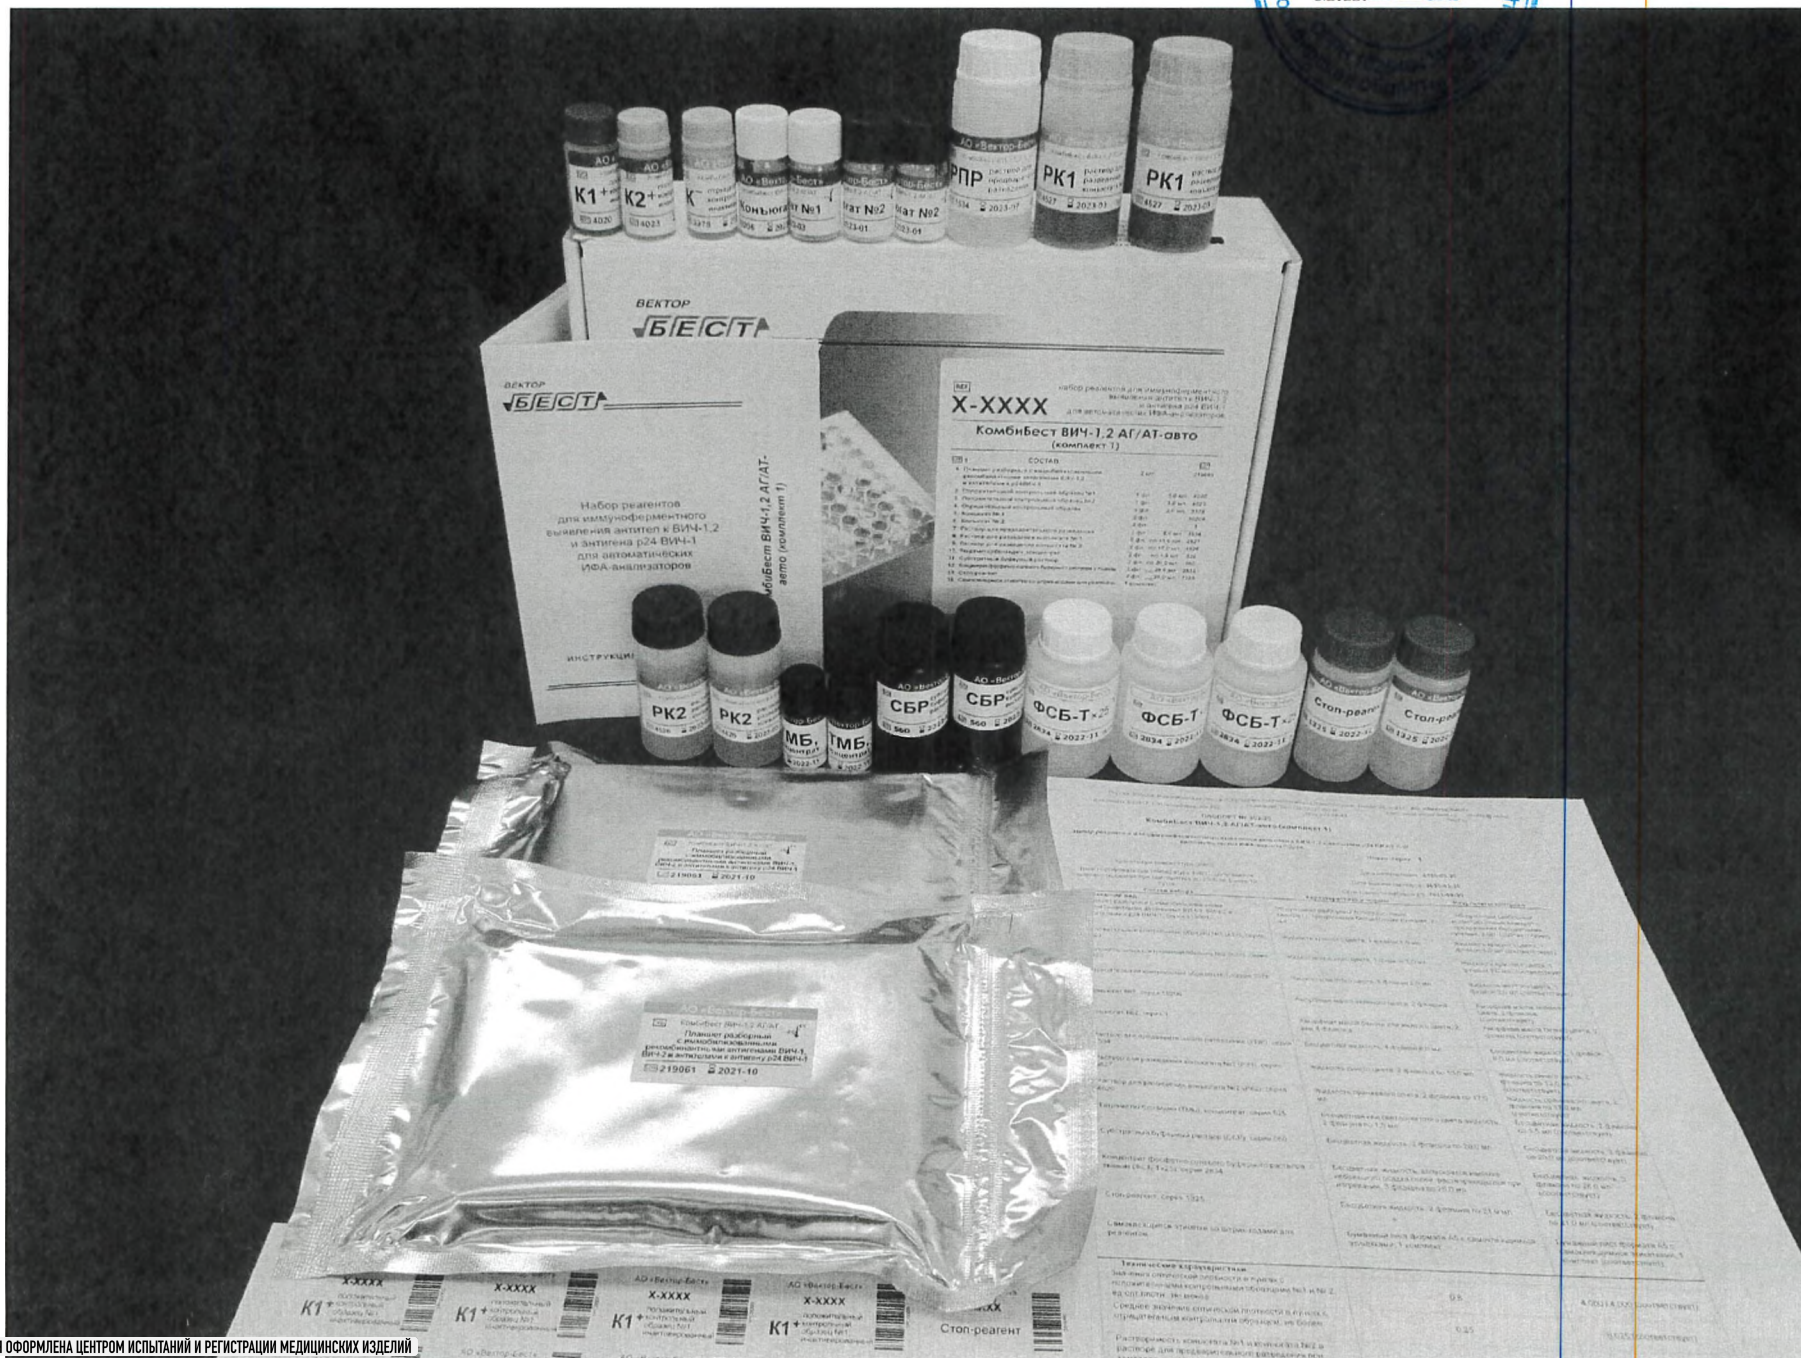


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ” №1
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.

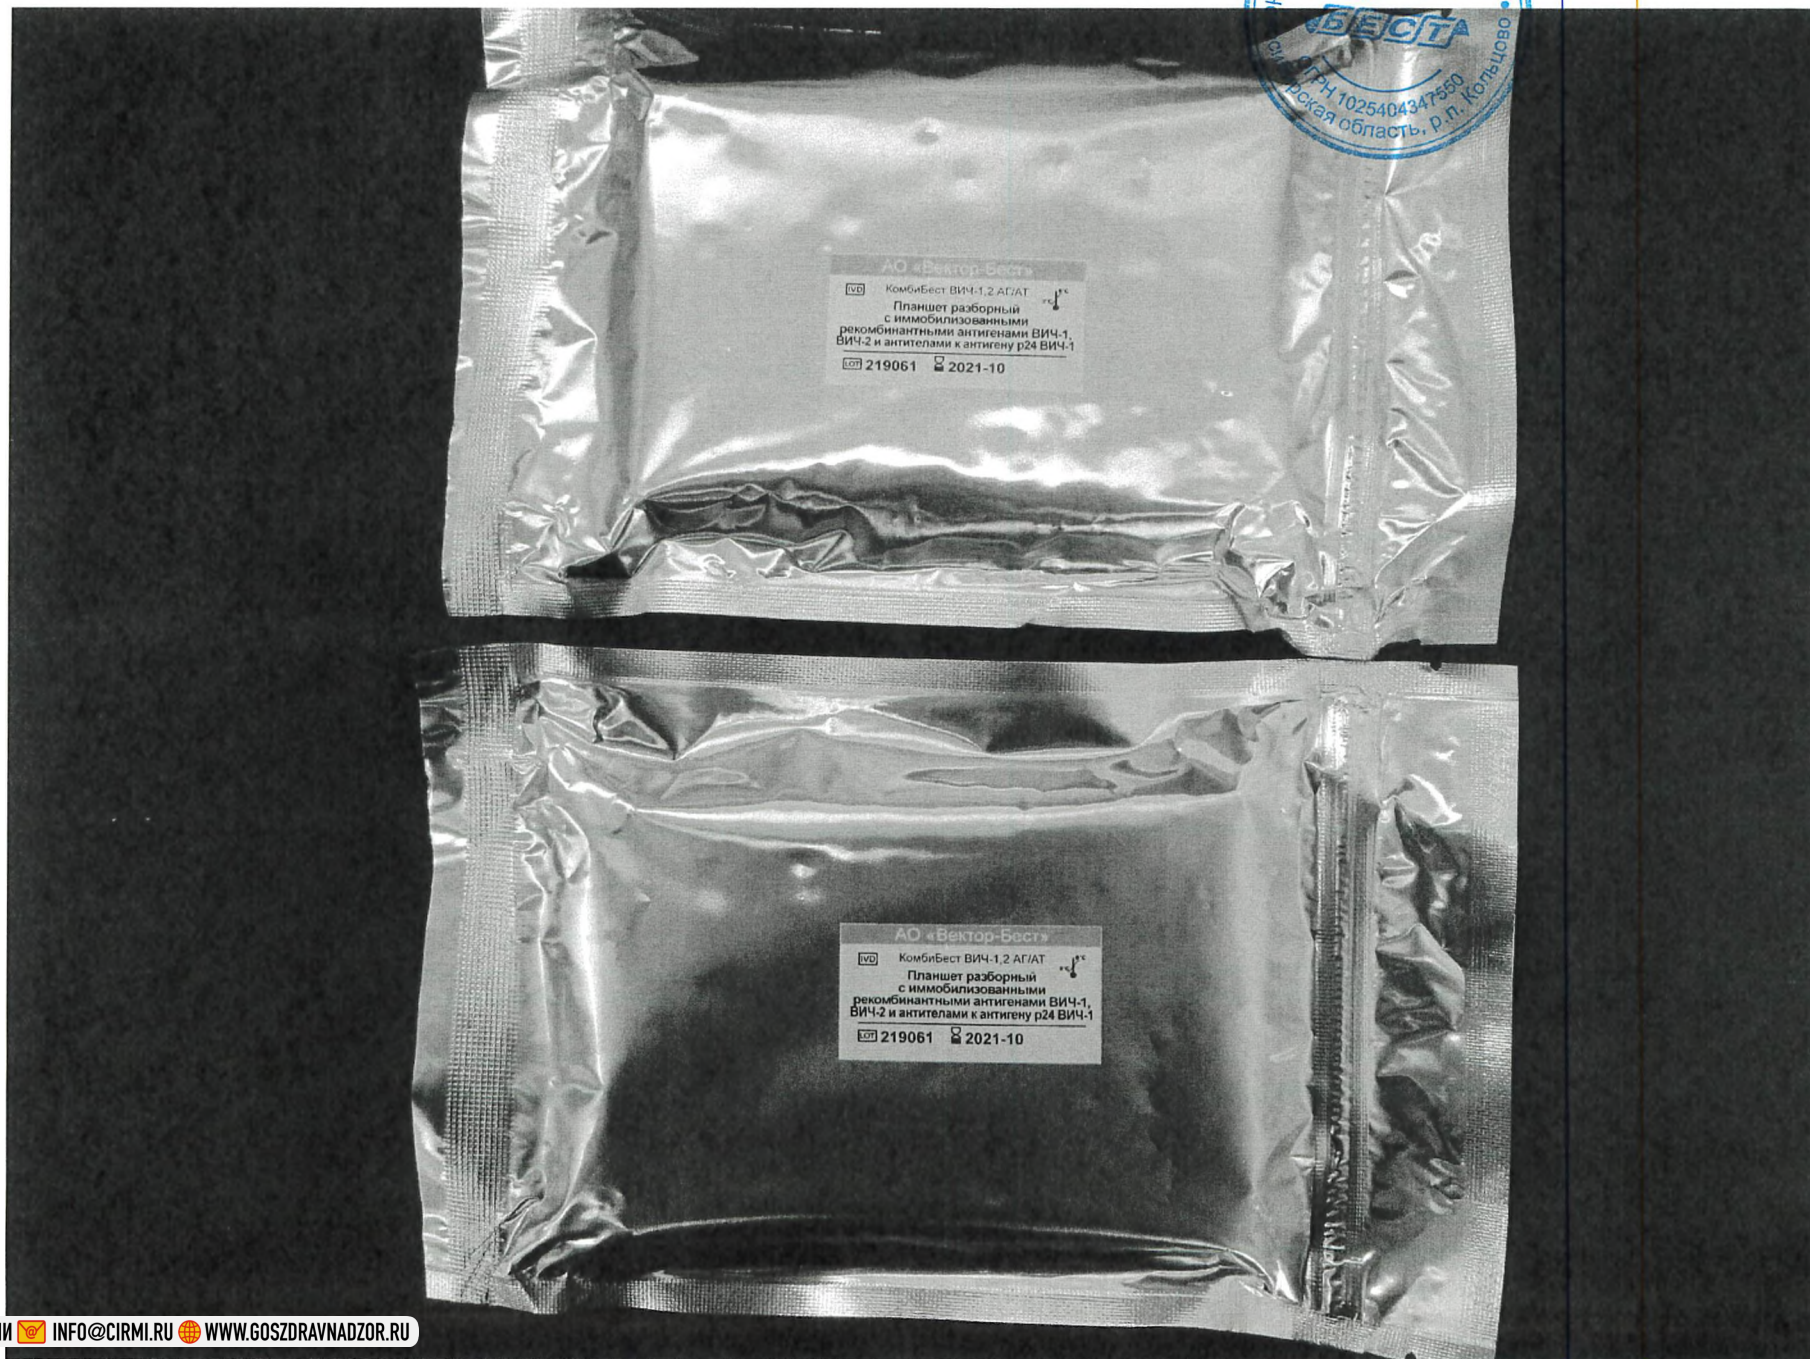


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №2
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д. Хусаинов
2020 г.

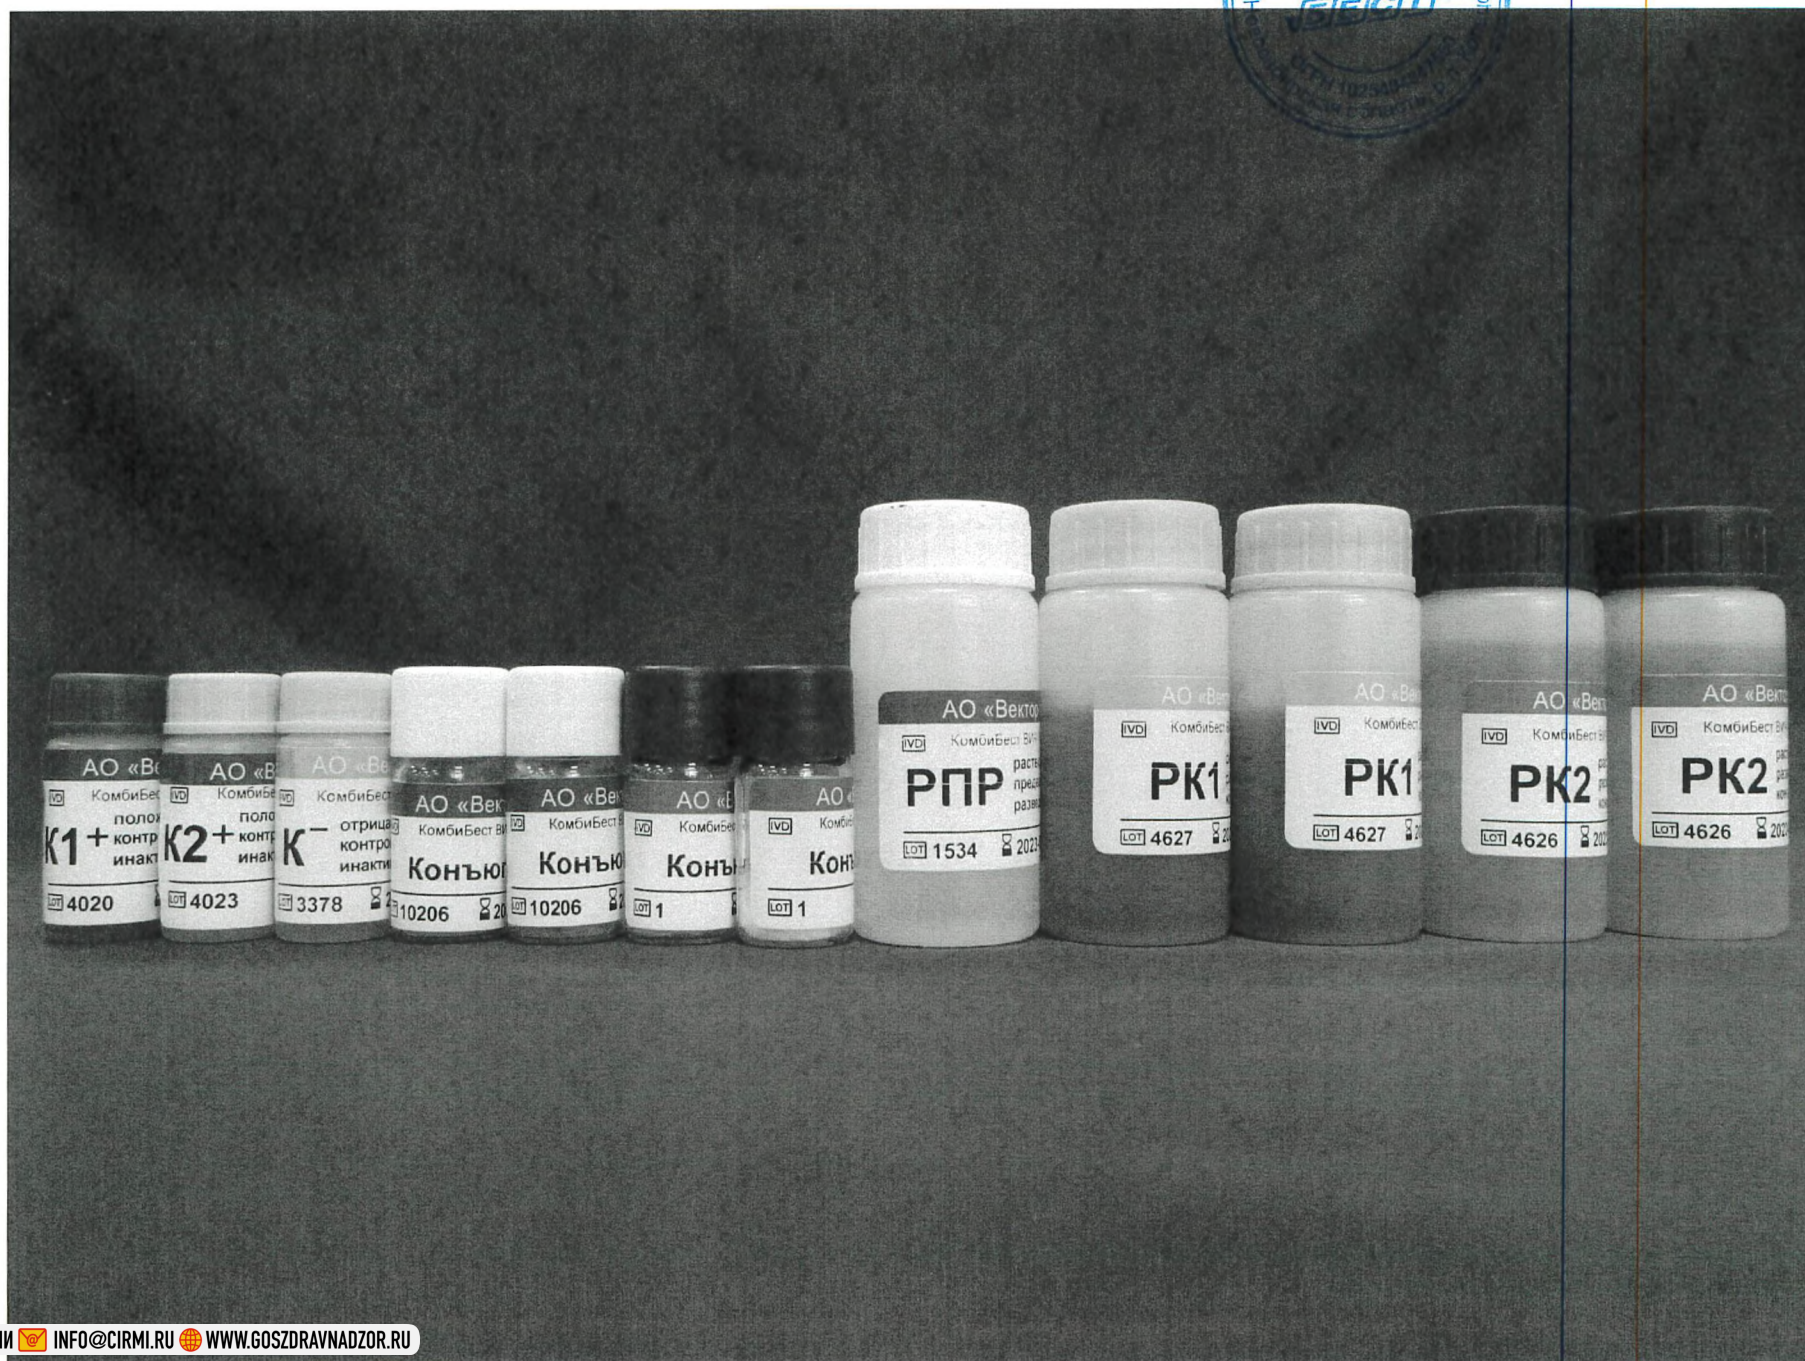

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №3
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №4
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“10” 03/2020 г.



Акционерное общество
«Вектор-Бест»
М.П.
ОГРН 1045000000000



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №5
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.

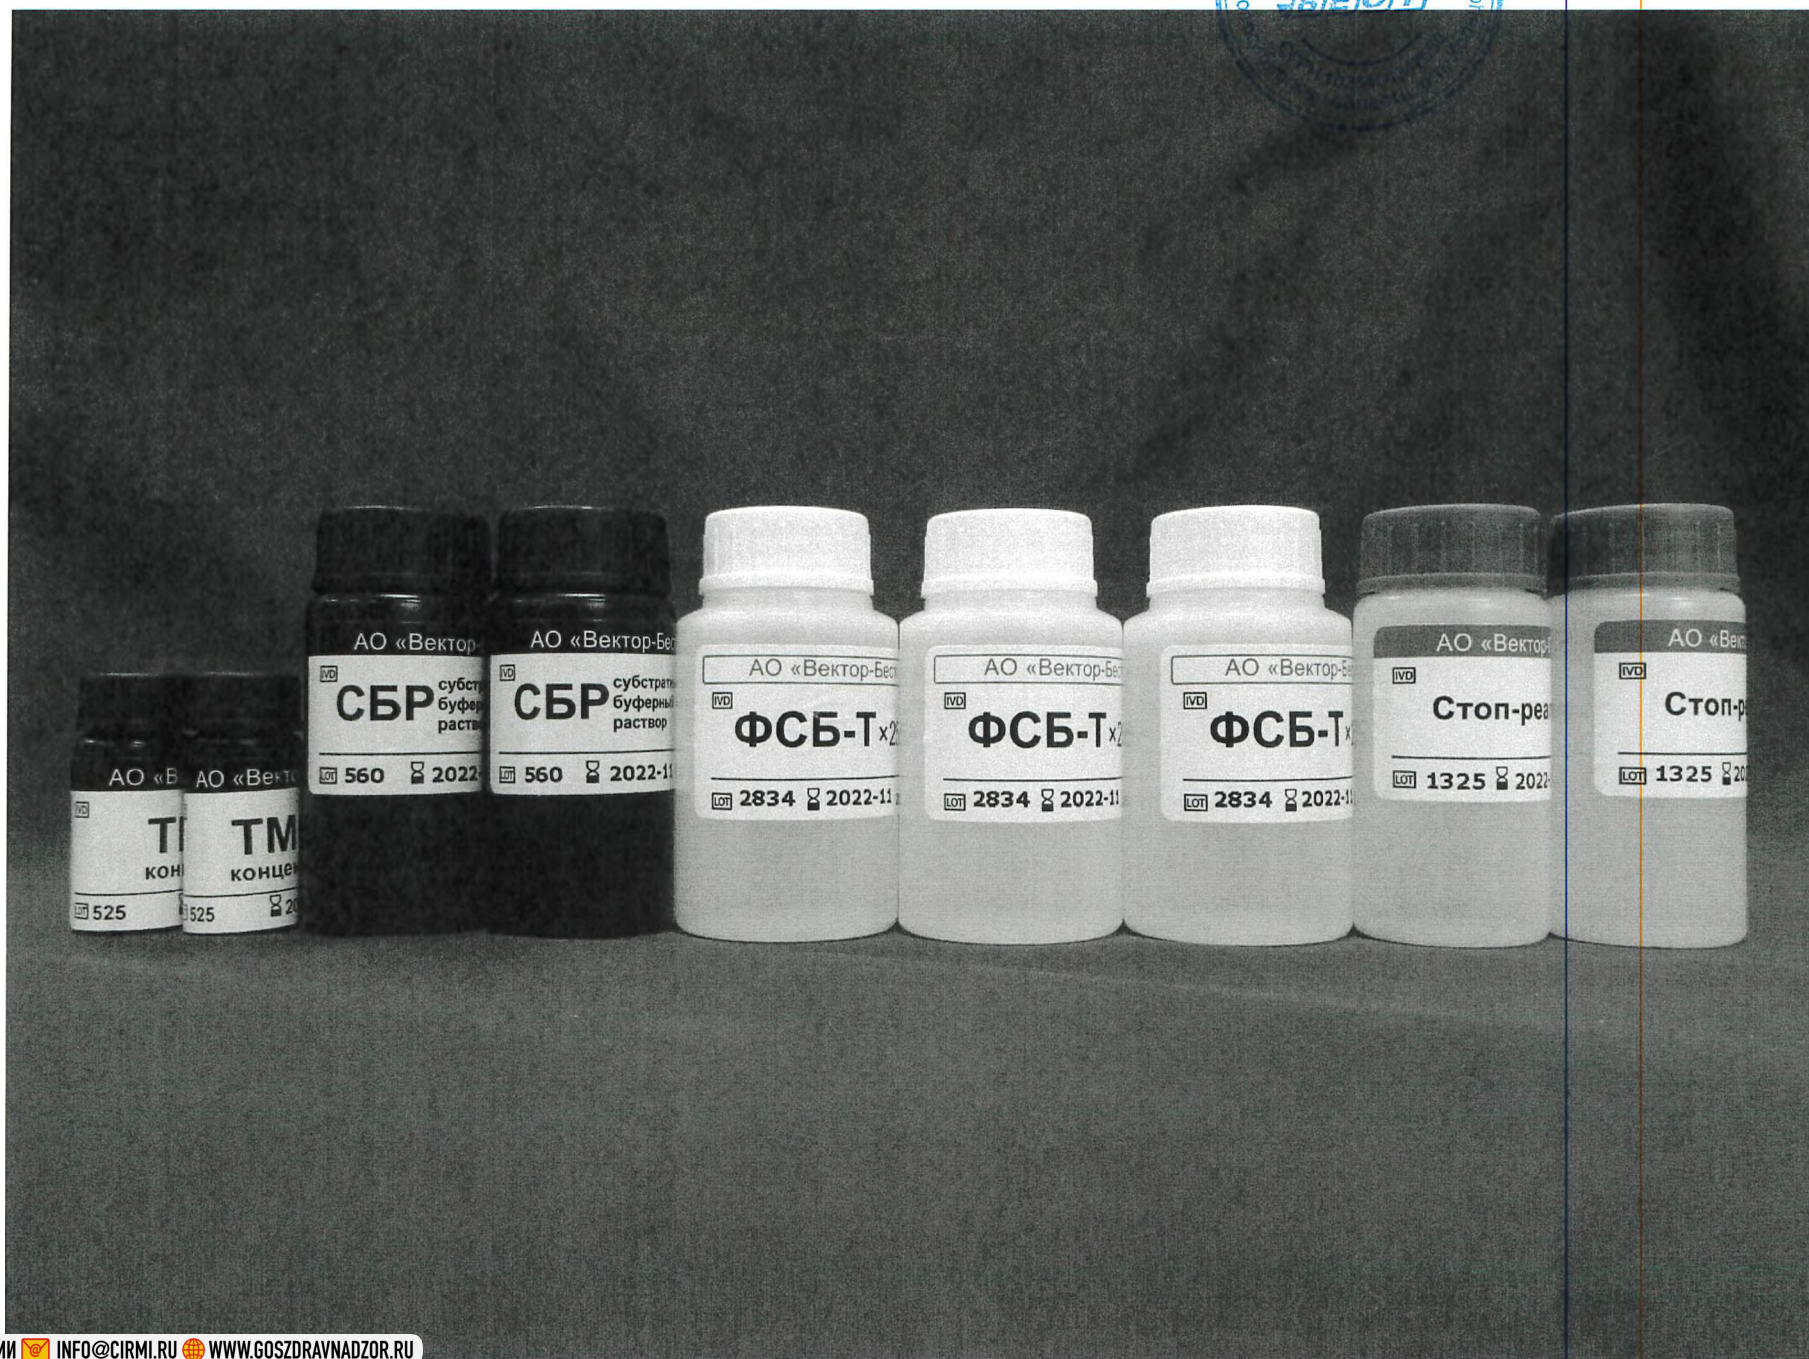

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №6
комплект 1 серия 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №7
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“10” “08” 2020 г.
М.П.

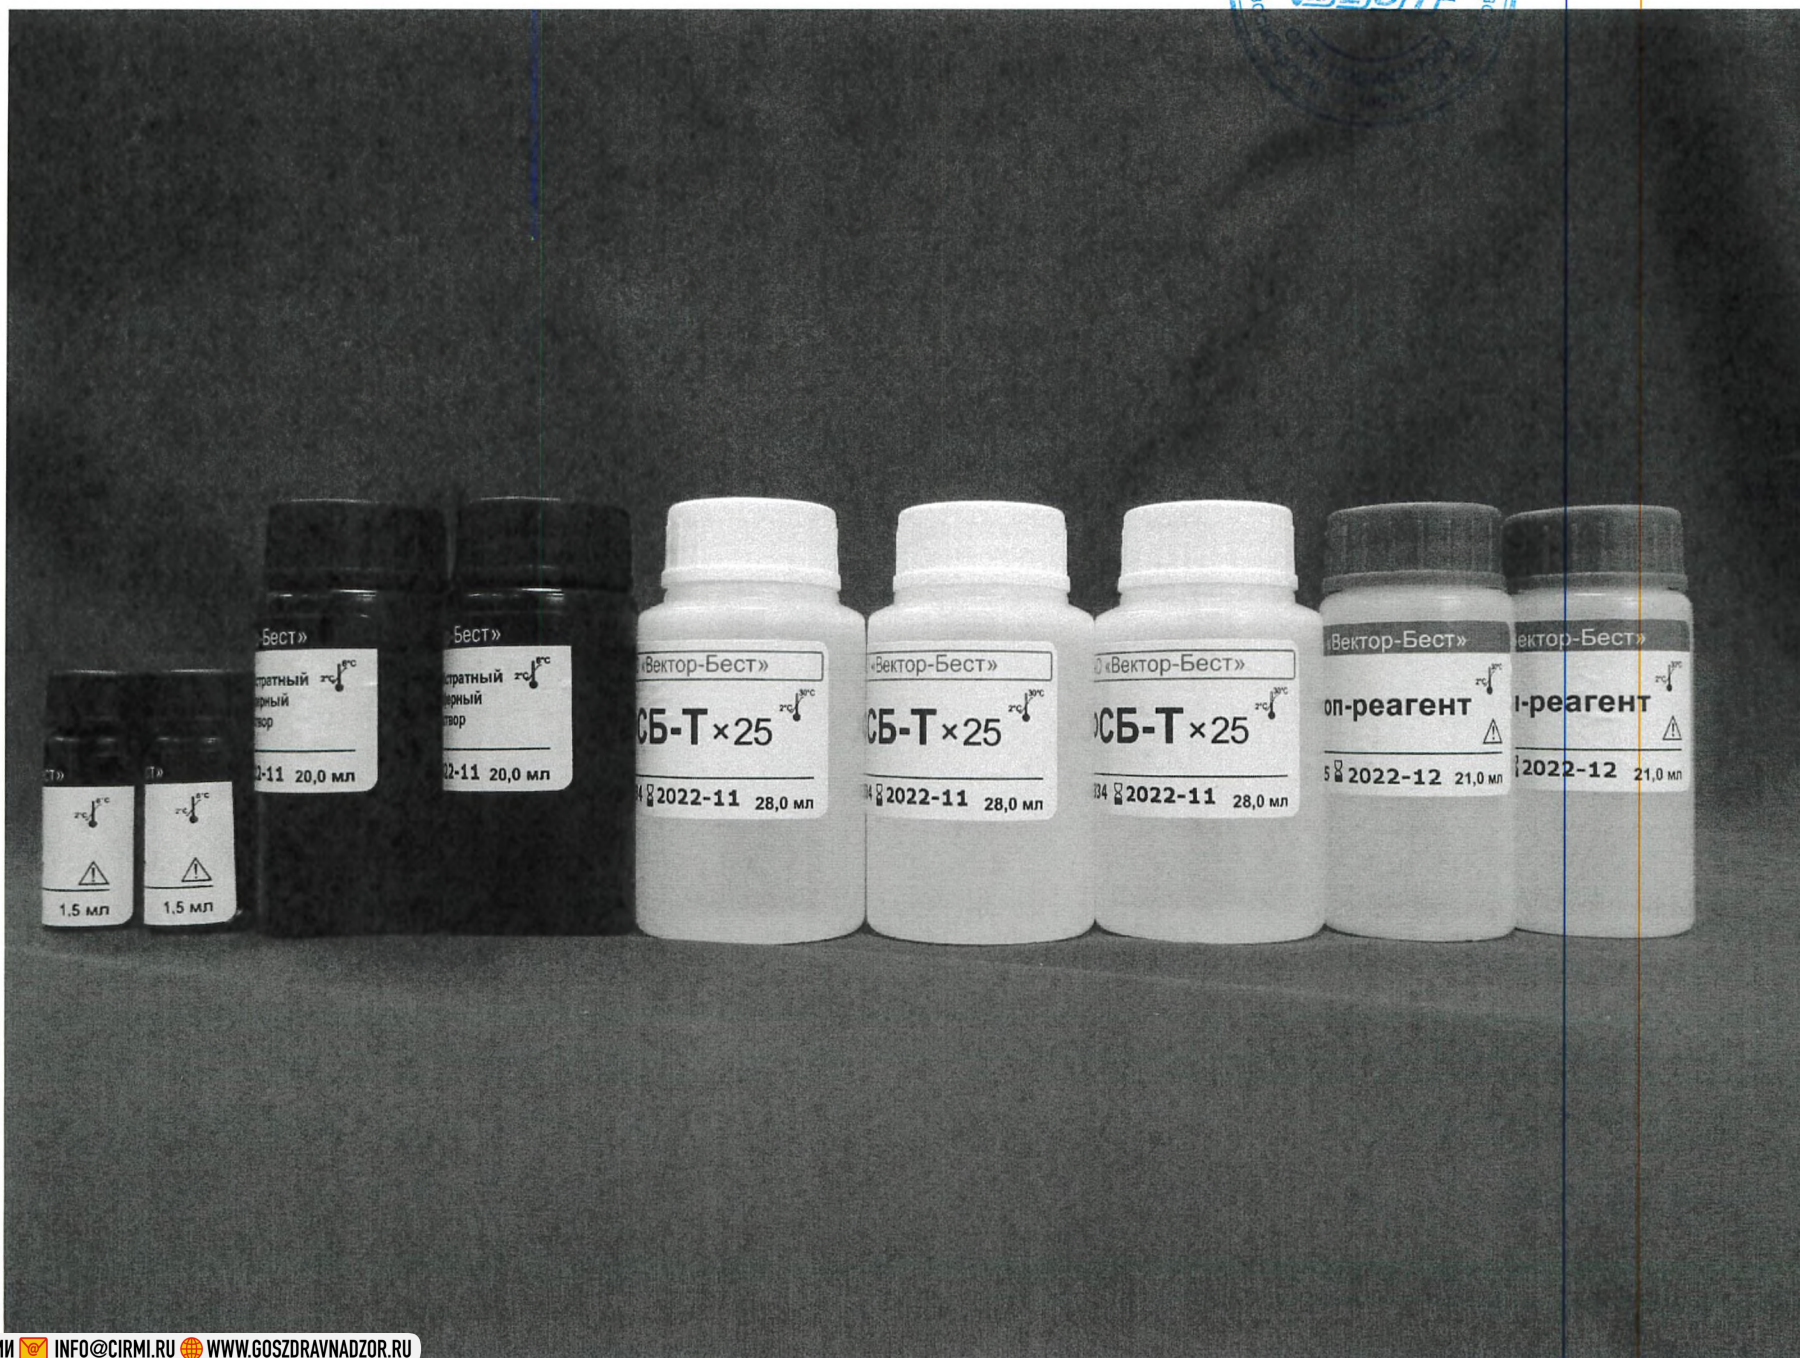



REF набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 для автоматических ИФА-анализаторов

X-XXXX

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто (комплект 1)

КОТ 1	СОСТАВ:	КОТ
1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24ВИЧ-1	2 шт.	219061
2. Положительный контрольный образец №1	1 фл. 1,0 мл	4020
3. Положительный контрольный образец №2	1 фл. 1,0 мл	4023
4. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 2,0 мл	3378
5. Конъюгат № 1	2 фл.	10206
6. Конъюгат № 2	2 фл.	1
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл. 8,0 мл	1534
8. Раствор для разведения конъюгата № 1	2 фл. по 13,0 мл	4827
9. Раствор для разведения конъюгата № 2	2 фл. по 17,0 мл	4826
10. Тетраметилбензидин, концентрат	2 фл. по 1,5 мл	525
11. Субстратный буферный раствор	2 фл. по 20,0 мл	560
12. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твиним	3 фл. по 28,0 мл	2834
13. Стоп-реагент	2 фл. по 21,0 мл	1325
14. Самоклеящиеся этикетки со штрих-кодами для реагентов	1 комплект	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №2
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2020 г.


“20”

03/

М.П.

ВЕКТОР

БЕСТ

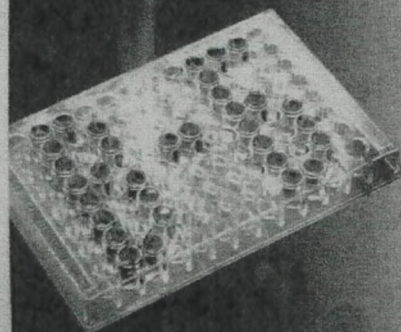

REF X-XXXX

Σ 192

LOT

1

ТУ 21.20.23-043-23548172-2020

РУ №

2020-03-20


2021-09-20

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто
(комплект 1)

IVD



2°C 8°C



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №3
комплект 1 серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.П.

“20”
сентября

М.Д. Хусаинов

2020 г.




АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто”
 комплект 1 серия 2

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
 “10” _____ 2020 г.
 М.П. 

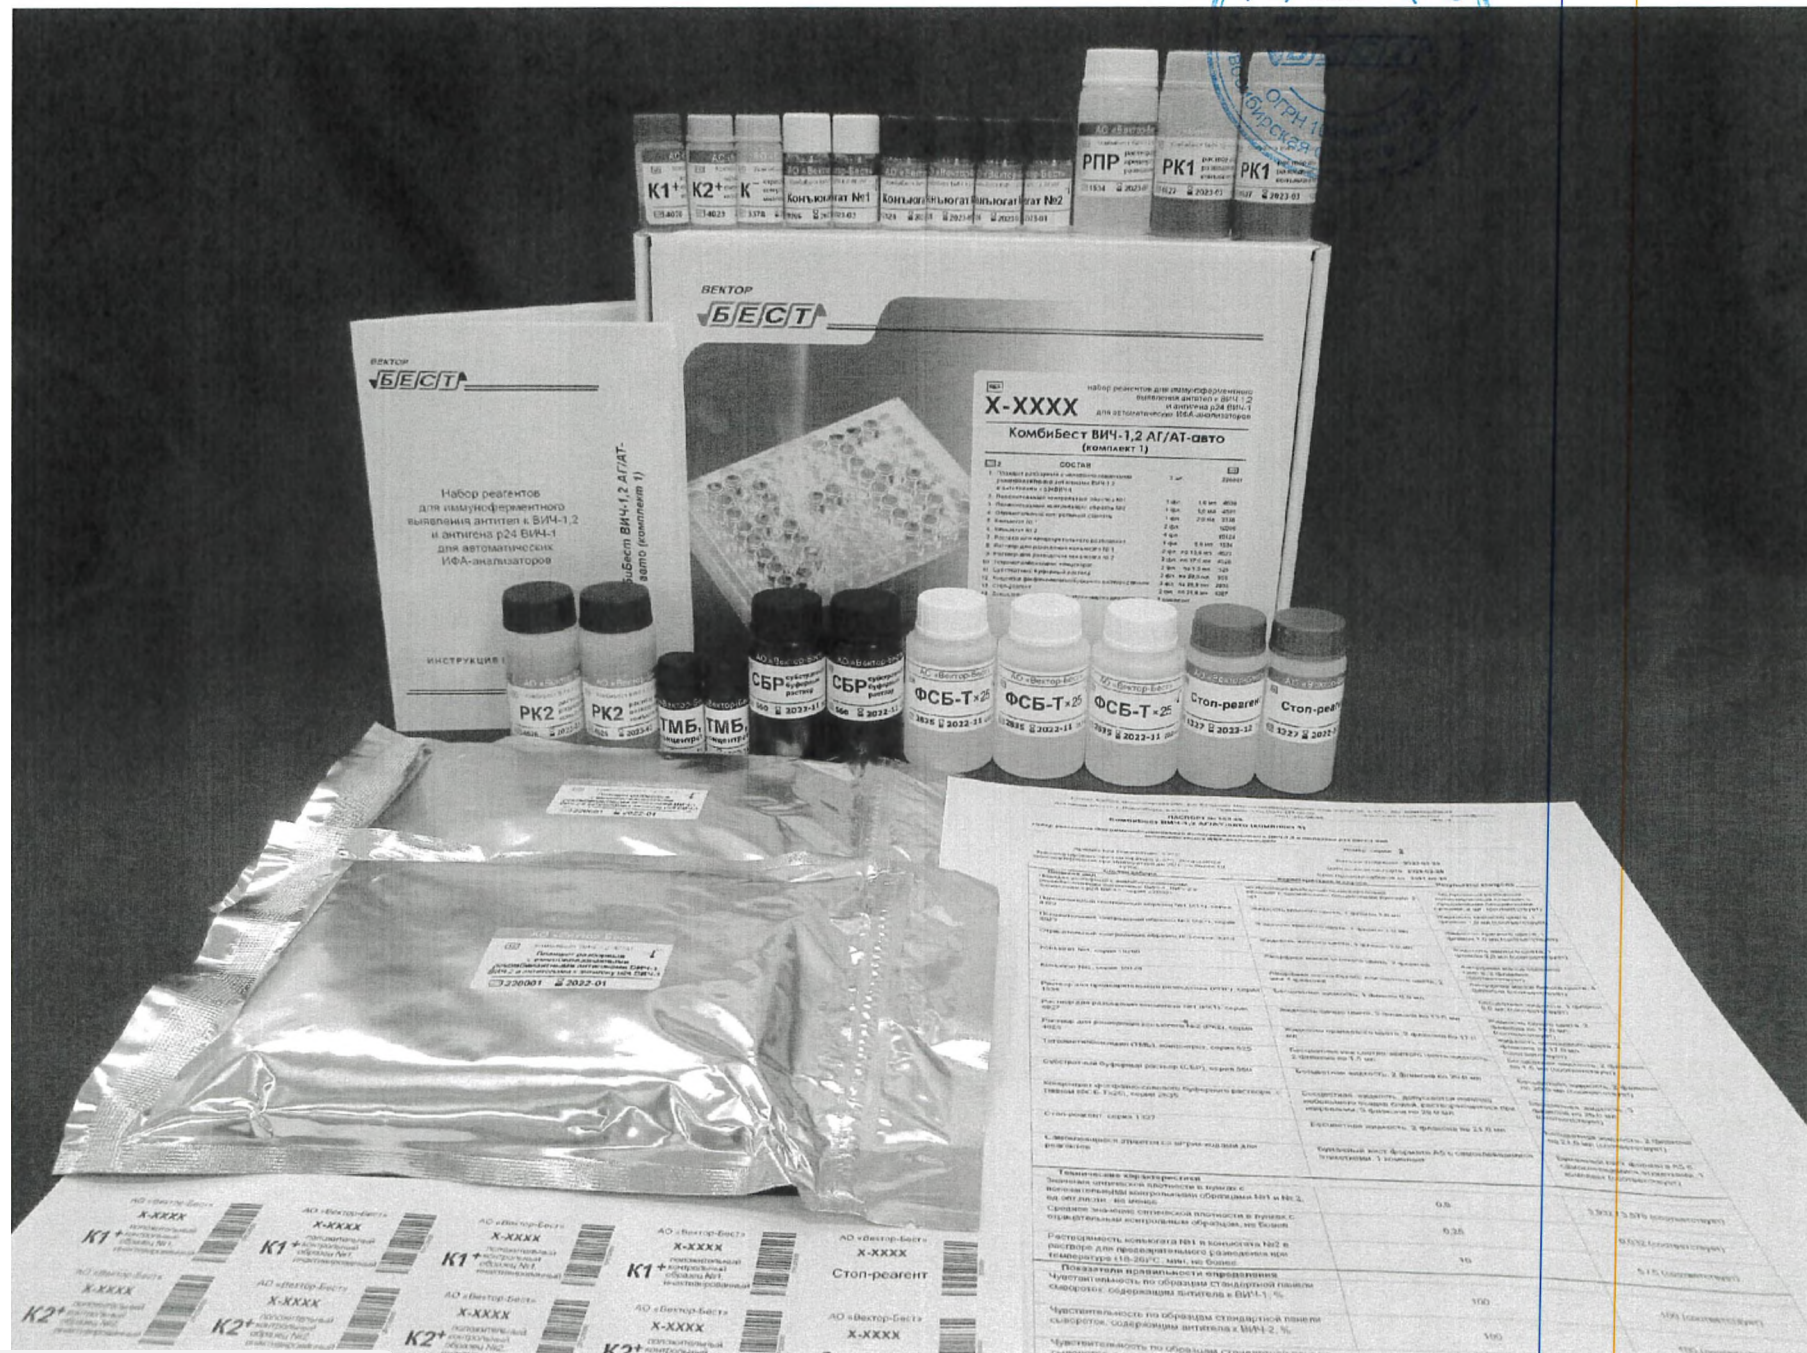


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №1
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"10" 03/ 2020 г.
М.П.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №2
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

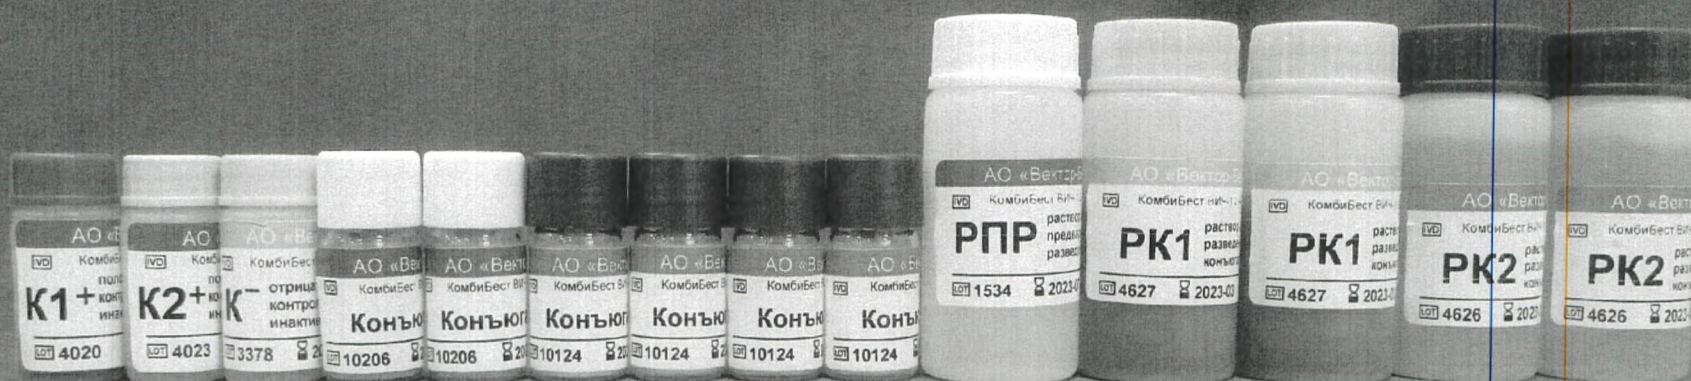

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №3
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“10” 09/2020 г.

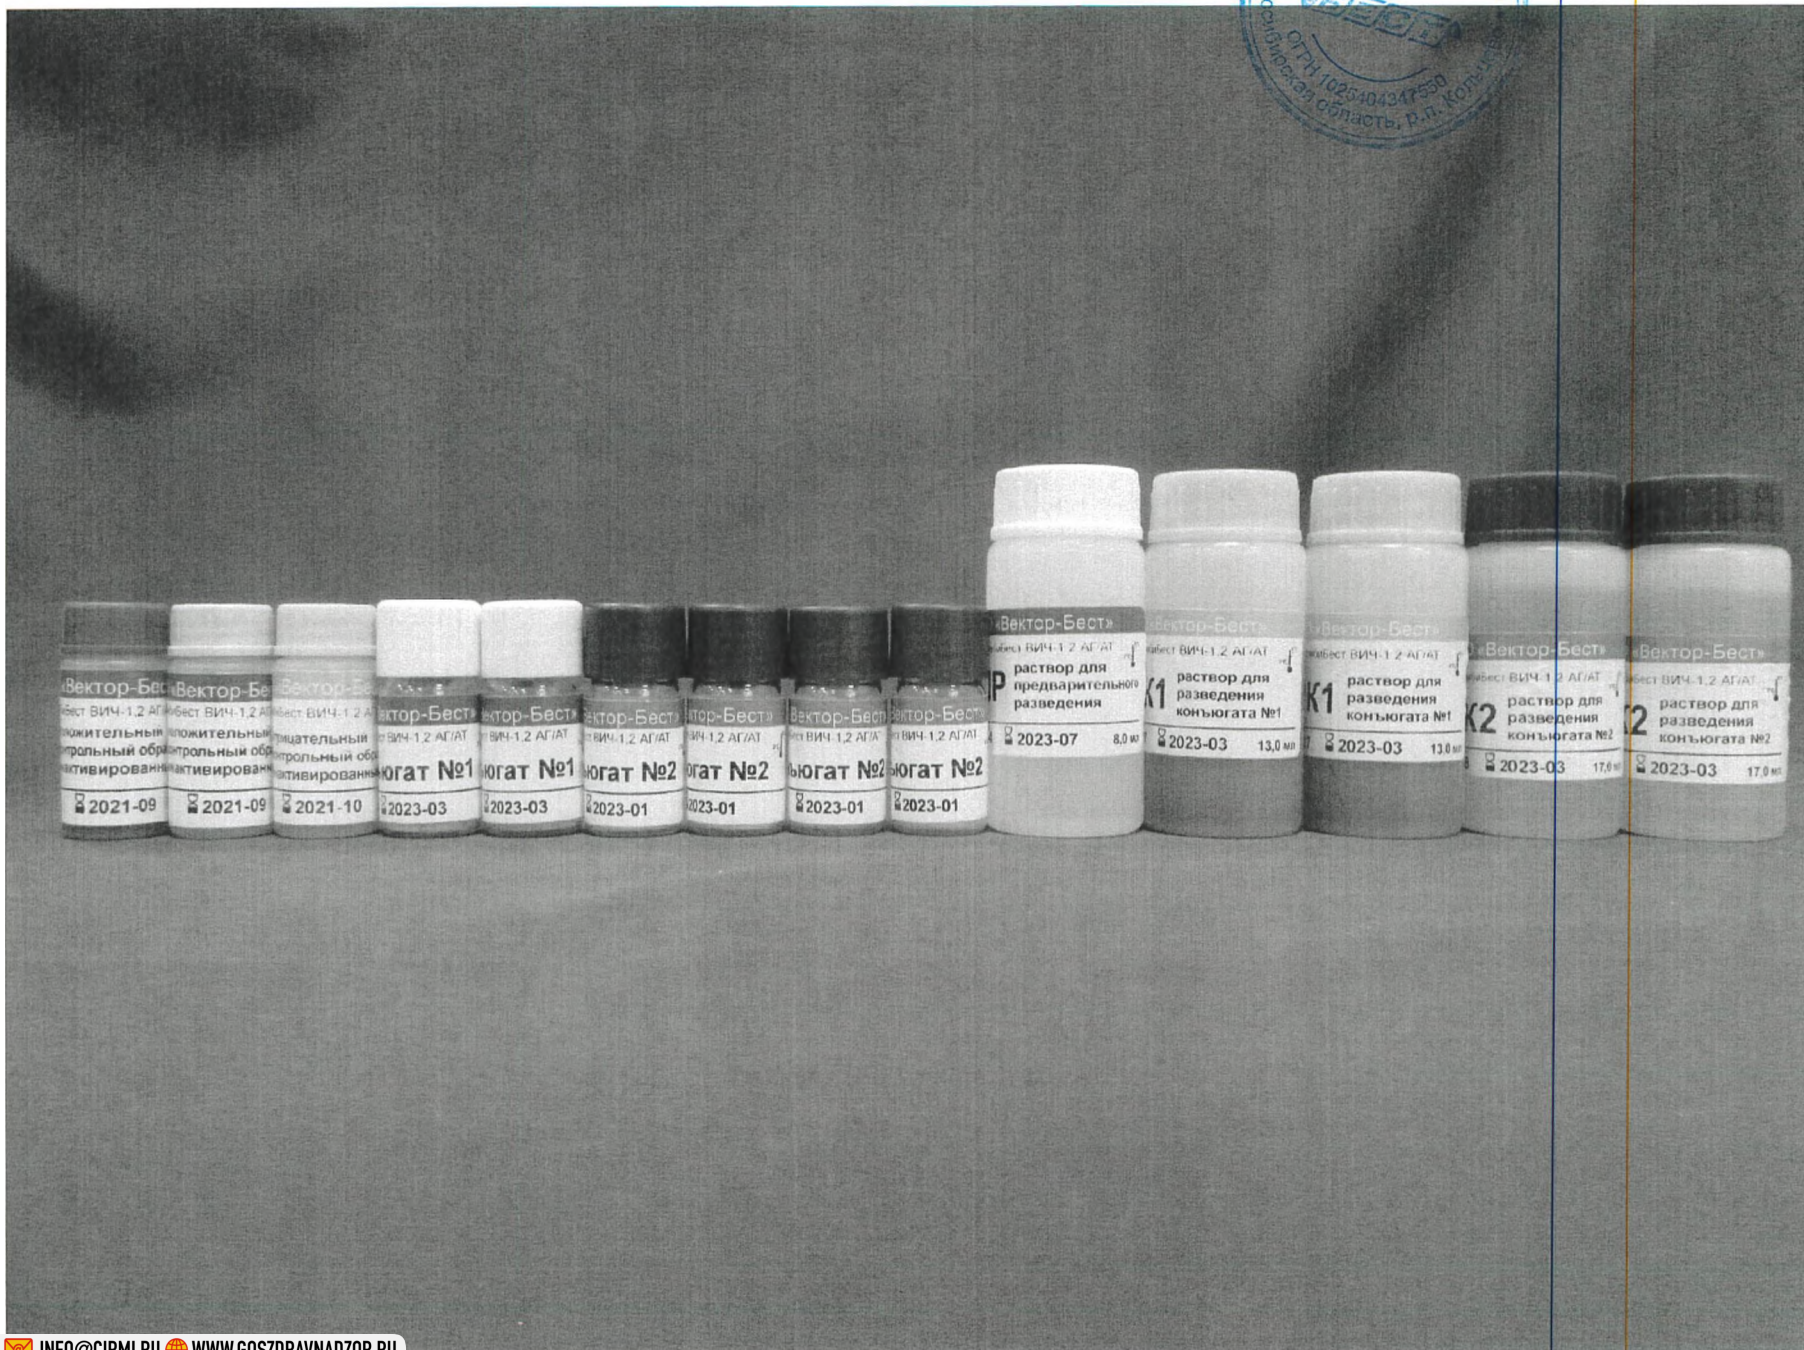

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №4
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №5
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 03 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №6
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“20” 03 2020 г.

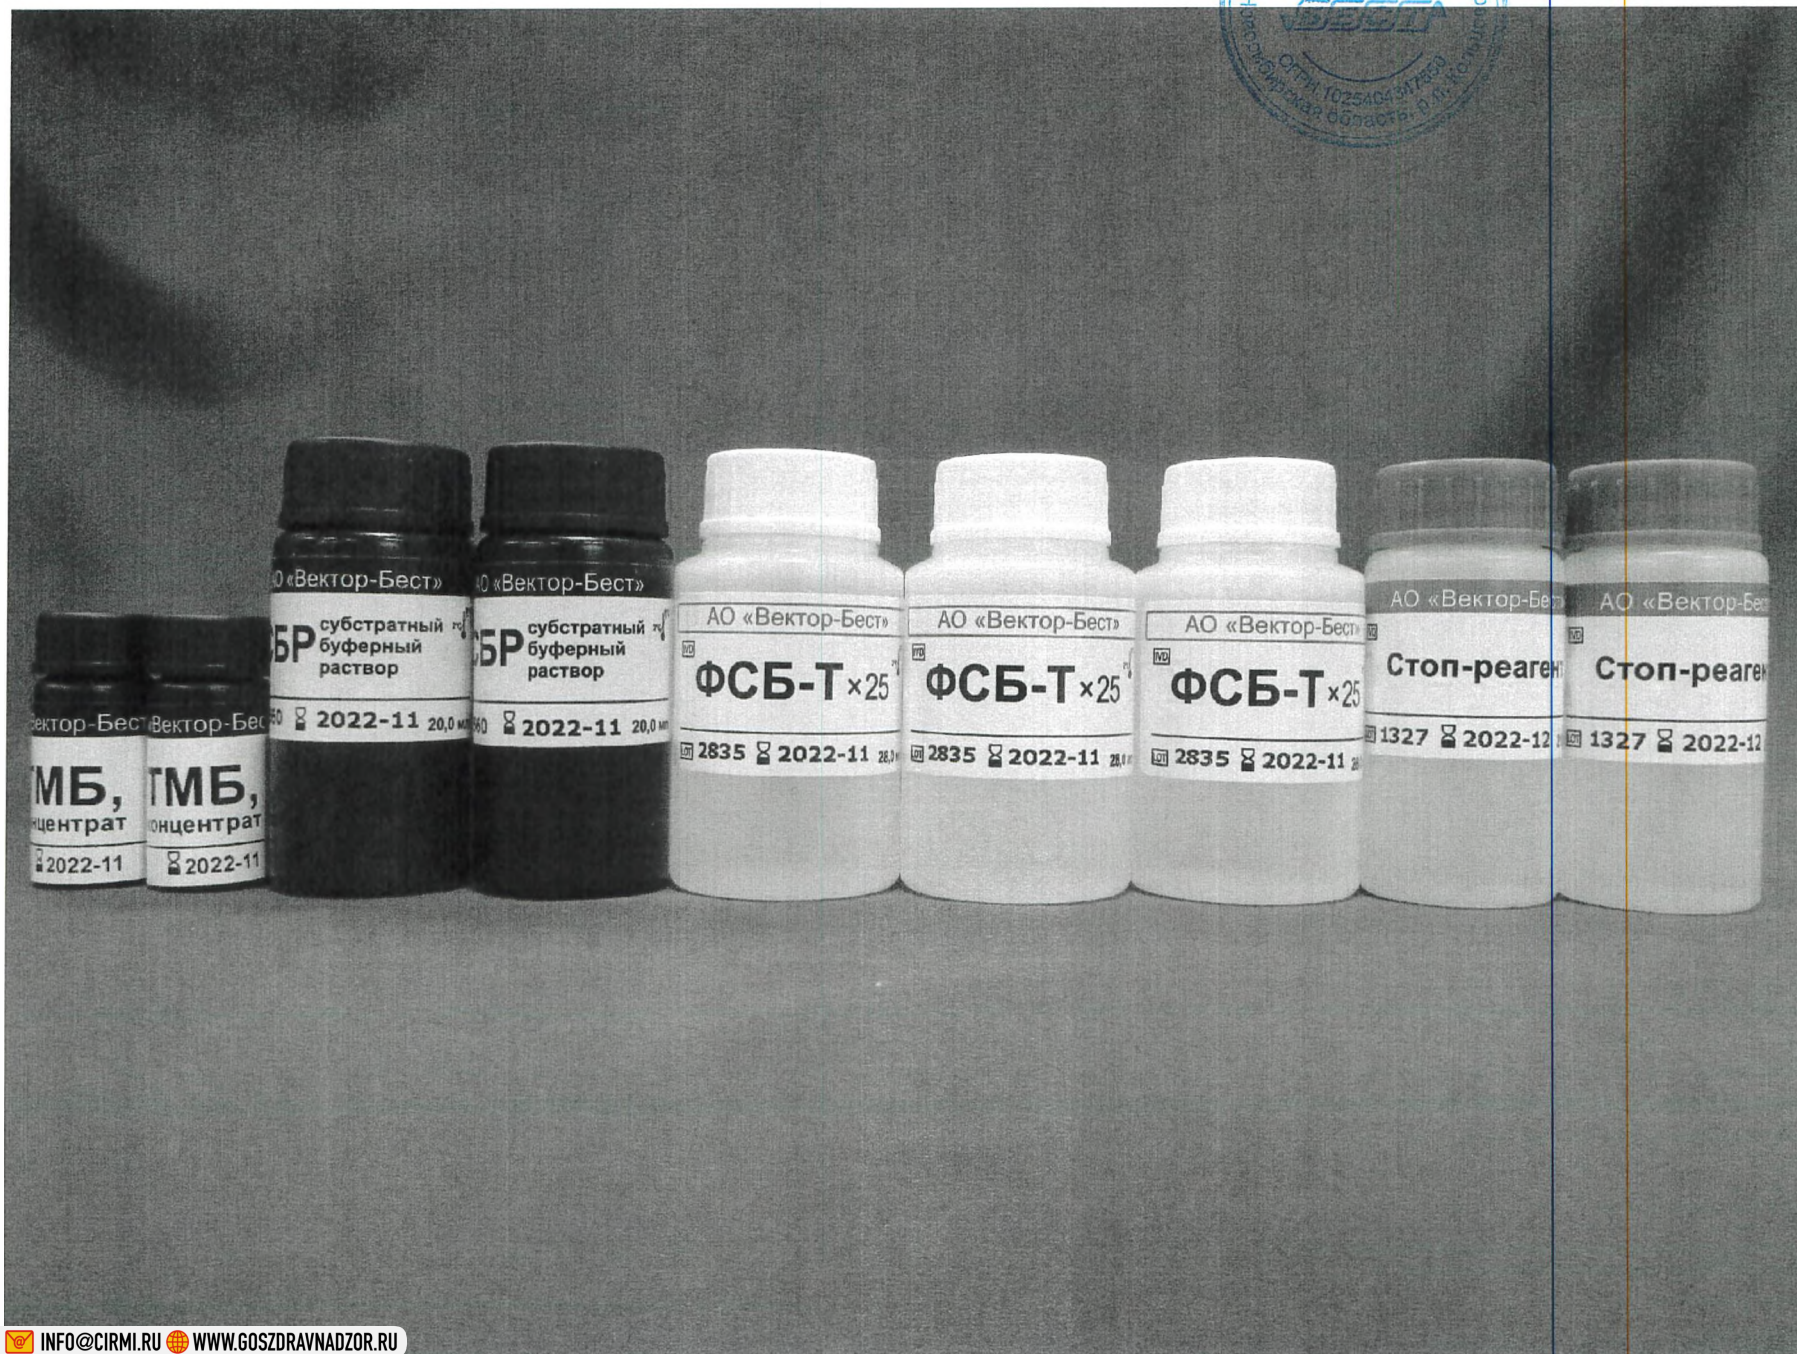

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто» №7
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2020 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №1
 комплект 1 серия 2



Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”


М.Д. Хусаинов
 2020 г.

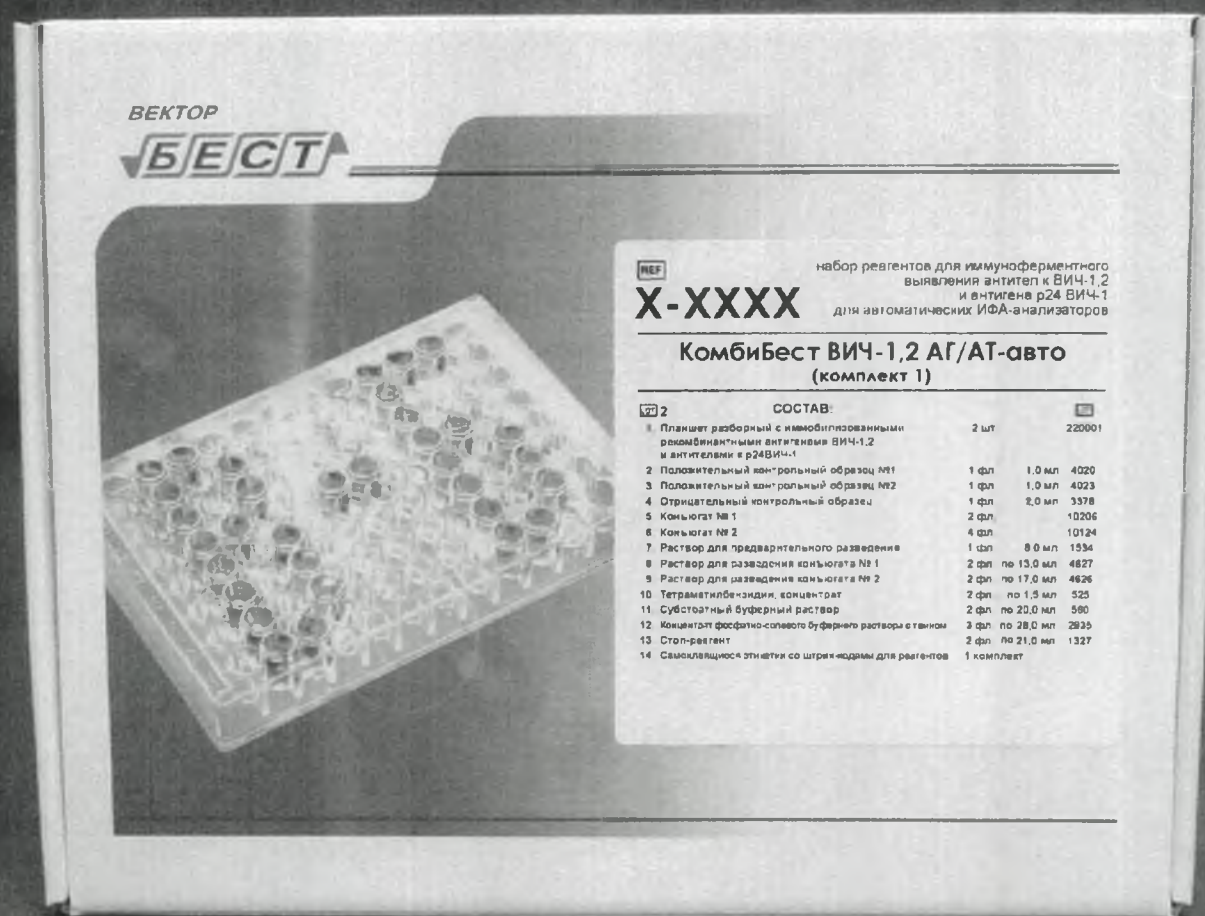


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" №2
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО "Бектор-Бест"
М.П.

М.Д. Хусаинов
2020 г.

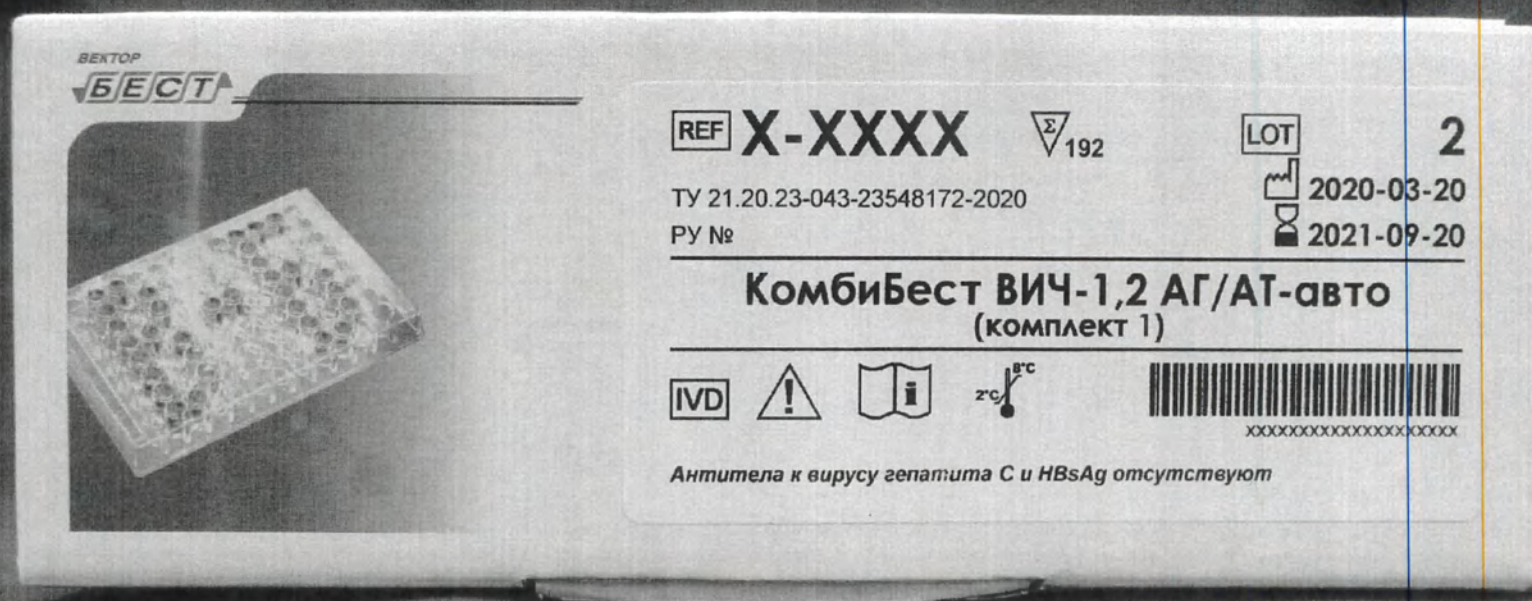

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” №3
комплект 1 серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“20” “03” 2020 г.
М.П. 



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто”
 комплект 2/Чароит серия 3


Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “20” 03/2020 г.

М.П.

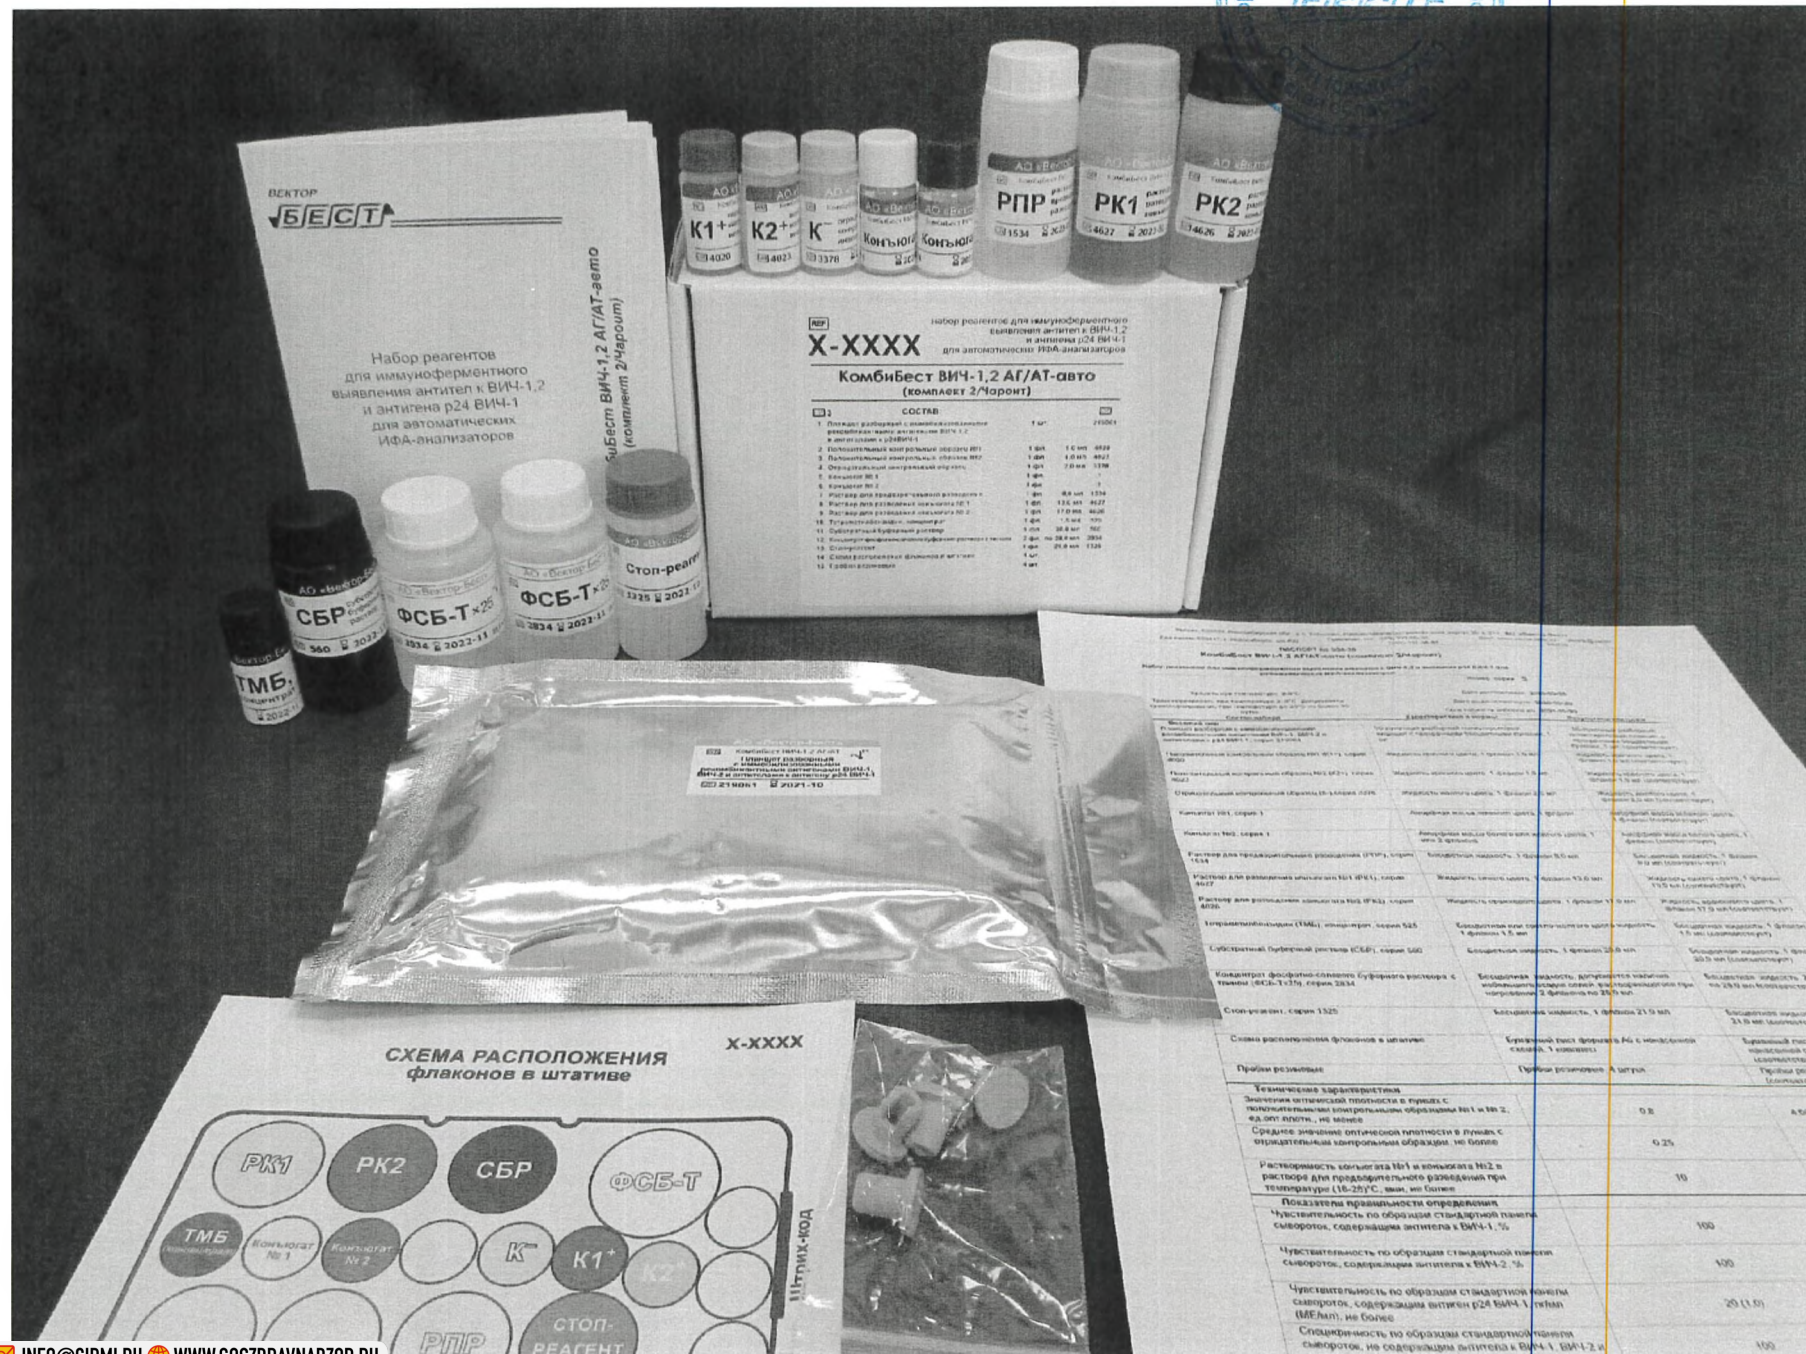

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 1
комплект 2/Чароит серия 3


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“20” 03/ 2020 г.
М.П.

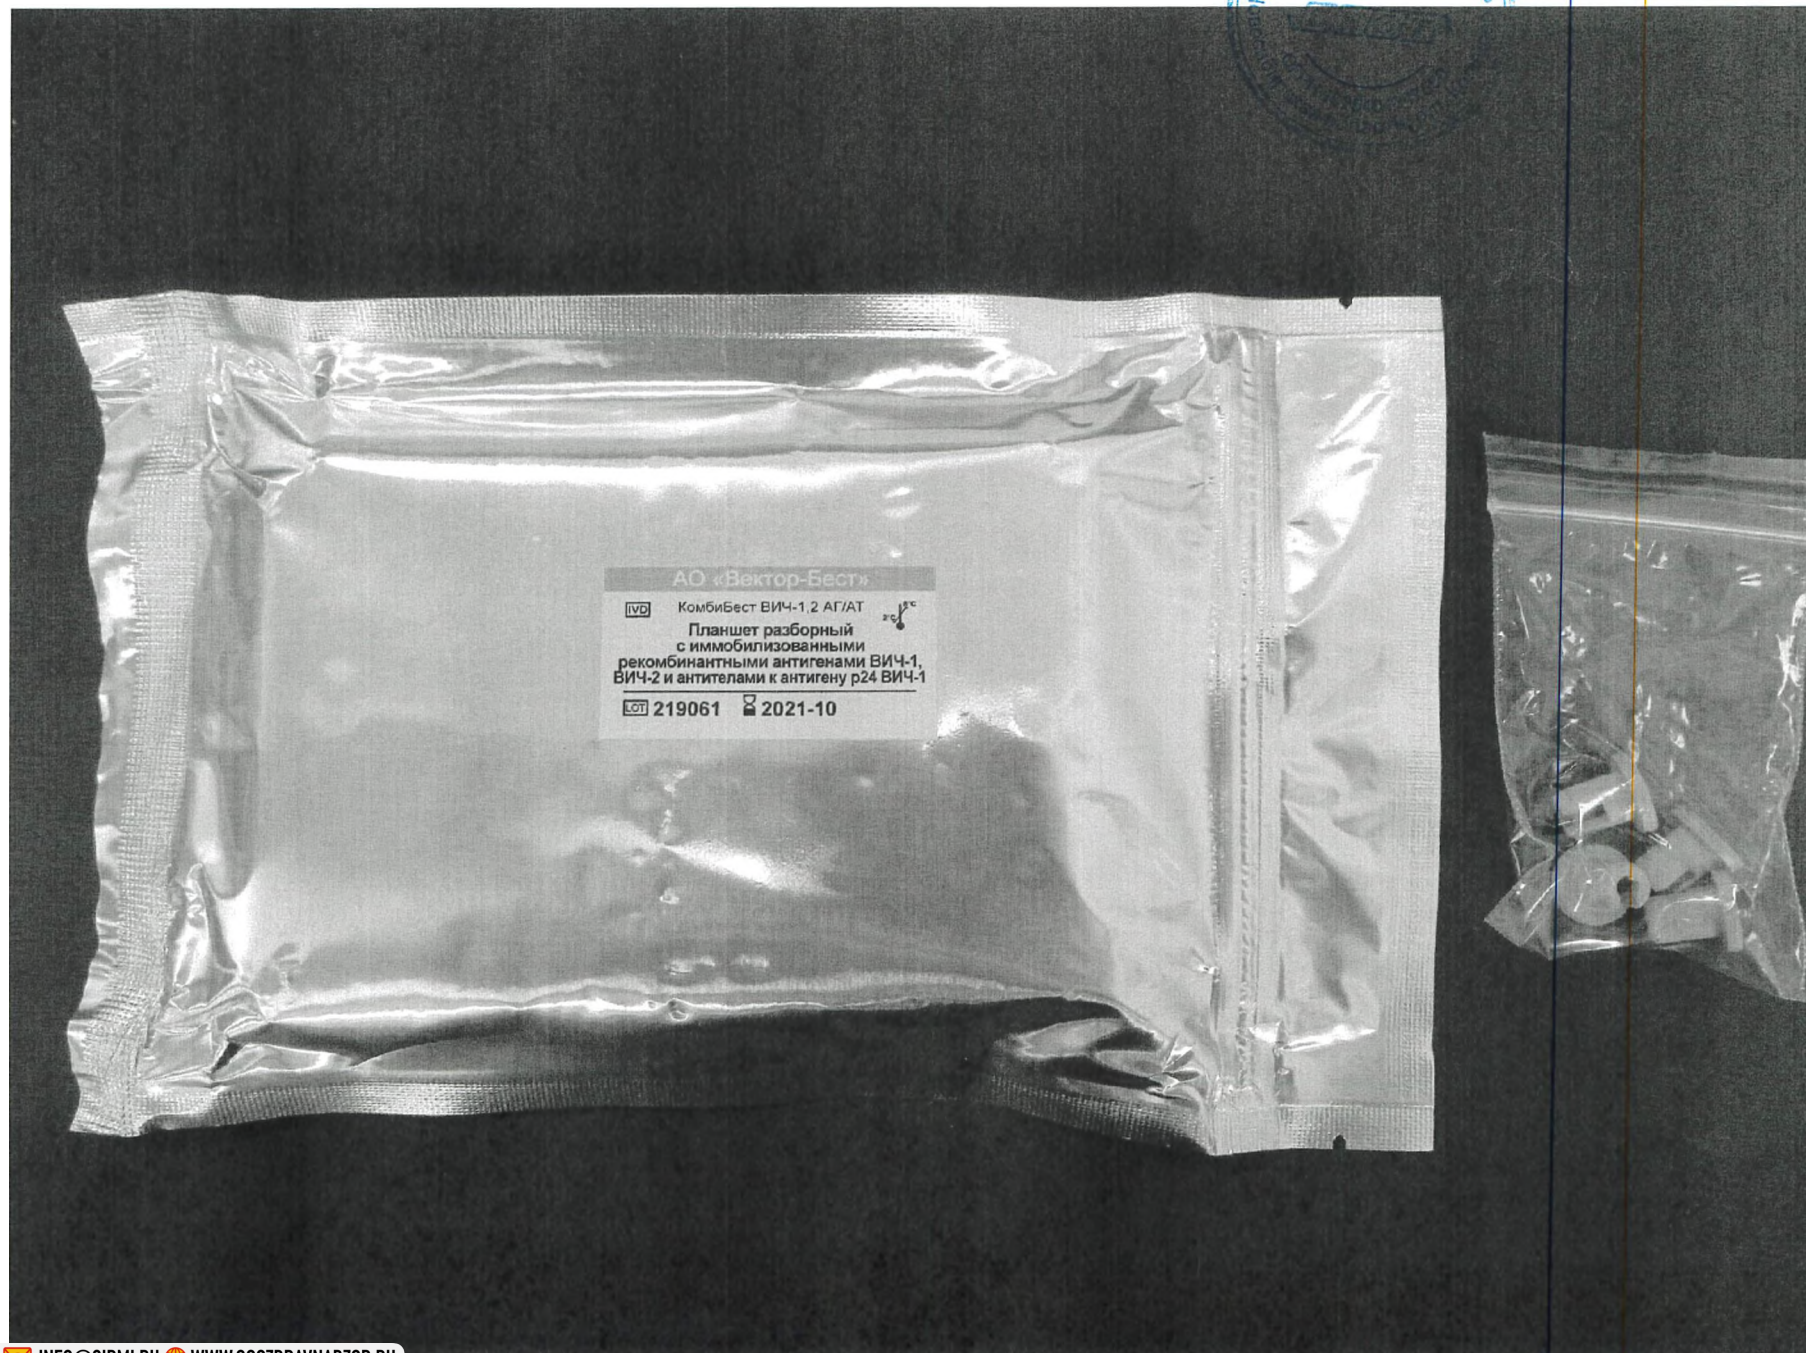

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 2
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"


М.Д. Хусаинов
2020 г.

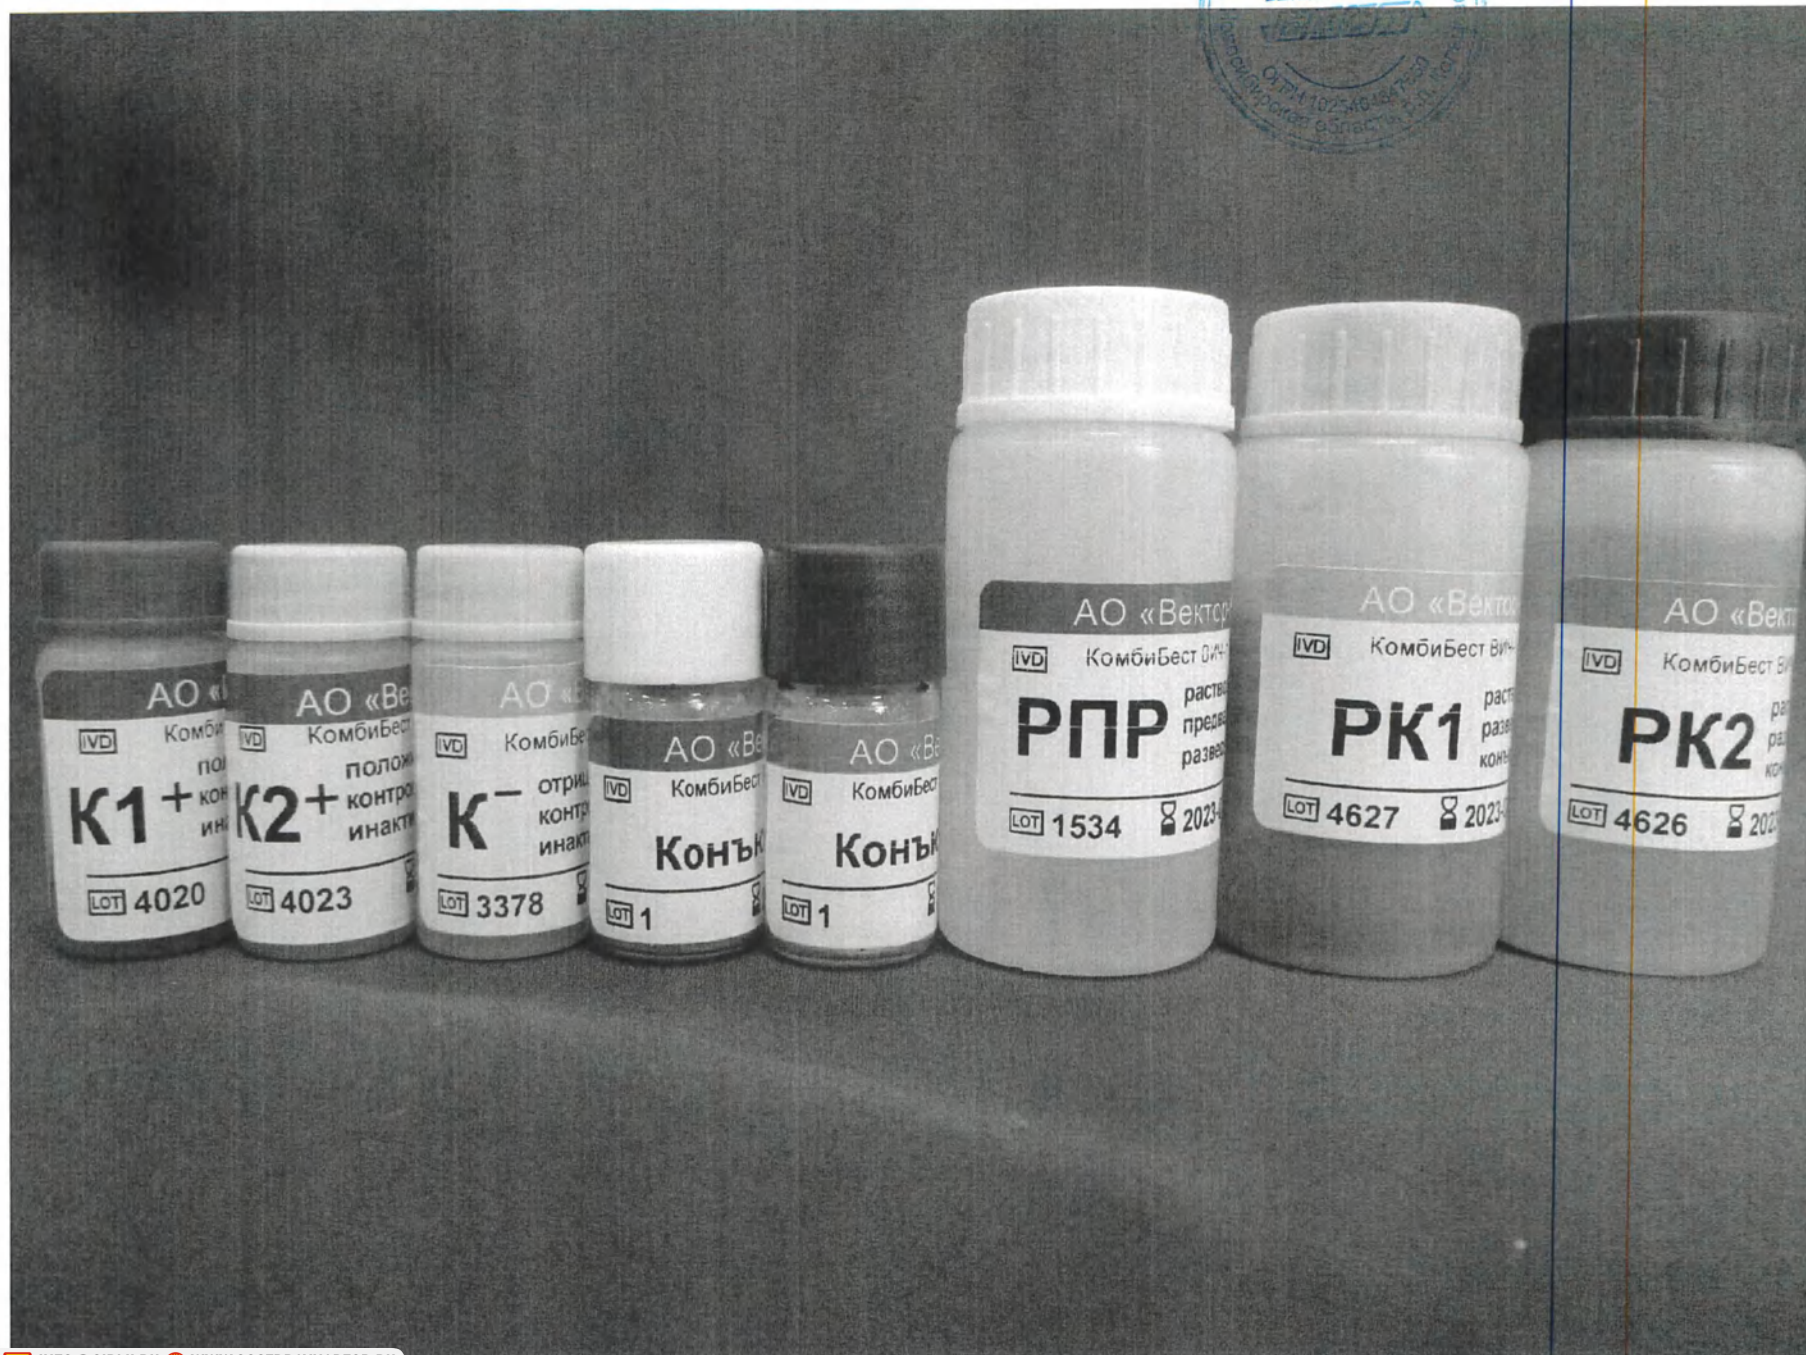

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 3
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2020 г.

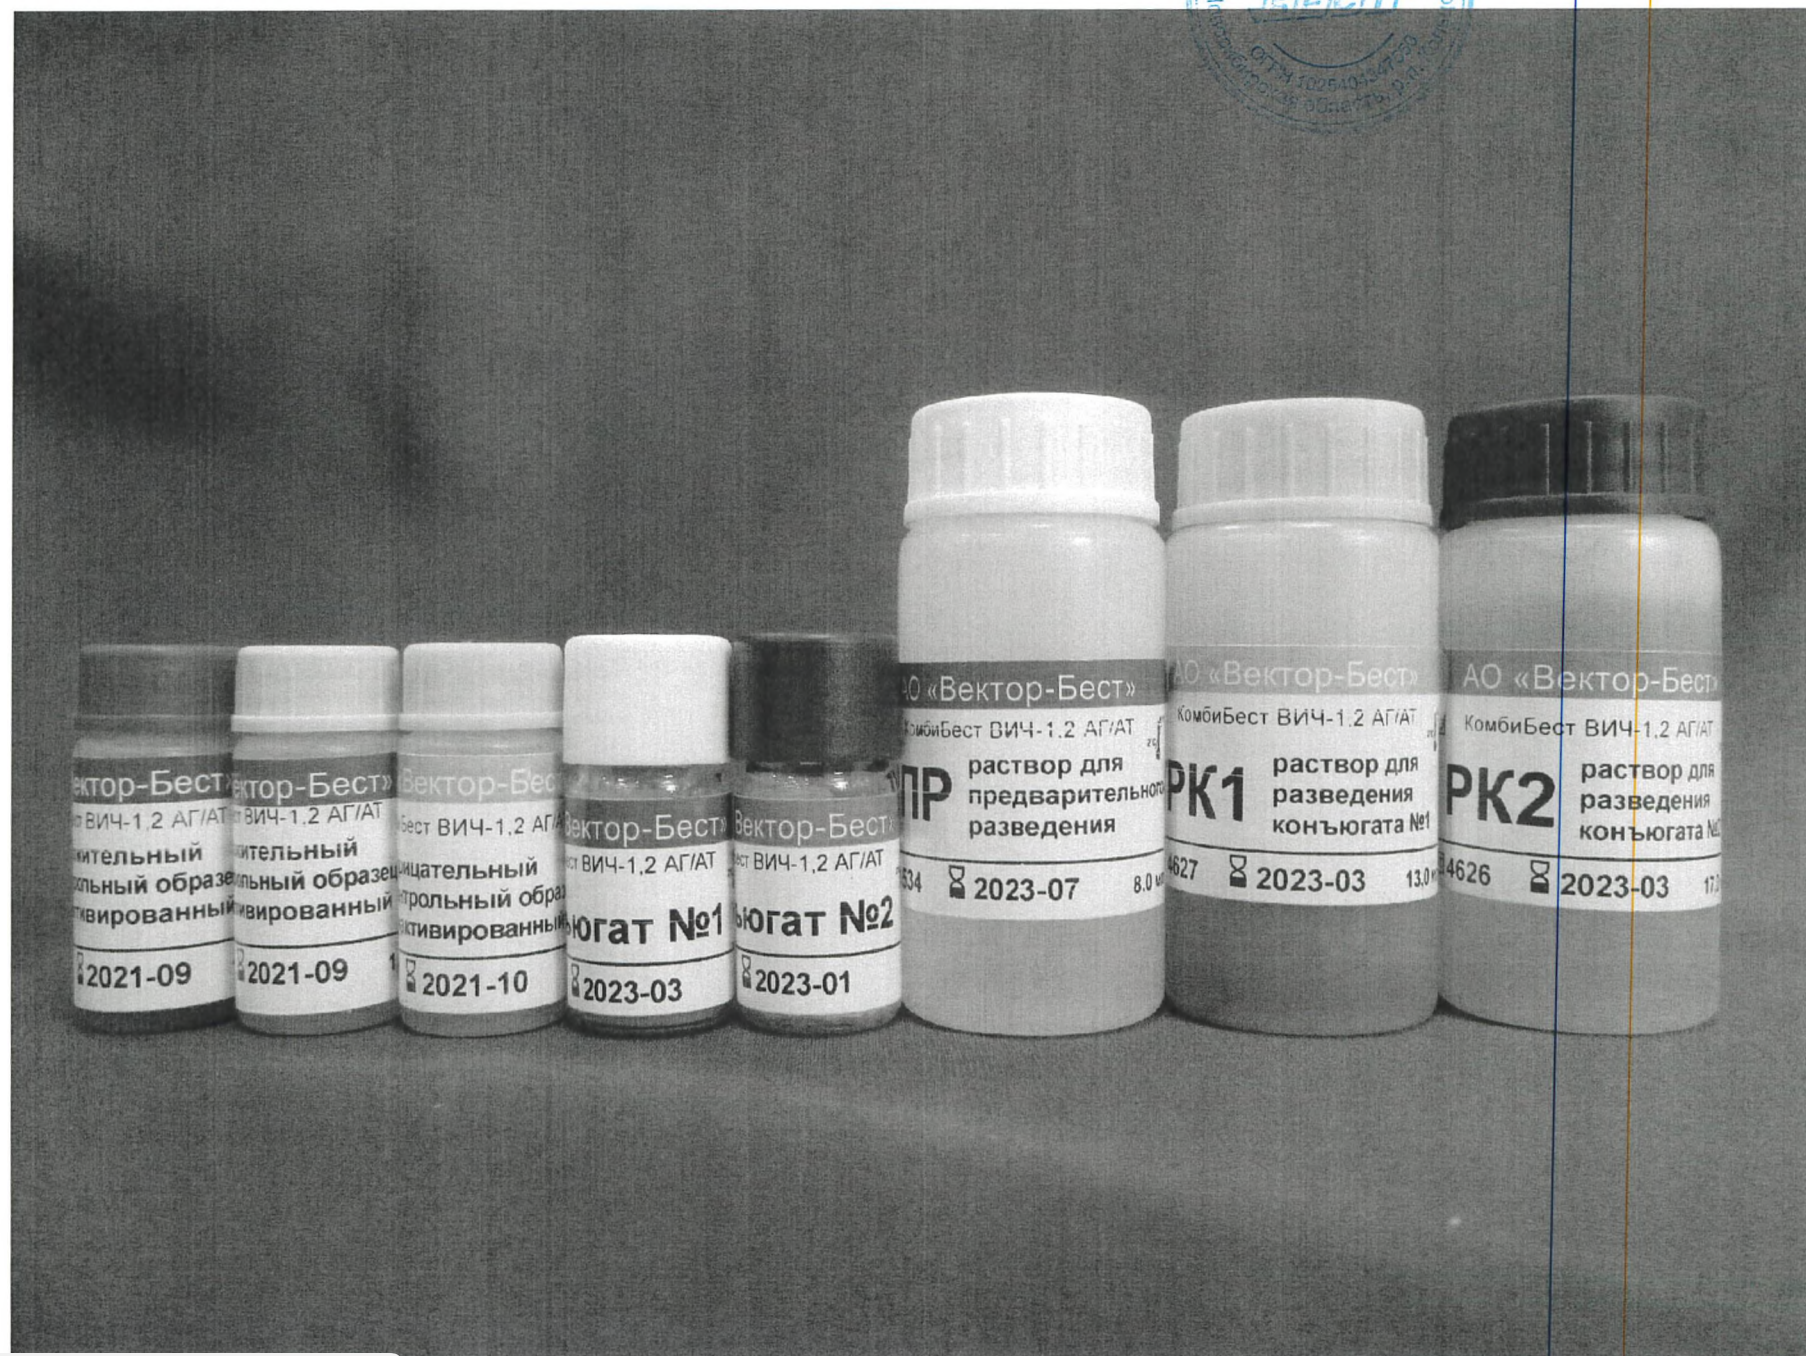

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 4
комплект 2/Чароит серия 3


Генеральный директор

АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов

2020 г.


М.П.

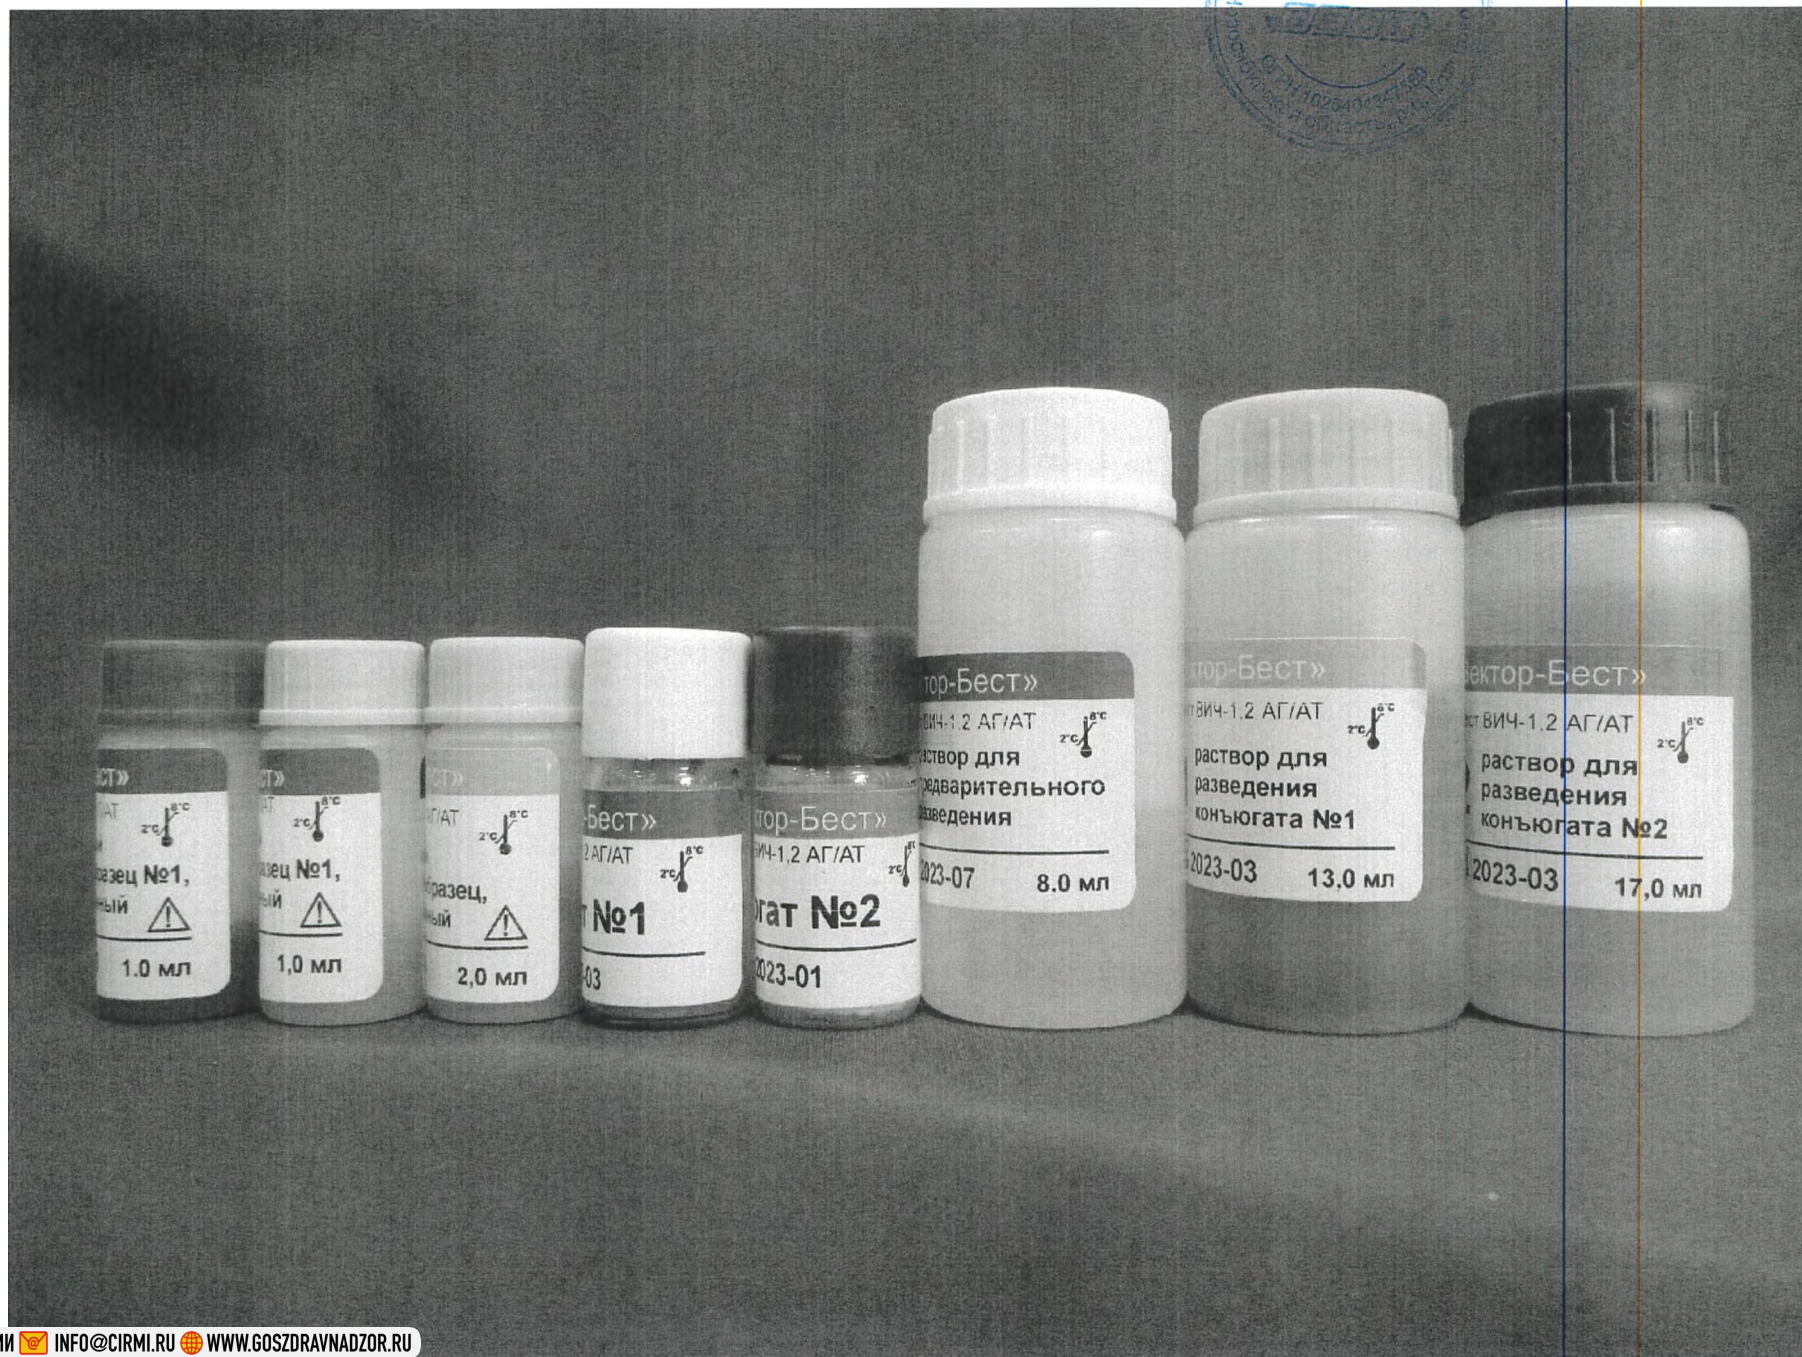

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 5
комплект 2/Чароит серия 3


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.

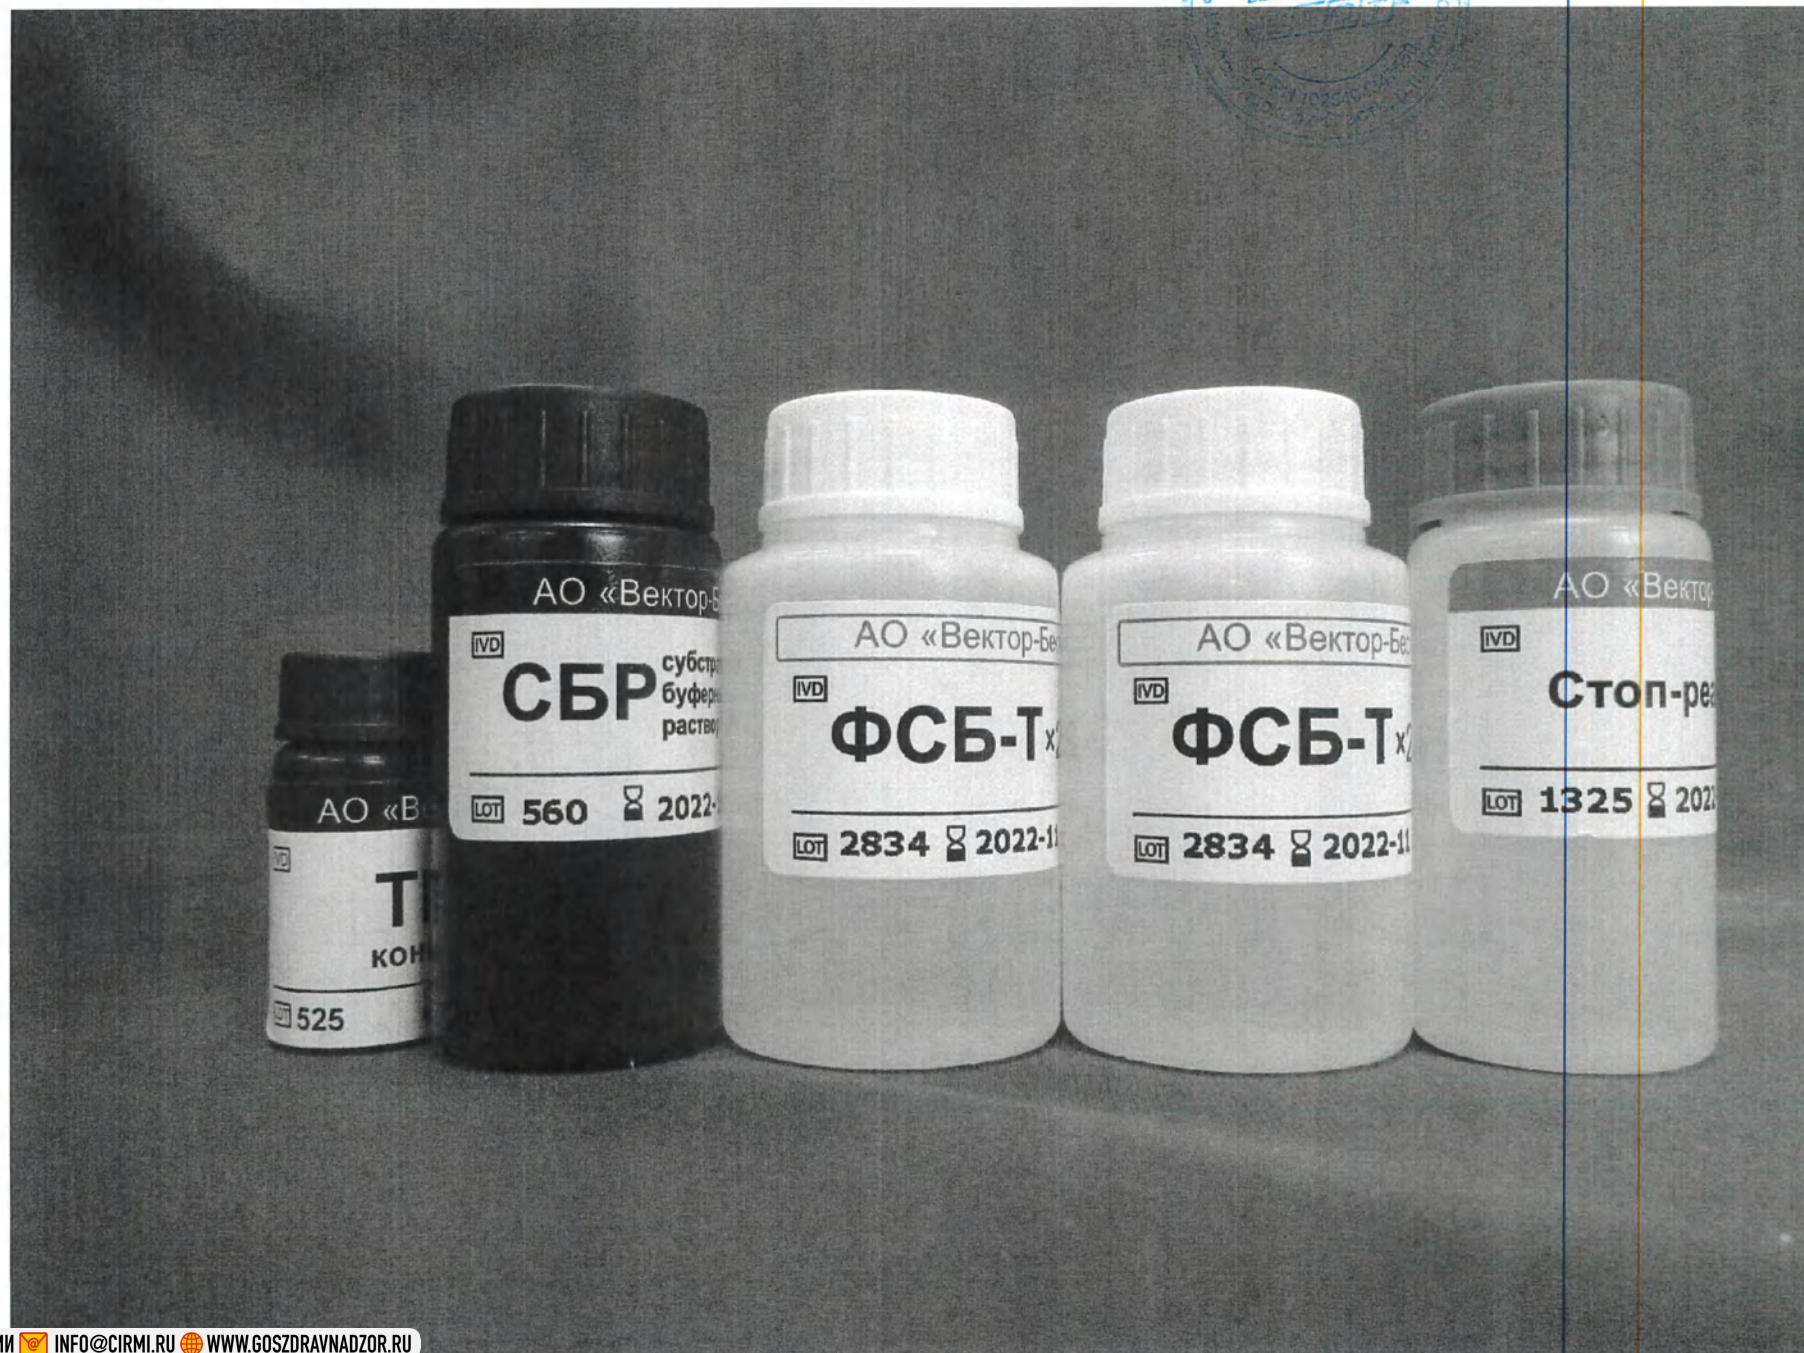


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 6
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” “20” М.Д. Хусаинов
2020 г.

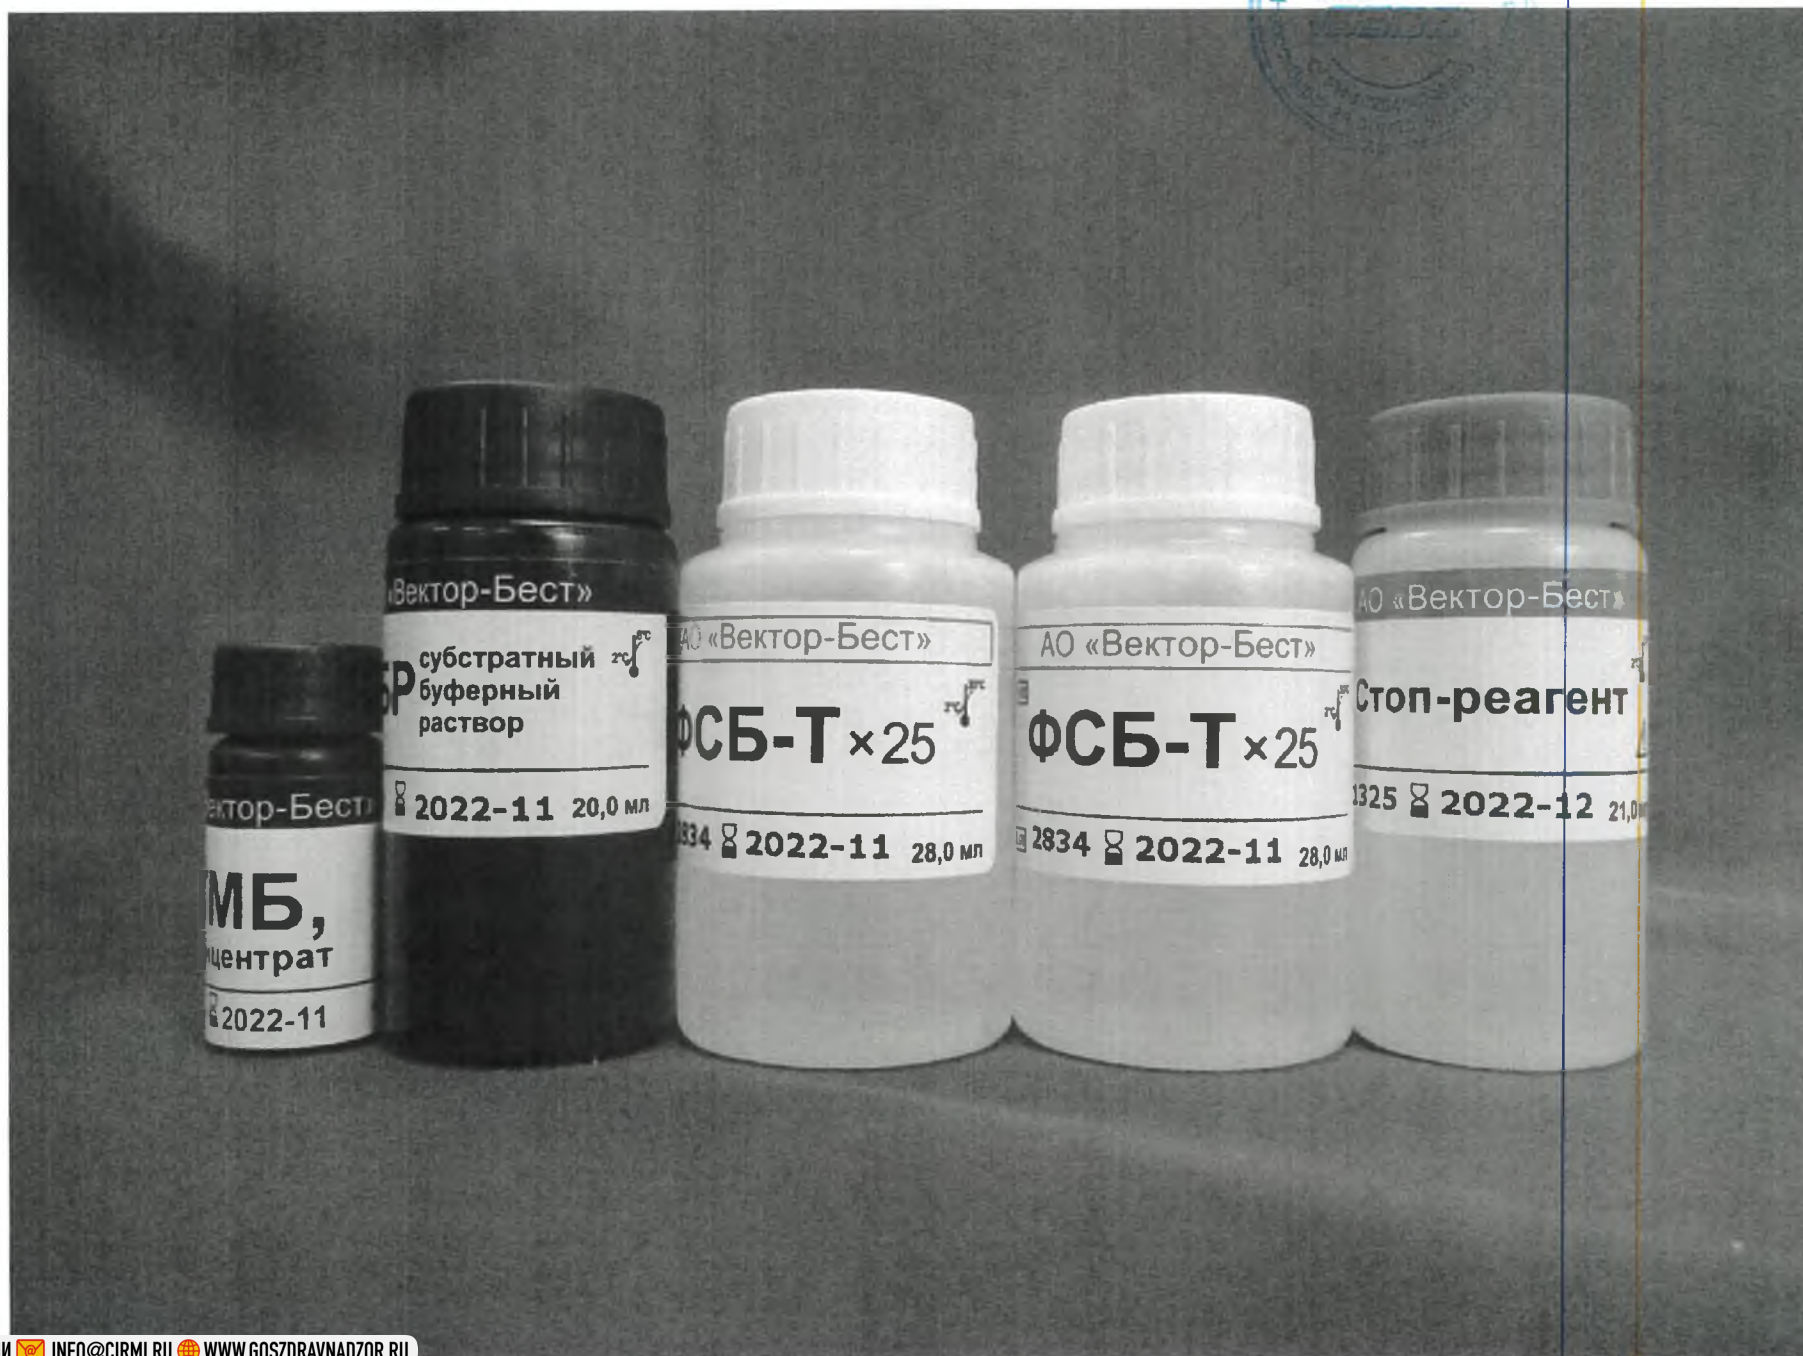

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 7
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 2020 г.

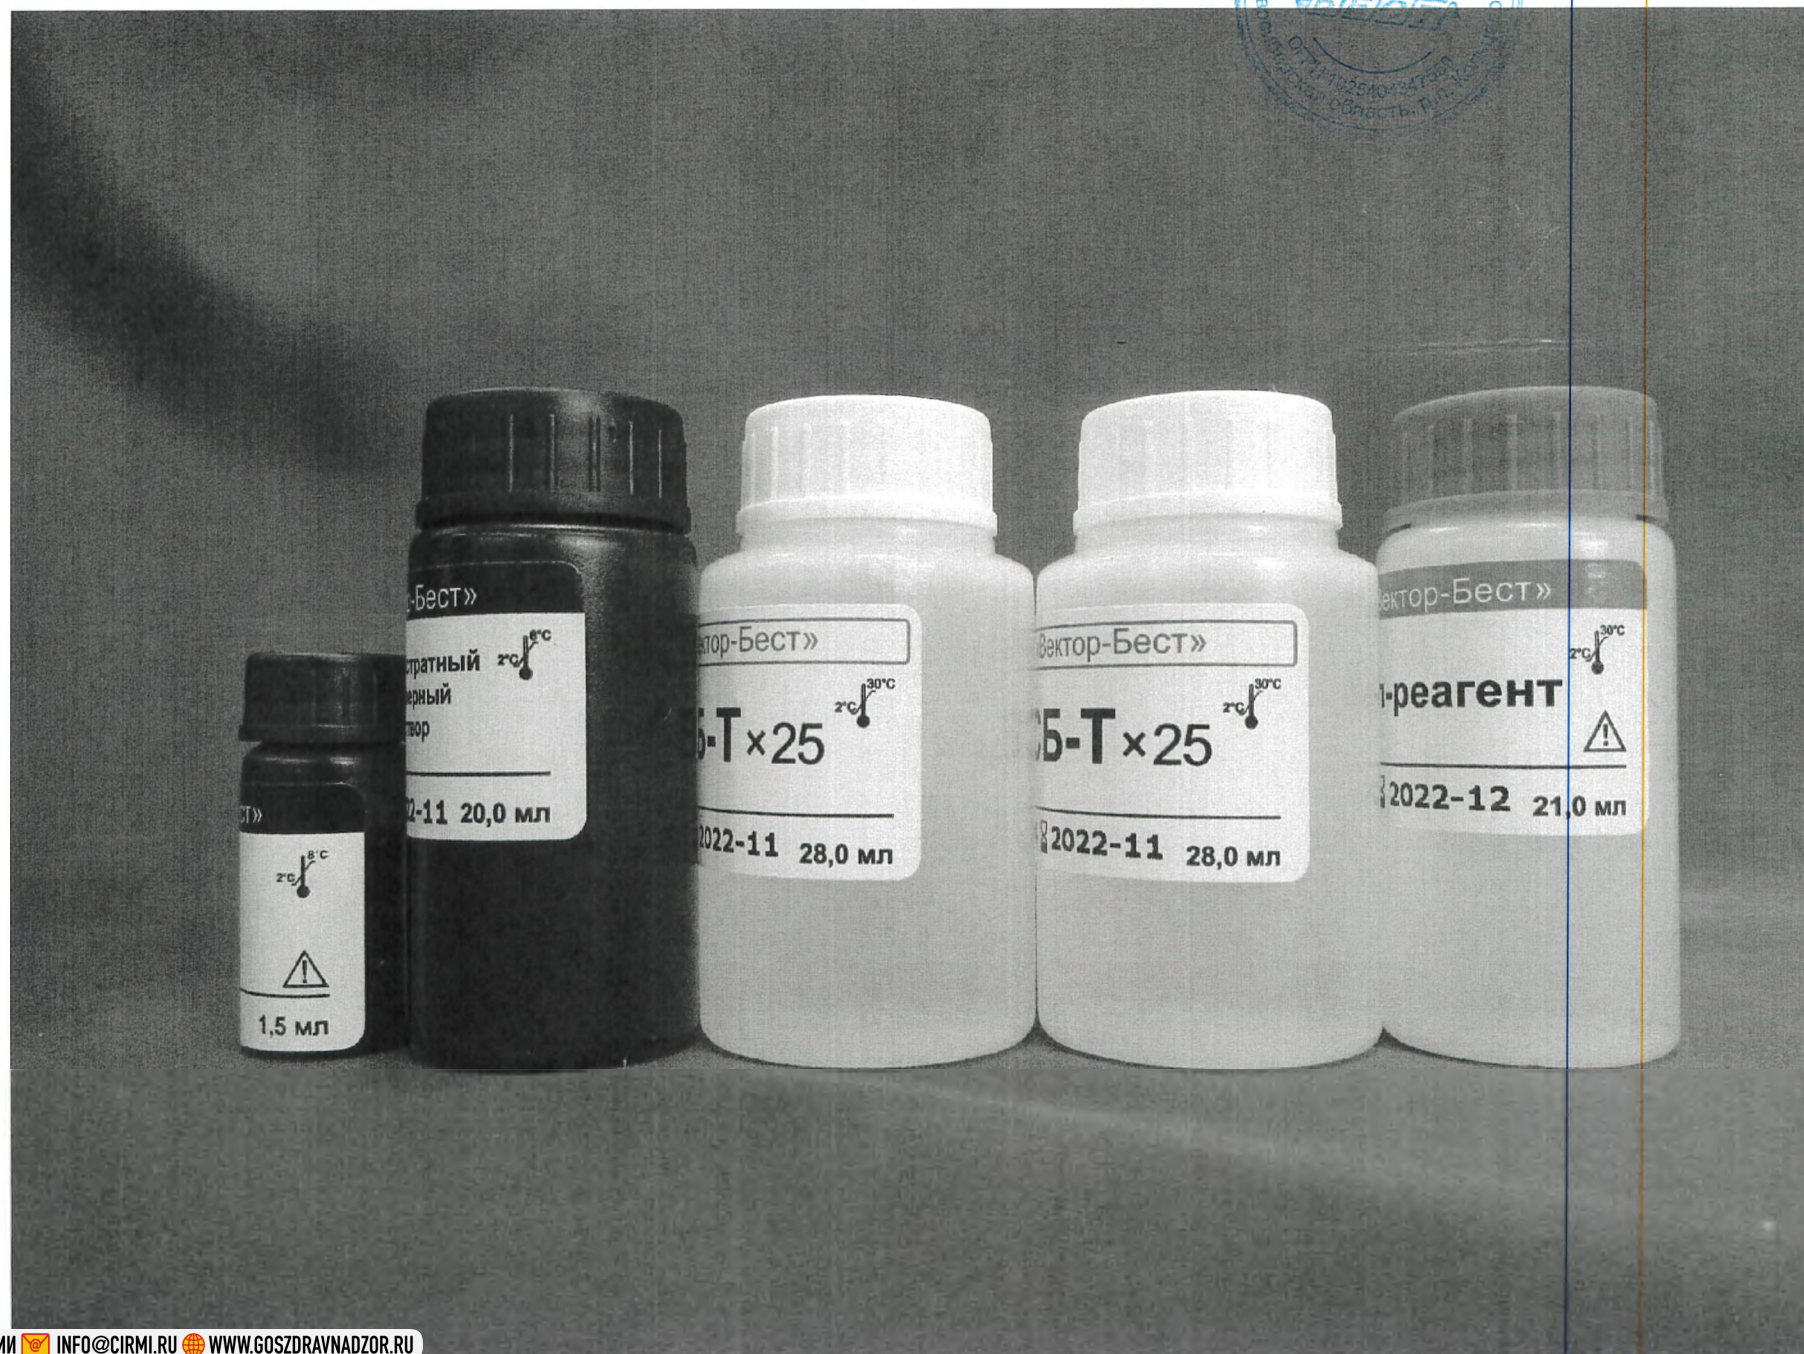



М.П.

REF

X-XXXX

набор реагентов для иммуноферментного
выявления антител к ВИЧ-1,2
и антигена р24 ВИЧ-1
для автоматических ИФА-анализаторов

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто
(комплект 2/Чароит)

LOT 3

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24ВИЧ-1	1 шт.	219061
2. Положительный контрольный образец №1	1 фл.	1,0 мл 4020
3. Положительный контрольный образец №2	1 фл.	1,0 мл 4023
4. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	2,0 мл 3378
5. Конъюгат № 1	1 фл.	1
6. Конъюгат № 2	1 фл.	1
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл.	8,0 мл 1534
8. Раствор для разведения конъюгата № 1	1 фл.	13,0 мл 4627
9. Раствор для разведения конъюгата № 2	1 фл.	17,0 мл 4626
10. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	1,5 мл 525
11. Субстратный буферный раствор	1 фл.	20,0 мл 560
12. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2834
13. Стоп-реагент	1 фл.	21,0 мл 1325
14. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.	
15. Пробки резиновые	4 шт.	

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 2
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" "03" 2020 г.
М.П.

REF **X-XXXX** Σ 96 LOT **3**
ТУ 21.20.23-043-23548172-2020 2020-03-20
РУ № 2021-09-20


КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто
(комплект 2/Чароит)

IVD ! i 2°C 8°C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 3
комплект 2/Чароит серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“20” “08” 2020 г.
М.П. 



АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru


www.vector-best.ru


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто”
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ М.Д. Хусаинов
«20» _____ 2020 г.

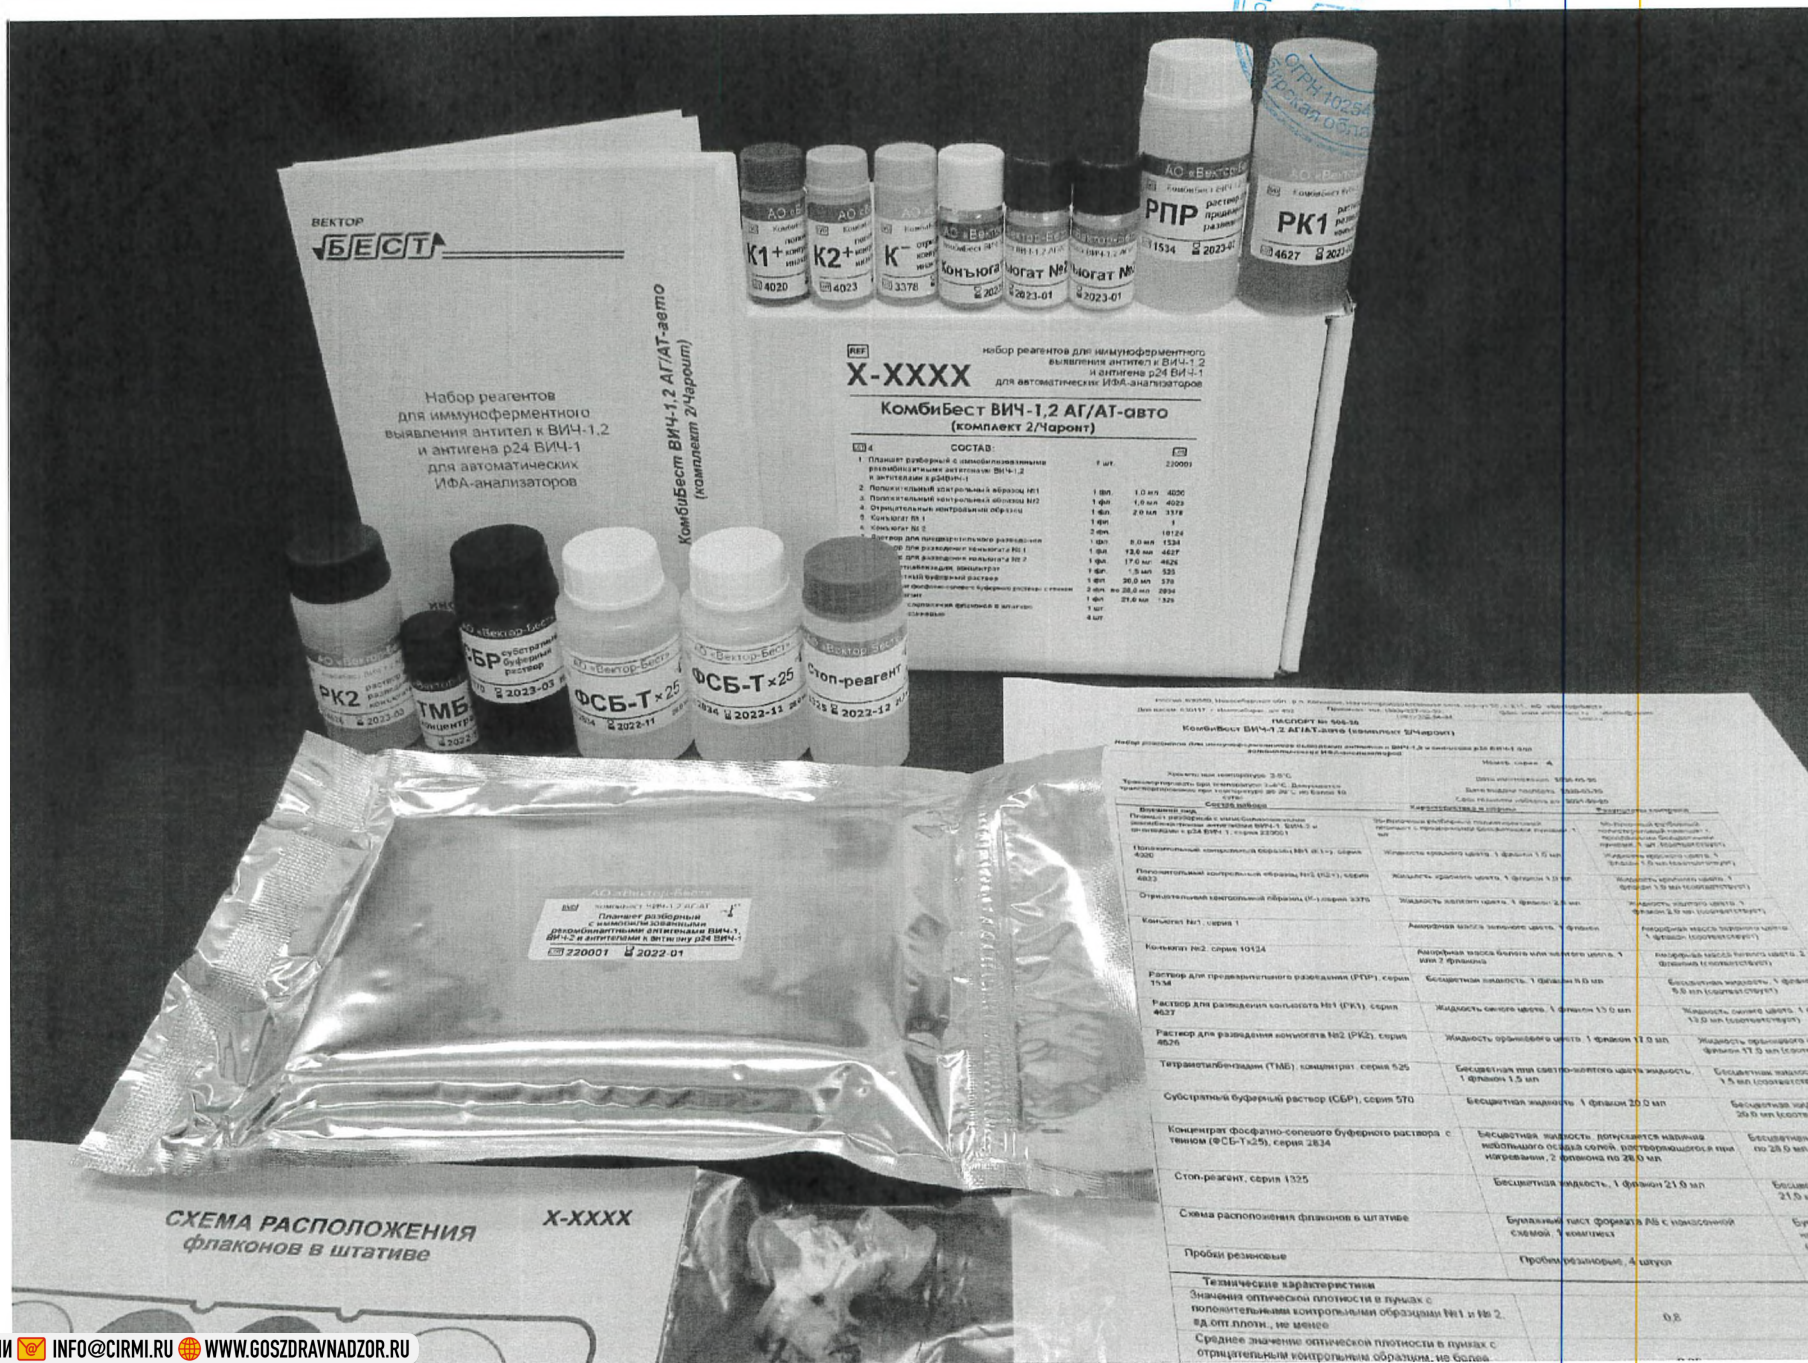


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 1
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“20” 03 2020 г.
М.П.

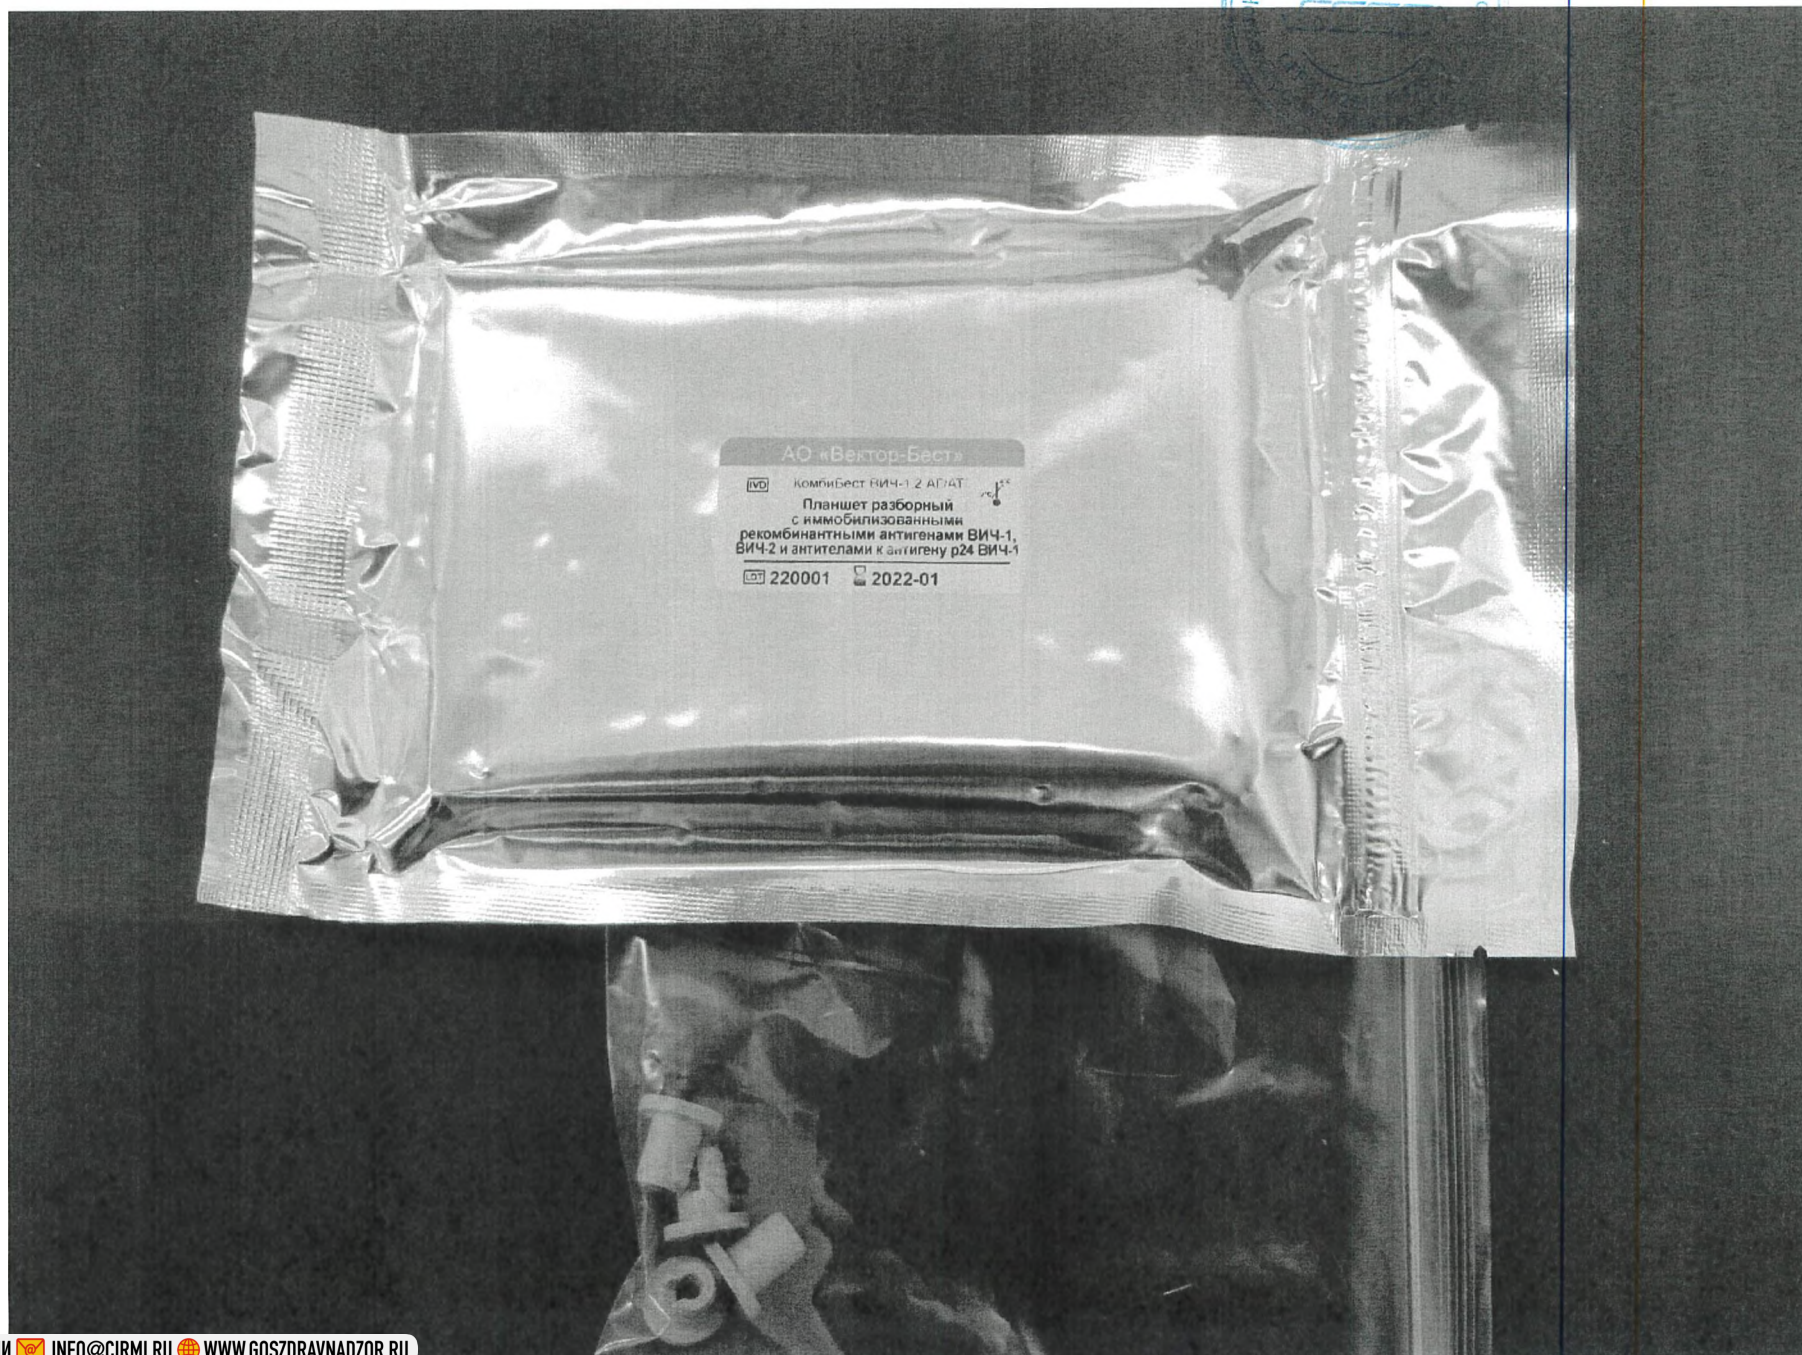


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 2
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“20” 03 2020 г.
М.П.

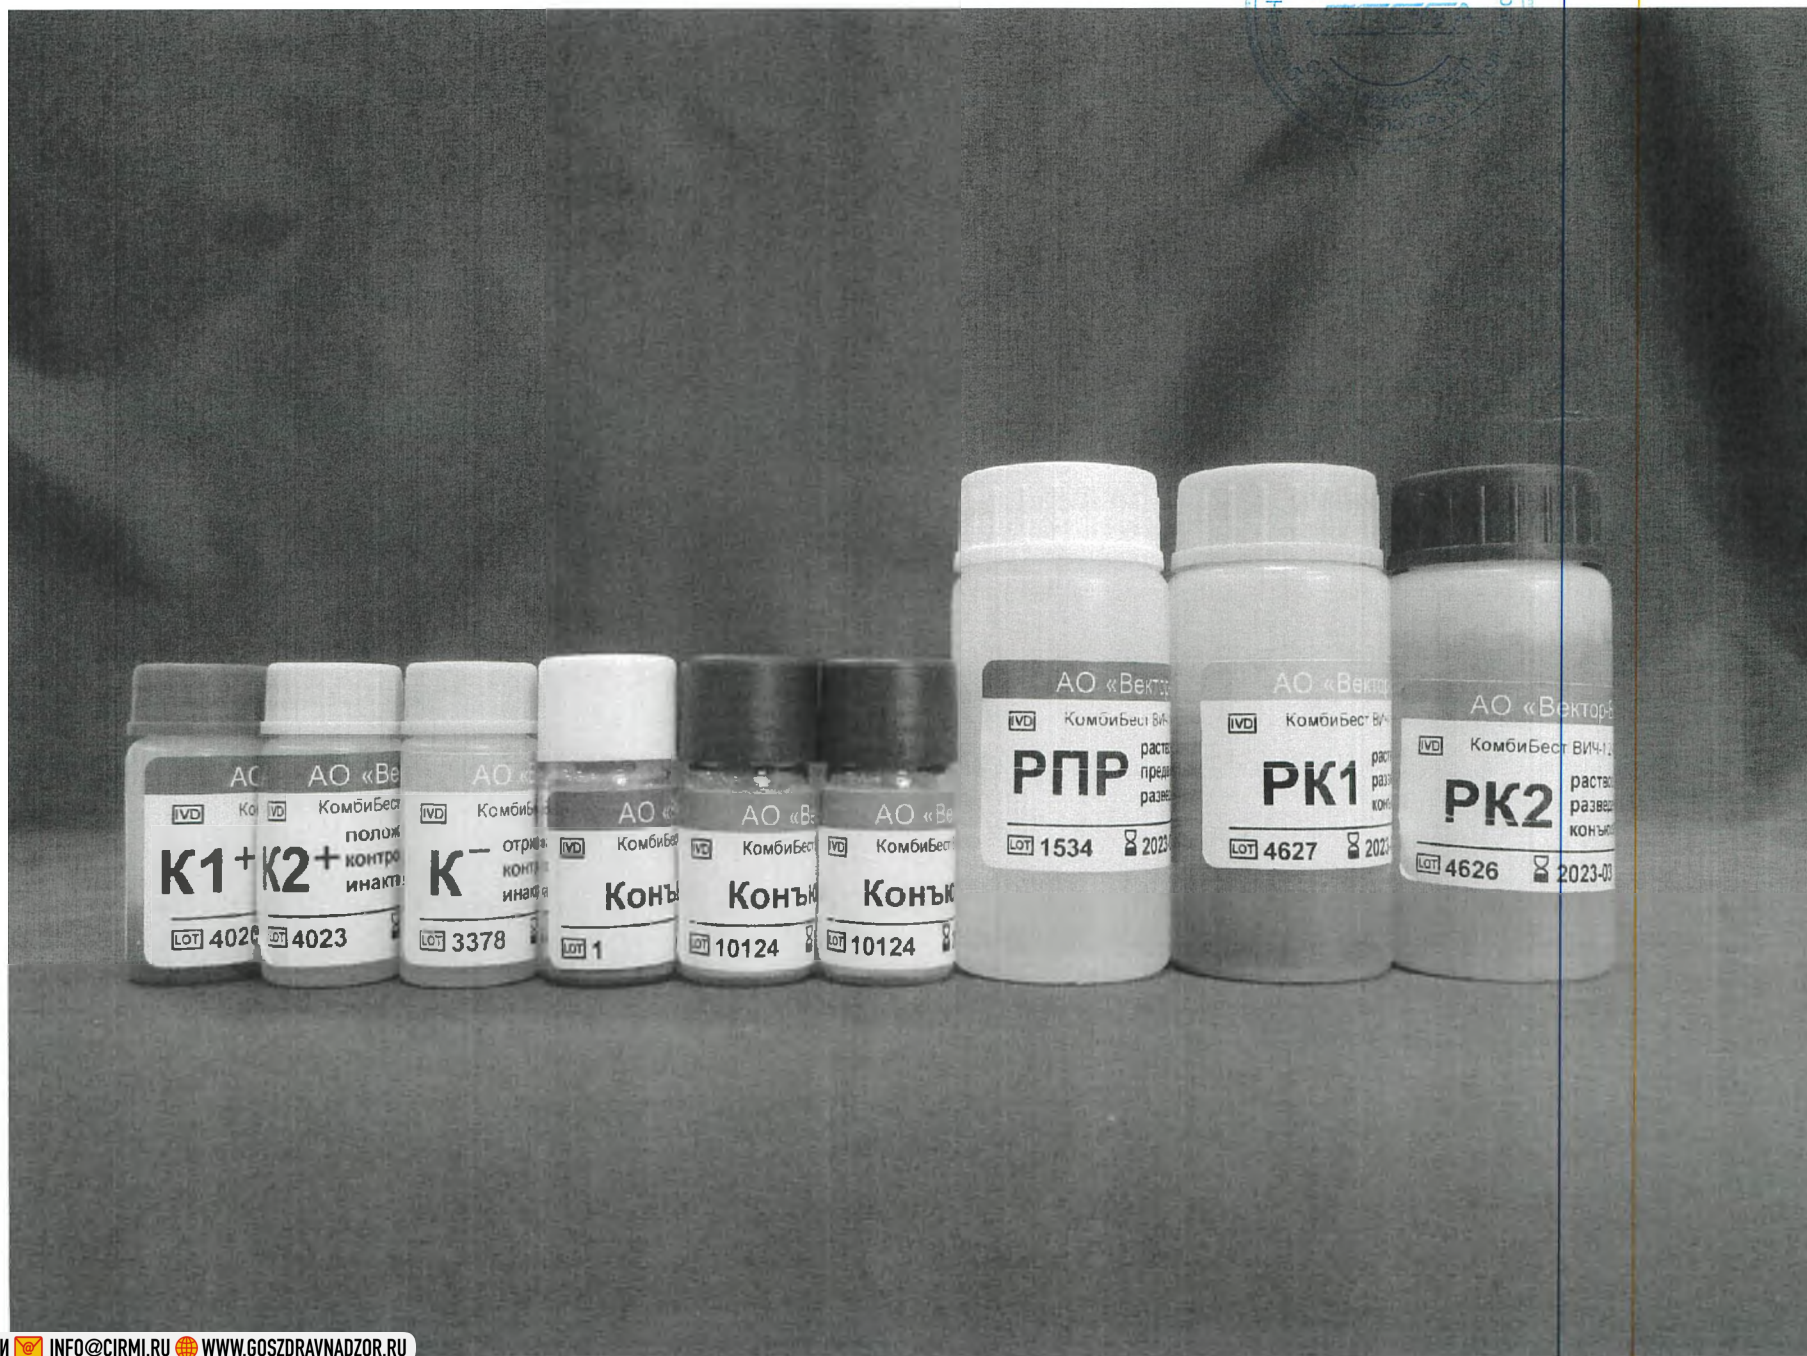


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 3
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.
М.П. _____

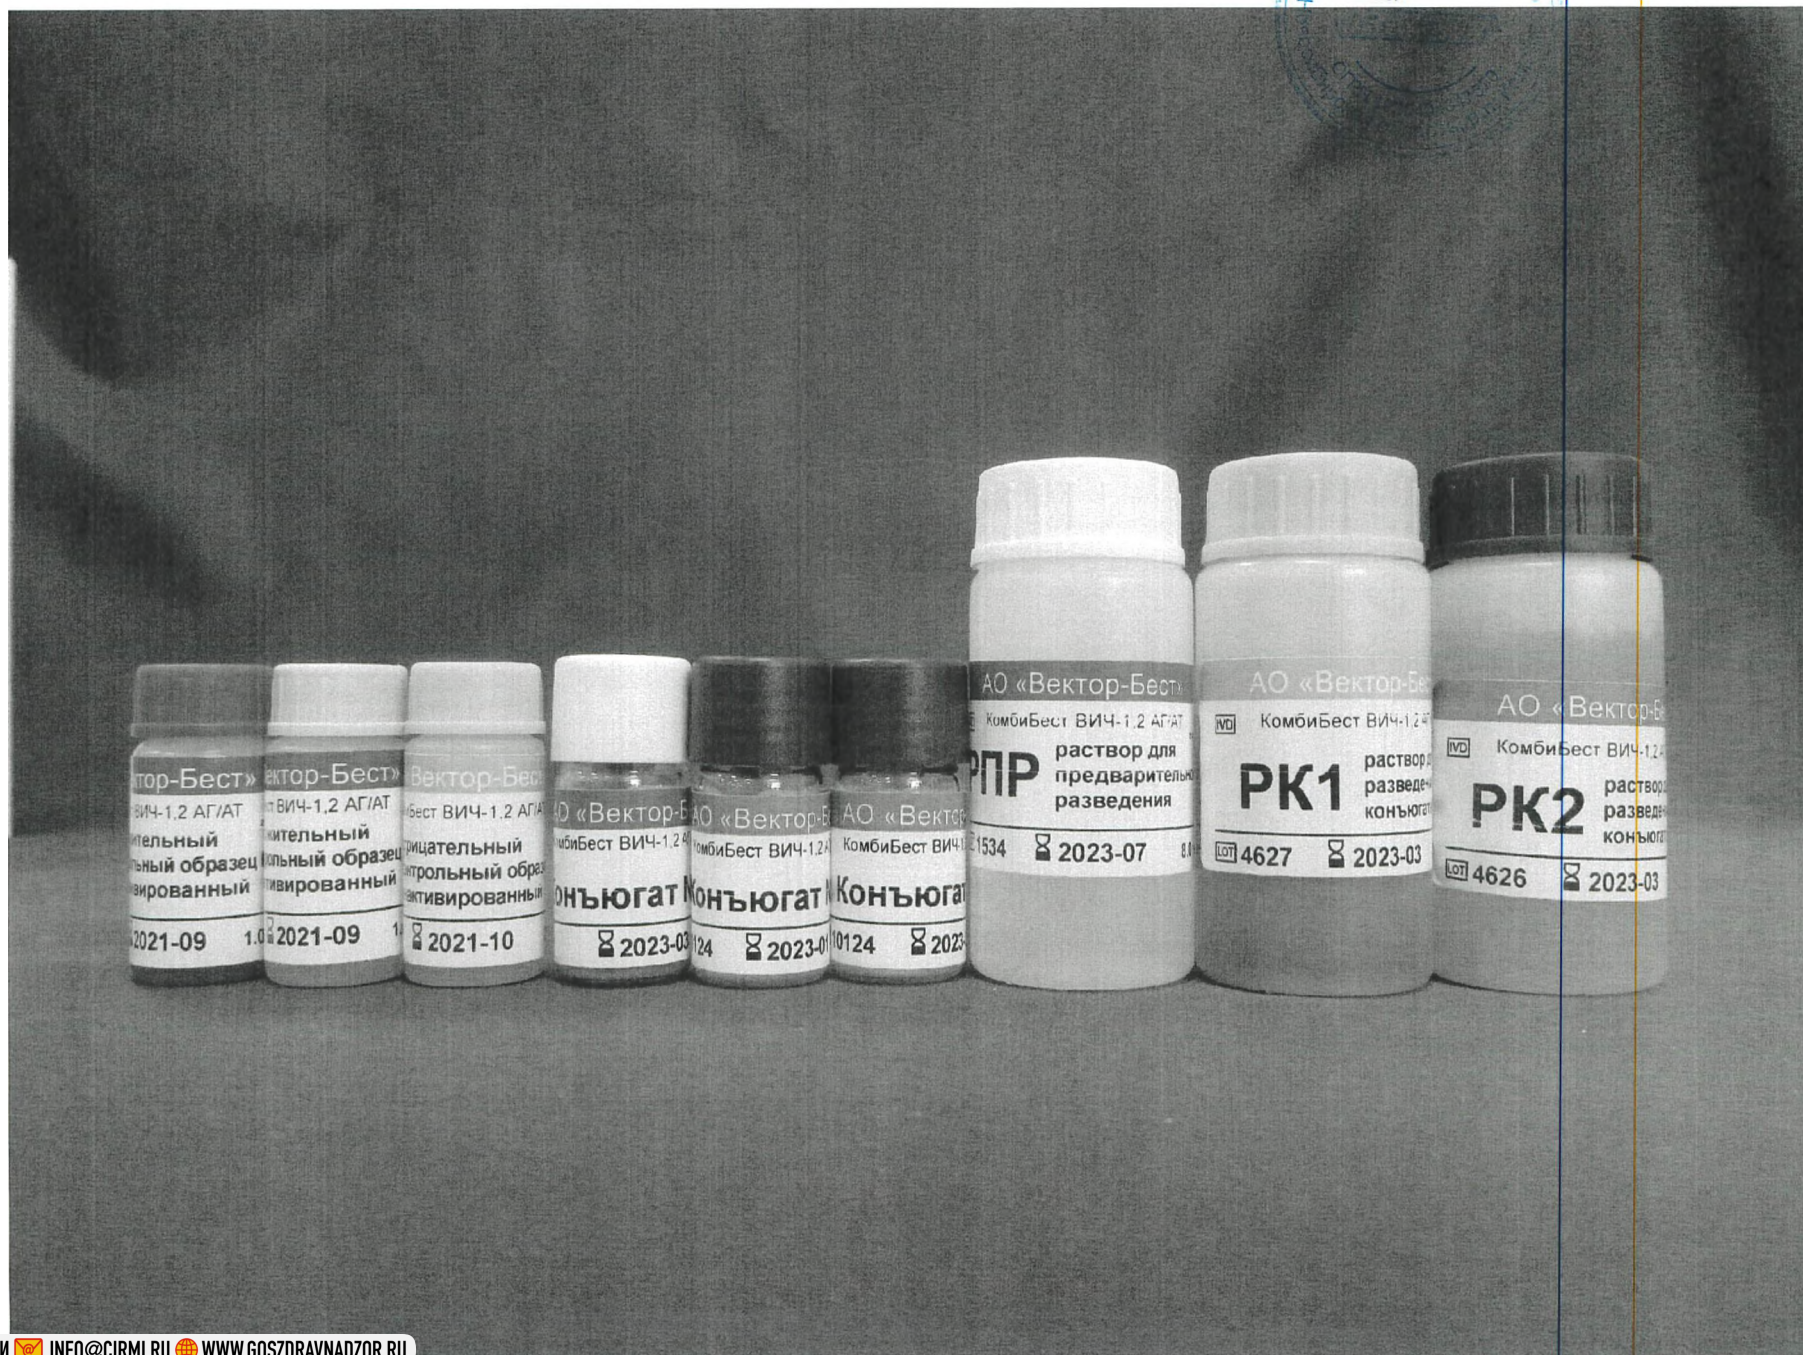

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто» № 4
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«20» 03/ 2020 г.
М.П.

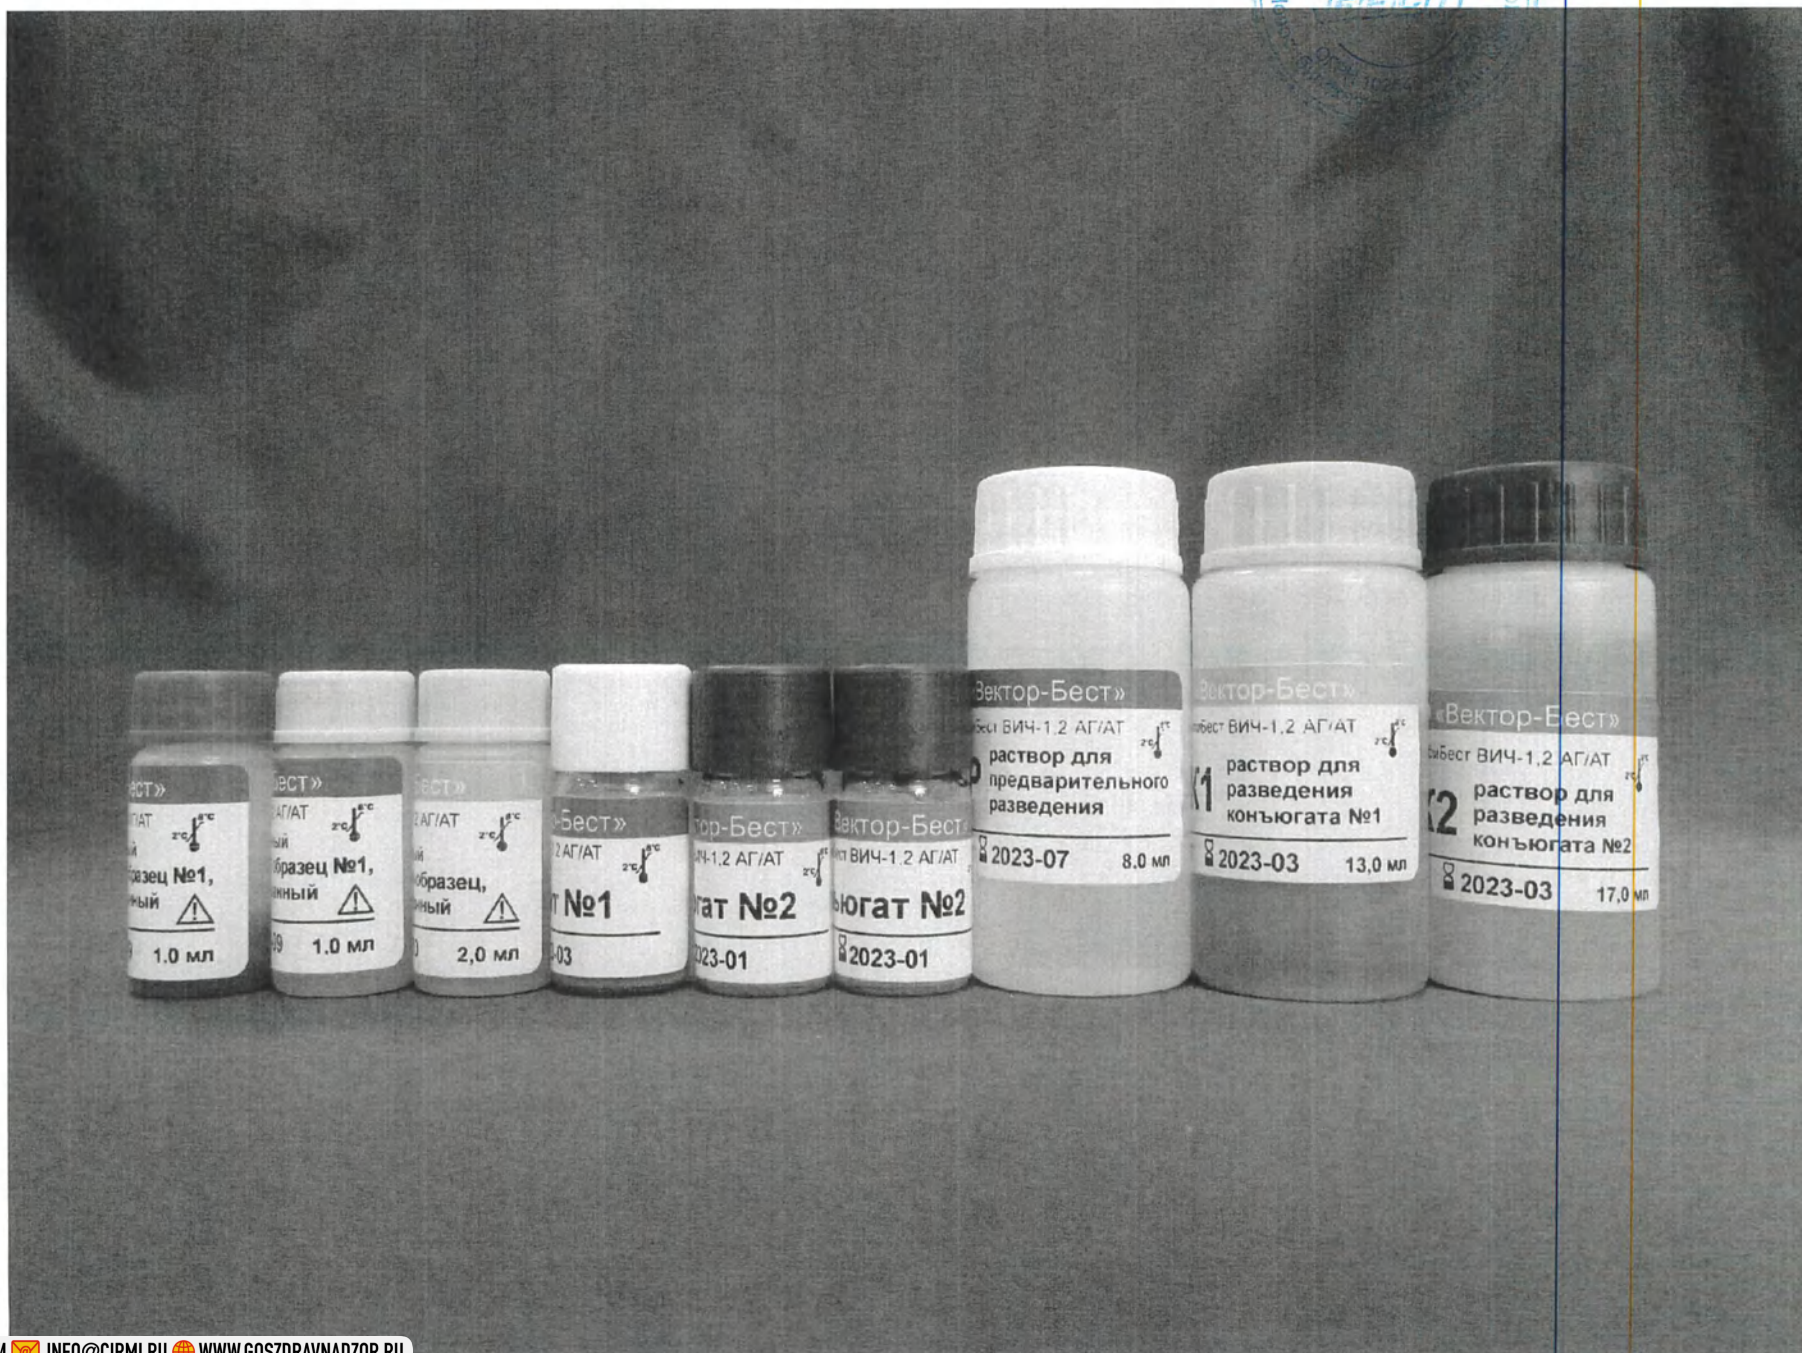


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто” № 5
комплект 2/Чароит серия 4




Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
2020 г.

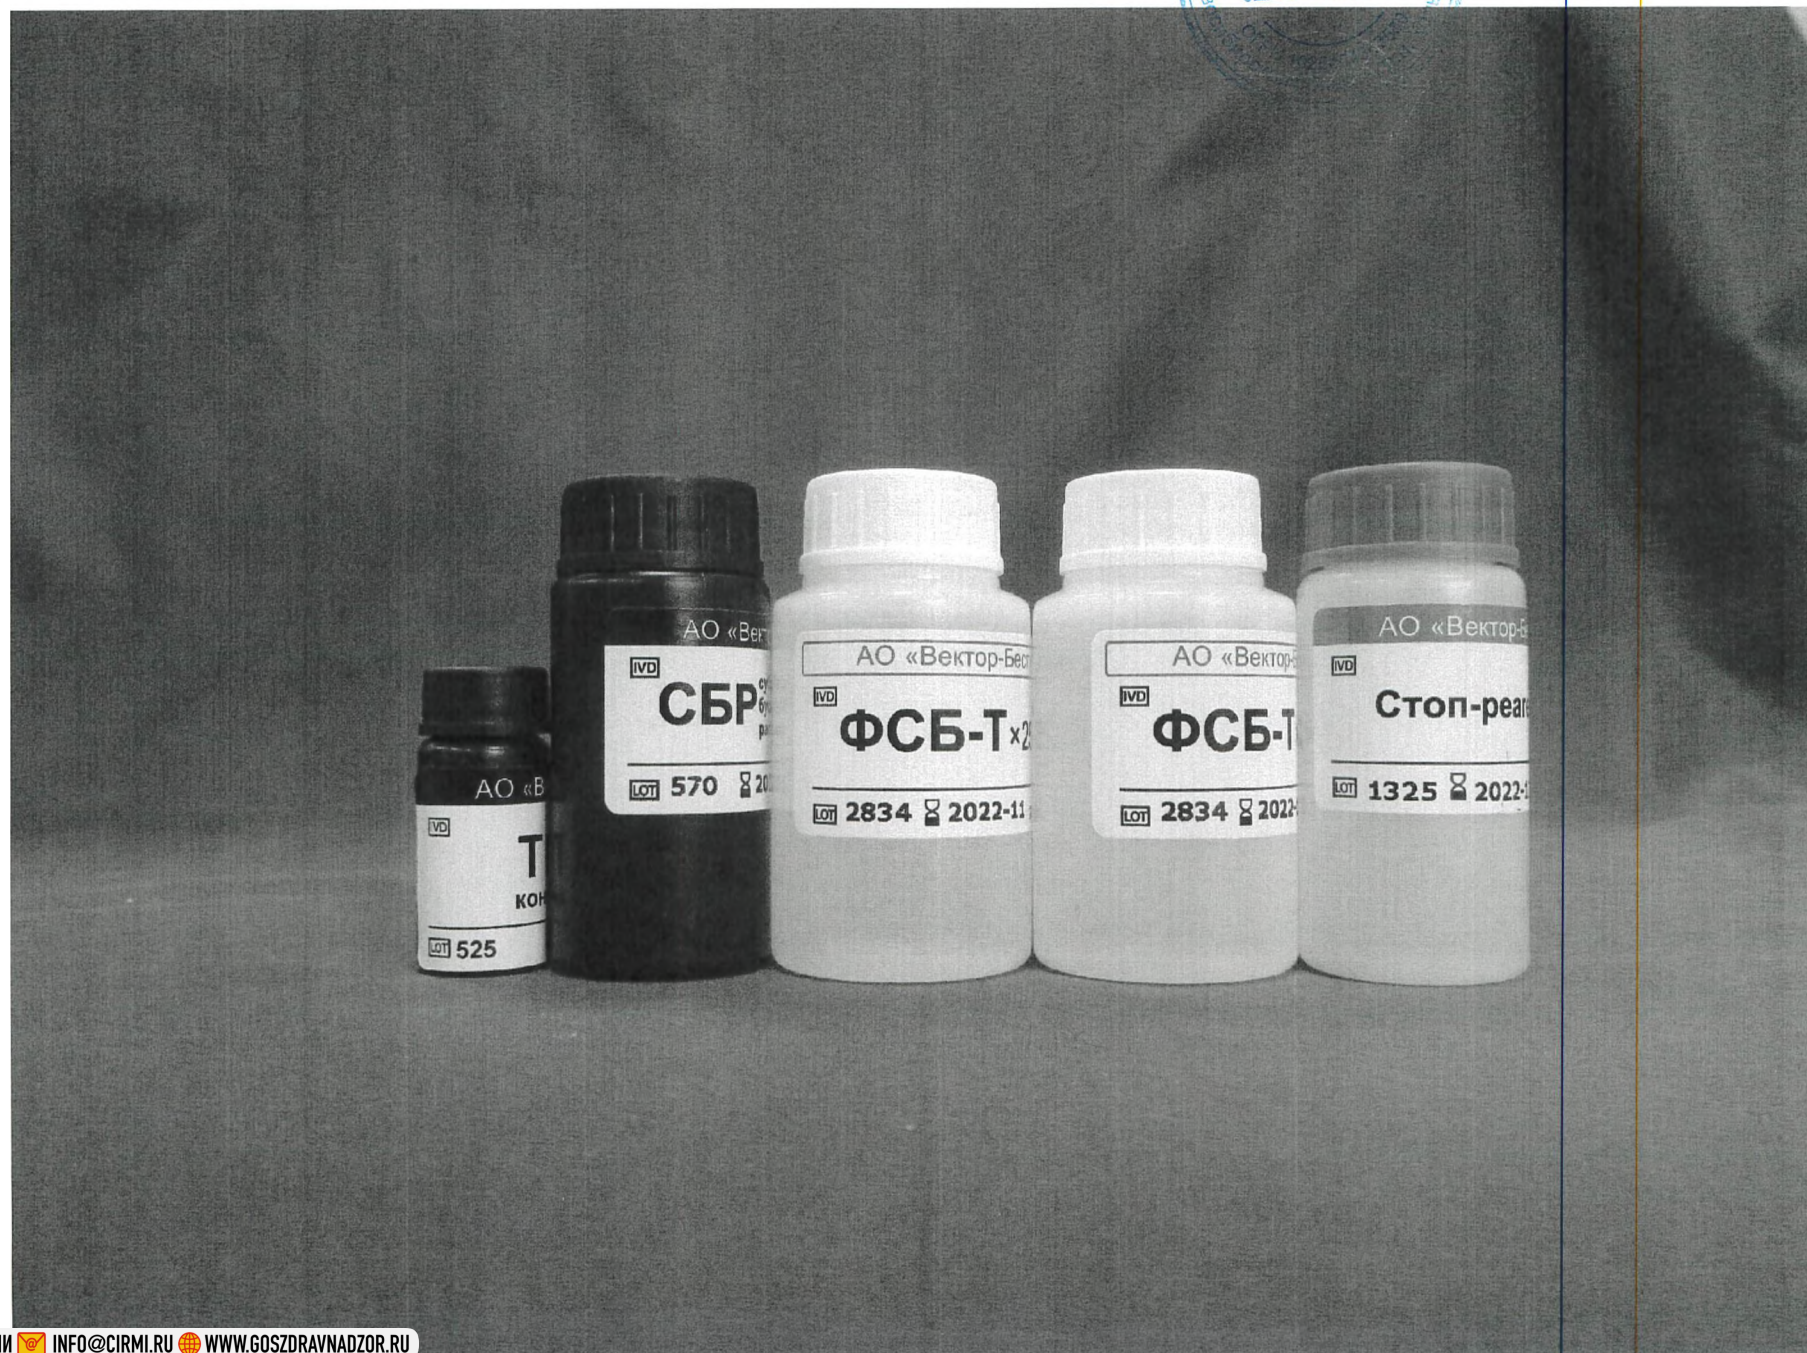


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 6
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"20" "03" 2020 г.
М.п. 

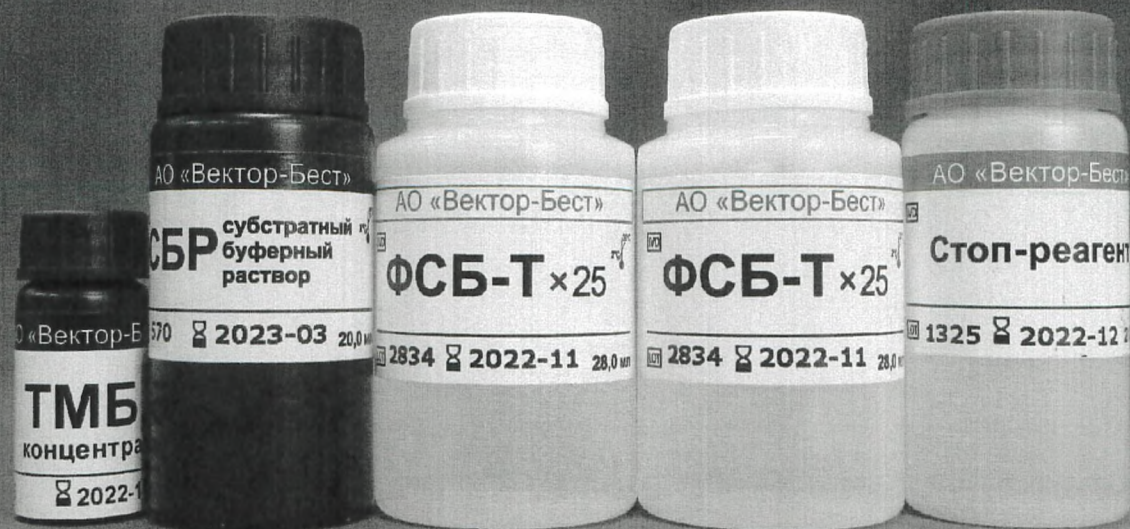

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 7
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 03 2020 г.
М.П.

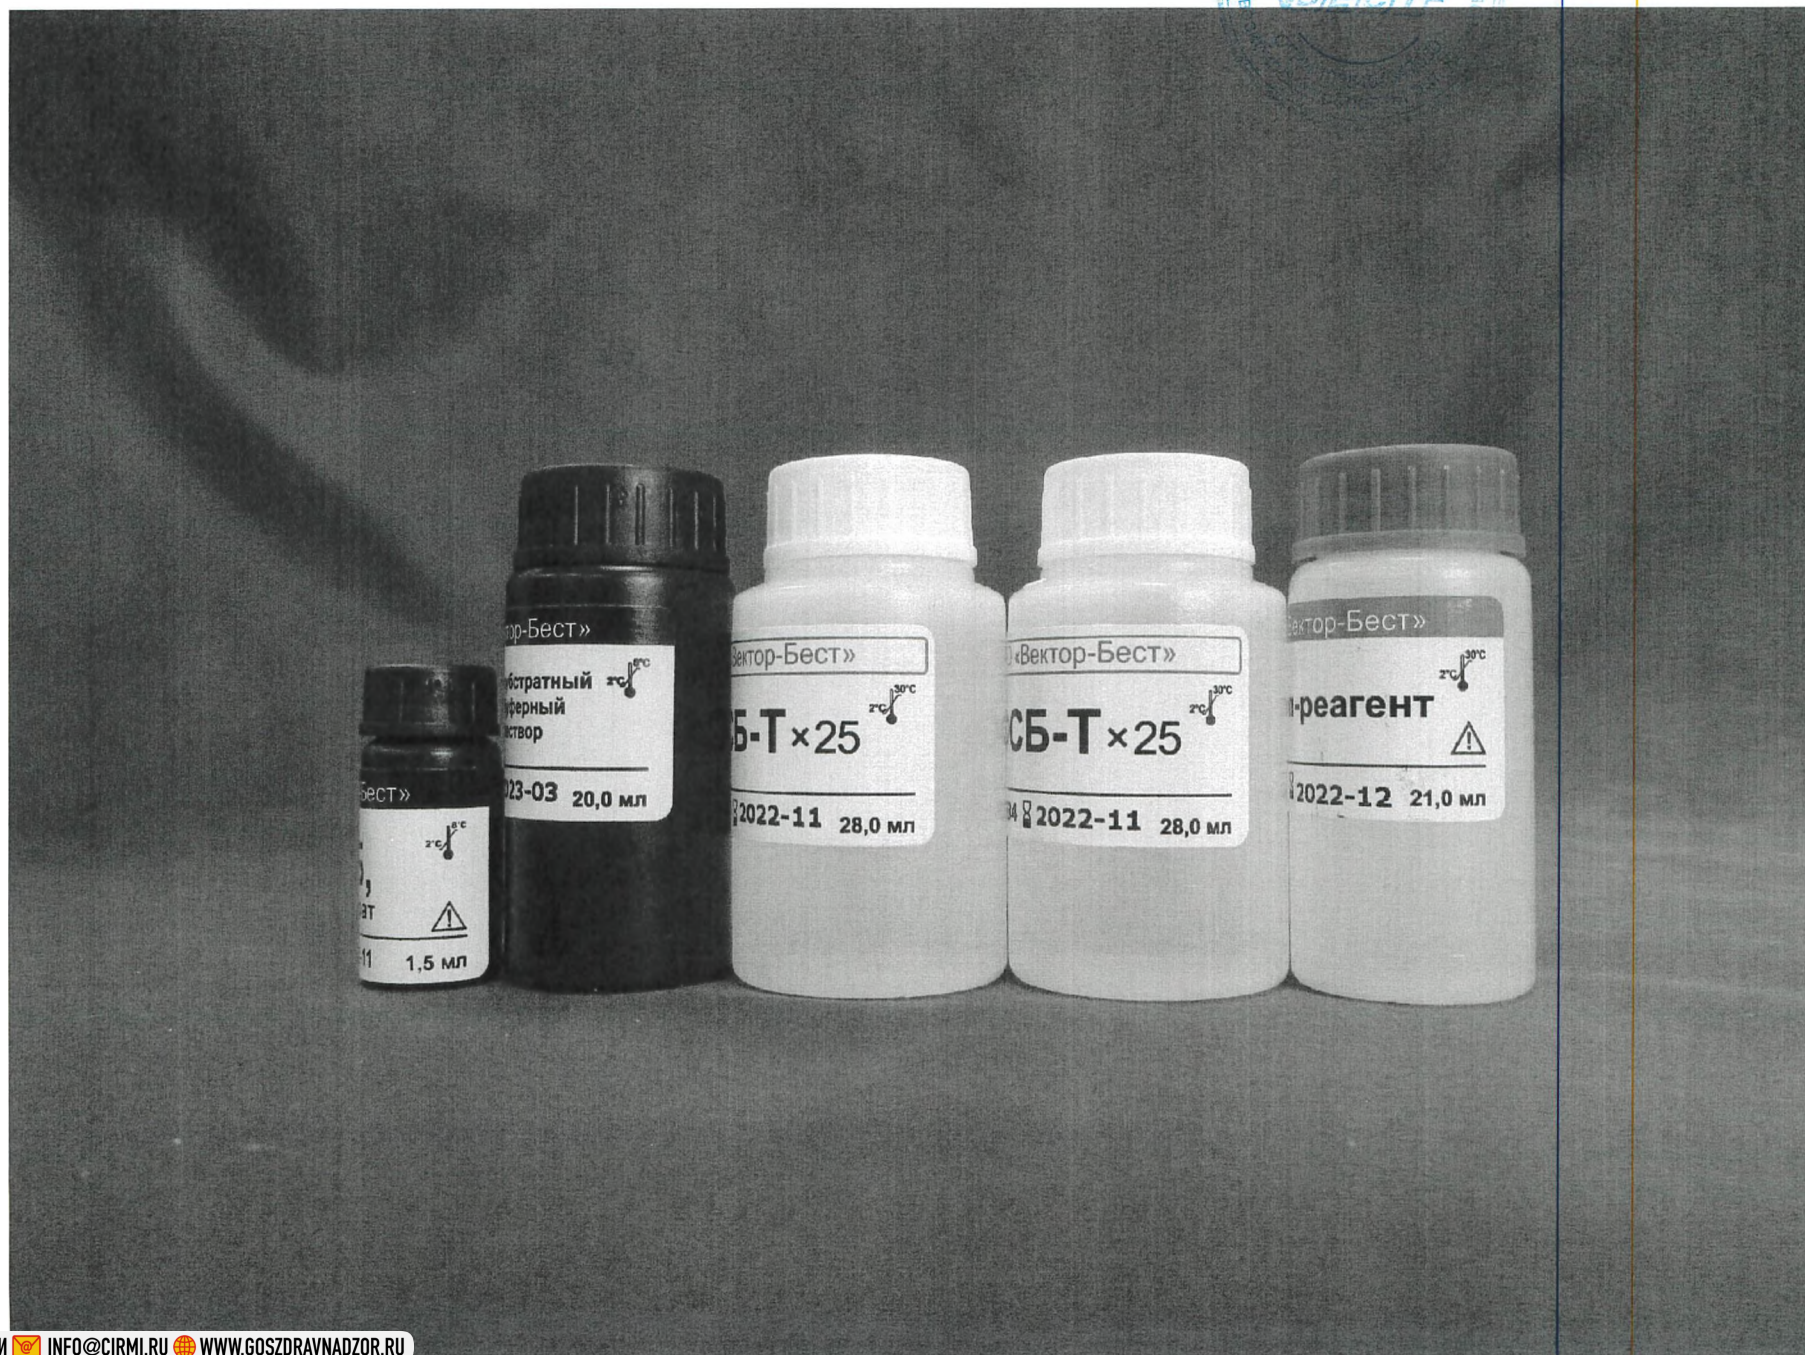

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 1
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"20" 03/1 2020 г.
М.П.

REF

X-XXXX

набор реагентов для иммуноферментного
выявления антител к ВИЧ-1,2
и антигена р24 ВИЧ-1
для автоматических ИФА-анализаторов

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто
(комплект 2/Чароит)


LOT 4

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВИЧ-1,2 и антителами к р24ВИЧ-1	1 шт.	220001
2. Положительный контрольный образец №1	1 фл.	1,0 мл 4020
3. Положительный контрольный образец №2	1 фл.	1,0 мл 4023
4. Отрицательный контрольный образец	1 фл.	2,0 мл 3378
5. Конъюгат № 1	1 фл.	1
6. Конъюгат № 2	2 фл.	10124
7. Раствор для предварительного разведения	1 фл.	8,0 мл 1534
8. Раствор для разведения конъюгата № 1	1 фл.	13,0 мл 4627
9. Раствор для разведения конъюгата № 2	1 фл.	17,0 мл 4626
10. Тетраметилбензидин, концентрат	1 фл.	1,5 мл 525
11. Субстратный буферный раствор	1 фл.	20,0 мл 570
12. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл. по 28,0 мл	2834
13. Стоп-реагент	1 фл.	21,0 мл 1325
14. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.	
15. Пробки резиновые	4 шт.	


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 2
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"20" 03 2020 г.
М.П.

REF **X-XXXX**   **4**


ТУ 21.20.23-043-23548172-2020
РУ №  **2020-03-20**
 **2021-09-20**

КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто
(комплект 2/Чароит)

IVD    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ-авто" № 3
комплект 2/Чароит серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"20" 03/ 2020 г.
М.П. 



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

[www. vector-best.ru](http://www.vector-best.ru)