

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

« 01 » 11 2019 г.

**Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая
по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
СЫВОРОТКА
ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ
ТИТР 1:
2 МЛ
С
ГОДЕН ДО

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

« 01 » 20 19 г.

**Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая
по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 105x24x65 мм

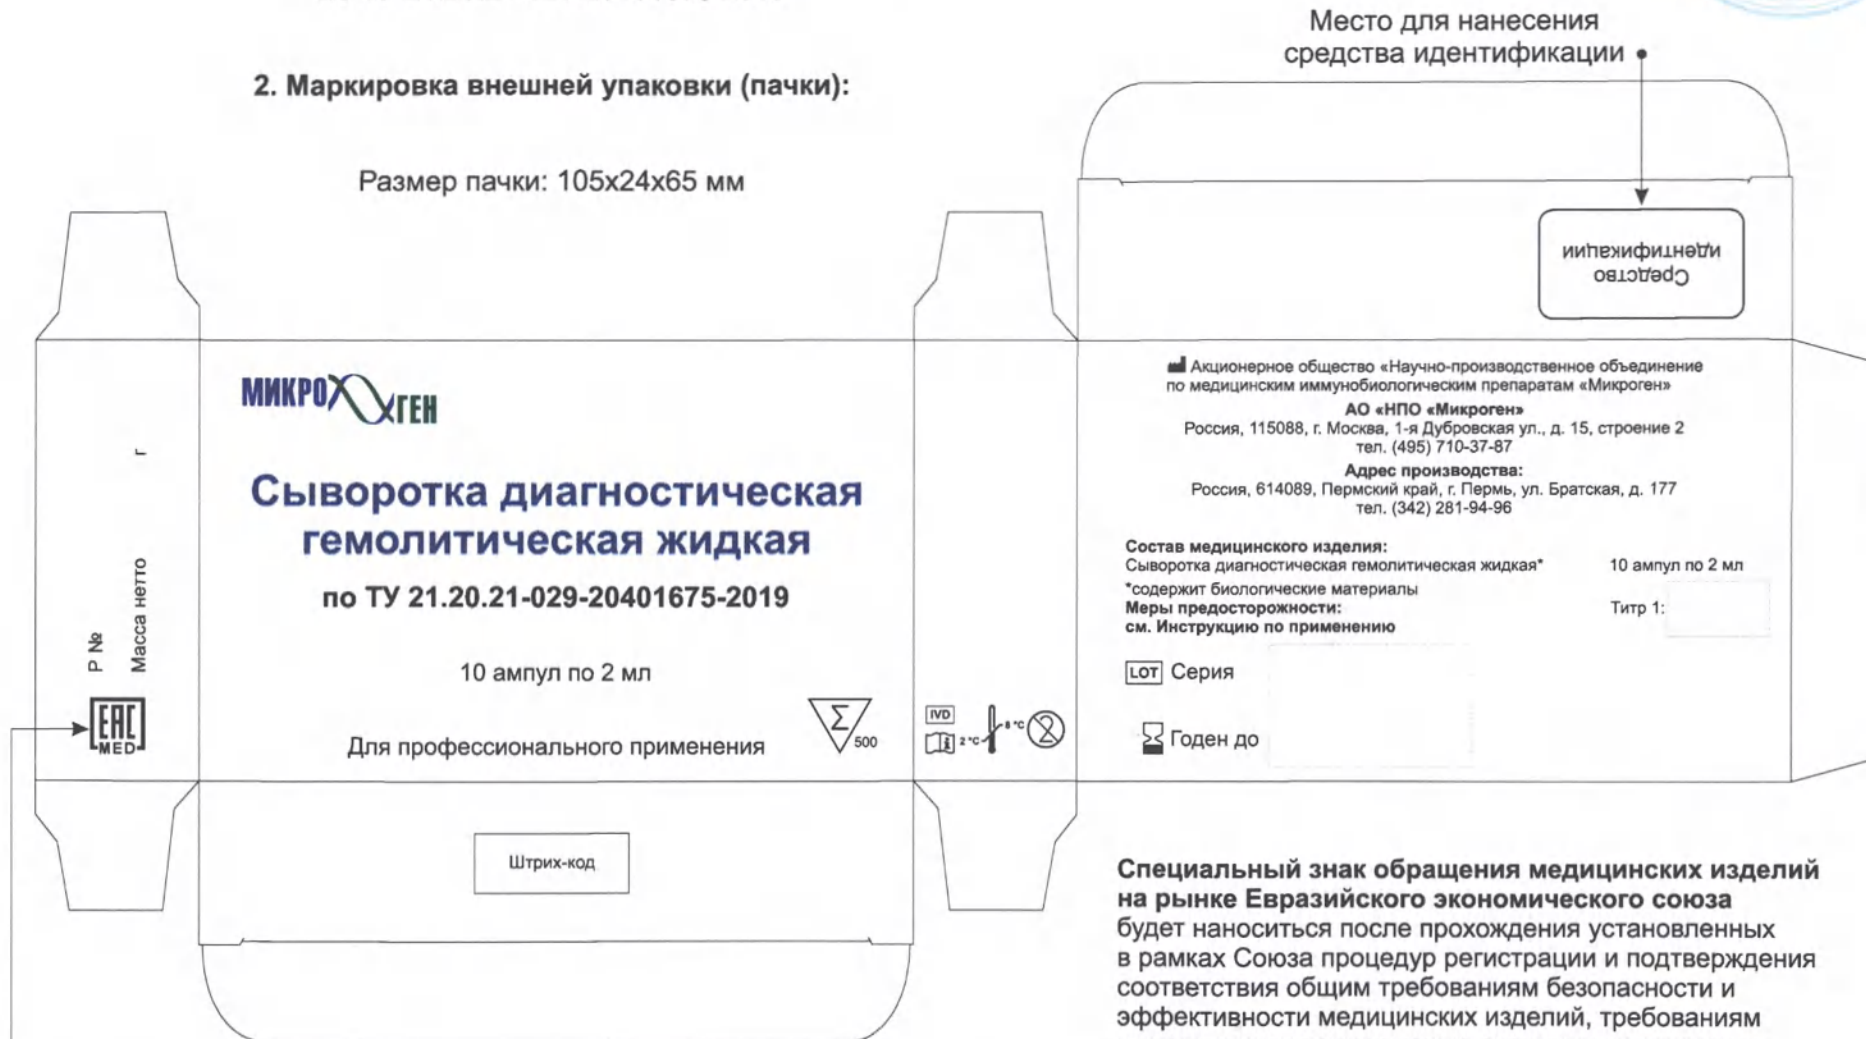


**Специальный знак обращения медицинских изделий
на рынке Евразийского экономического союза**
будет наноситься после прохождения установленных
в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения
соответствия общим требованиям безопасности и
эффективности медицинских изделий, требованиям
к внедрению и поддержанию системы менеджмента
качества медицинских изделий

**Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая
по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019**


3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»
_____ А.Е. Ершов
« 01 » _____ 20 19 г.

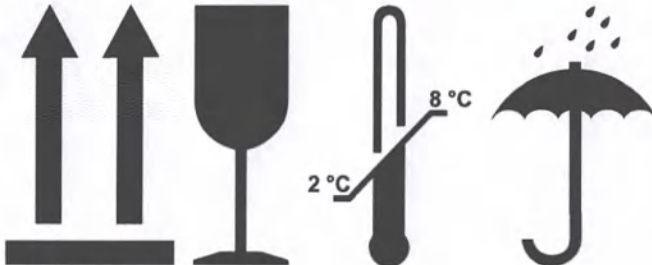 <p>Не кантовать!</p>	<p>LOT Серия:</p> <p>Годен до:</p> <p>Число единиц потребит. упак. изделия:</p>
<p align="center">Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019</p> <p align="right"></p>	
<p align="center">БИОПРЕПАРАТЫ</p>	
<p>Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (до 48 ч) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С.</p>	<p align="center">МИКРОГЕН</p> <p align="center"></p> <p align="center">АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87</p> <p align="center">Адрес производства: Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 281-94-96</p>
<p>Масса брутто</p>	
<p>Масса нетто</p>	
<p>Масса нетто потребит. упак.</p>	

Специальный знак обращения медицинских изделий на рынке Евразийского экономического союза будет наноситься после прохождения установленных в рамках Союза процедур регистрации и подтверждения соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к внедрению и поддержанию системы менеджмента качества медицинских изделий

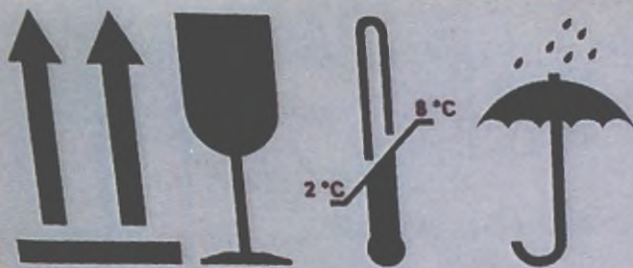

Не кантовать!

LOT Серия: 168-0418

Годен до: VIII 20

Число единиц потребит. упак. изделия: 112

**Сыворотка диагностическая
гемолитическая жидкая
по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019**

БИОПРЕПАРАТЫ

Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Допускается кратковременно (до 48 ч) транспортировать при температуре от 9 до 25 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С.

МИКРОХГЕН

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96

Масса брутто 7,0 кг
Масса нетто 6,7 кг
Масса нетто потребит. упак. 602



Филиал АО «НПО «Микроген» в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед»
Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, 177

ПАСПОРТ № 634

Наименование изделия: «Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая» по ТУ 21.20.21-029-20401675-2019

Сокращенное наименование: СЫВОРОТКА ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00181

Номер серии (партии) 168-0718

Количество, ед. измерения 26 упаковок

Назначение медицинского изделия:

Сыворотка диагностическая гемолитическая жидкая

10 ампул по 2 мл

ТУ 21.20.21-029-20401675-2019

Важные даты

Начальник
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АО «НПО «МИКРОГЕН»

А.Е. Ершов



LOT Серия: 168-0418

Годен до: VIII 20

Число единиц потребит.
упак. изделия: 112

ностическая
ая жидкая
20401675-2019

РАТЫ

МИКРОХГЕН

АО «НПО «Микроген»
Россия, 115088, г. Москва,
1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2
тел. (495) 710-37-87

Адрес производства:
Россия, 614089, Пермский край,
г. Пермь, ул. Братская, д. 177
тел. (342) 281-94-96



Пермь «Пермское НПО «Биомед»
г. Пермь, ул. Братская, 177

634

гемолитическая жидкая

ТИЧЕСКАЯ

по ТУ 21.20.21-029-

10 ампул по 2 мл

019

