

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НЭКСТ Био»

П.П. Родионов





ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия для диагностики in vitro

Тест-полоски SelfyCheck Regular

1. Фотографическое изображение маркировки МИ "Тест-полоски SelfyCheck Regular"-
лист 2;
2. Фотографическое изображение маркировки МИ "Тест-полоски SelfyCheck Regular "-
лист 3;
3. Фотографическое изображение маркировки МИ "Тест-полоски SelfyCheck Regular "-
лист 4.
4. Фотографическое изображение маркировки МИ "Тест-полоски SelfyCheck "-
лист 5.



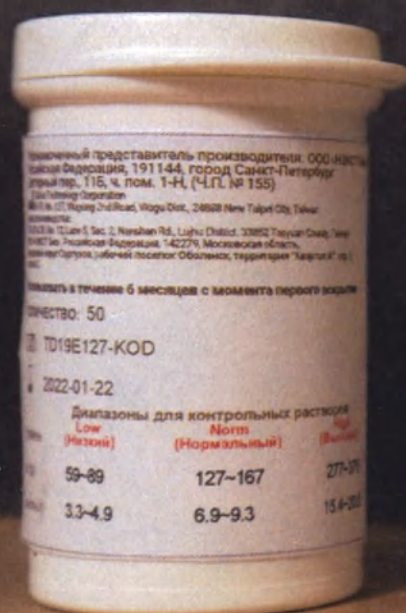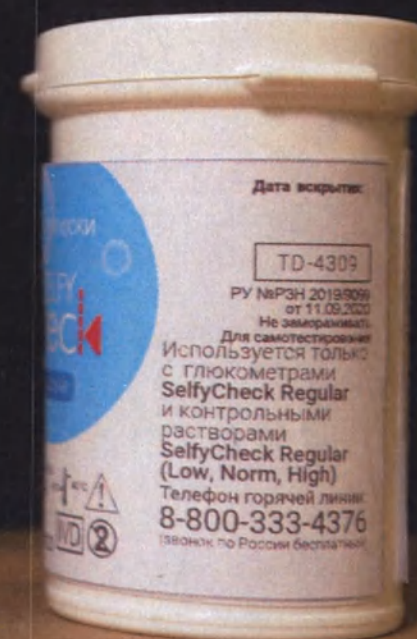

Уполномоченный представитель производителя: ООО
Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург
Дегтярный пер., 11Б, ч. пом. 1-Н, (Ч.П. № 155)

TabDoc Technology Corporation
61-7F, No. 127, Wugong 2nd Road, Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
Изм. производства
TP127 & 3F No. 12, Lane 5, Sec. 2, Nanshan Rd., Lugan District 33852 Taoyuan City, Taiwan
ООО ИЖСТ Баз, Российская Федерация, 142279, Московская область
поселок с/пос. Делухов, рабочий поселок Оболенск, территория "Медиа-Сити"
этаж 2

Использовать в течение 6 месяцев с момента первого вскрытия

КОЛИЧЕСТВО: 50
TD19E127-KOD

2022-01-22

Диапазоны для контрольных растворов

	Норм (Нормальный)
Low (Низкий)	127-167
59-89	6.9-9.3
3.3-4.9	

Уполномоченный представитель производителя: ООО «НЭКСТ Био»
Российская Федерация, 191144, город Санкт-Петербург
Дегтярный пер., 11Б, ч. пом. 1-4, (Ч.П. № 155)

Guibao Technology Corporation
No. 1-77, No. 127, Wuyang 2nd Road, Wuyang Dist., 24086 Nan Tai City, Taiwan

Адрес производства:
1F & 2F & 3F No. 12, Lane 5, Sec. 2, Neihu Rd., Neihu District, 23852 Tainan City, Taiwan
ООО «НЭКСТ Био», Российская Федерация, 142279, Московская область,
поселок «Восток», д. 10, стр. 1, корпус 1, территория «Август А», стр. 3,
корпус 2.

Использовать в течение 6 месяцев с момента первого вскрытия

КОЛИЧЕСТВО: 50

LOT: TD19E127-KOD

2022-01-22

Уровень	Диапазоны для контрольных растворов		
	Low (Низкий)	Norm (Нормальный)	High (Высокий)
мг/дл	59-89	127-167	277-375
ммоль/л	3.3-4.9	6.9-9.3	15.4-20.8

ТЕСТ-ПОЛОСКИ

SELFY
check

REGULAR

Дата вскрытия:

TD-4309

Р/У №РЗН 2019/9099


от 11.09.2020

Не замораживать

Для самотестирования

Используется только
с глюкометрами
SelfyCheck Regular
и контрольными
растворами
SelfyCheck Regular
(Low, Norm, High)

Телефон горячей линии:
8-800-333-4376
(звонок по России бесплатный)



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 6 листа(ов).

Должность, ФИО:

Руководитель отдела подал и
регистрационной поддержки

Г.А. Моисеев

(подпись)

М.П.

2019 года

