




Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 (жесткий футляр)

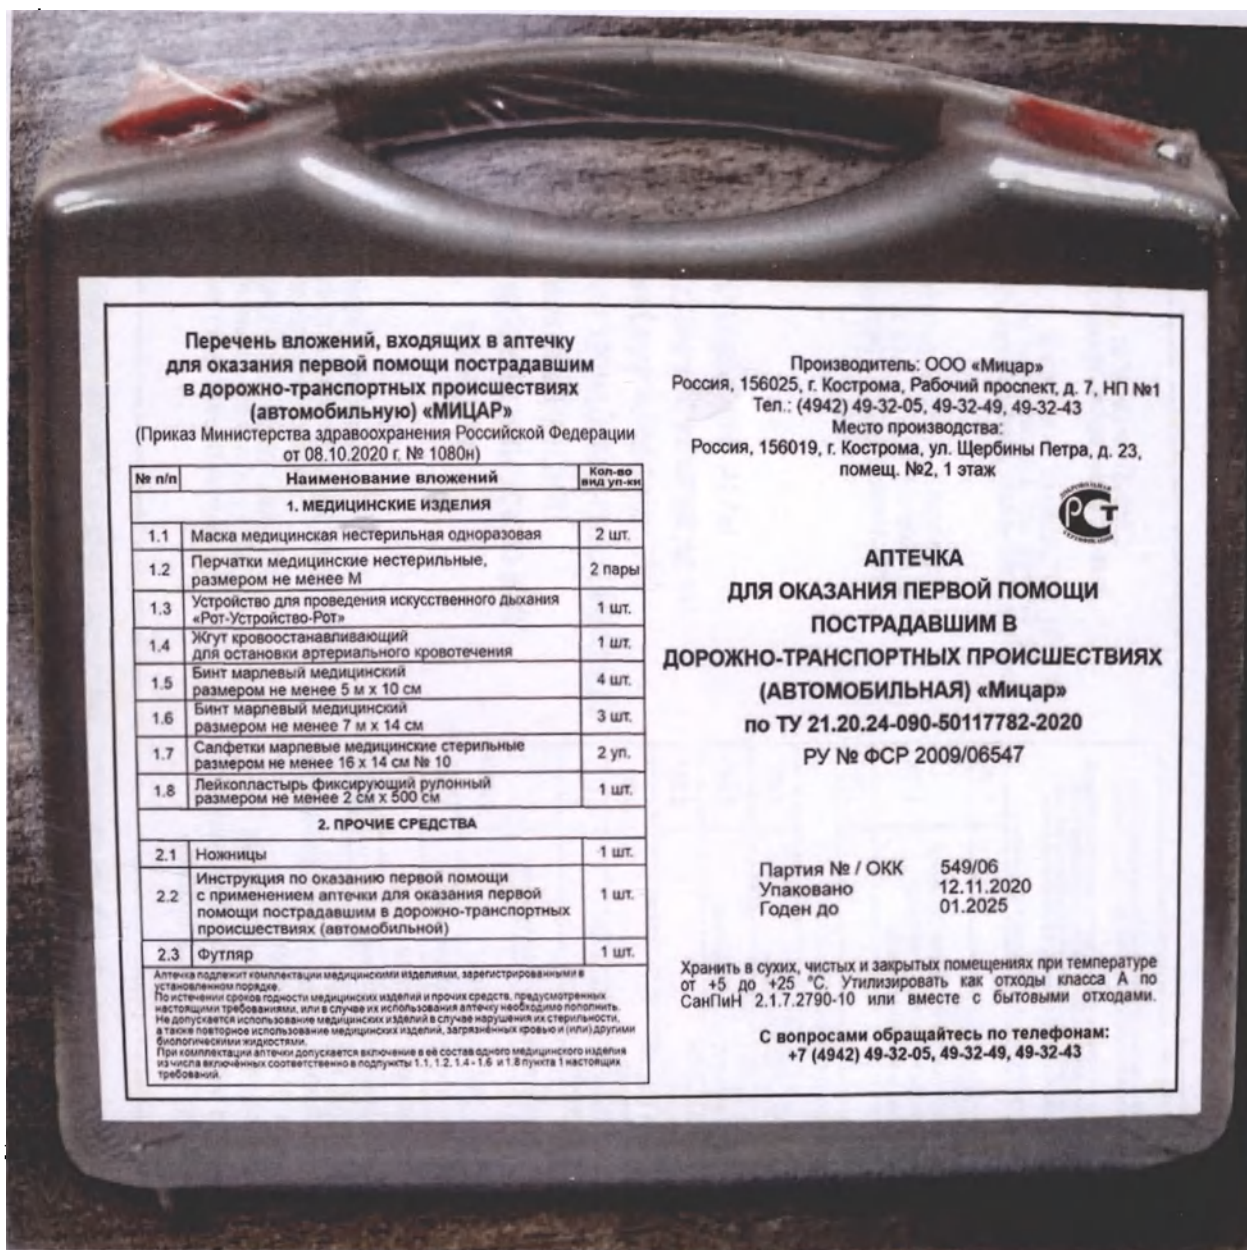

**Перечень вложений, входящих в аптечку
для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
(автомобильную) «МИЦАР»**

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 г. № 1080н)

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во в шт. уп-ки
1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10	2 уп.
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
2.1	Ножницы	1 шт.
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3	Футляр	1 шт.

Аптечка подлежит комплектованию медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.
По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.
Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.

Производитель: ООО «Мицар»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 7, НП №1
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

Место производства:
Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23,
помещ. №2, 1 этаж



**АПТЕЧКА
для оказания первой помощи
пострадавшим в
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
(АВТОМОБИЛЬНАЯ) «Мицар»
по ТУ 21.20.24-090-50117782-2020
ПУ № ФСР 2009/06547**

Партия № / ОКК 549/06
Упаковано 12.11.2020
Годеи до 01.2025

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре
от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по
СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

С вопросами обращайтесь по телефонам:
+7 (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 (жесткий футляр)

**Перечень вложений, входящих в аптечку
для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
(автомобильную) «МИЦАР»**

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 г. № 1080Н)

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во вид уп-ки
1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10	2 уп.
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
2.1	Ножницы	1 шт.
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3	Футляр	1 шт.
<small>Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. При комплектации аптечки допускается включение в её состав одного медицинского изделия из числа включённых соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.</small>		

Производитель: ООО «Мицар»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 7, НП №1
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства:
Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23,
помещ. №2, 1 этаж



**АПТЕЧКА
для оказания первой помощи
ПОСТРАДАВШИМ В
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
(АВТОМОБИЛЬНАЯ) «Мицар»
по ТУ 21.20.24-090-50117782-2020
ПУ № ФСР 2009/06547**

Партия № / ОКК 549/06
Упаковано 12.11.2020
Годеи до 01.2025

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

С вопросами обращайтесь по телефонам:
+7 (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43



Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 (жесткий футляр)



Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 (мягкий футляр (шитый))

**Перечень вложений, входящих в аптечку
для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
(автомобильную) «МИЦАР»**
(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 г. № 1080н)

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во шт. (или уп.)
1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10	2 уп.
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
2.1	Ножницы	1 шт.
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3	Футляр	1 шт.
<small>Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями. При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.</small>		

Производитель: ООО «Мицар»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 7, НП №1
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства:
Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23,
помещ. №2, 1 этаж



**АПТЕЧКА
для оказания первой помощи
пострадавшим в
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
(АВТОМОБИЛЬНАЯ) «Мицар»**
по ТУ 21.20.24-090-50117782-2020
ПУ № ФСР 2009/06547

Партия № / ОКК 549/06
Упаковано 12.11.2020
Годеи до 01.2025

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

С вопросами обращайтесь по телефонам:
+7 (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 (мягкий футляр (шитый))

**Перечень вложений, входящих в аптечку
для оказания первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
(автомобильную) «МИЦАР»**

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 08.10.2020 г. № 1080н)

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во в шт. или уп.
1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		
1.1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	2 шт.
1.2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	2 пары
1.3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»	1 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	3 шт.
1.7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см № 10	2 уп.
1.8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см x 500 см	1 шт.
2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА		
2.1	Ножницы	1 шт.
2.2	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)	1 шт.
2.3	Футляр	1 шт.

Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.
По истечении срока годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.
При комплектации аптечки допускается включение в её состав одного медицинского изделия из числа включённых соответственно в подпункты 1.1, 1.2, 1.4-1.6 и 1.8 пункта 1 настоящих требований.

Производитель: ООО «Мицар»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 7, НП №1
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

Место производства:
Россия, 156019, г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23,
помещ. №2, 1 этаж



АПТЕЧКА

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ПОСТРАДАВШИМ В

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

(АВТОМОБИЛЬНАЯ) «МИЦАР»

по ТУ 21.20.24-090-50117782-2020

РУ № ФСР 2009/06547

Партия № / ОКК 549/06
Упаковано 12.11.2020
Годен до 01.2025


Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.


**С вопросами обращайтесь по телефонам:
+7 (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43**

Маркировка Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 -
2020 (мягкий футляр (шитый))


**Общий вид комплектации Аптечки для оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)
«Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020**

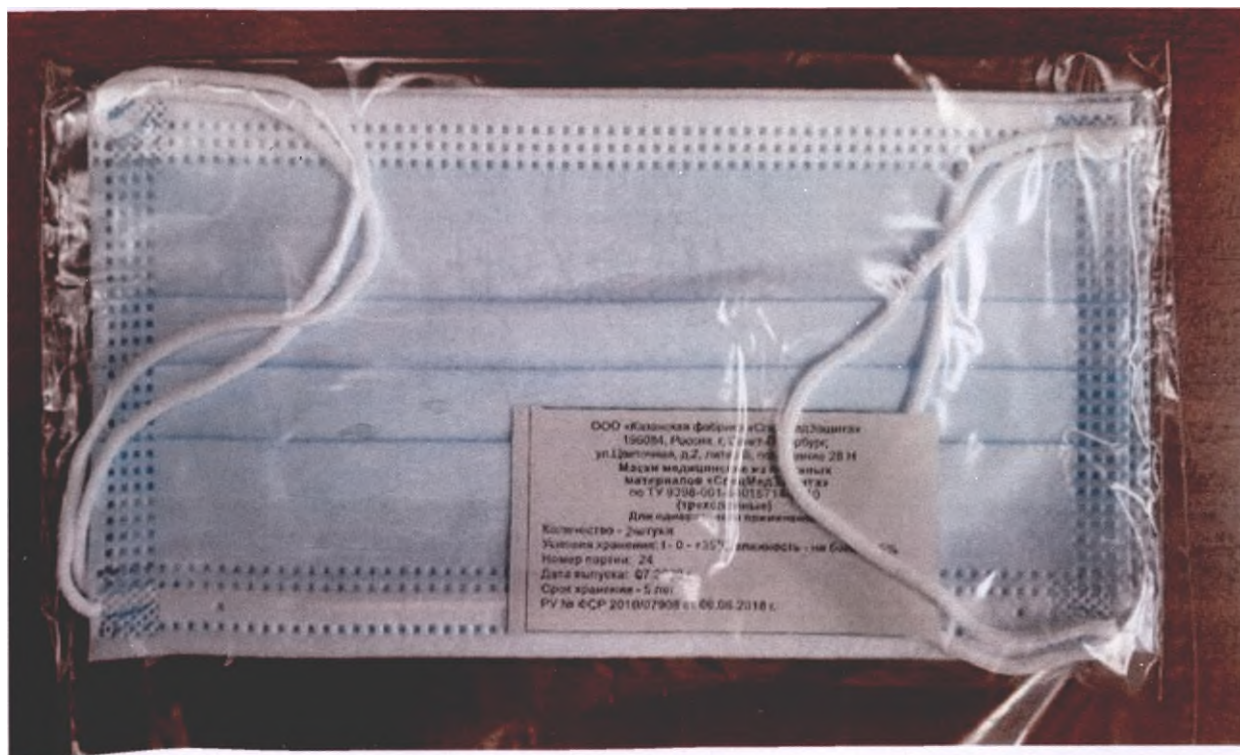

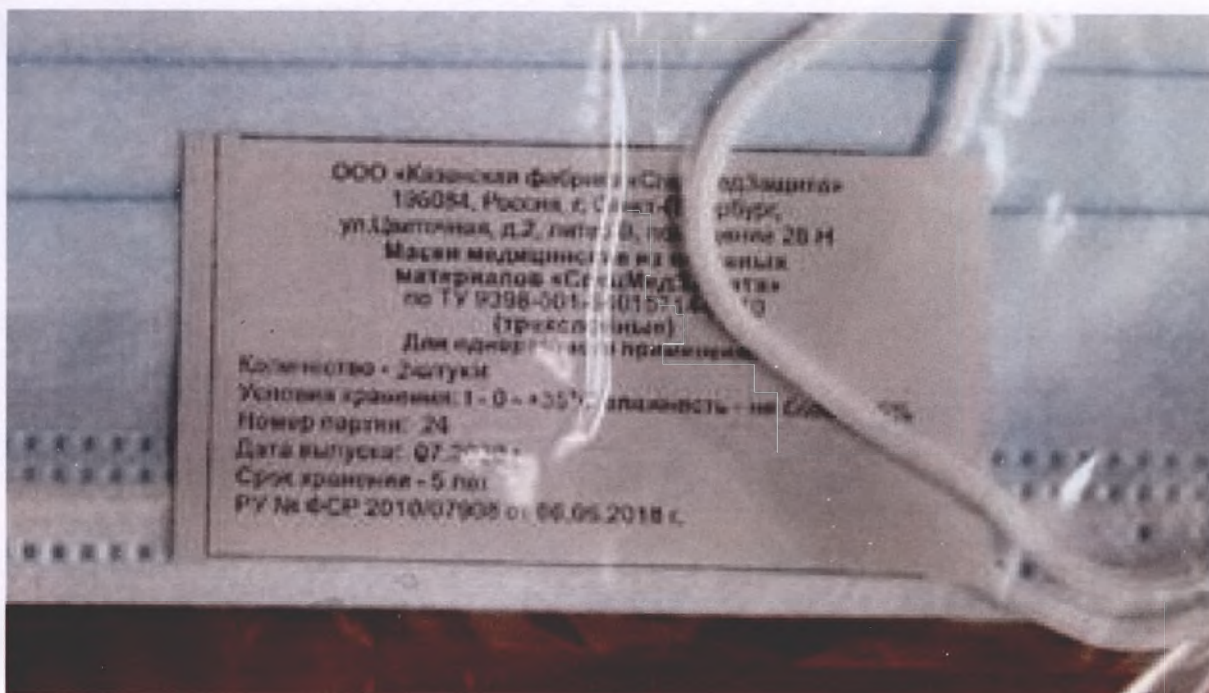



Маска медицинская нестерильная одноразовая
(Маски медицинские из нетканых материалов «СпецМедЗащита» по ТУ 9398-001-64015714-2010, РУ № ФСР 2010/07908, производства ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита», Россия)



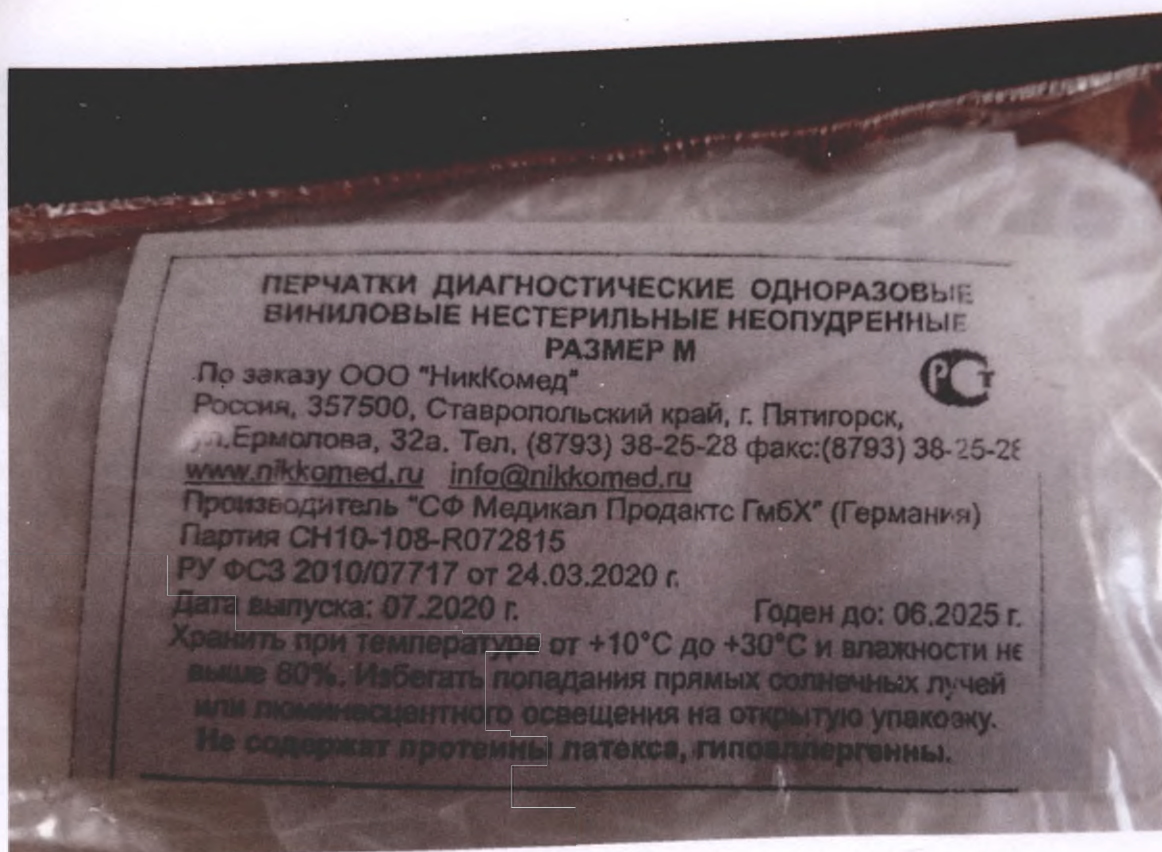



Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М
(Перчатки диагностические медицинские SF-Glovs различных типоразмеров, РУ №
ФСЗ 2010/07717, производства «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия)

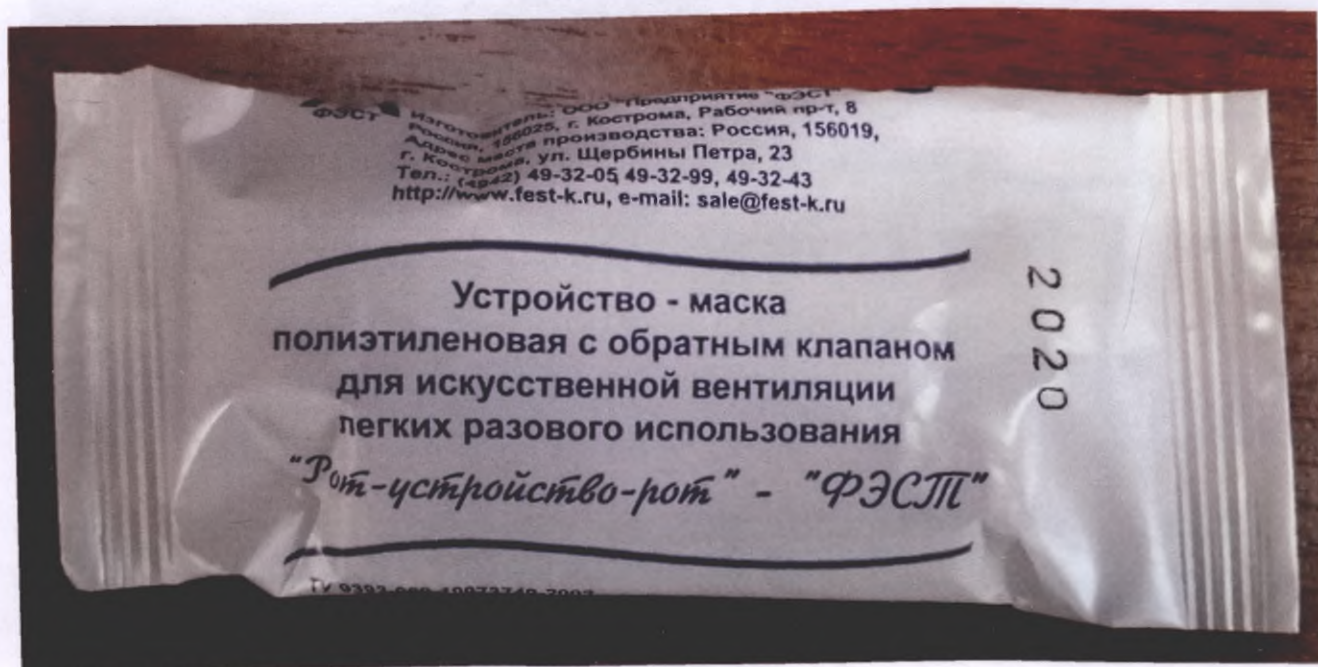

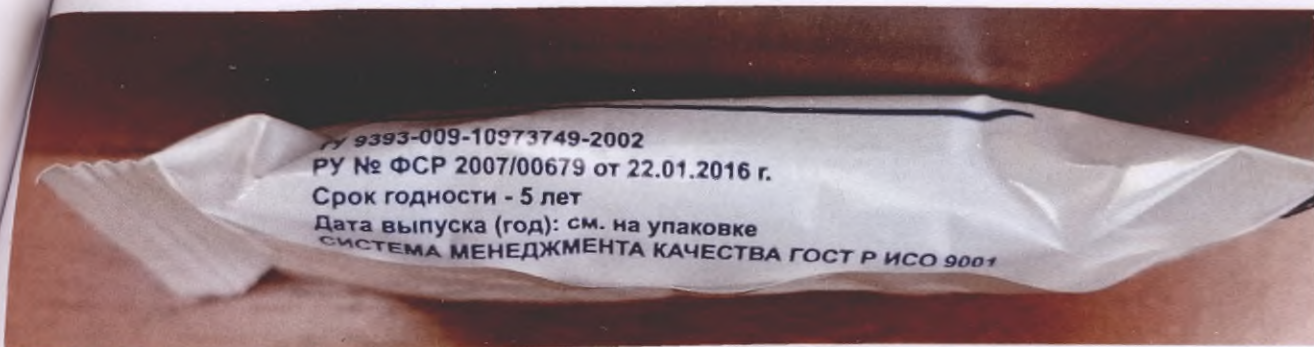

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» (Устройство – маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования «рот-устройство-рот»-«ФЭСТ» по ТУ 9393-009-10973749-2002, РУ № ФСР 2007/00679, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия)

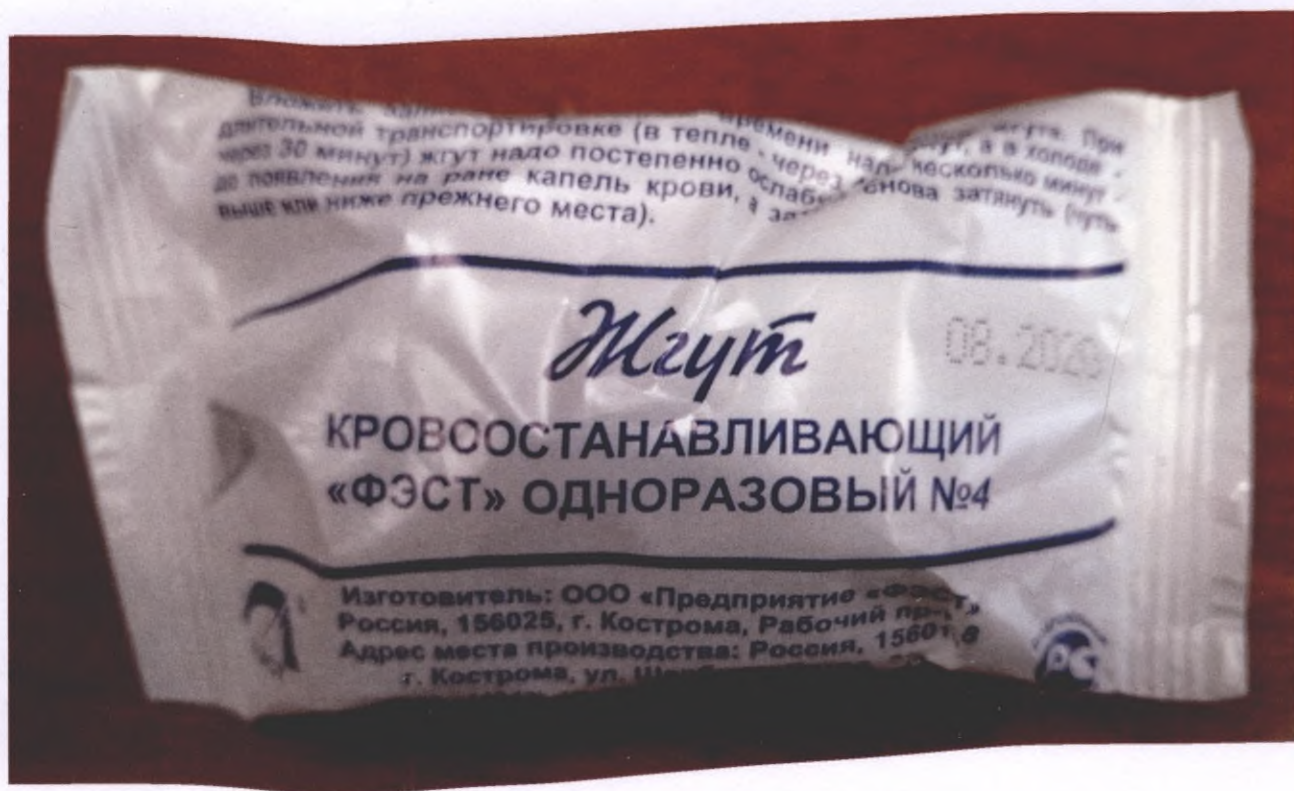


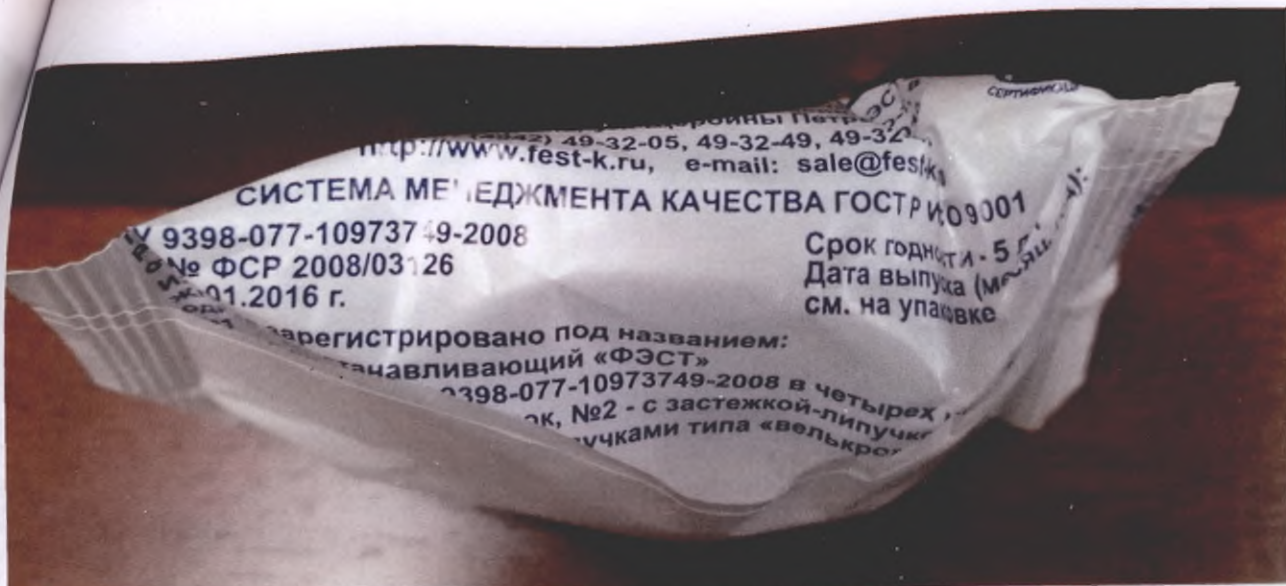

Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения
 (Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый по ТУ 9398-077-10973749-2008,
 РУ № ФСР 2008/03126, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия)



Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см
(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93, РУ №
ФСР 2011/12070, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия)

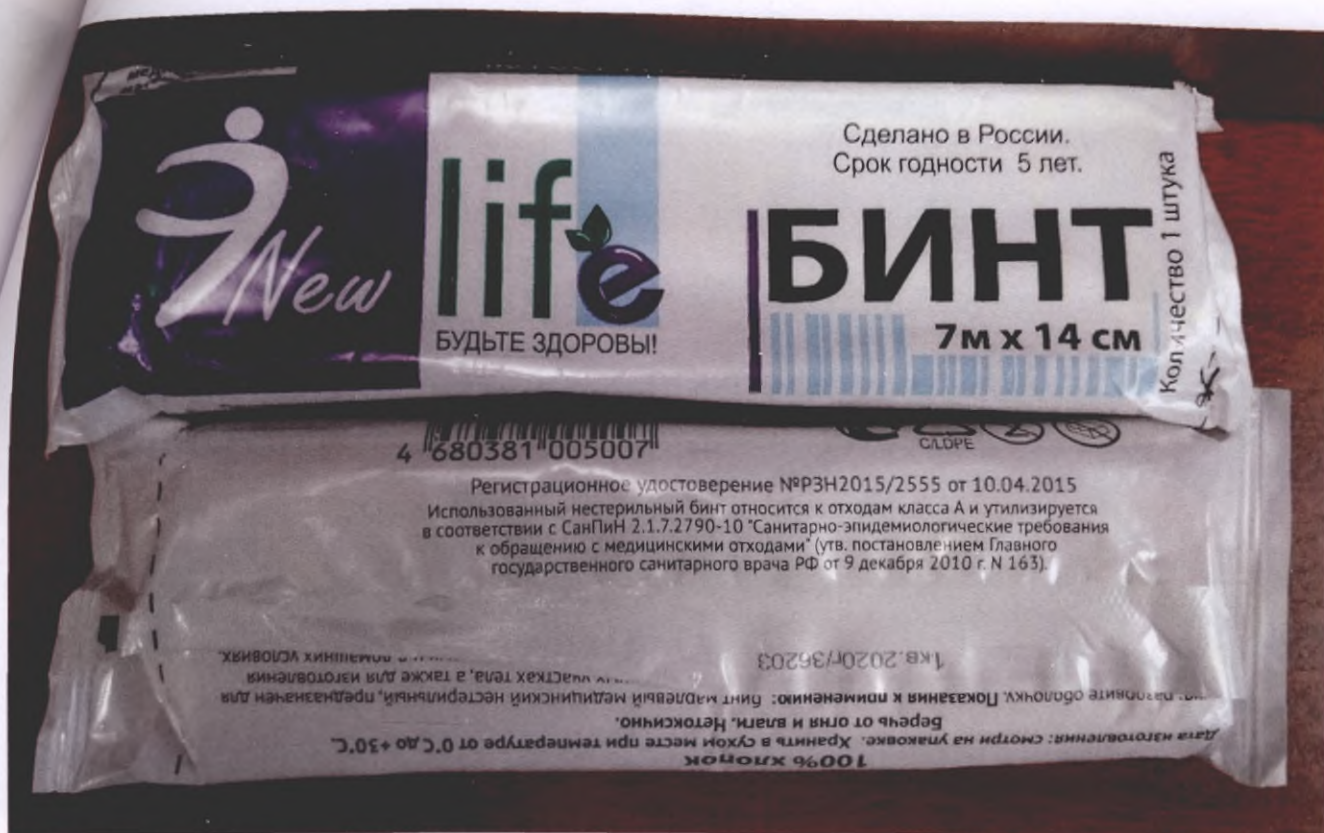


Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см
(Бинты марлевые медицинские нестерильные, РУ № РЗН 2015/2555, производства ООО «ХБК Навтекс», Россия)




Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см
 (Бинты марлевые медицинские нестерильные, РУ № РЗН 2015/2555, производства ООО
 «ХБК Навтекс», Россия)



Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10
(Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, РУ № ФСР
2011/12069, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия)

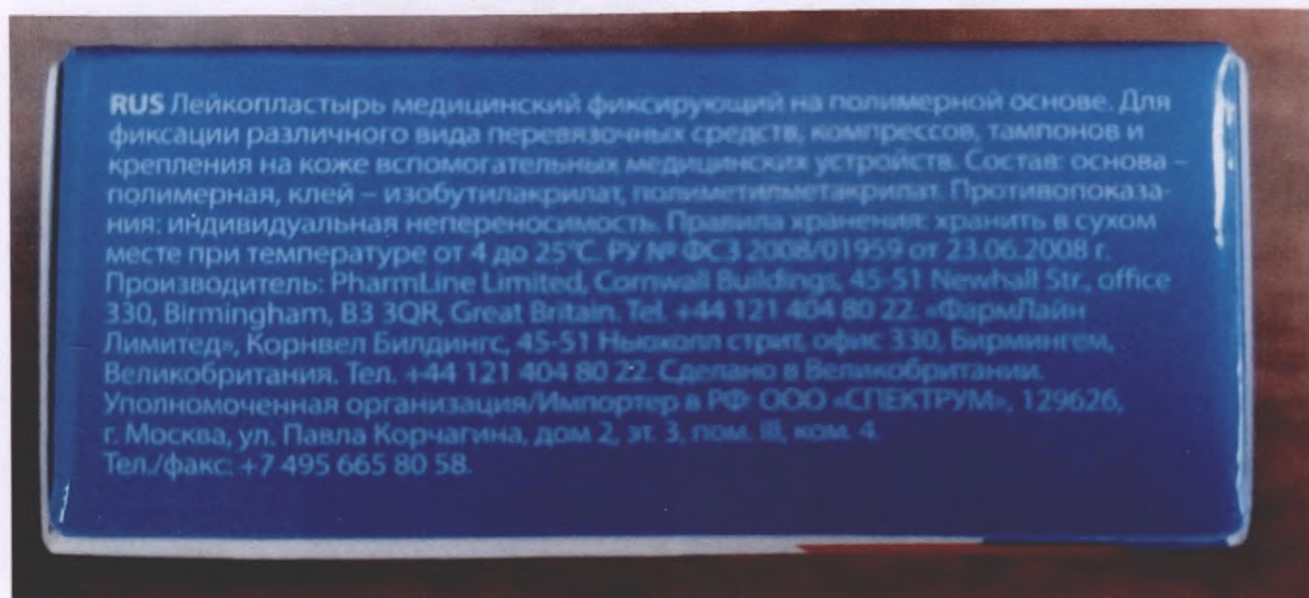

Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см
(Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой,
тканевой основах, РУ № ФСЗ 2008/01959, производства «ФармЛайн Лимитед»,
Великобритания)

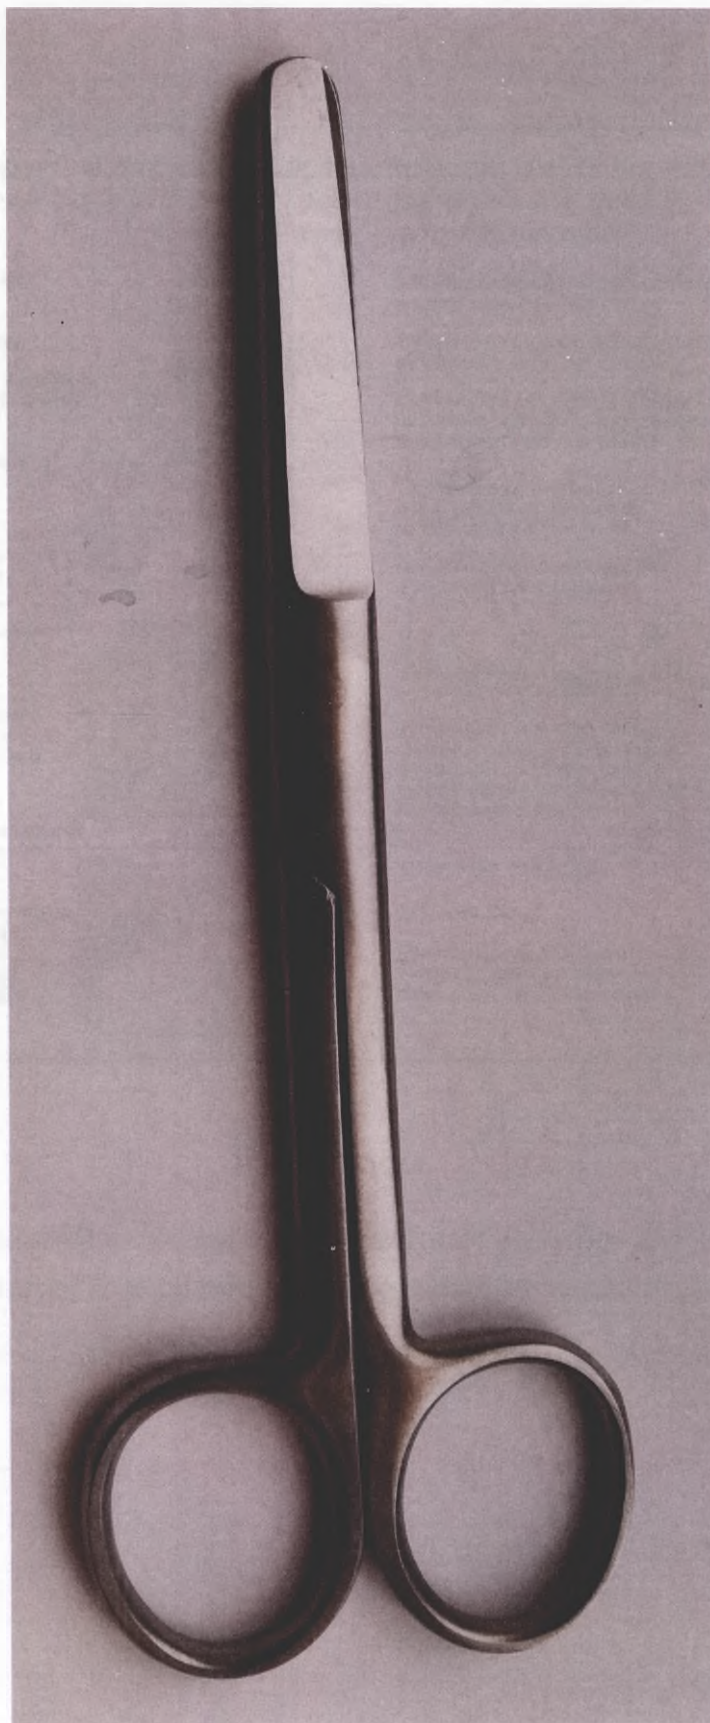

Ножницы, РУ № ФСР 2010/07370, производства ОАО «МИЗ им. М. Горького»,
Россия

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

1. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Маска медицинская нестерильная одноразовая

Применяют для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём.



1.2. Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М

Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались.



1.3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»

Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-лёгочной реанимации.



1.4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения

Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки.



1.5. Бинт марлевый медицинский, размер не менее 5 м x 10 см

1.6. Бинт марлевый медицинский, размер не менее 7 м x 14 см

Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей.



1.7. Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10

Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей.



1.8. Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см

Используйте для закрытия ссадин, потёртостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди.



2. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

2.1. Ножницы

Применяйте для отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.



Инструкция

по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)



Общий вид Аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Мицар» по ТУ 21.20.24 - 090 - 50117782 - 2020 в транспортной таре с маркировкой

Прошито, пронумеровано,
опечатано

19 (Десятигудат) листов

Директор
Загулина Н.В.



Заг