


Генеральный директор ООО «Медфорд»




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Аппарат ультразвуковой диагностический для неинвазивного определения степени фиброза печени iLivTouch в вариантах исполнения FT100, FT200, в составе

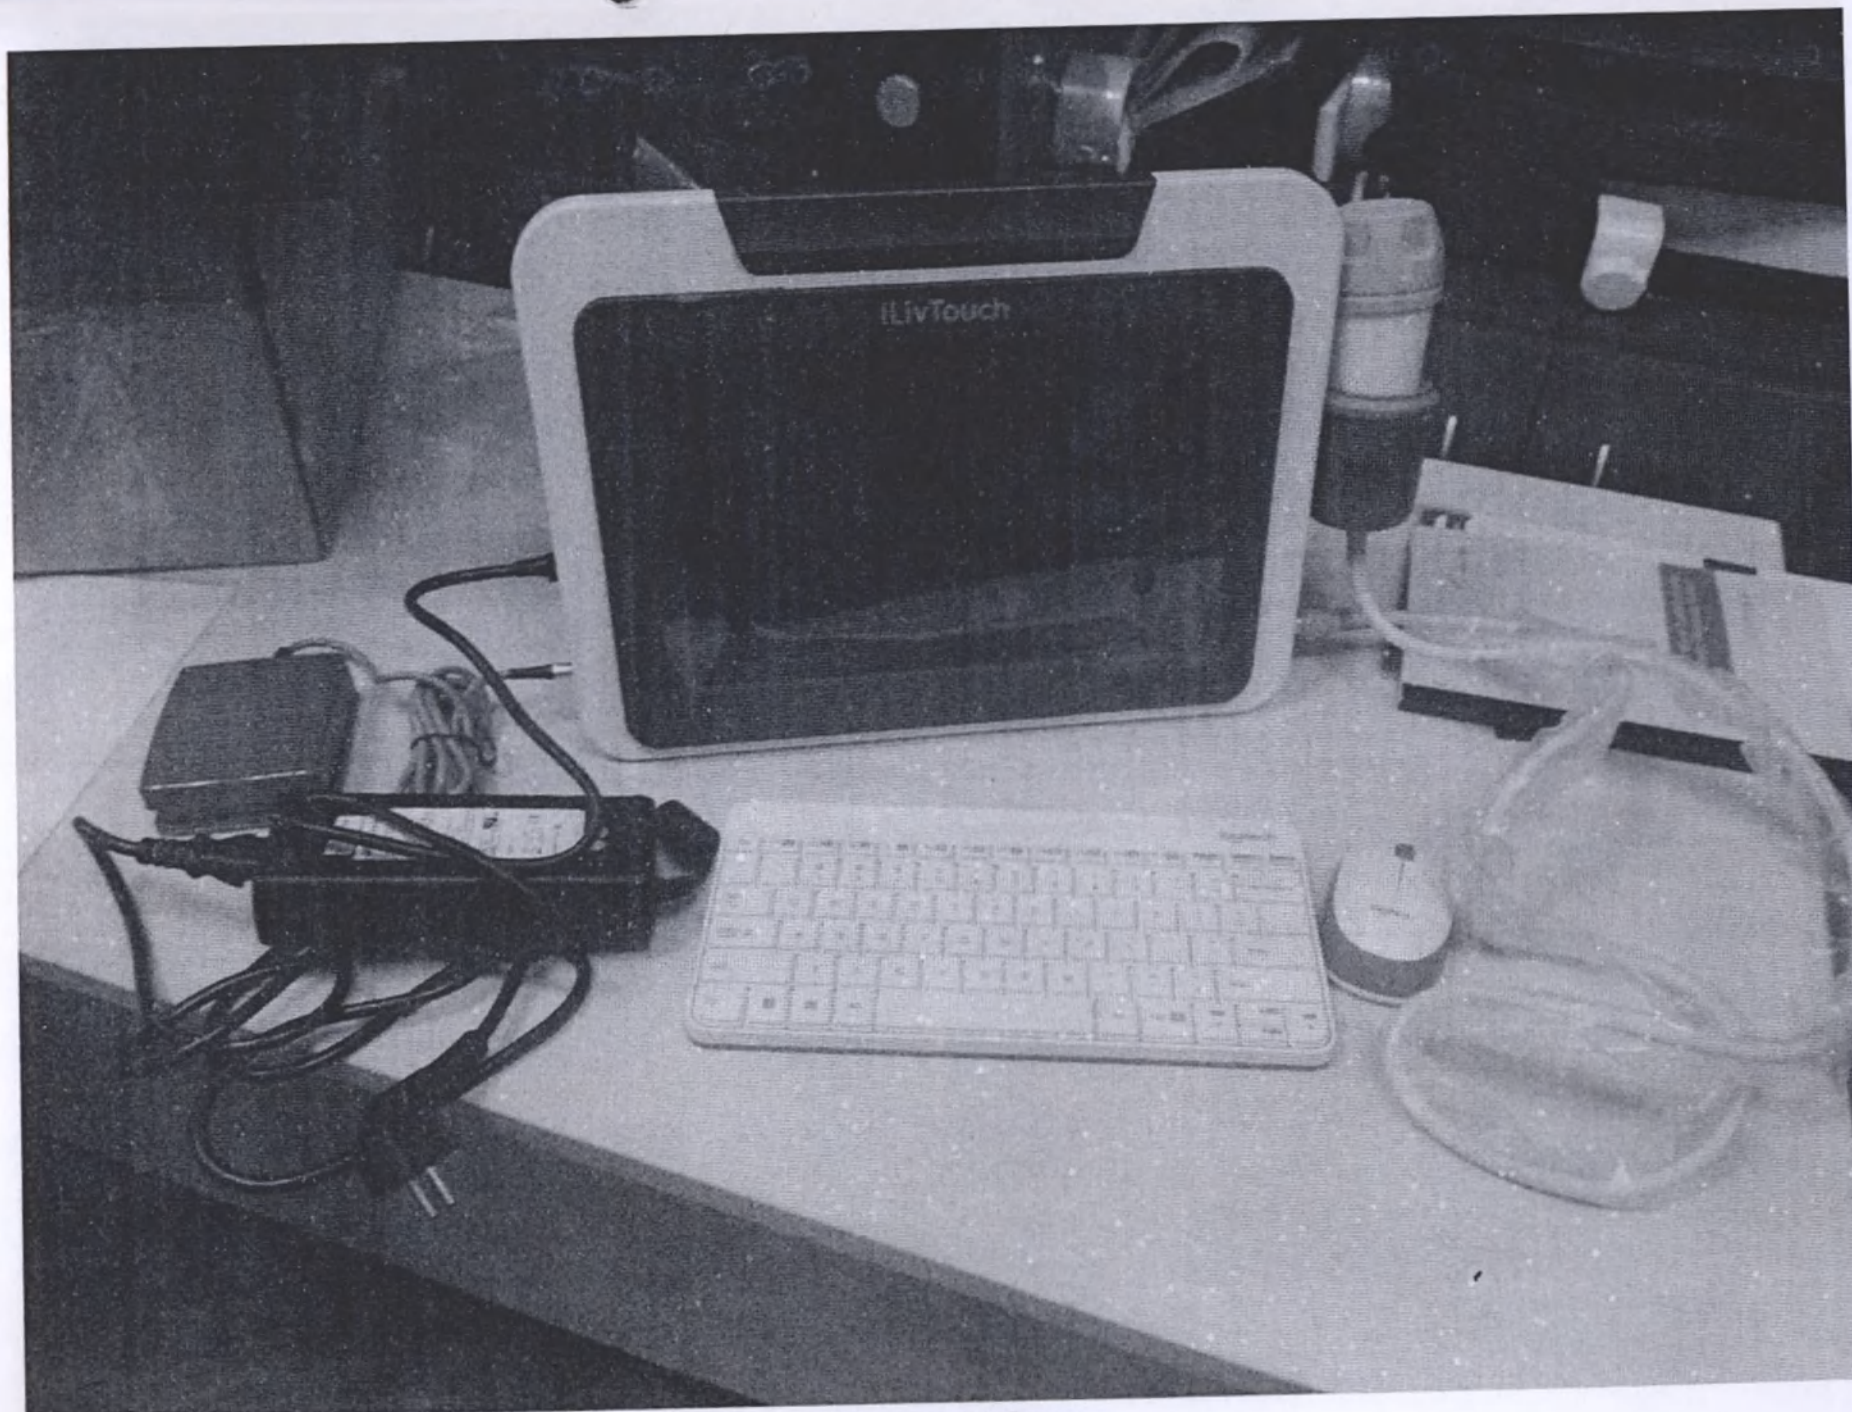

Основной блок

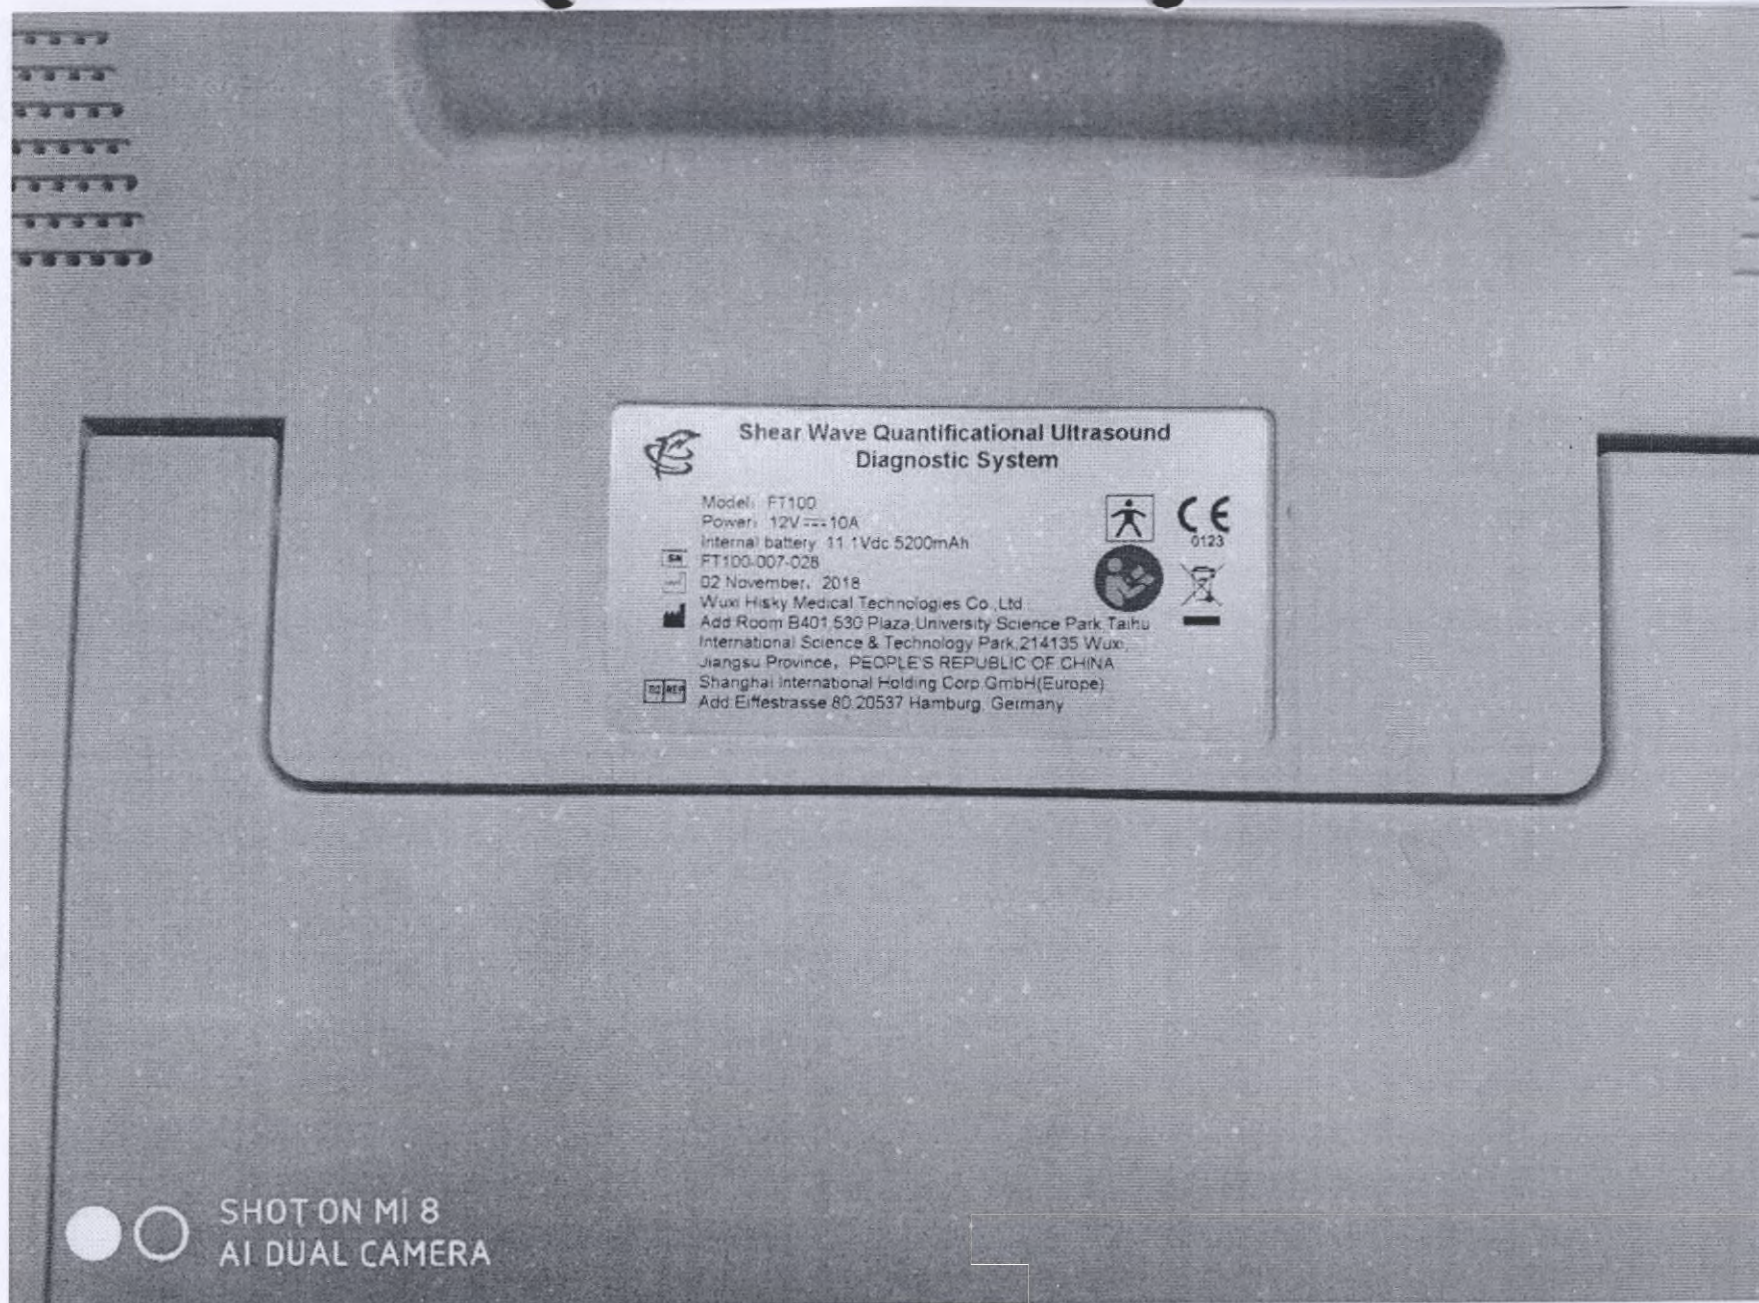

Основной блок

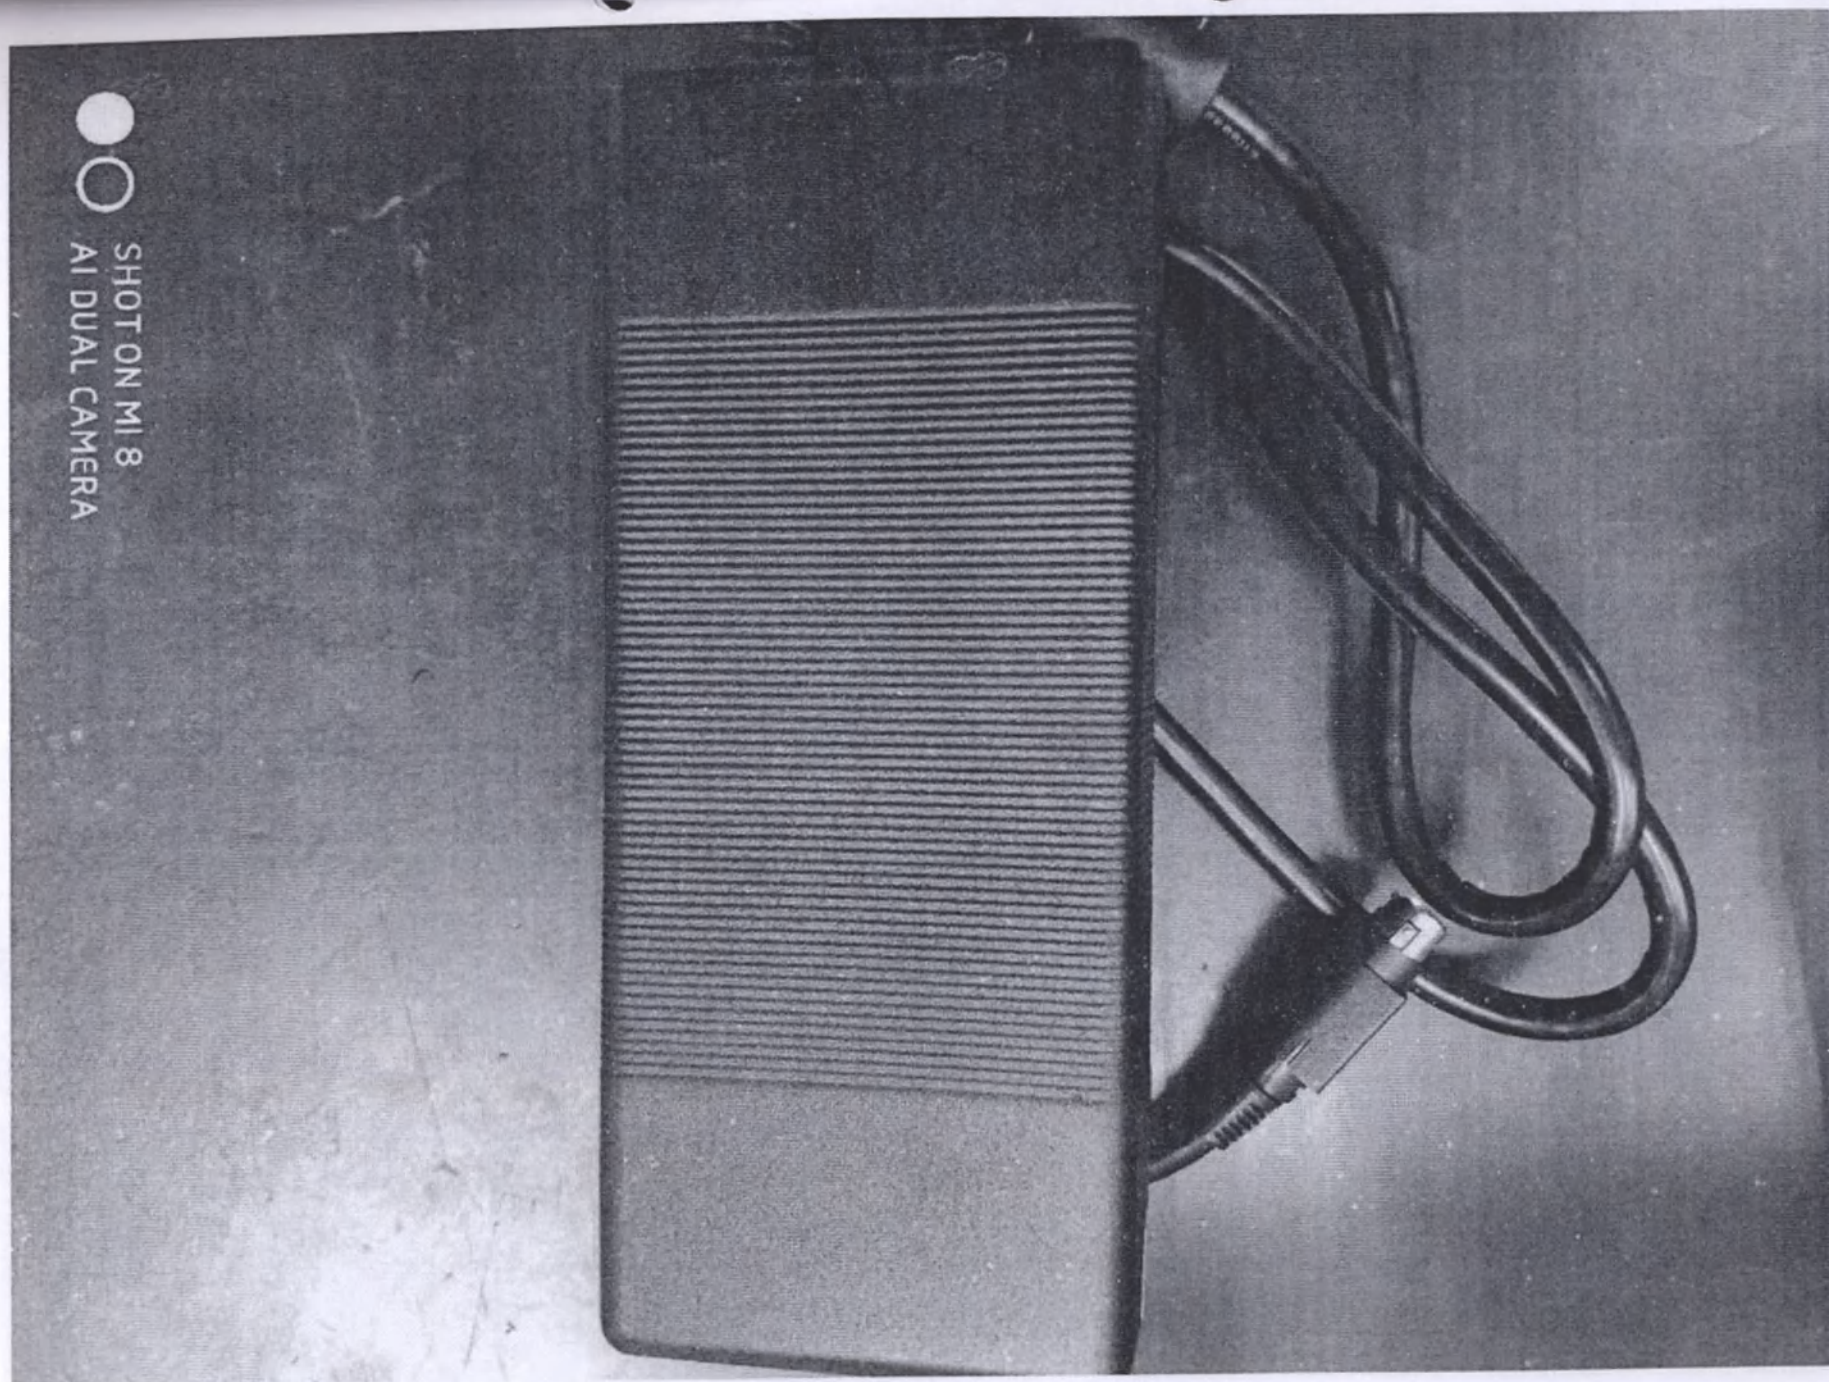


Блок питания




● ○ SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

Датчик для фиброскопирования


SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

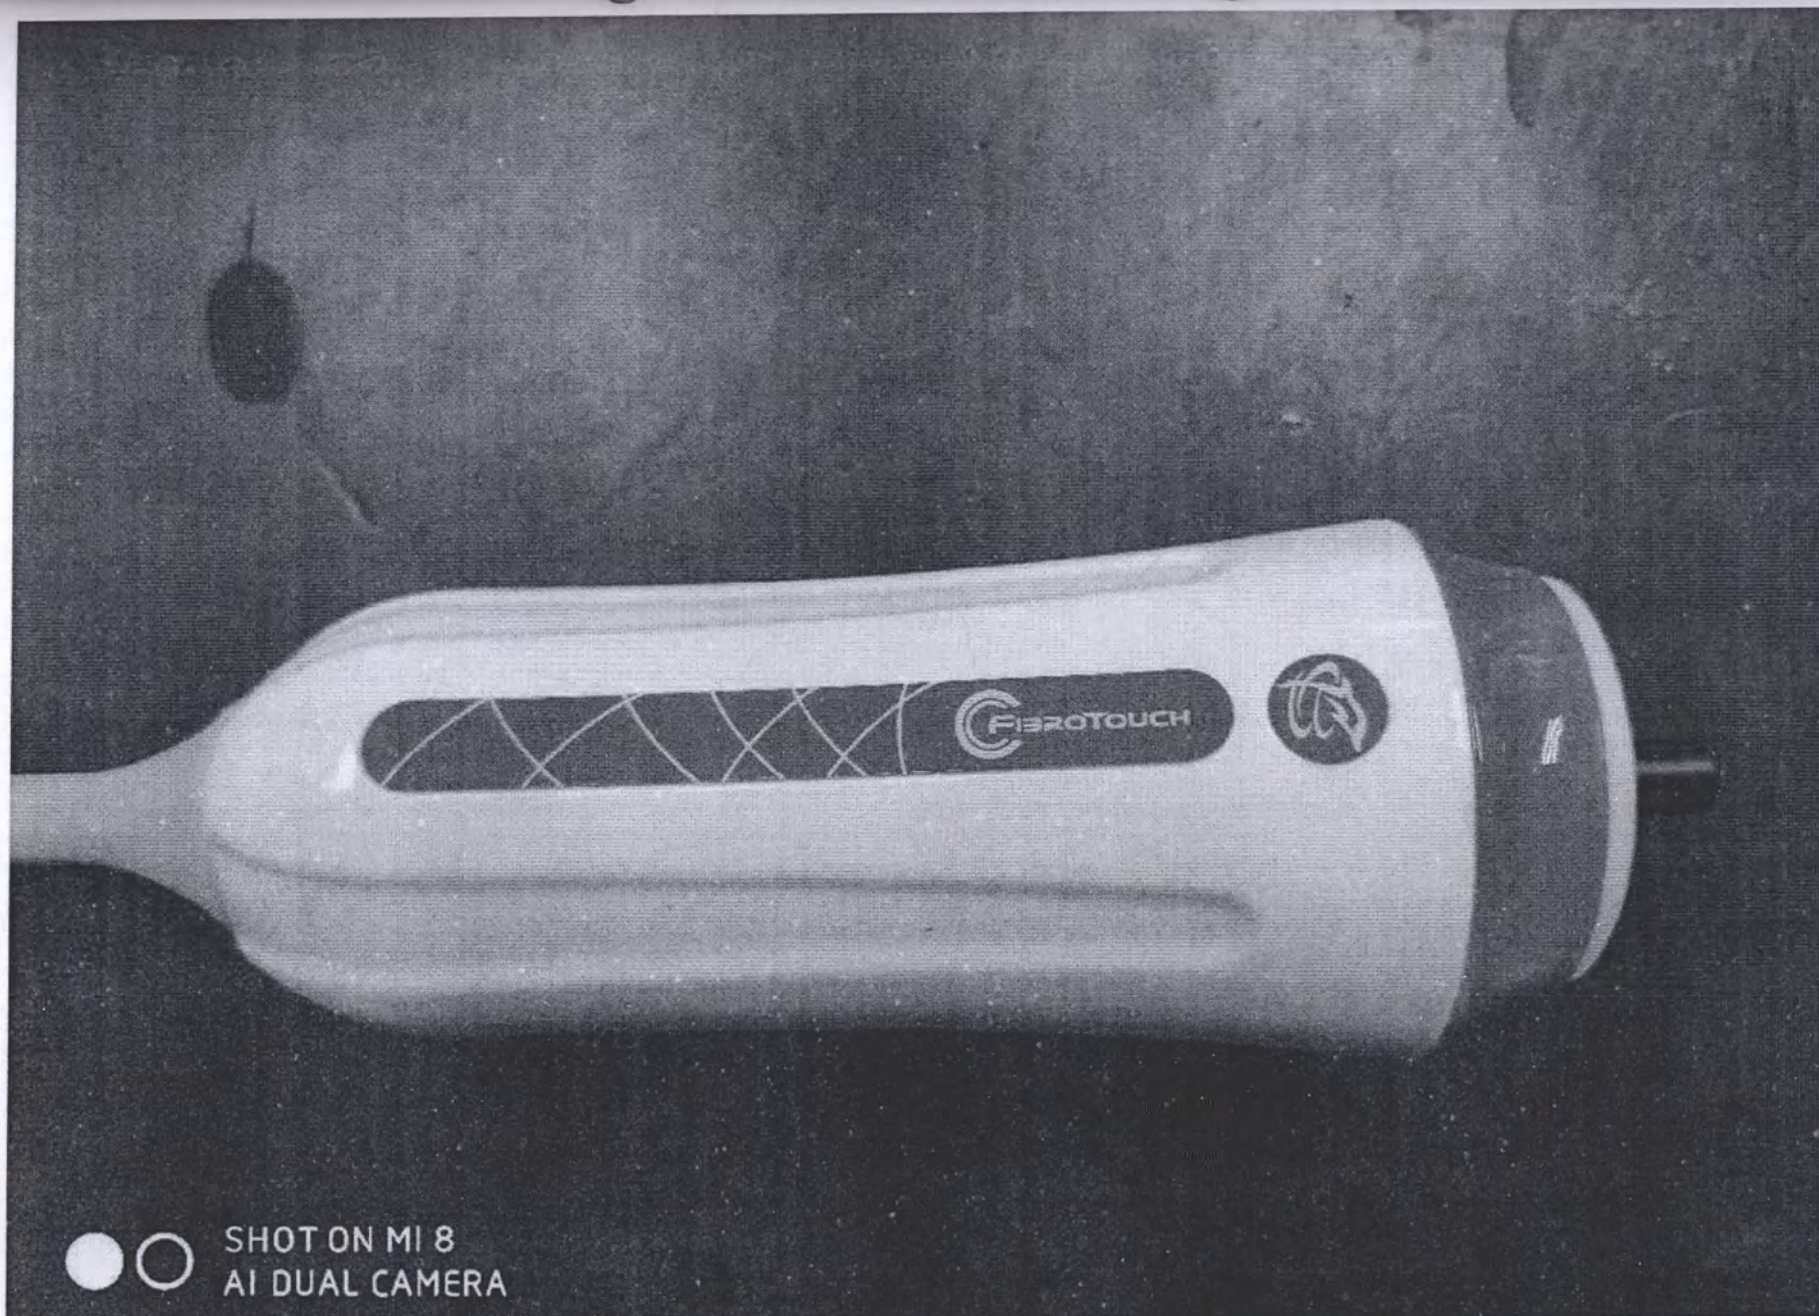


Датчик для фибросканирования

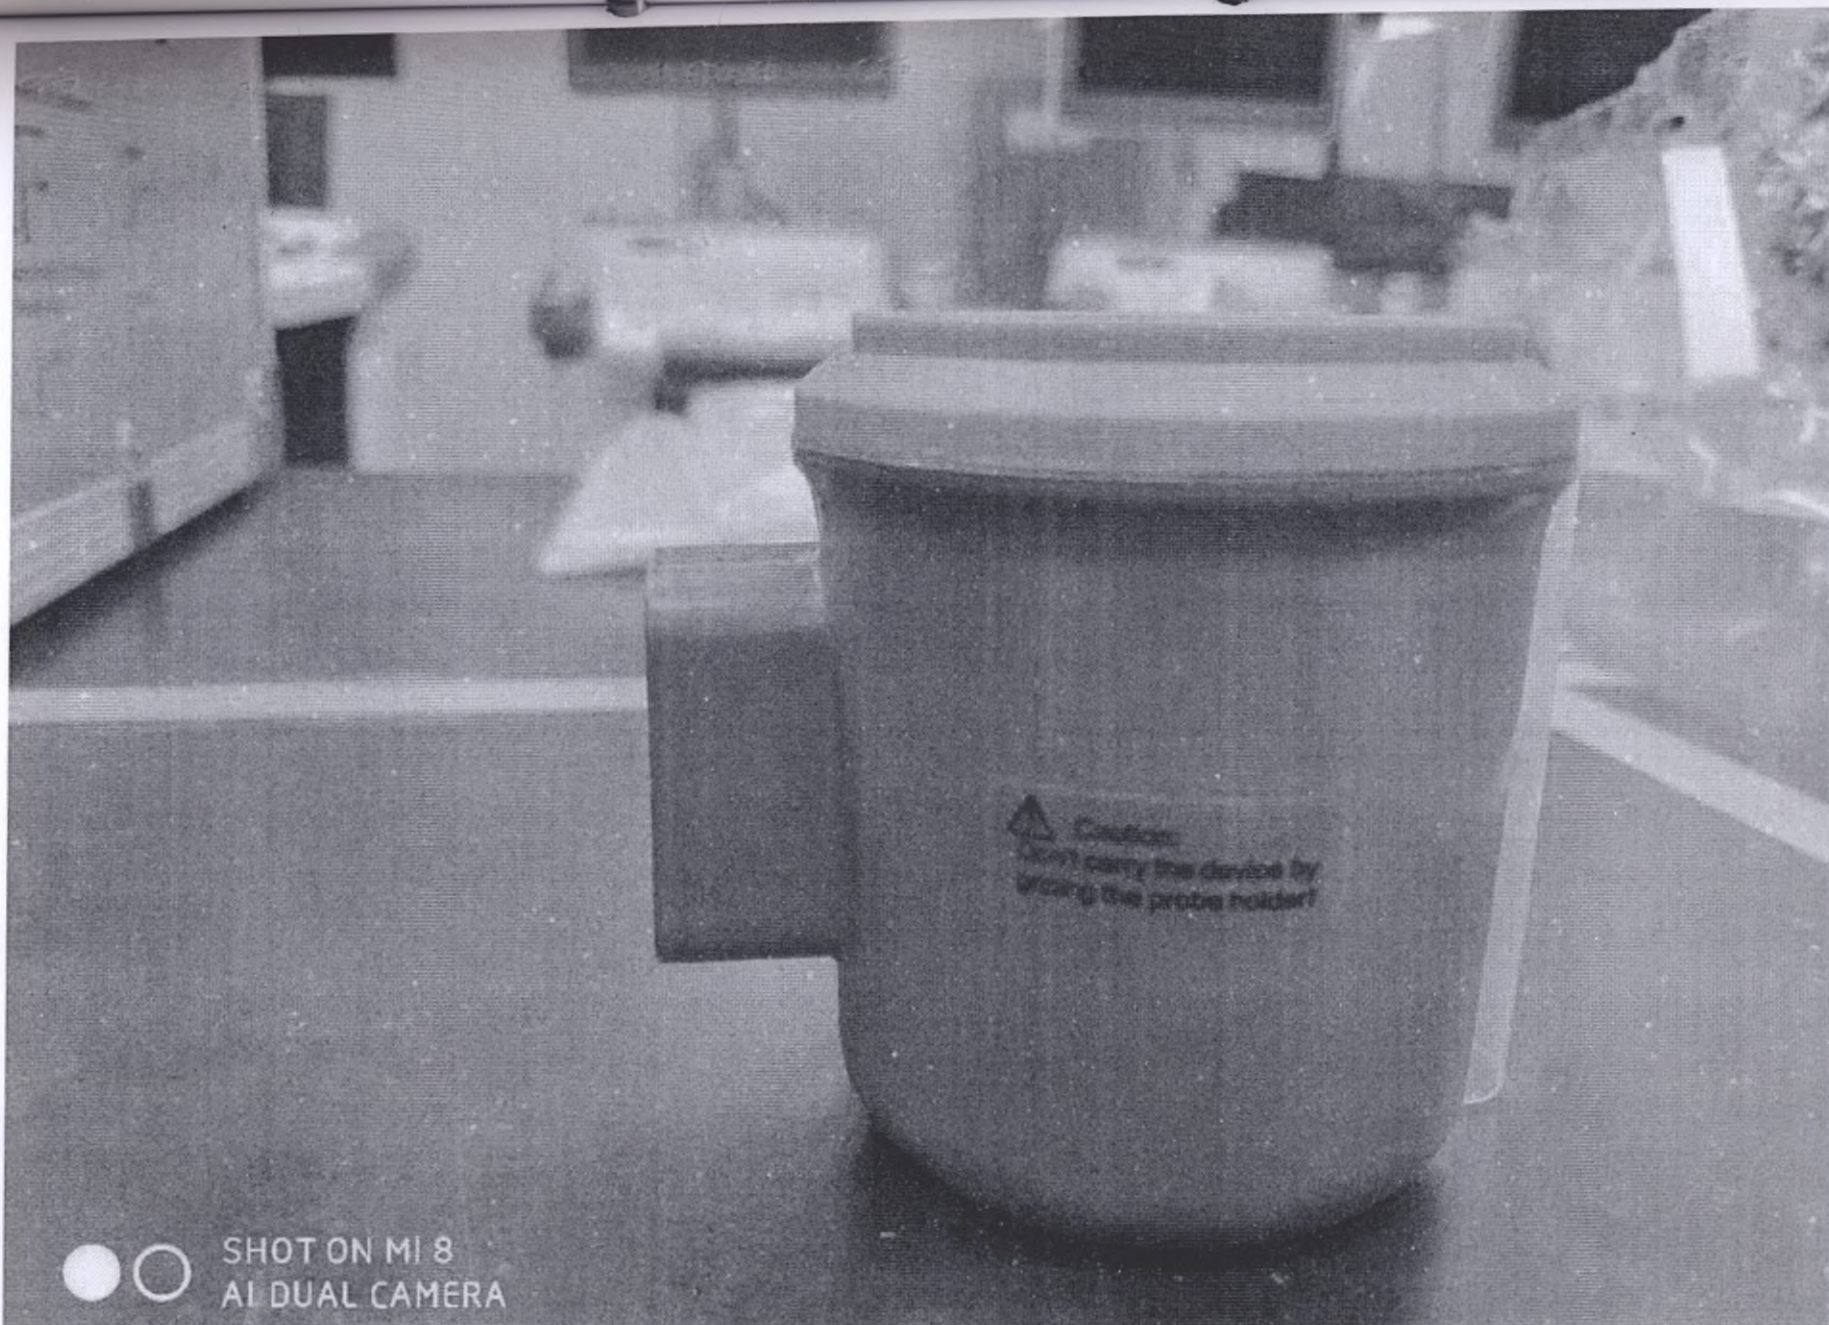


Держатель датчика

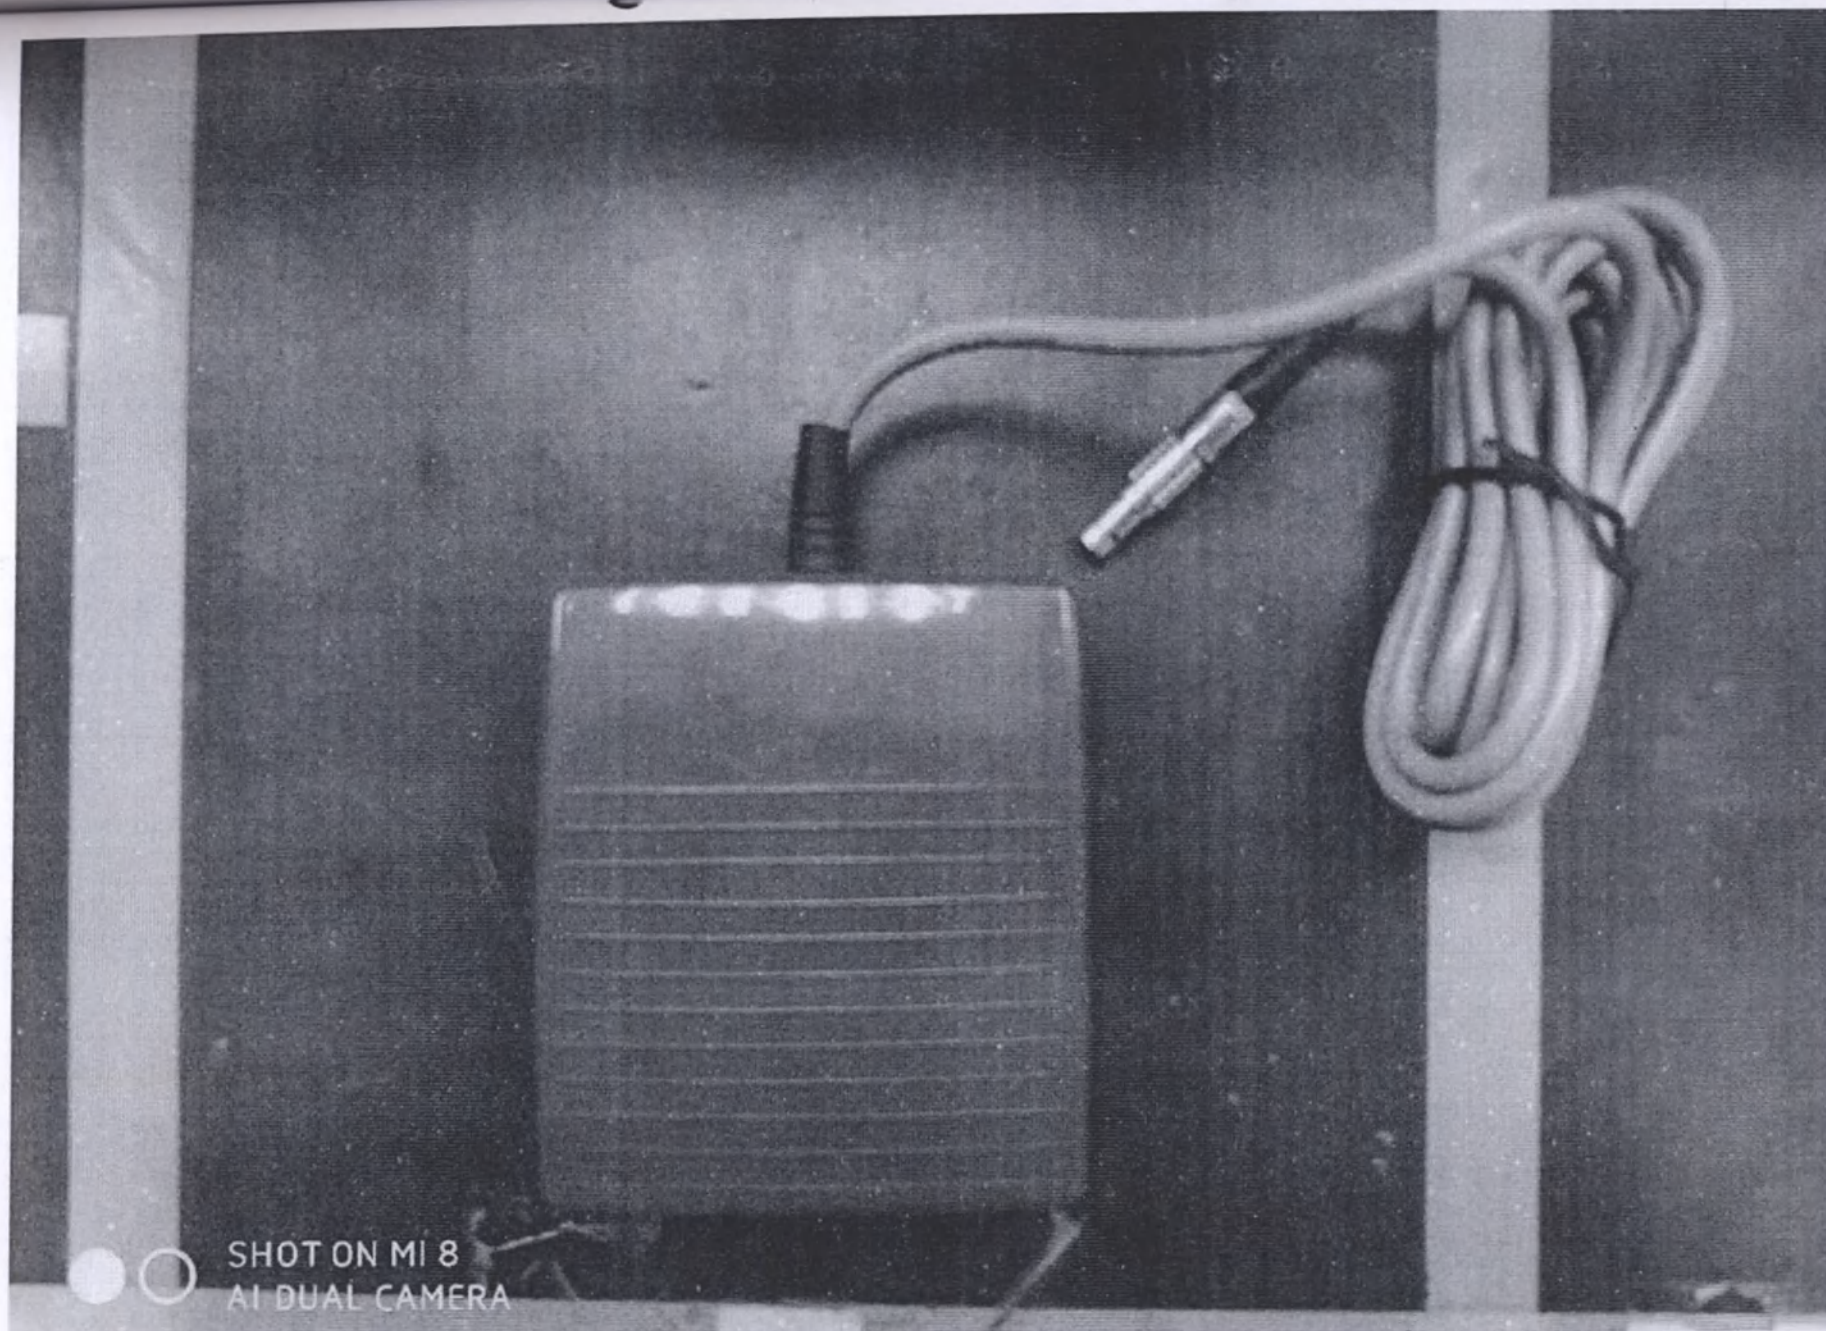


Ножной переключатель

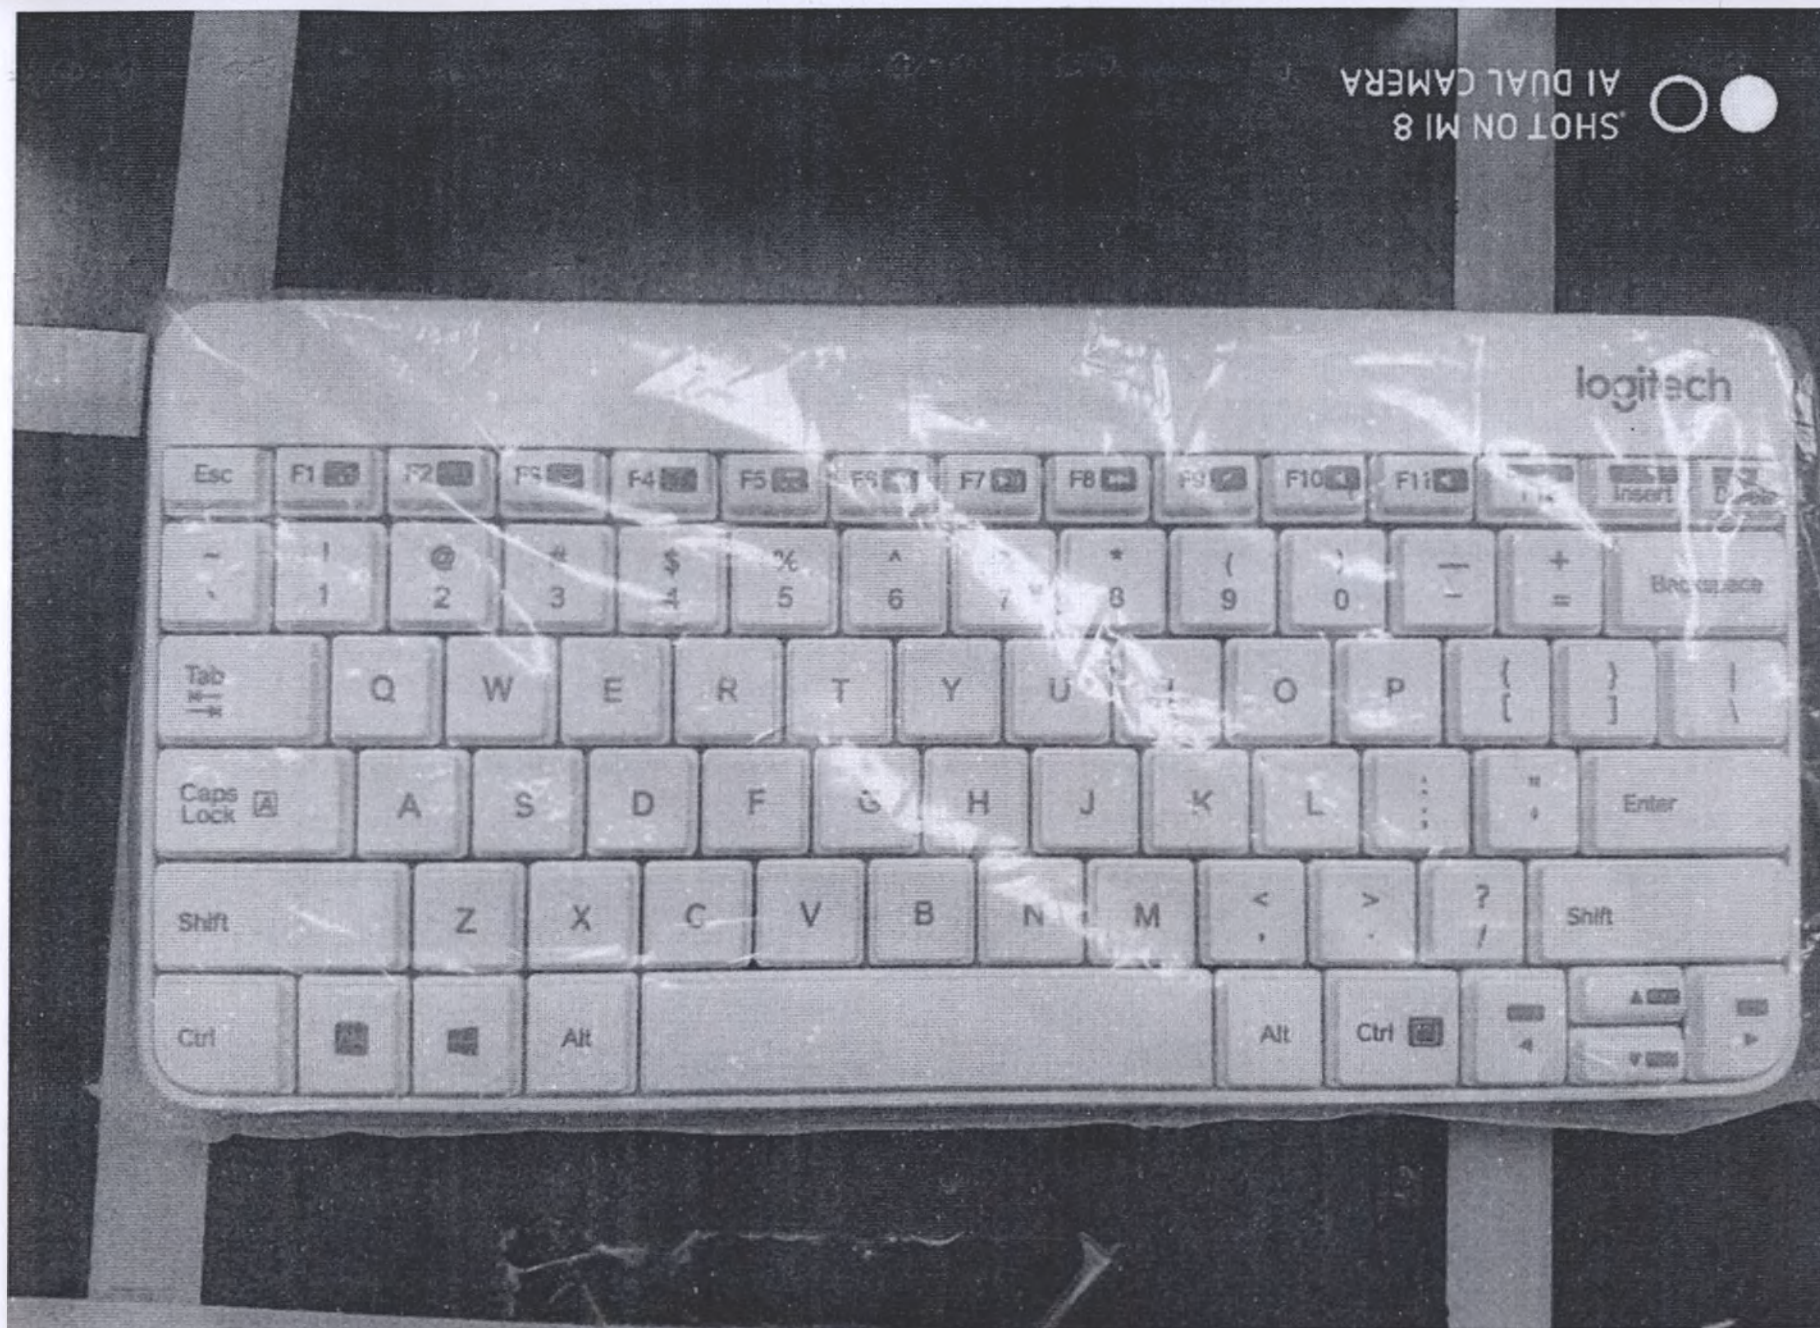


Комплект устройств ввода: клавиатура

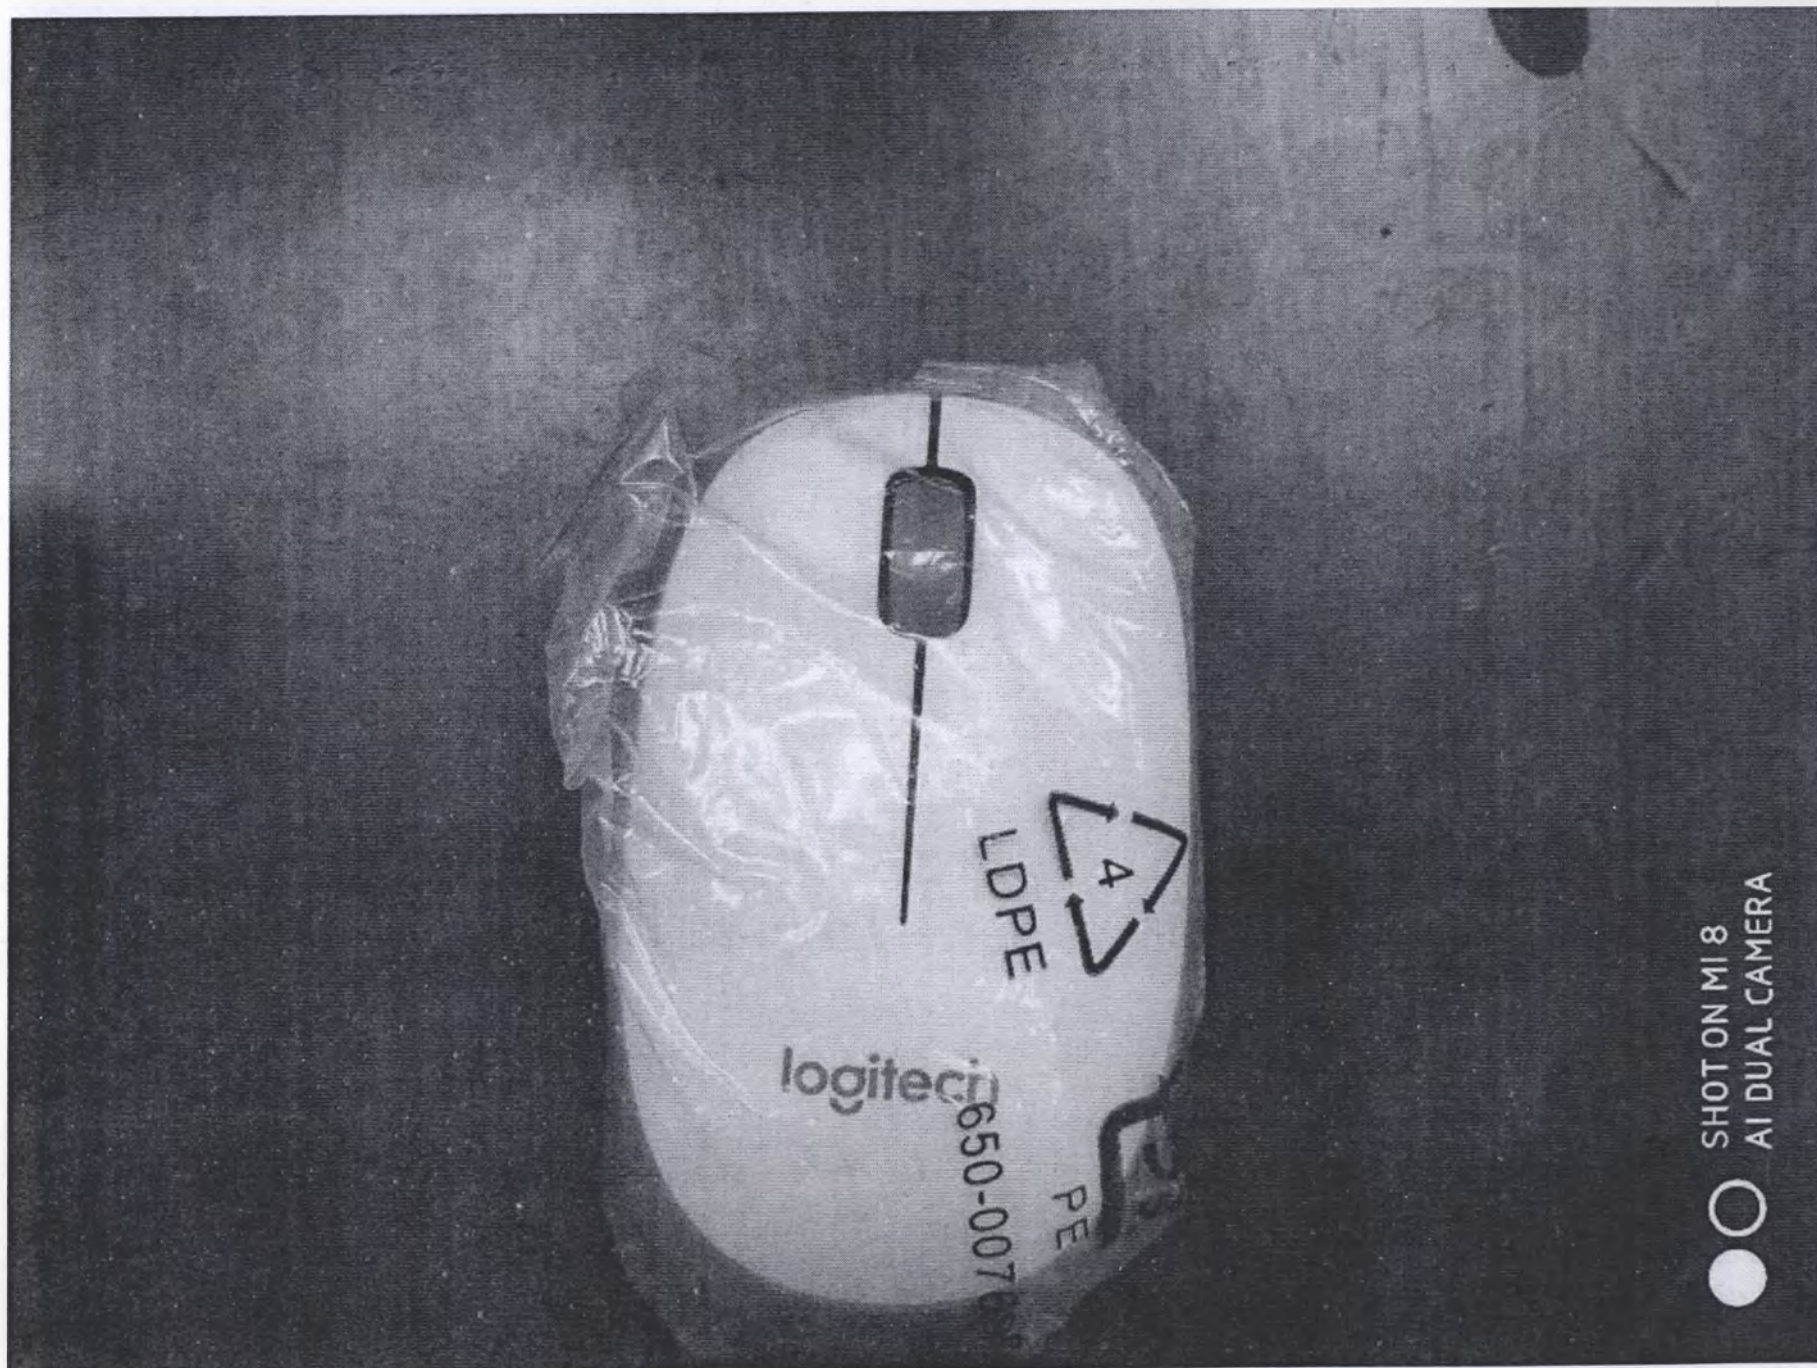


SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

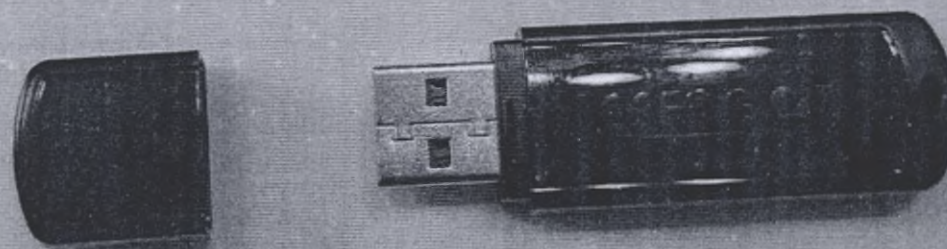


Комплект устройств ввода: USB-ключ

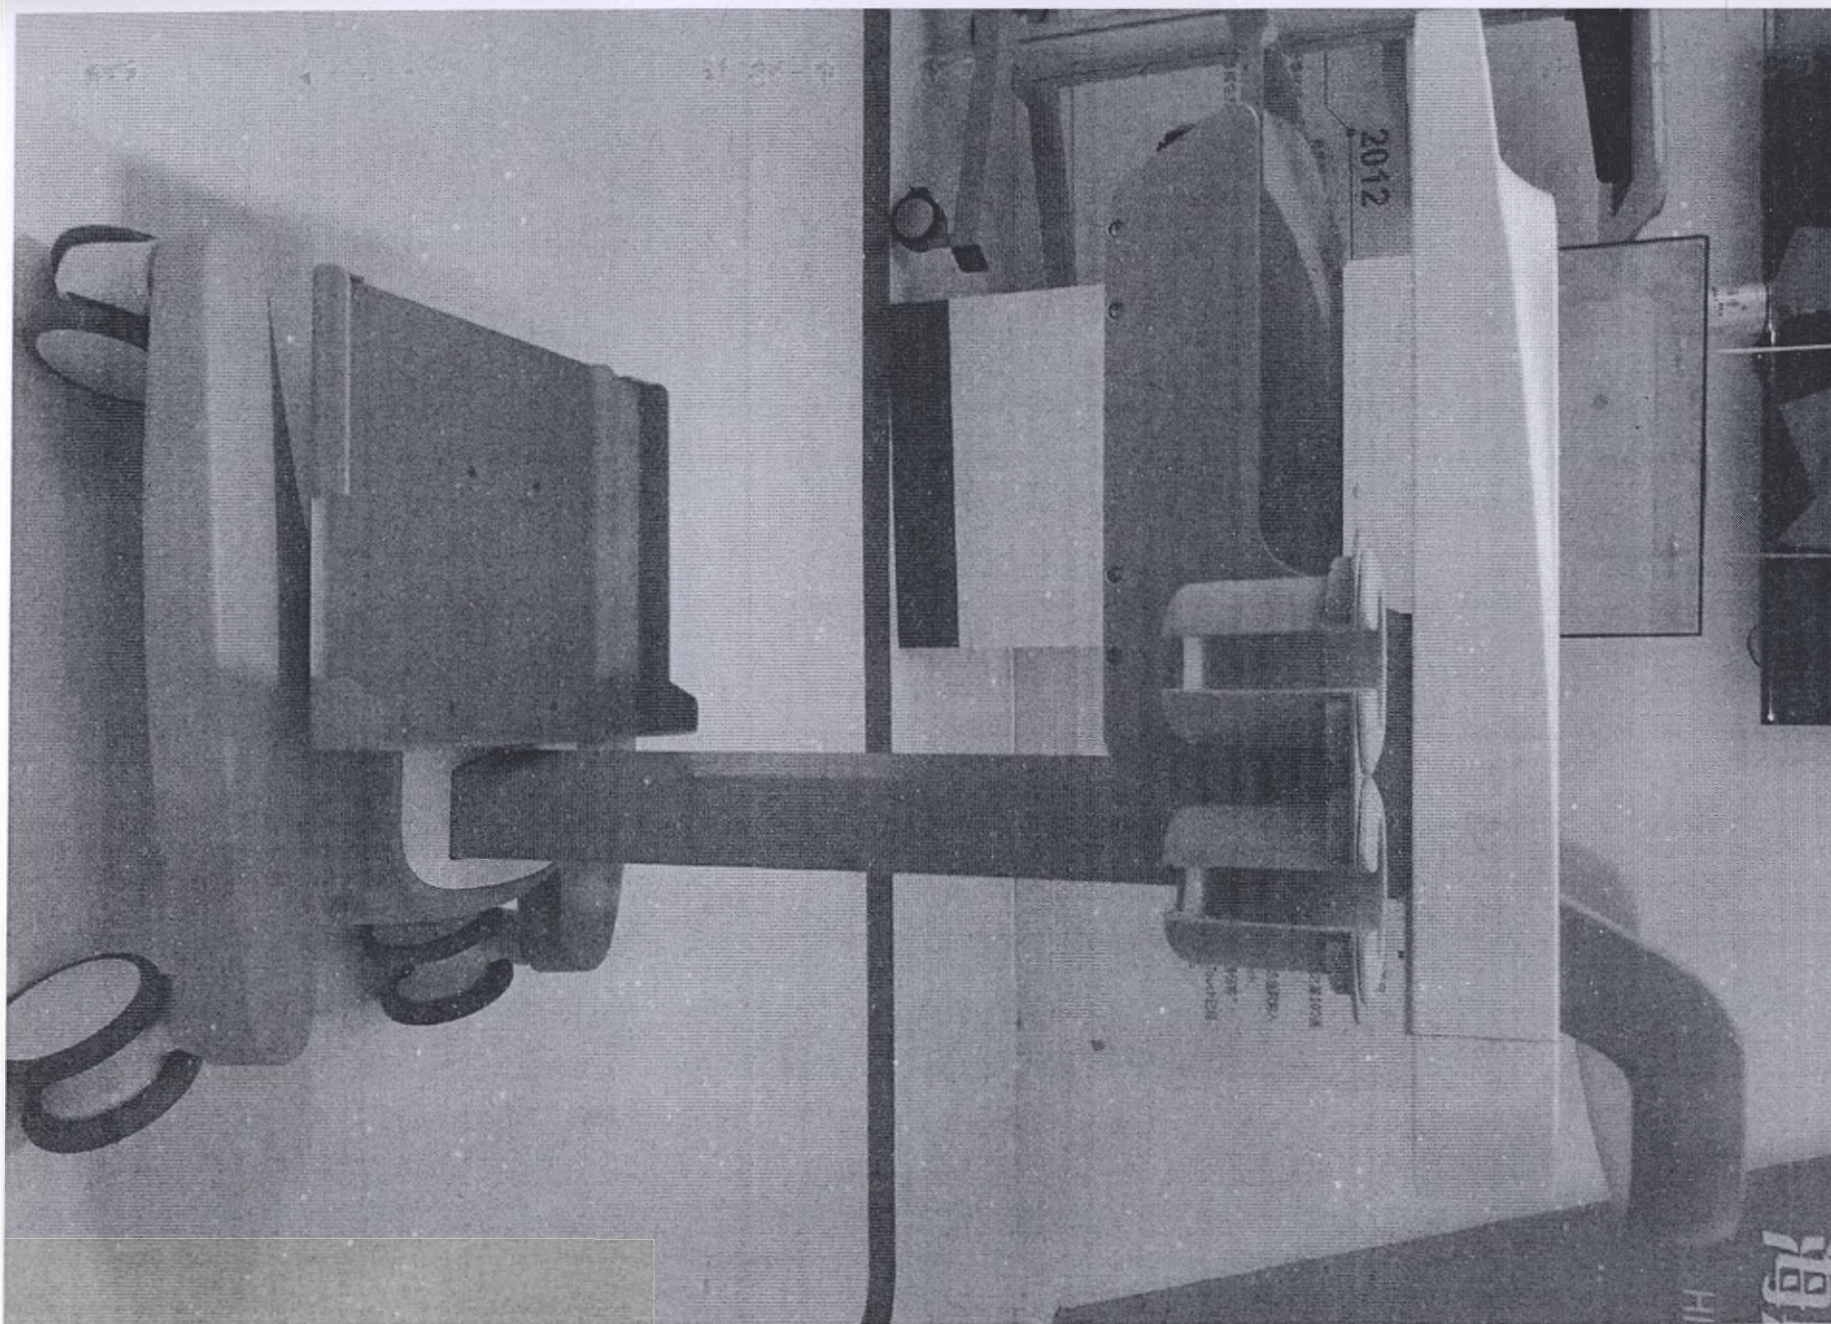


Тележка

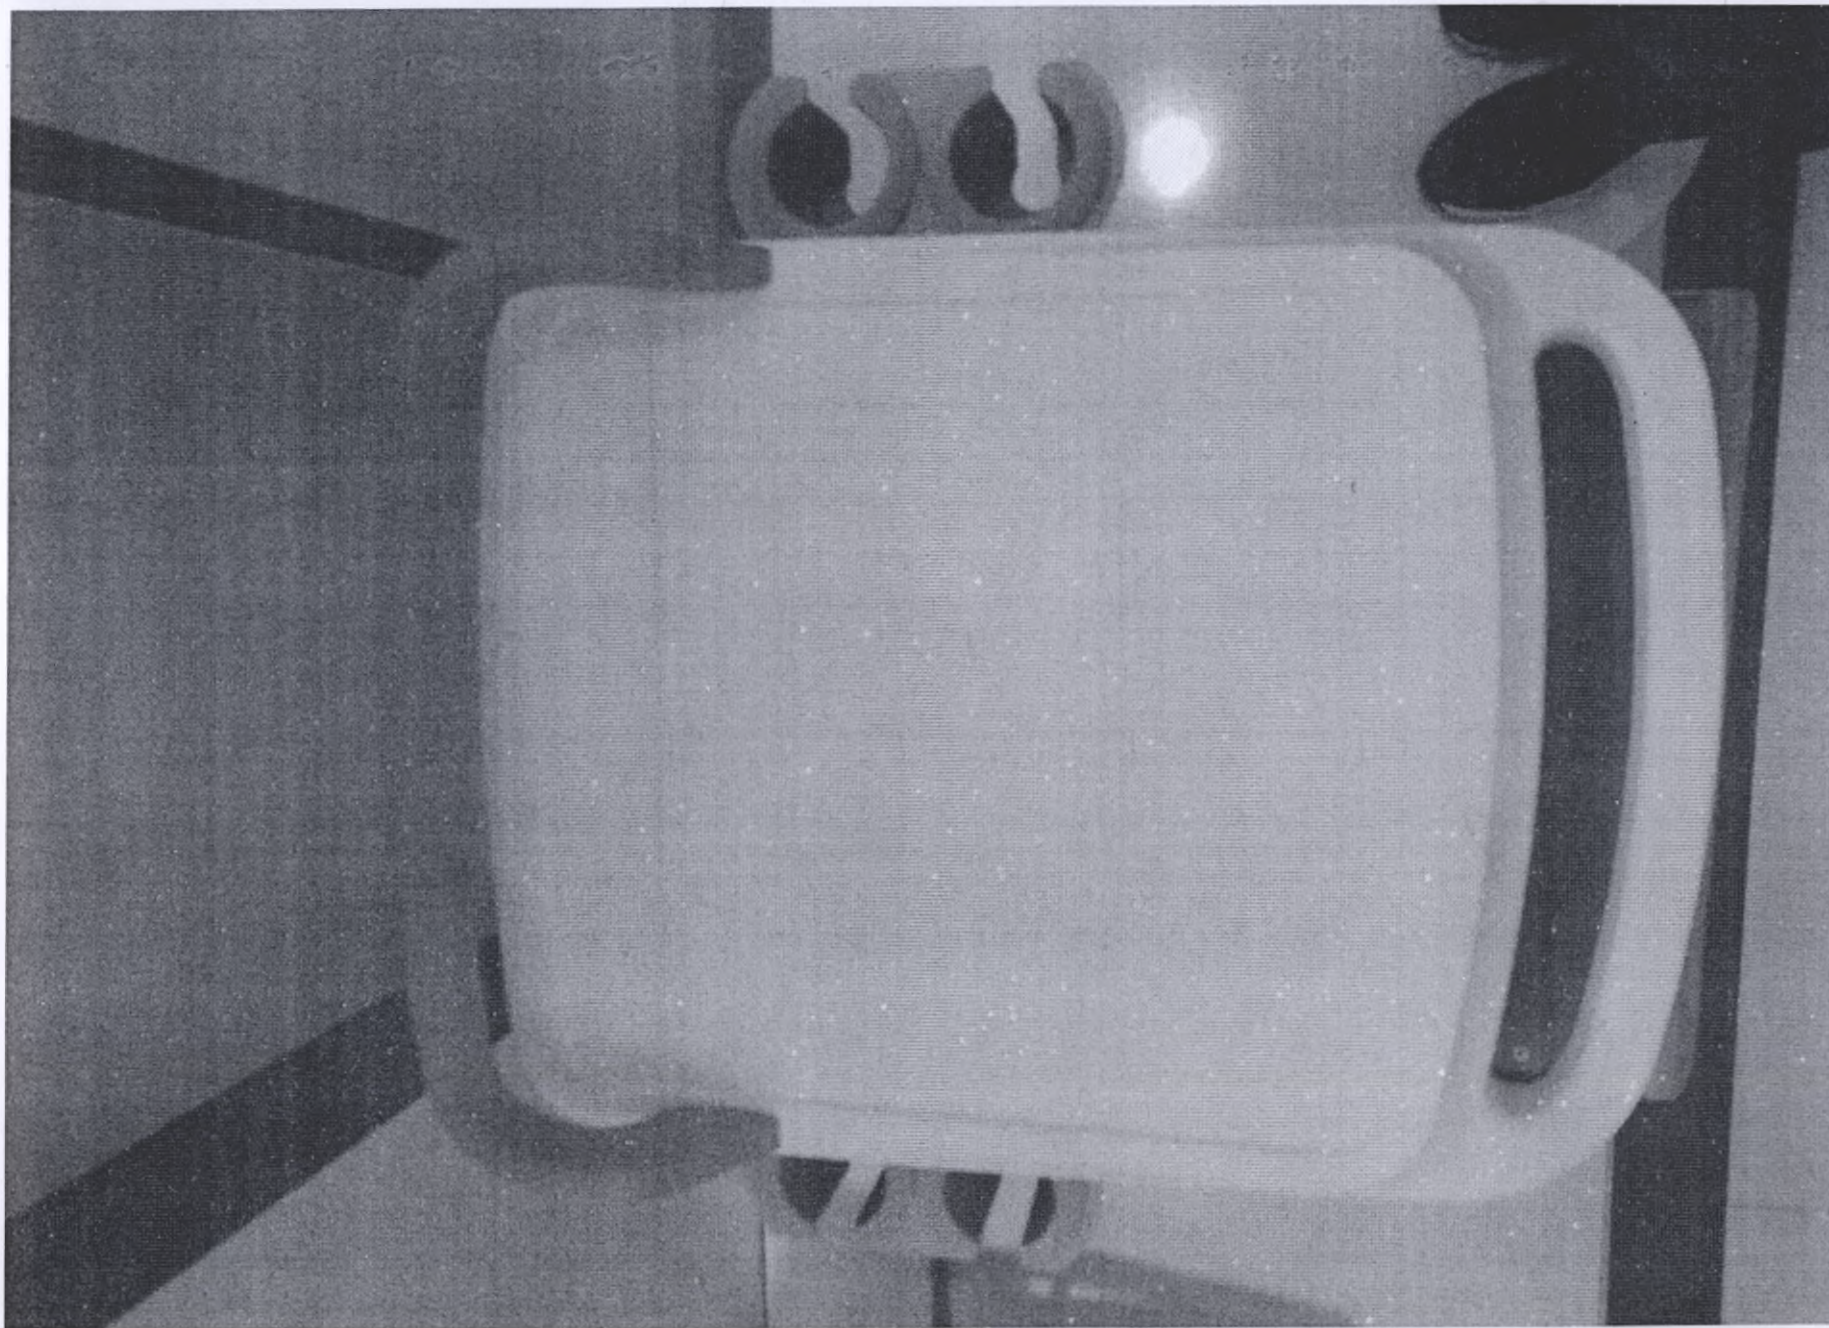

Тележка

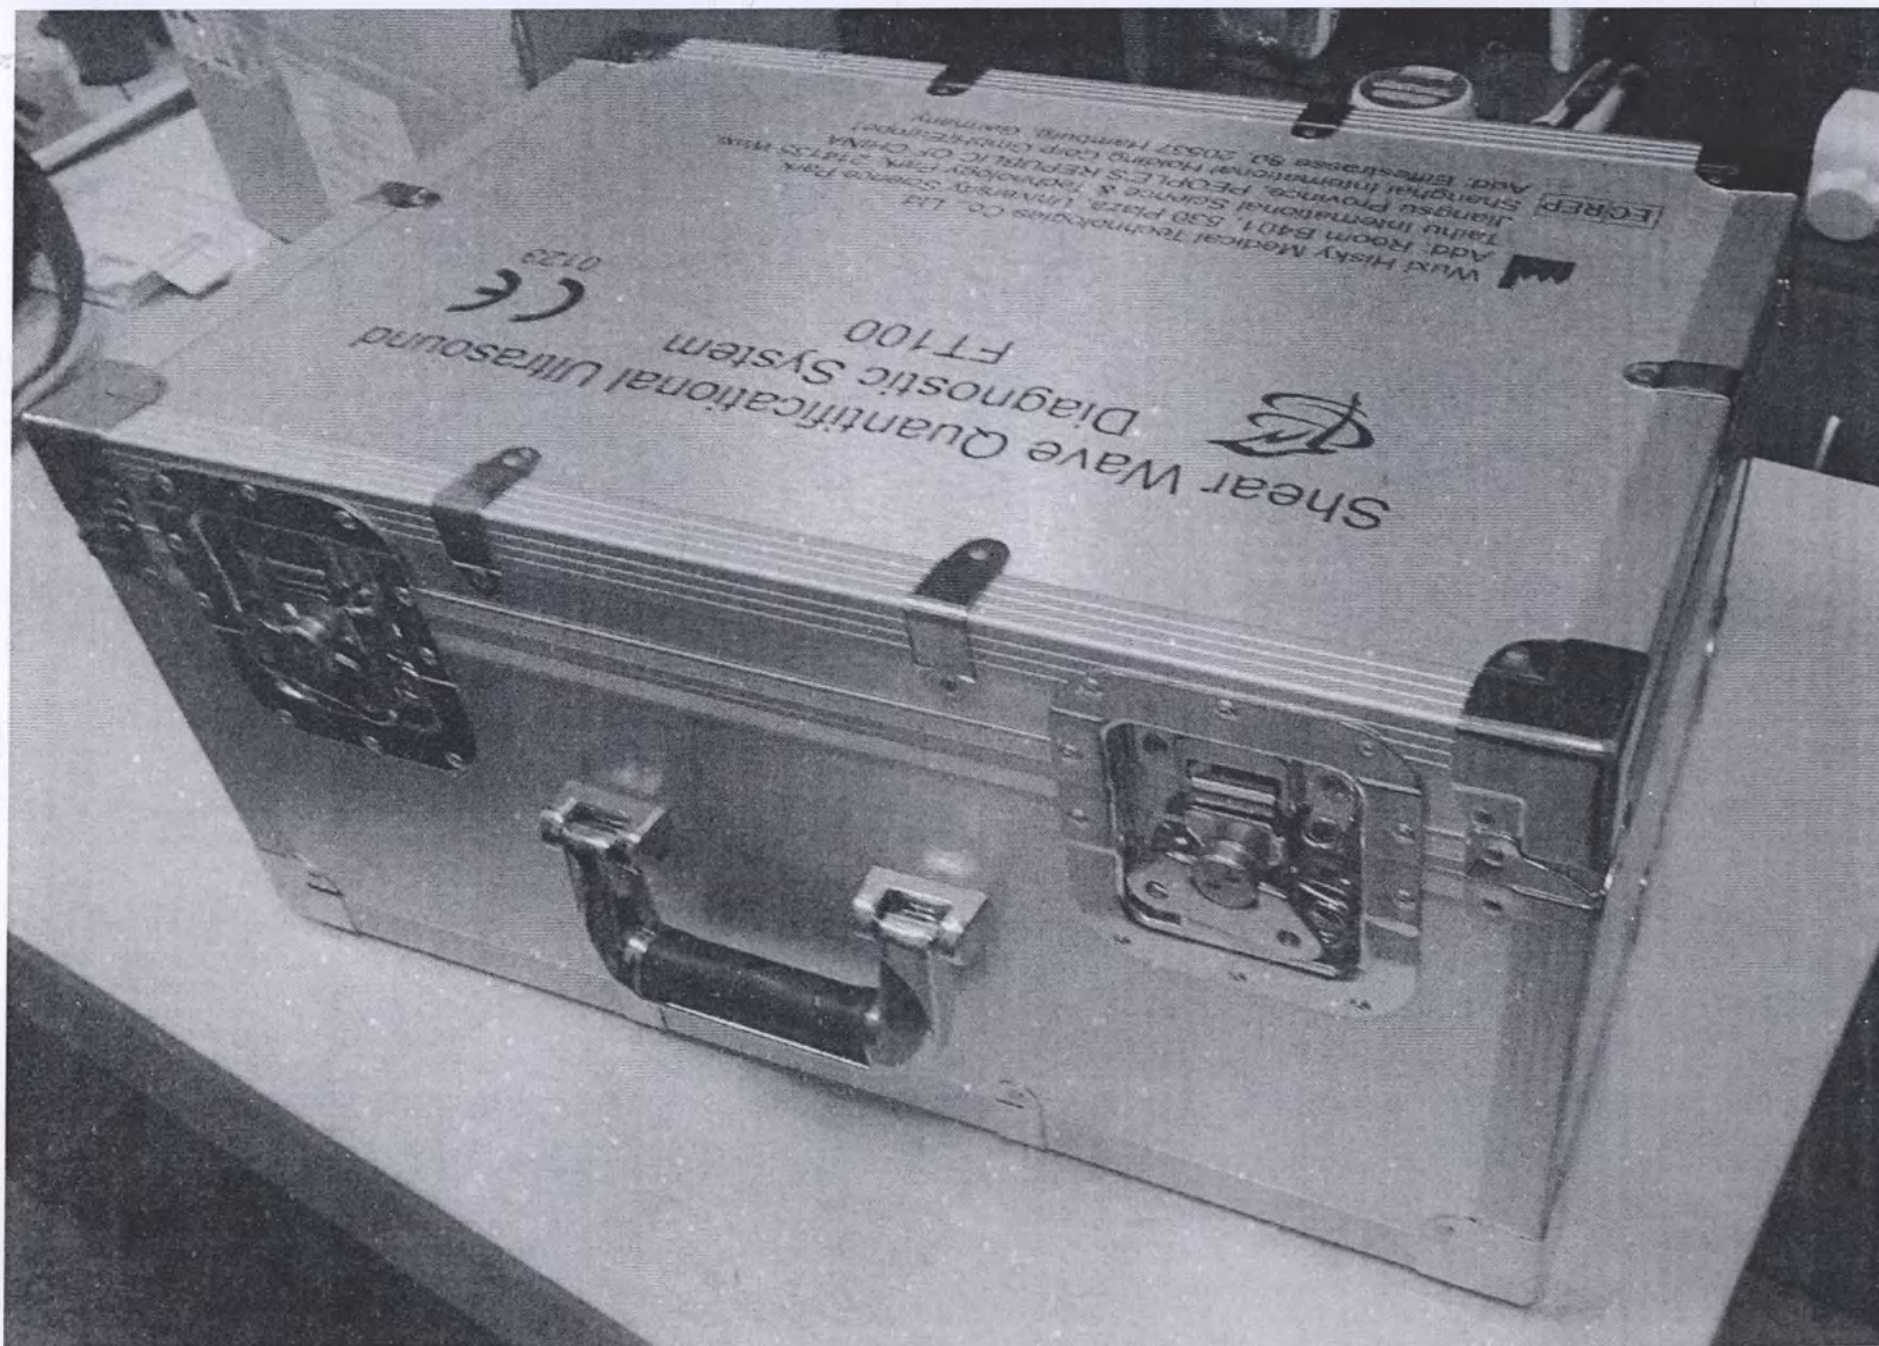

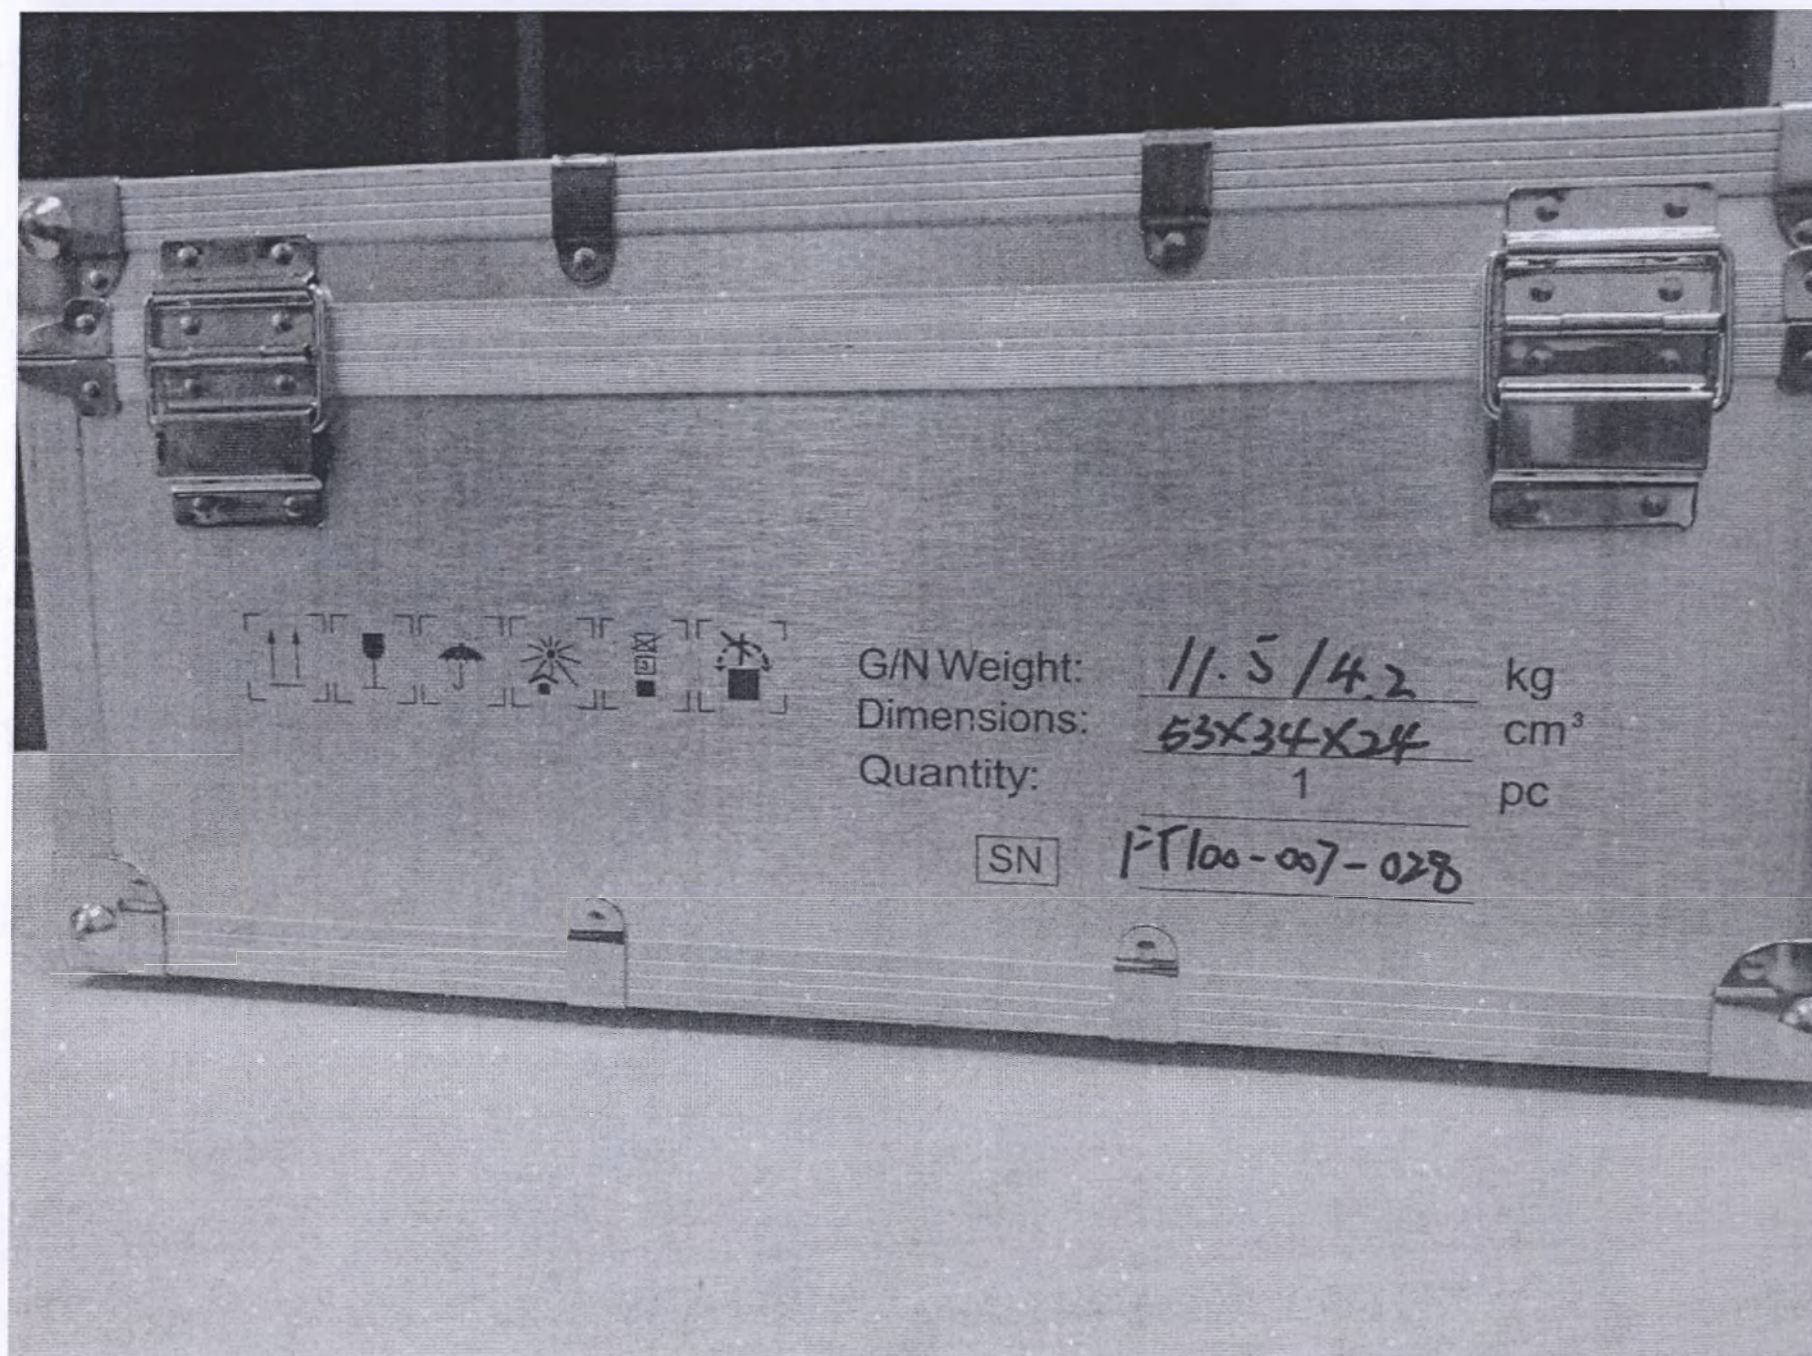



Аппарат ультразвуковой диагностический для неинвазивного
определения степени фиброза печени iLivTouch в вариантах
исполнения FT100, FT200

SN



«Wuxi Hisky Medical Technologies Co., Ltd.», Room B401, 530 Plaza, University
Science Park, Taihu International Science & Technology Park, 214135 Wuxi, Jiangsu
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA/Китайская Народная Республика

Регистрационное удостоверение № ФСЗ от

Уполномоченный представитель: ООО «Медфорд»

Адрес: 111116, Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 4,
корпус 3, комната 8.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Адрес: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany (Гамбург, Германия)

Макет маркировки на русском языке.

Пронумеровано, прошито
скреплено печатью 1

восемнацать листов

