

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»

Б.С. Хышиктуев


«01» марта 2020г

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Помпа для энтерального питания SN, варианты исполнения: SN-600N, SN-600NR, SN-M1, SN-M2, SN-N2



Фотографическое изображение помпы для энтерального питания SN-600N/SN-600NR (1) и кабеля питания (2).

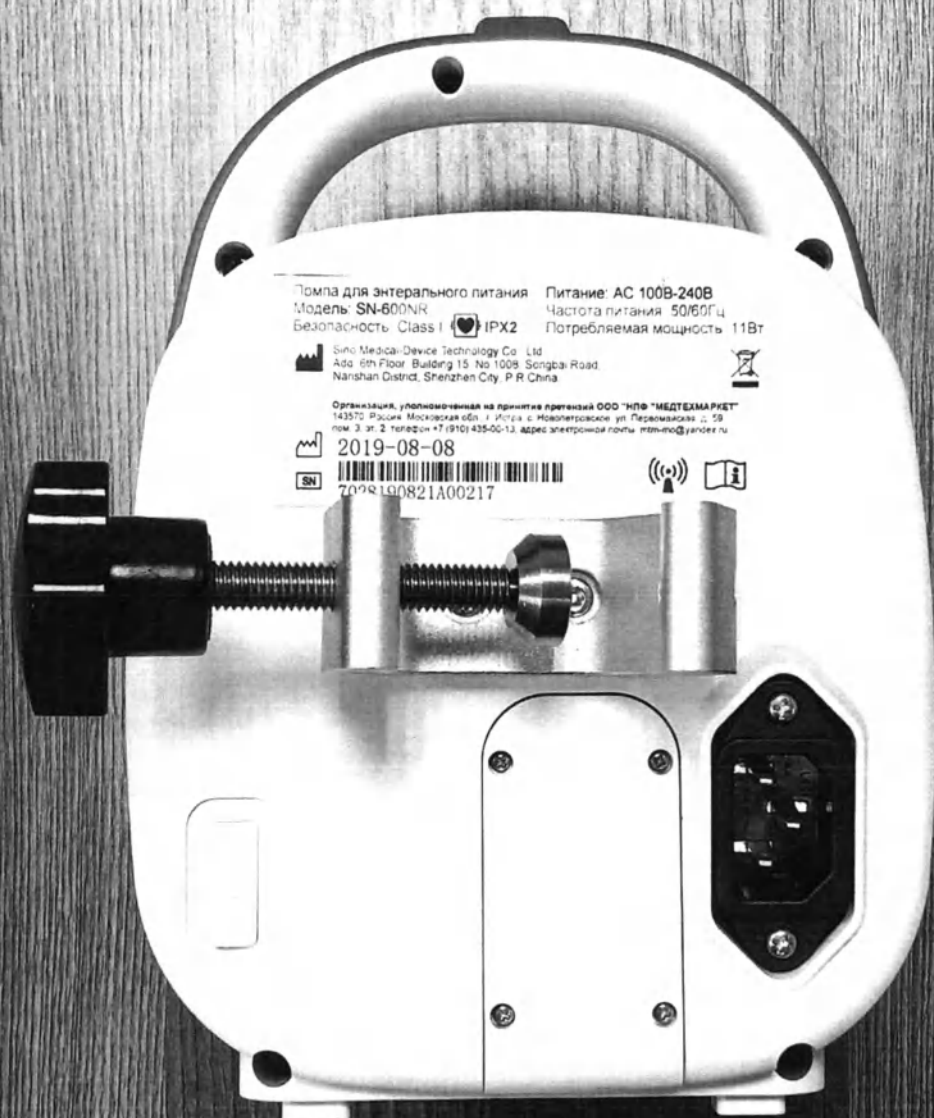


Фотографическое изображение маркировки помпы для энтерального питания SN-600NR (задняя часть корпуса).


1



2

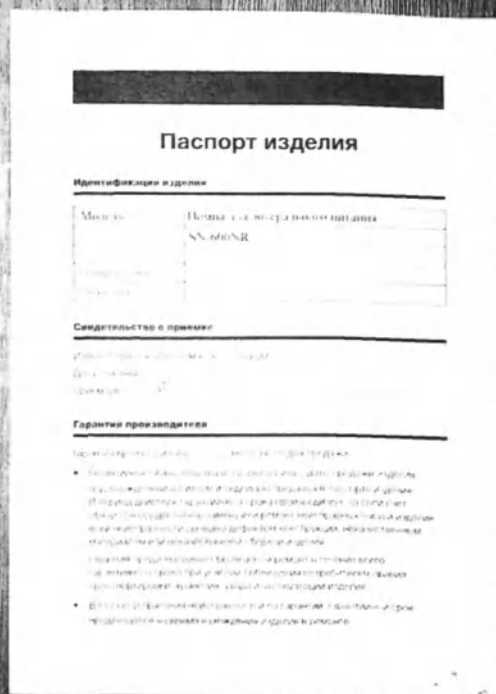

3

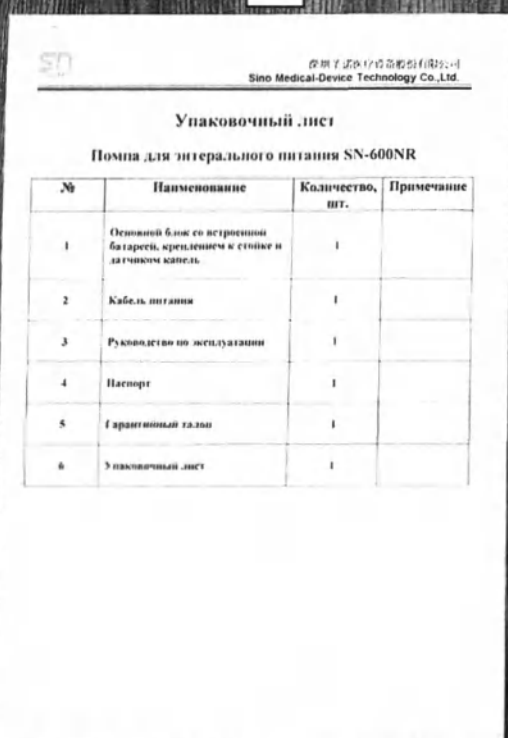


4



Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) для помпы для энтерального питания SN-600N/SN-600NR.



Фотографическое изображение помпы для энтерального питания SN-N2 (1), адаптера сетевого питания (2), датчика капель (3), переходника для коммуникационного порта (4).

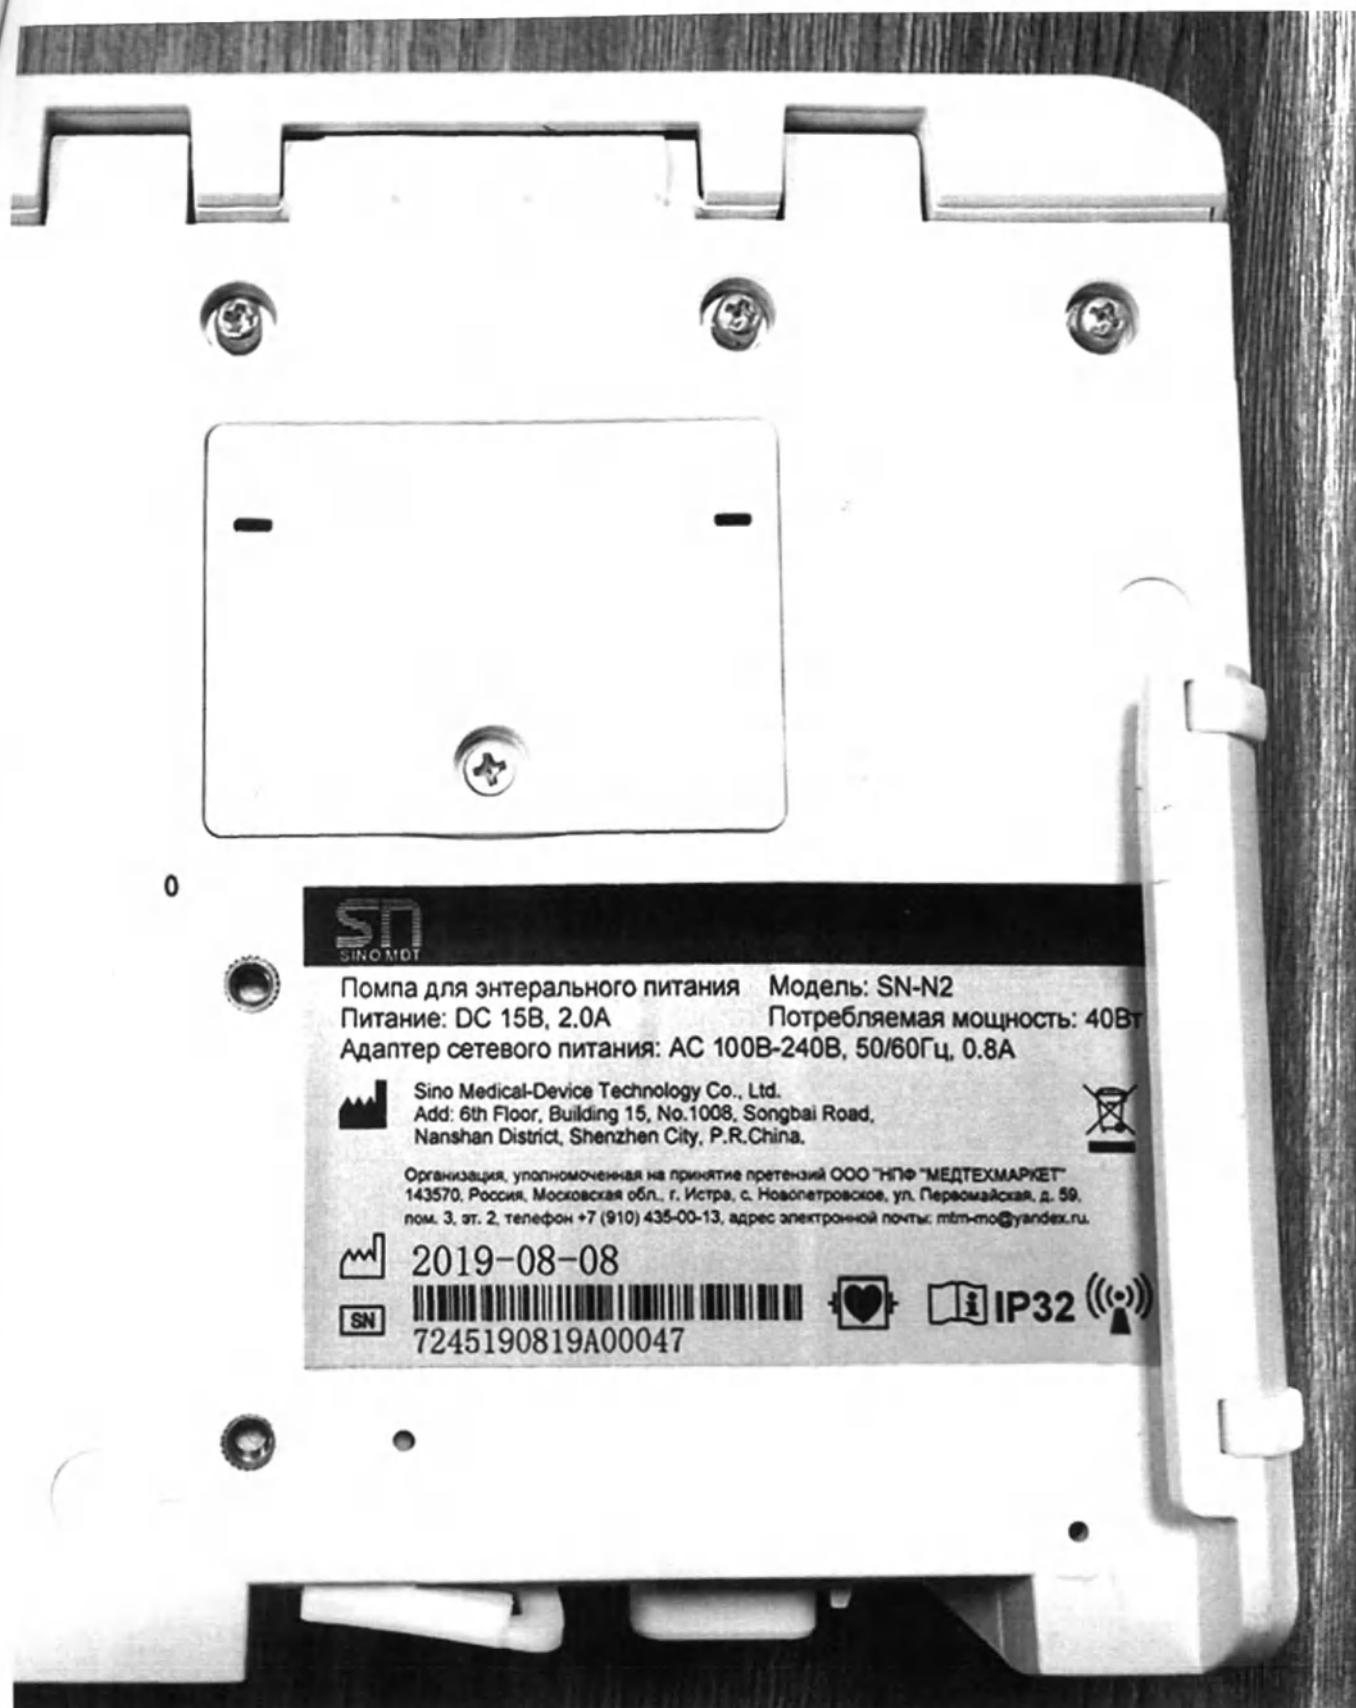


Фотографическое изображение маркировки помпы для энтерального питания SN-N2 (нижняя часть корпуса).


1



2

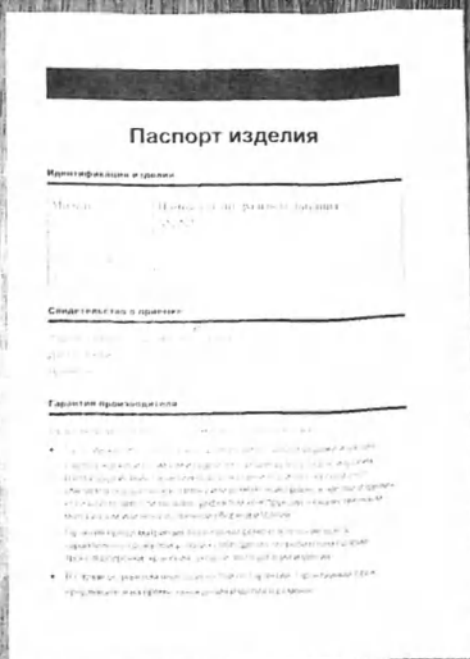

3

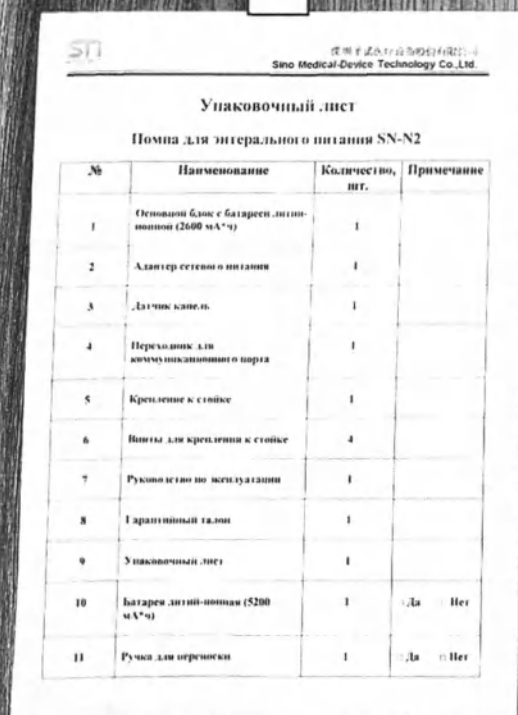

4



Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) для помпы для энтерального питания SN-N2.



Фотографическое изображение помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2 (1) и адаптера сетевого питания (2).



Фотографическое изображение маркировки помпы для энтерального питания SN-M2 (нижняя часть корпуса).

1

2

SD

深圳圣诺医疗科技股份有限公司
Sino Medical Device Technology Co., Ltd.

РАКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МН ПИЩЕВ КОМБИБИЛИ

«Помпа для энтерального питания
SN-M1/SN-M2»

Паспорт изделия

Идентификация изделия

Модель	Помпа для энтерального питания
	SN-M2
Сериальный номер	
Датум выпуска	

Содержание в комплекте

Изделие пришло в комплекте с эксплуатацией

Дата приема

Печать

Гарантия производителя

Гарантия производителя _____ месяцев со дня продажи

- Гарантийные обязательства вступают в силу с даты продажи изделия, подтвержденной штампом и подписью продавца и покупателя и приняты. В течение действия гарантийного срока производитель за свой счет обязуется осуществлять замену или ремонт неисправных частей изделия, если неисправности вызваны дефектом конструкции, некачественными материалами или некачественной сборкой изделия. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации изделия.
- В случае устранения неисправностей по гарантии, гарантийный срок продлевается на время наладки изделия в ремонт.

3

4

SD

深圳圣诺医疗科技股份有限公司
Sino Medical Device Technology Co., Ltd.

Упаковочный лист

Помпа для энтерального питания SN-M2

№	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Основной блок с батареей литий-ионной (2400 мА*ч)	1	
2	Адаптер сетевого питания	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	
4	Гарантийный талон	1	
5	Упаковочный лист	1	
6	Переходник для коммункационного порта	1	☐ Да ☐ Нет
7	Крепление к стойке	1	☐ Да ☐ Нет
8	Винты для крепления к стойке	4	☐ Да ☐ Нет
9	Батарея литий-ионная (5200 мА*ч)	1	☐ Да ☐ Нет
10	Ручка для переноса	1	☐ Да ☐ Нет

SD

Гарантийный талон

Отметка о продаже

Модель

Сериальный номер

Дата продажи _____

Подпись продавца _____


Подпись покупателя _____

Сведения об эксплуатационной организации

Имя, фамилия и адрес _____

Отвеченный за эксплуатацию изделия _____


Фотографическое изображение руководства по эксплуатации (1), паспорта (2), упаковочного листа (3) и гарантийного талона (4) для помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2.

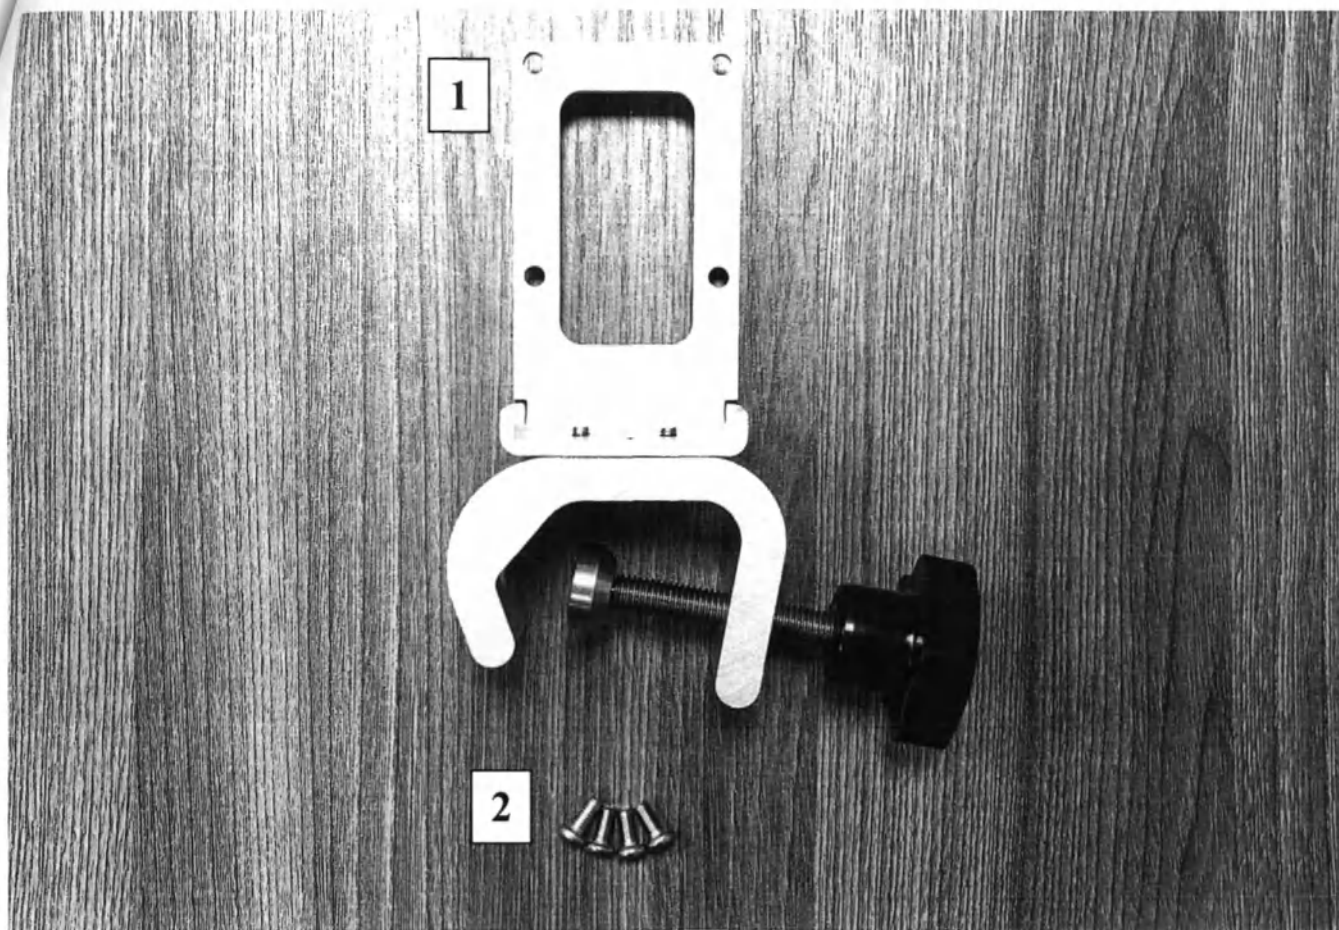

Фотографическое изображение крепления к стойке (1) и винтов для крепления к стойке (2) для помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2/SN-N2.




Фотографическое изображение переходника для коммуникационного порта для помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2/SN-N2.

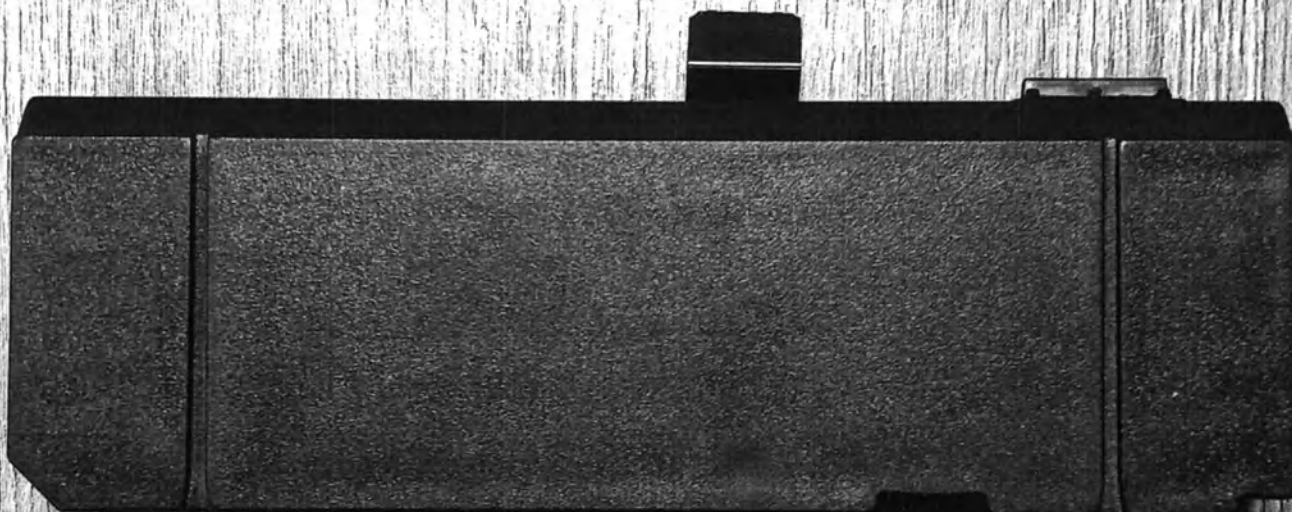


Фотографическое изображение батареи литий-ионной (2600/5200 мА*ч) для помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2/SN-N2.



Фотографическое изображение ручки для переноски для помпы для энтерального питания SN-M1/SN-M2/SN-N2.

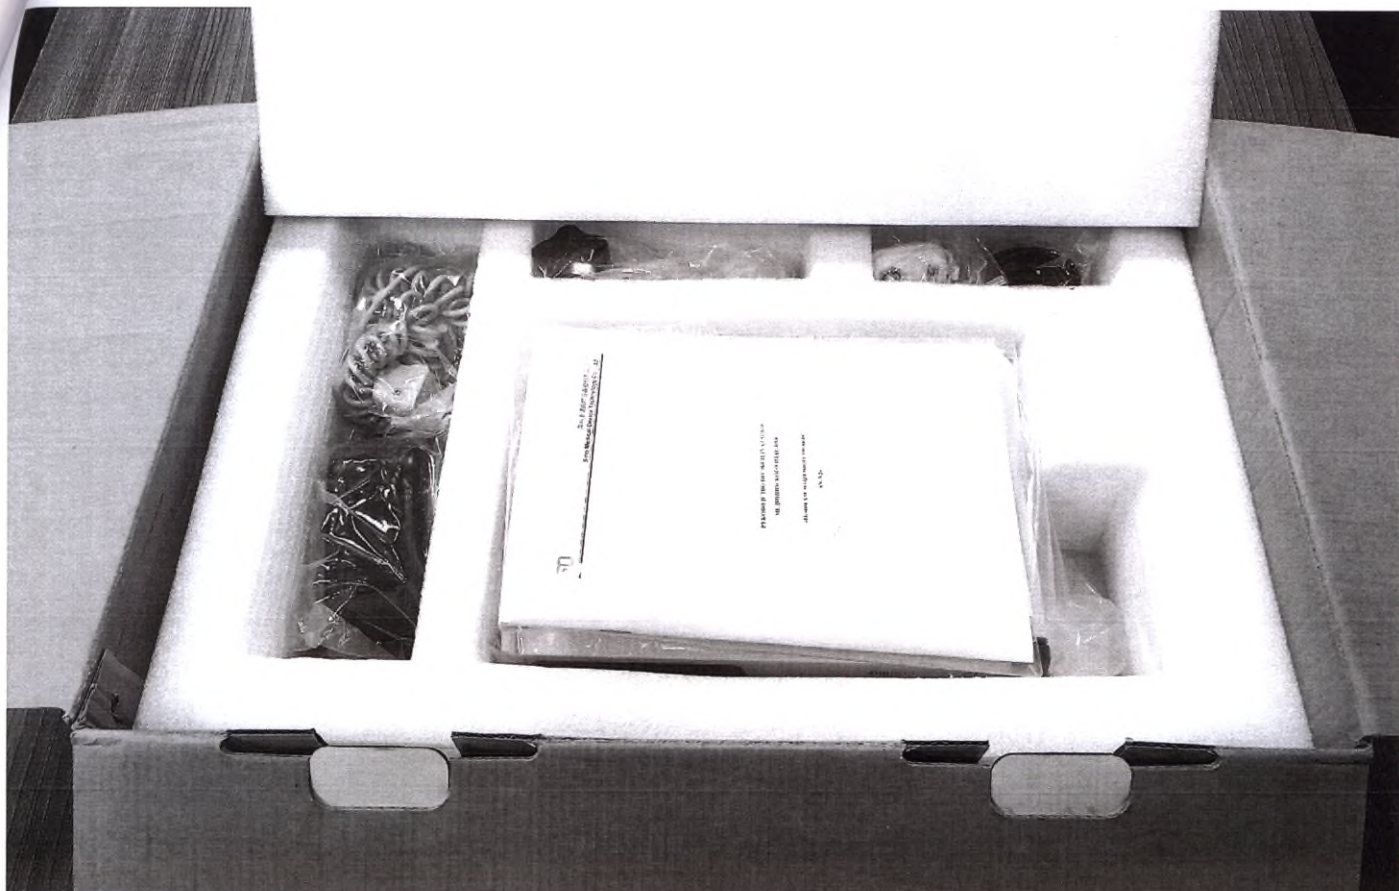

Фотографические изображения транспортной упаковки для помпы для энтерального питания SN-N2.

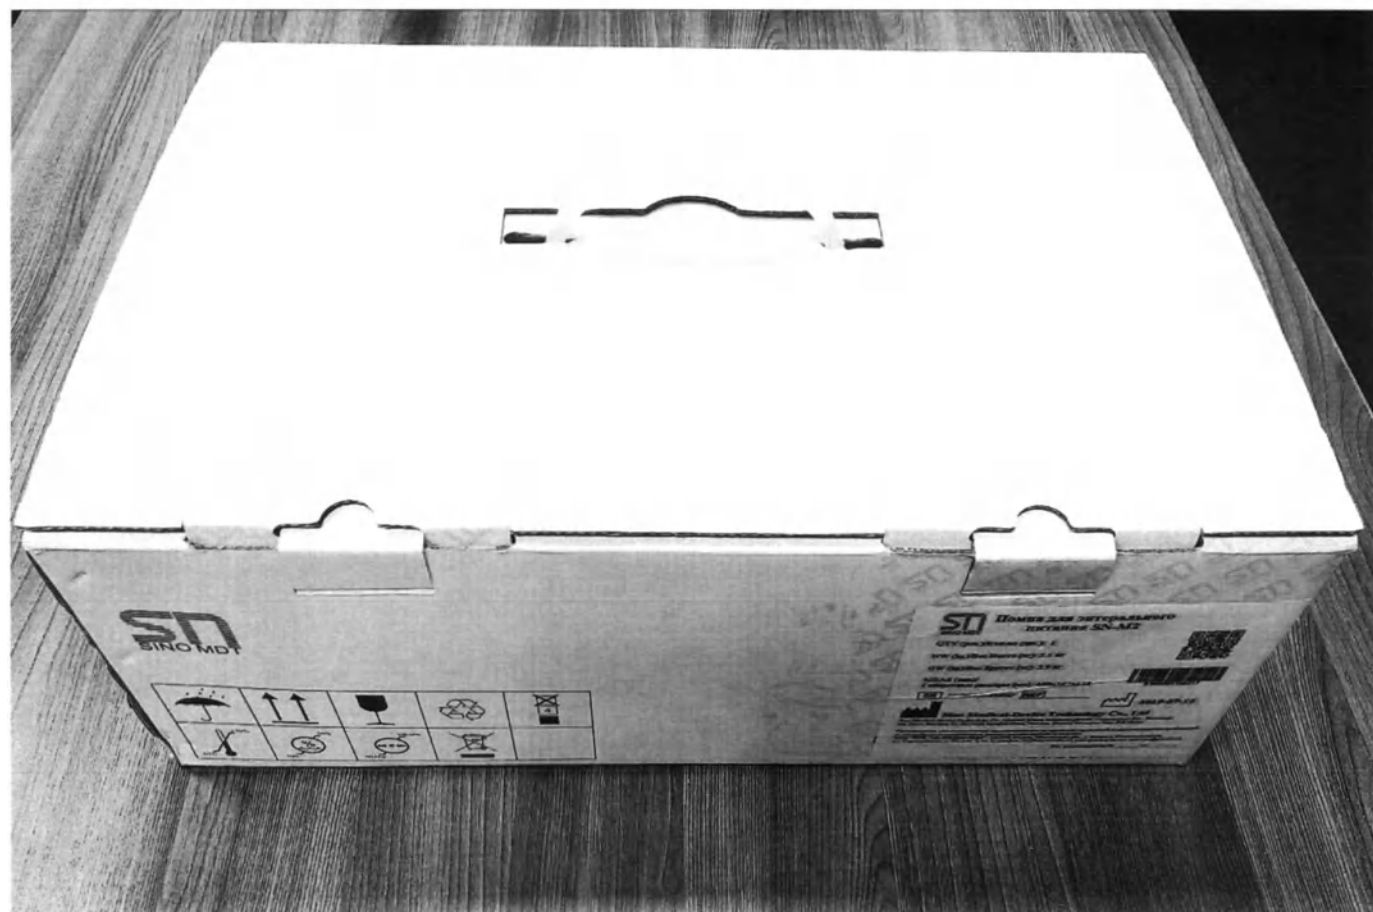

**Фотографические изображения транспортной упаковки для помпы для энтерального питания
SN-M1/SN-M2**

и скреплено печатью

16

лист

Генеральный директор ООО

«НПФ «МЕДТЕХМАРКЕТ»

Б.С. Хышиктуев

