

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»



А.Е. Ершов

20 21 г.

**Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом
и специфической сорбцией сухой
по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
АНТИТОКСИН
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ДИФТЕРИЙНЫЙ
1 мл
С
ГОДЕН ДО

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»


А.Е. Ершов

« 16 » 20 21 г.

**Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментоллизом
и специфической сорбцией сухой
по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 105x24x65 мм

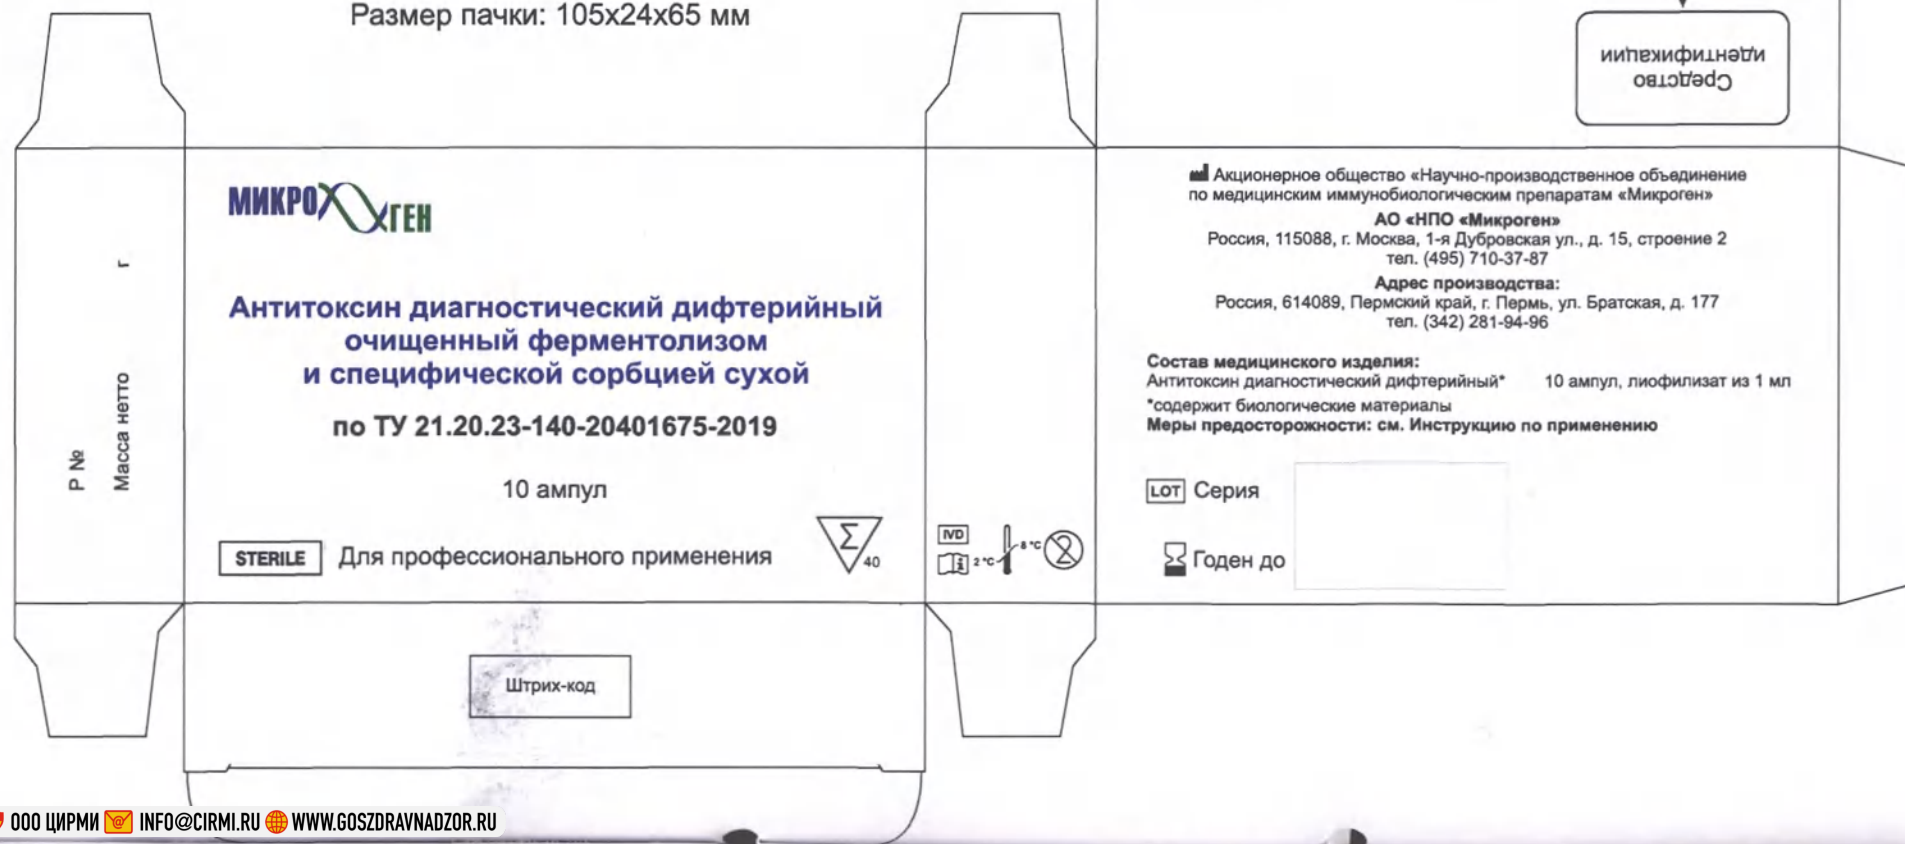

**Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом
и специфической сорбцией сухой
по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019**


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
регистрации и медицинских
исследований
АО «НПО «Микроген»

А.Е. Ершов

« 16 » 05 2021 г.

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

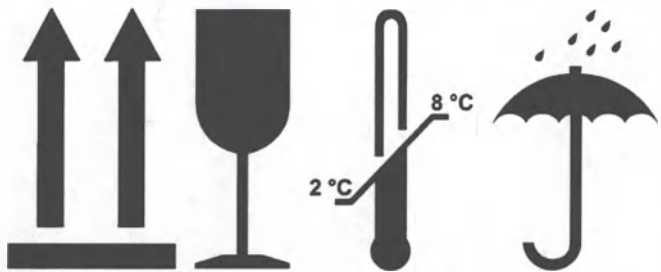 Не кантовать!	LOT Серия: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С.	МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 281-94-96
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
листа(ов)

Начальник
Управления регистрации
и медицинских исследований
АО «НПО «МИКРОГЕН»
А.Е. Ершов

Согласовано
Руководителем ИЛ
ФТБНУ Минздрава
и И.И. Мельникова



Душев (И.С. Кузнецов)