

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «МЕДСЕРВИС»

Узелкова М.Е.



«28» декабря 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Анализаторы активированного времени свертывания крови Actalyke Mini II, Actalyke XL, с принадлежностями,

производства Helena Laboratories Corp., USA, «Хелена Лабораториз Корп.», США.



Анализатор активированного времени свертывания крови Actalyke MINI II с двойным датчиком и термопринтером



Кабель питания

Helena Laboratories Point of Care

Actalyke MINI II

Анализатор активированного времени свертывания крови Actalyke MINI II




Руководство по эксплуатации

100/240 В переменного тока, 50/60 Гц
(одна ячейка / с двойным датчиком и принтером)

Руководство по эксплуатации

Helena Laboratories
Point of Care

**Actalyke
MINI II
Operator's
Manual**



Software requirements:
Microsoft Windows 95
or newer, 5.0 MB free hard disk
space, 16 MB RAM

Instructions for use:
Insert CD into CD-ROM
drive. Using Windows Explorer
or My Computer, access
the CD-ROM directory.
If needed, install the provided
Adobe Acrobat Reader software.
Open the Acrobat Reader
file folder and click on the file
Villy Adobe Acrobat Reader
installed. Read the provided
Operator's Manual file.

**Part Number 8JM22506
Rev. C**

Helena Laboratories, Inc. 800.225.0030 02/99

Руководство по эксплуатации на CD-диске

Сведения об установке

Рулон бумаги для термопринтера




Анализатор активированного времени свертывания крови Actalyke XL с двойным датчиком и термопринтером



Кабель питания

Actalyke XL

Анализатор активированного времени свертывания крови Actalyke XL

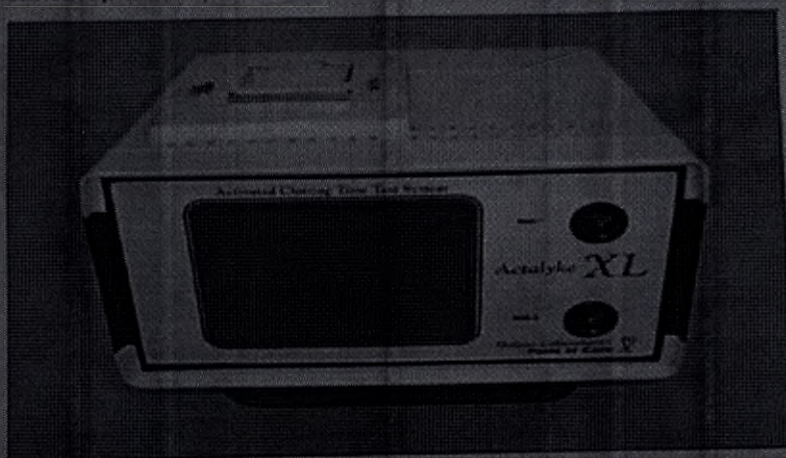

Руководство по эксплуатации

100/240 В переменного тока, 50/60 Гц

Руководство по эксплуатации

Actalyke XL Program Disk

Version 1.70 8PF20603 Rev. J

For use with Helena Actalyke XL

**Caution: Do not store near
magnetic or electromagnetic source**

**Helena Laboratories
Beaumont, Texas USA**

**8C206006H
03/09**

Дискета с ПО

Unit Serial # _____

_____ of Functionality

Well #2 _____

☐ Acceptable

Used _____

Test Well #1 _____

Test Well #2 _____

☐ Acceptable

☐ Unacceptable

Instrument Accepted _____

Installer Signature _____

Date _____


Return this form to Helena Laboratories Electronic Service Department, PO Box 752, Beaumont, Texas 77704-0752 or fax to (409)842-6241.

©January, 2002
Helena Laboratories

D4000068A
1/02

Сведения об установке

Рулон бумаги для термопринтера

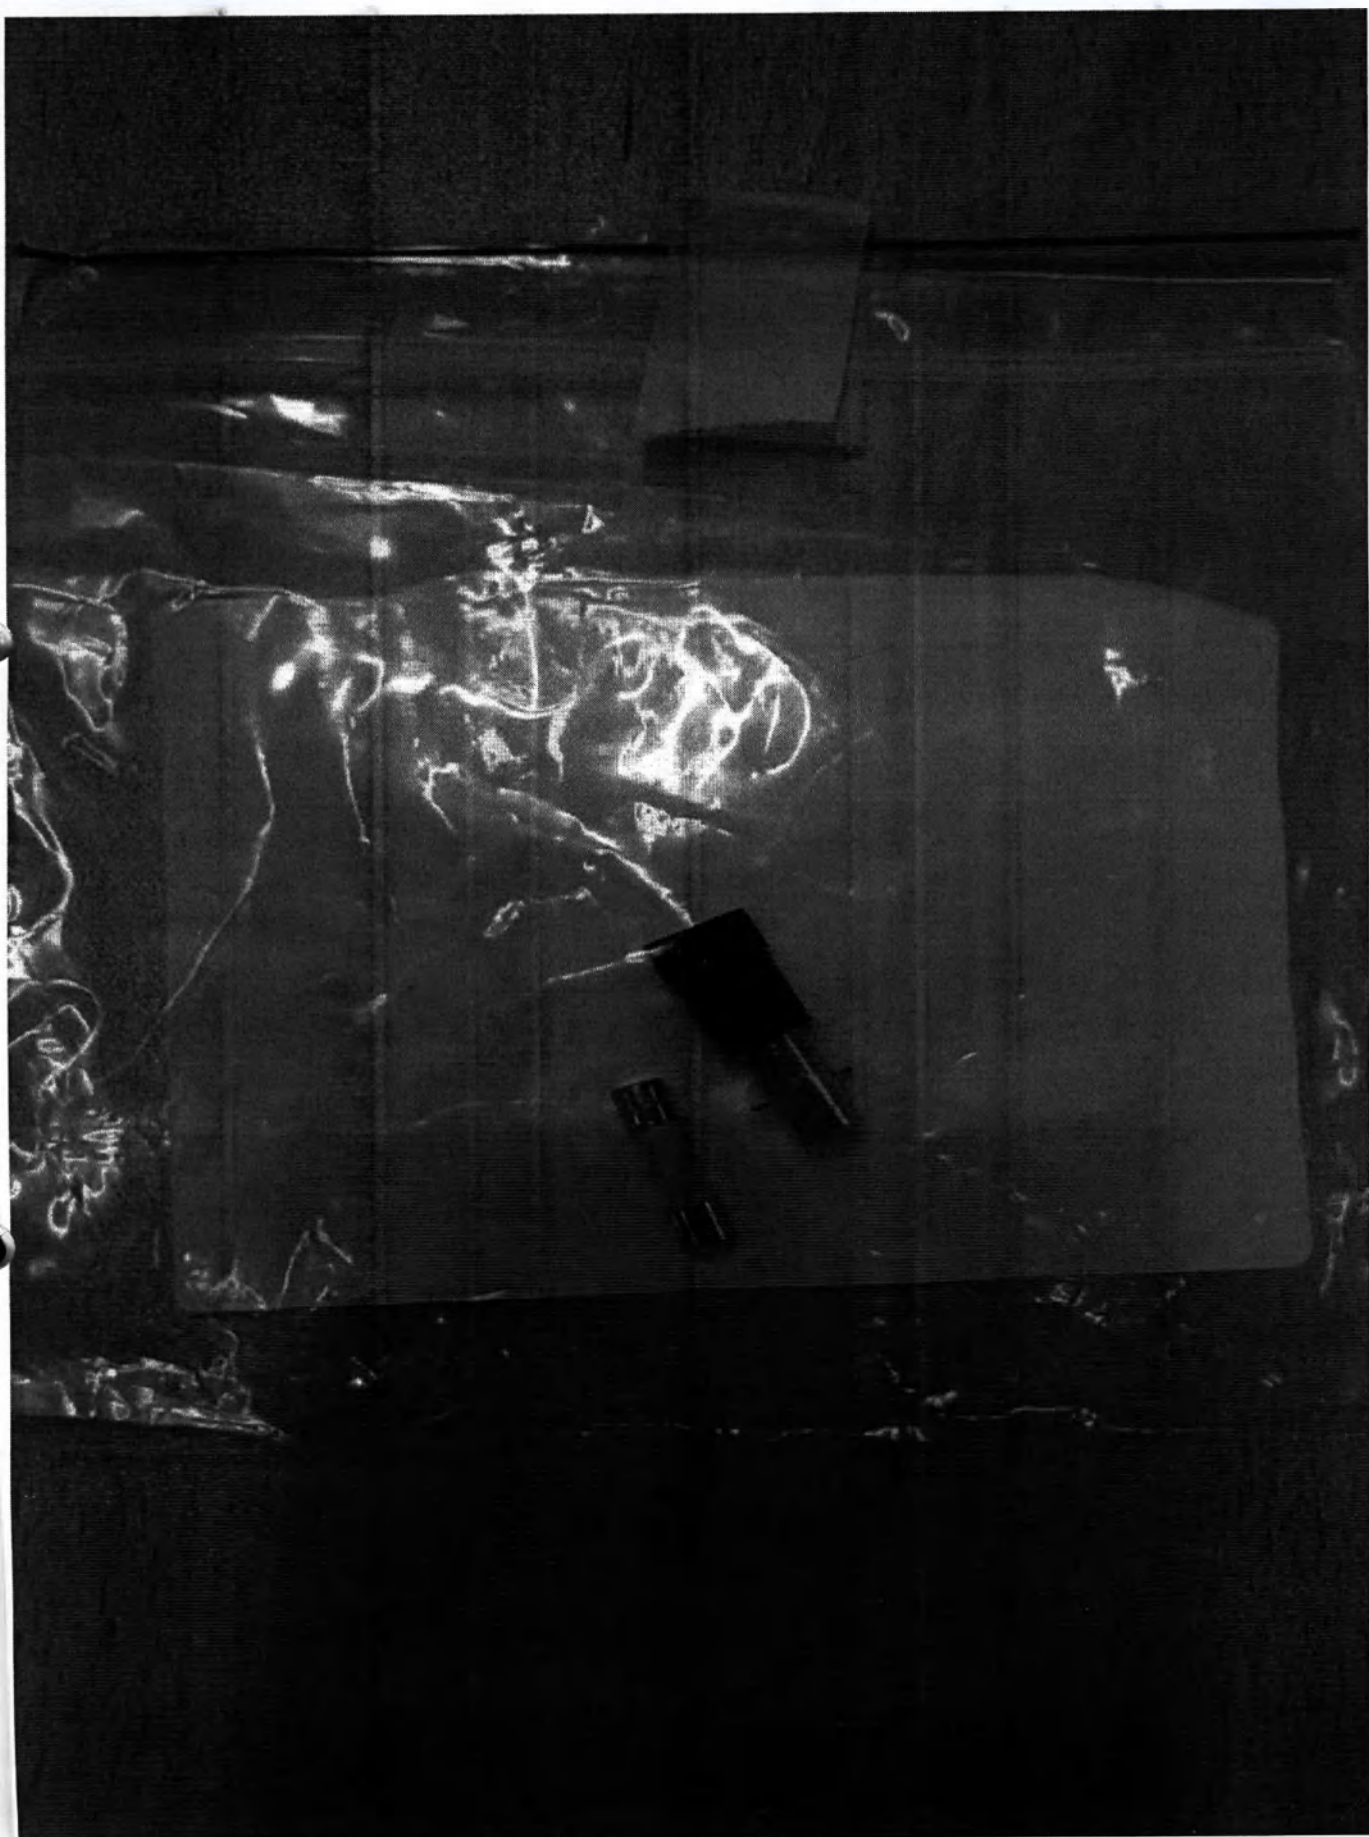

Предохранитель F2 с держателем

Прошито и скреплено печатью

14 листов

Директор АО «МЕДСЕРВИС»

 М.Е. Узелкова

